

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 13.12.23Г
СЫСОВА П.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ




Сюн Вэй

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Насос инфузионный в вариантах исполнения
BeneFusion iVP, BeneFusion uVP**

**производства: Шэньчжэнь Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.), Китай**

2024

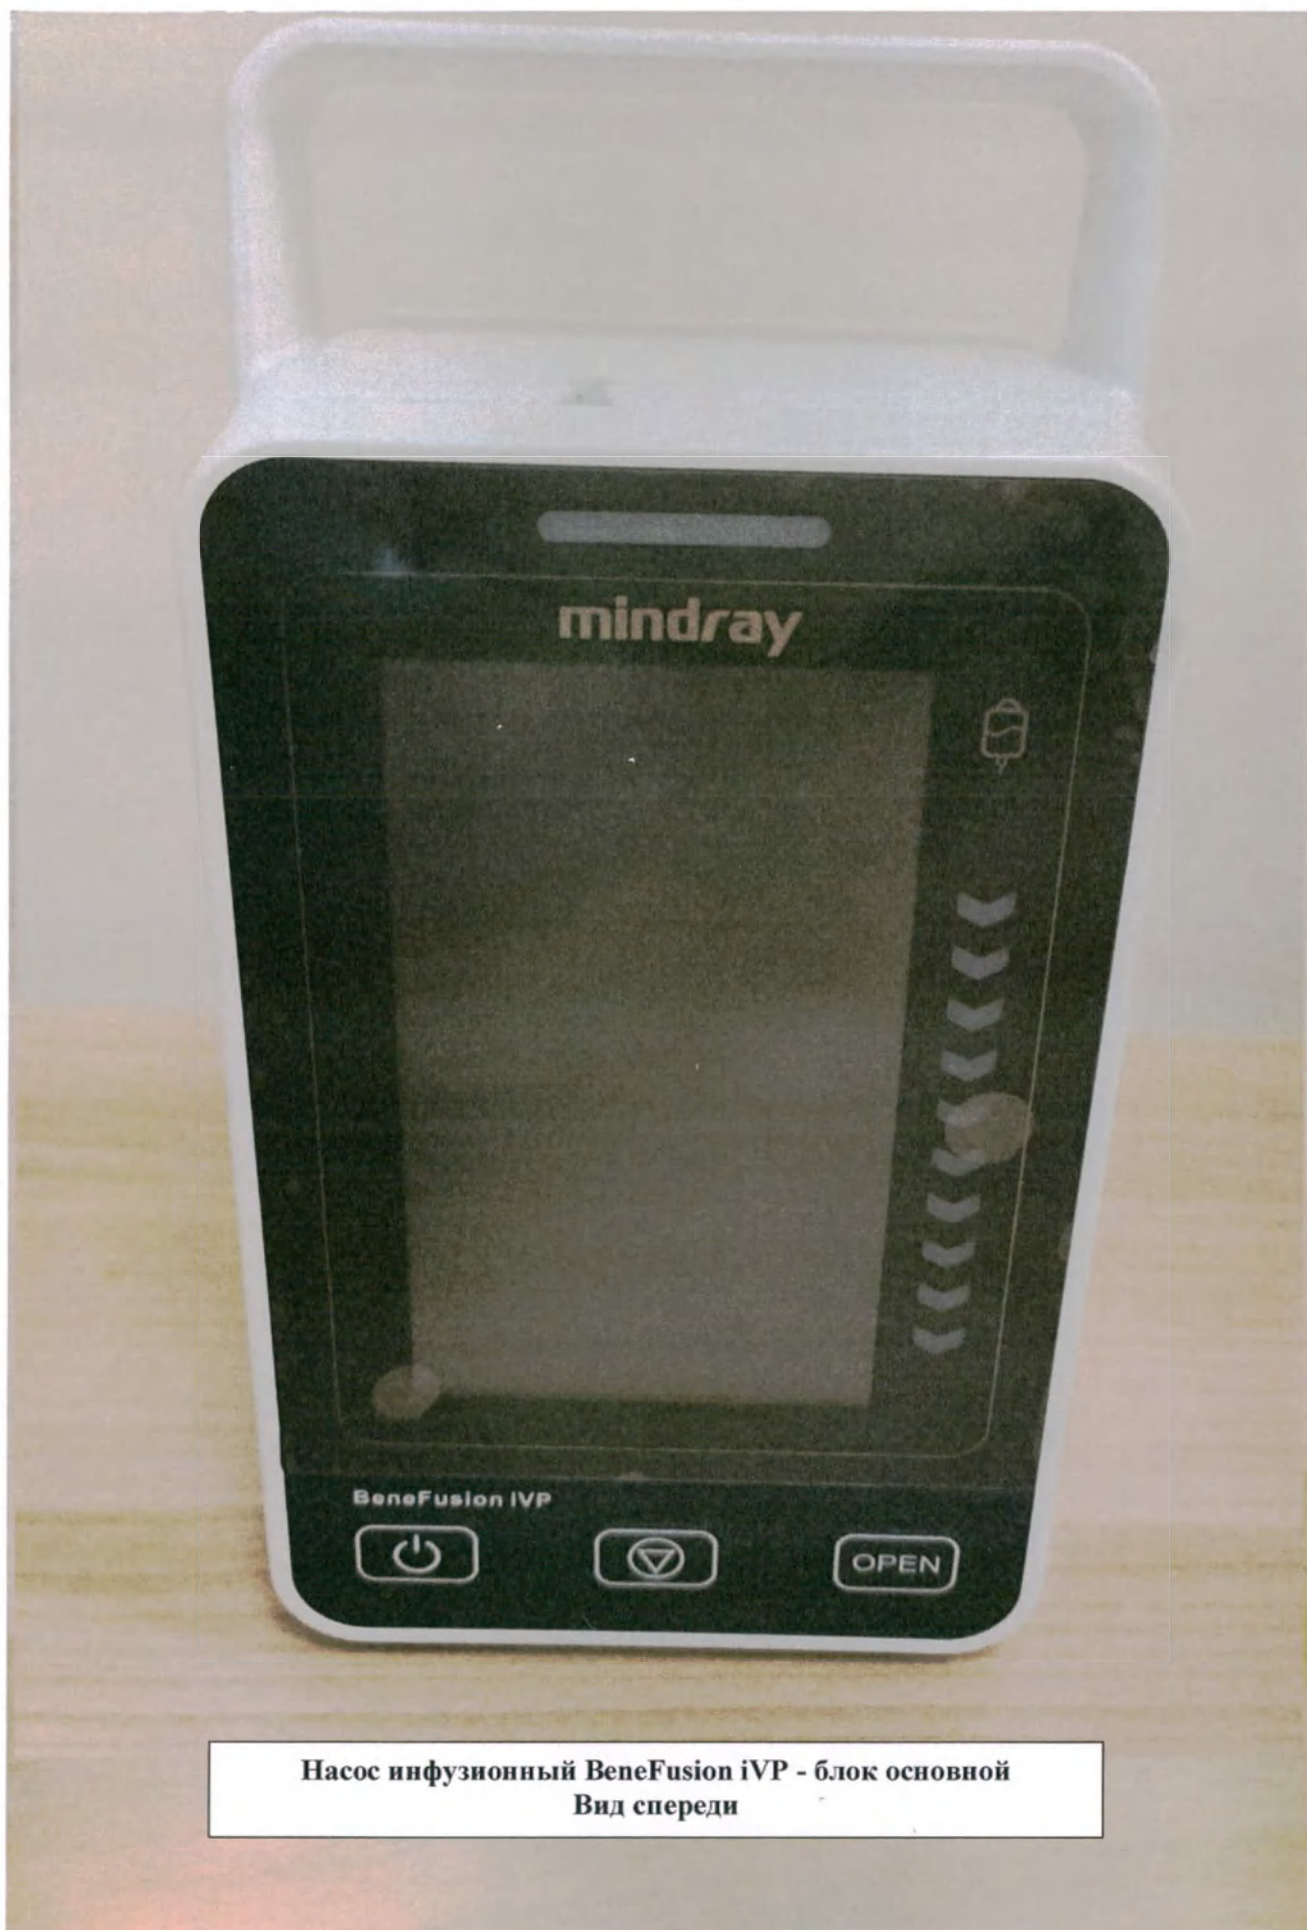

**Насос инфузионный BeneFusion iVP - блок основной
Вид спереди**


**Разъем
многофункциональный**



**Насос инфузионный BeneFusion iVP - блок основной
с установленным зажимом-фиксатором для крепления на стойке
(стандартный) и с разъемом функциональным. Вид сзади**




Насос инфузионный BeneFusion iVP - блок основной без разъема многофункционального. Вид сзади

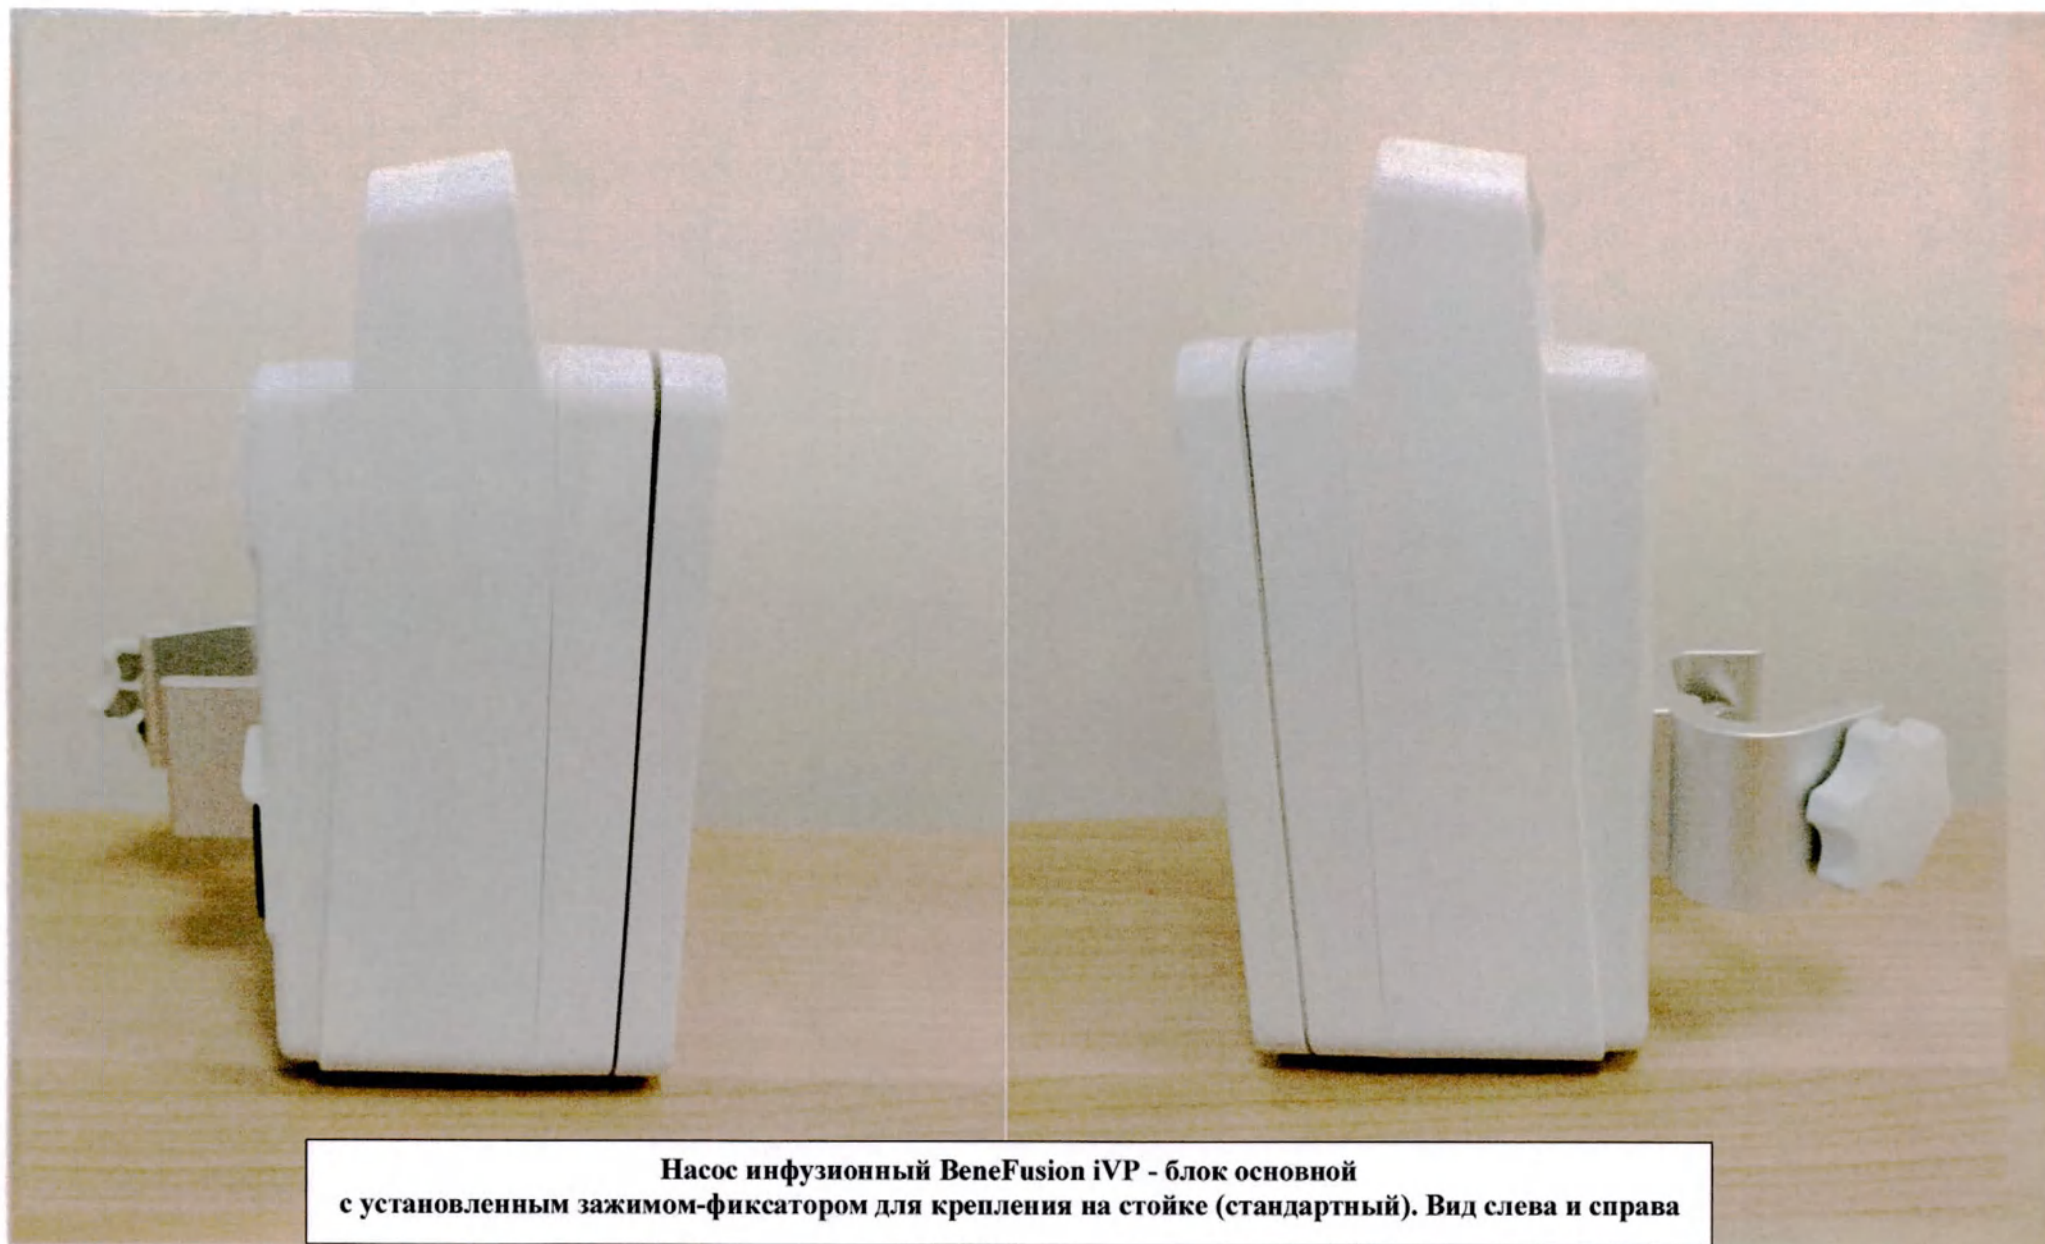


Насос инфузионный BeneFusion iVP - блок основной
с установленным зажимом-фиксатором для крепления на стойке (стандартный). Вид сверху и снизу



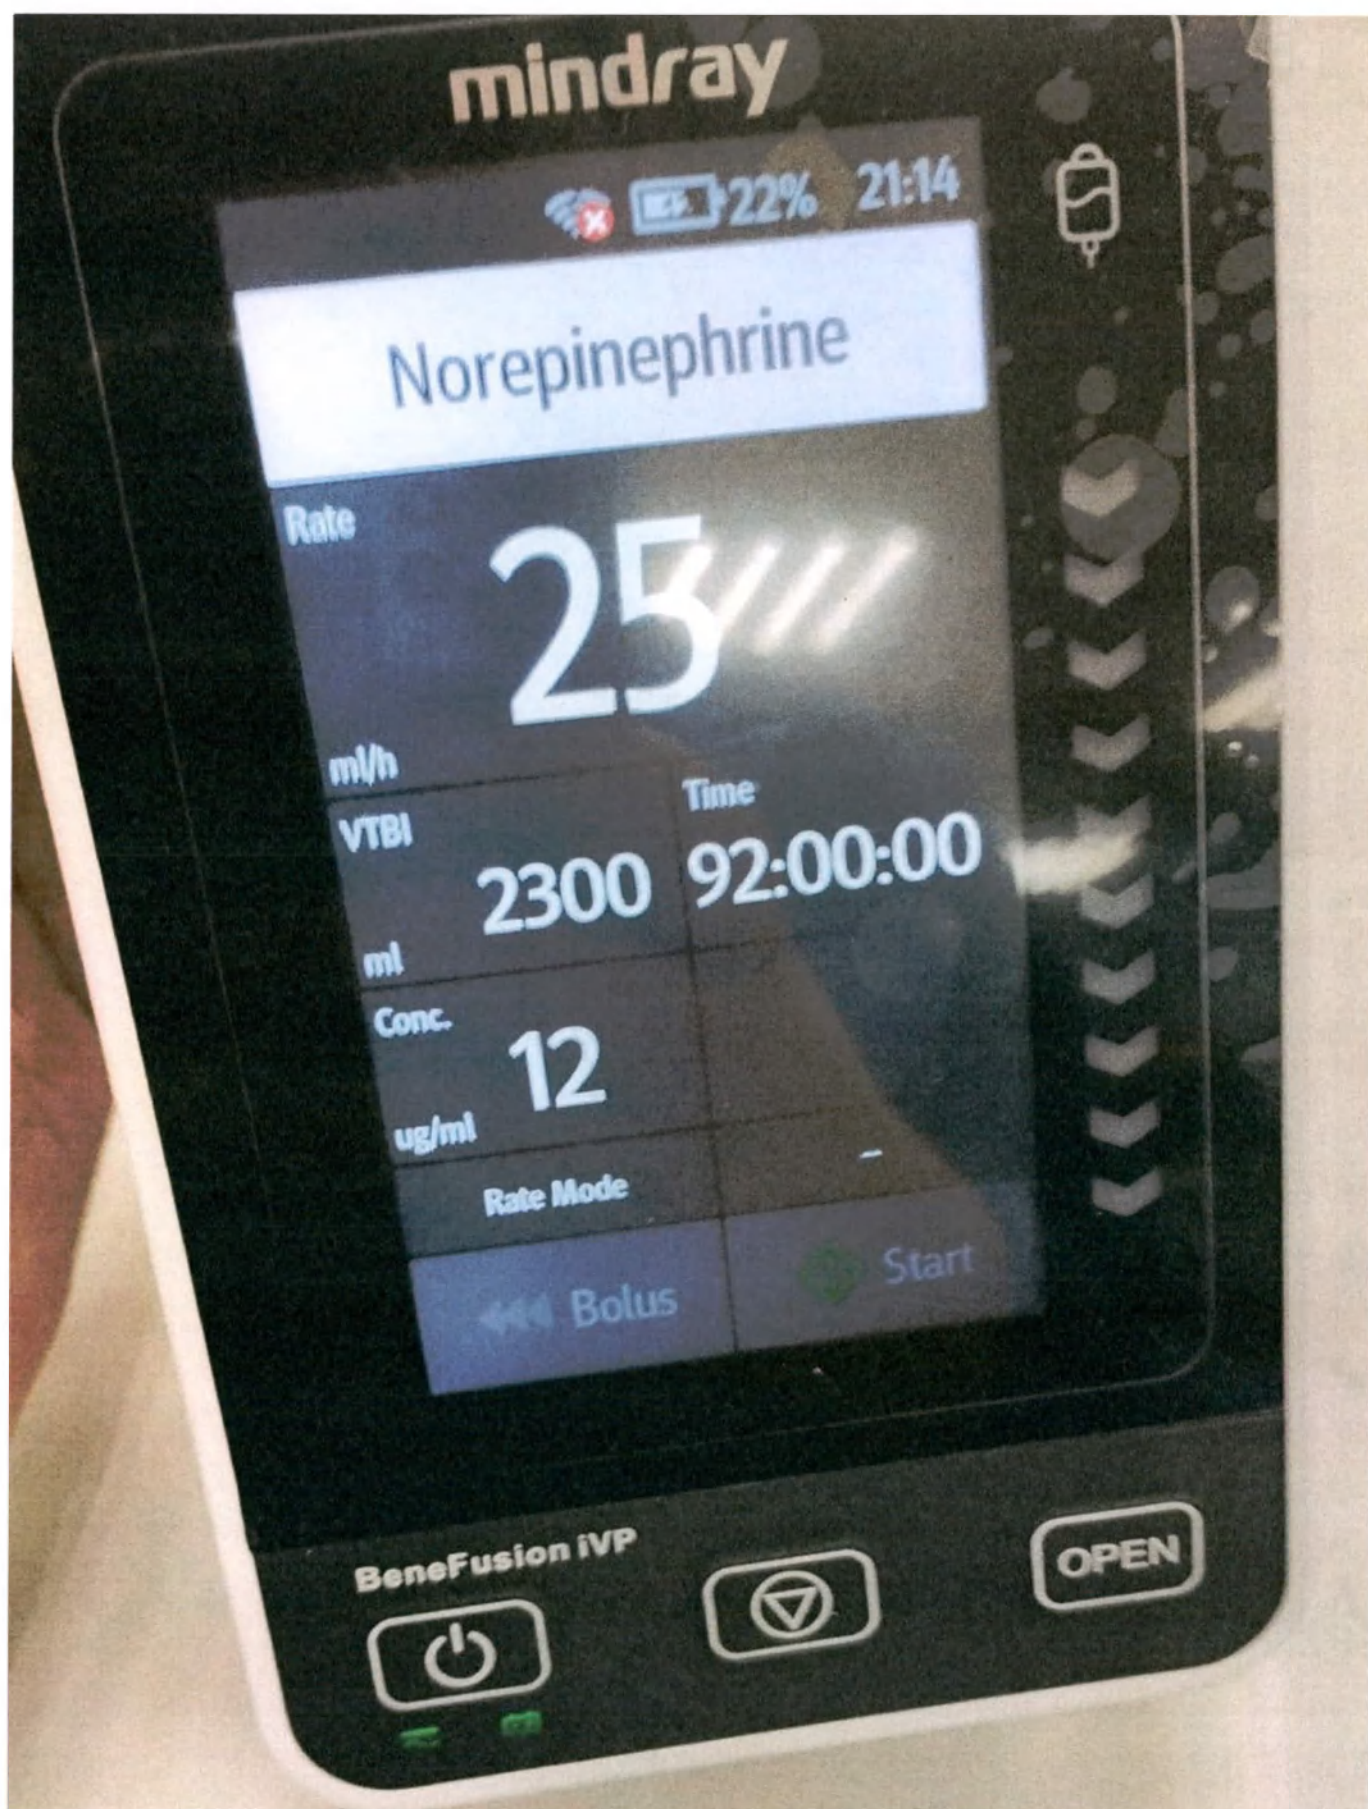


Насос инфузионный BeneFusion iVP - блок основной с включенным экраном.
Вид спереди

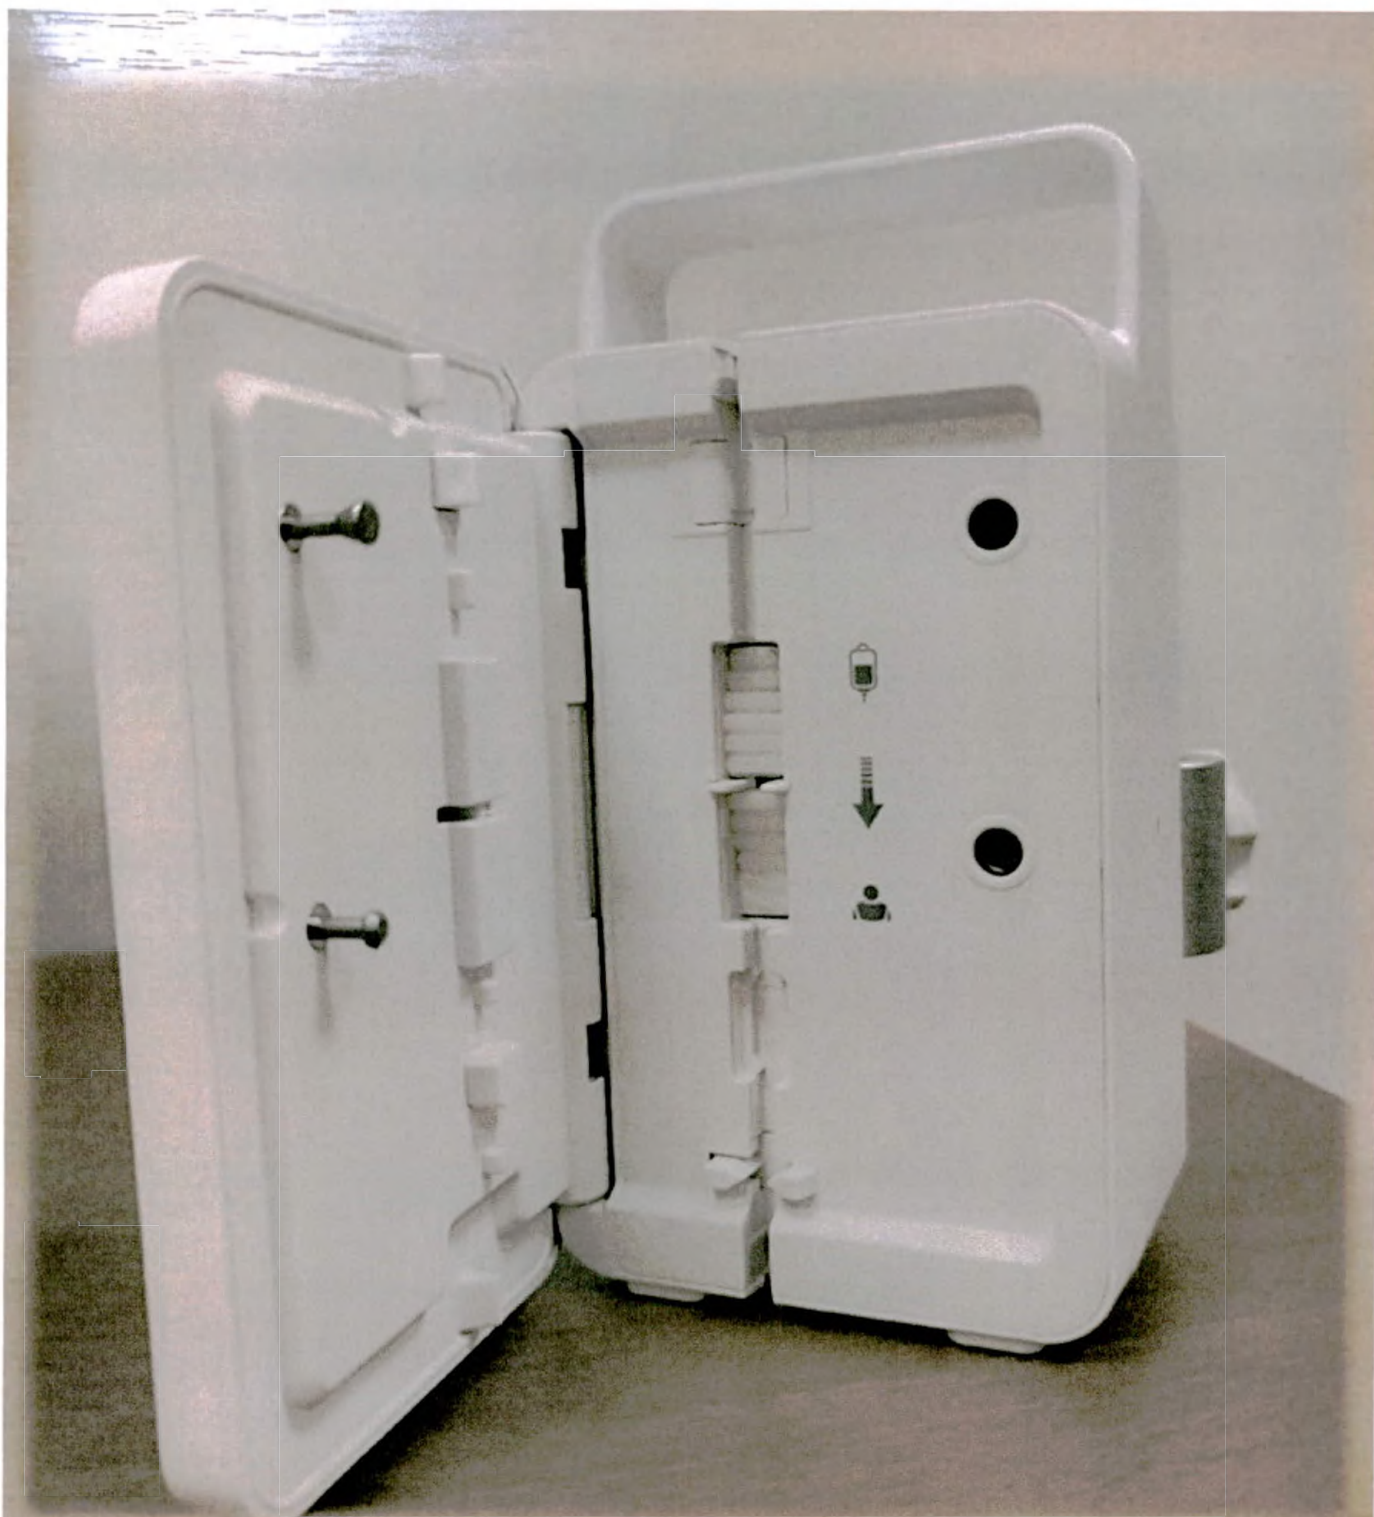


**Насос инфузионный BeneFusion iVP - блок основной с открытой дверцей.
Вид спереди**



Насос инфузионный BeneFusion iVP – маркировка на корпусе блока основного

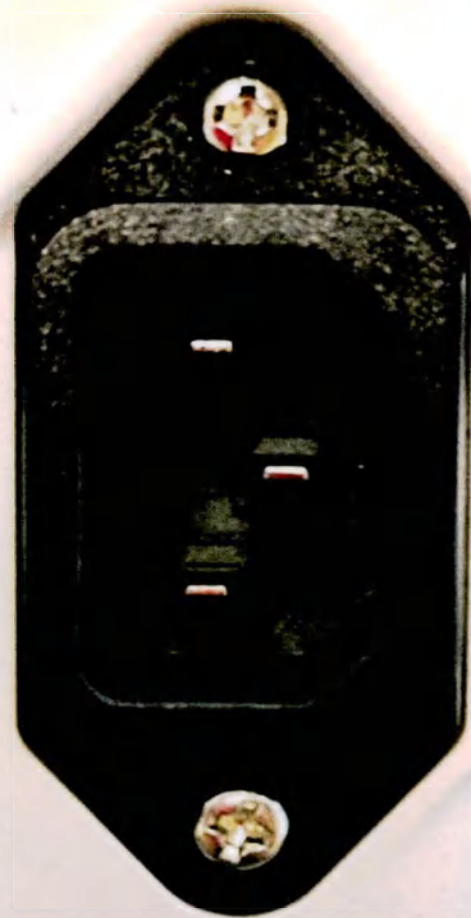


100-240V~
50/60Hz
0.30-0.13A

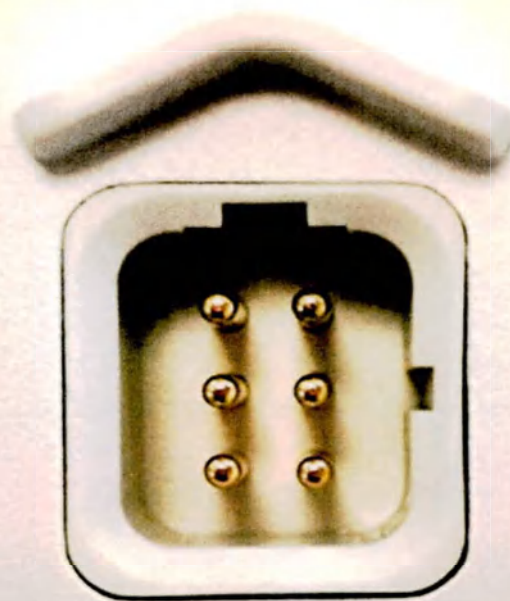

10-16V=
2.0-1.3A



Насос инфузионный BeneFusion iVP – маркировка на корпусе блока основного
вблизи мест электрических соединений

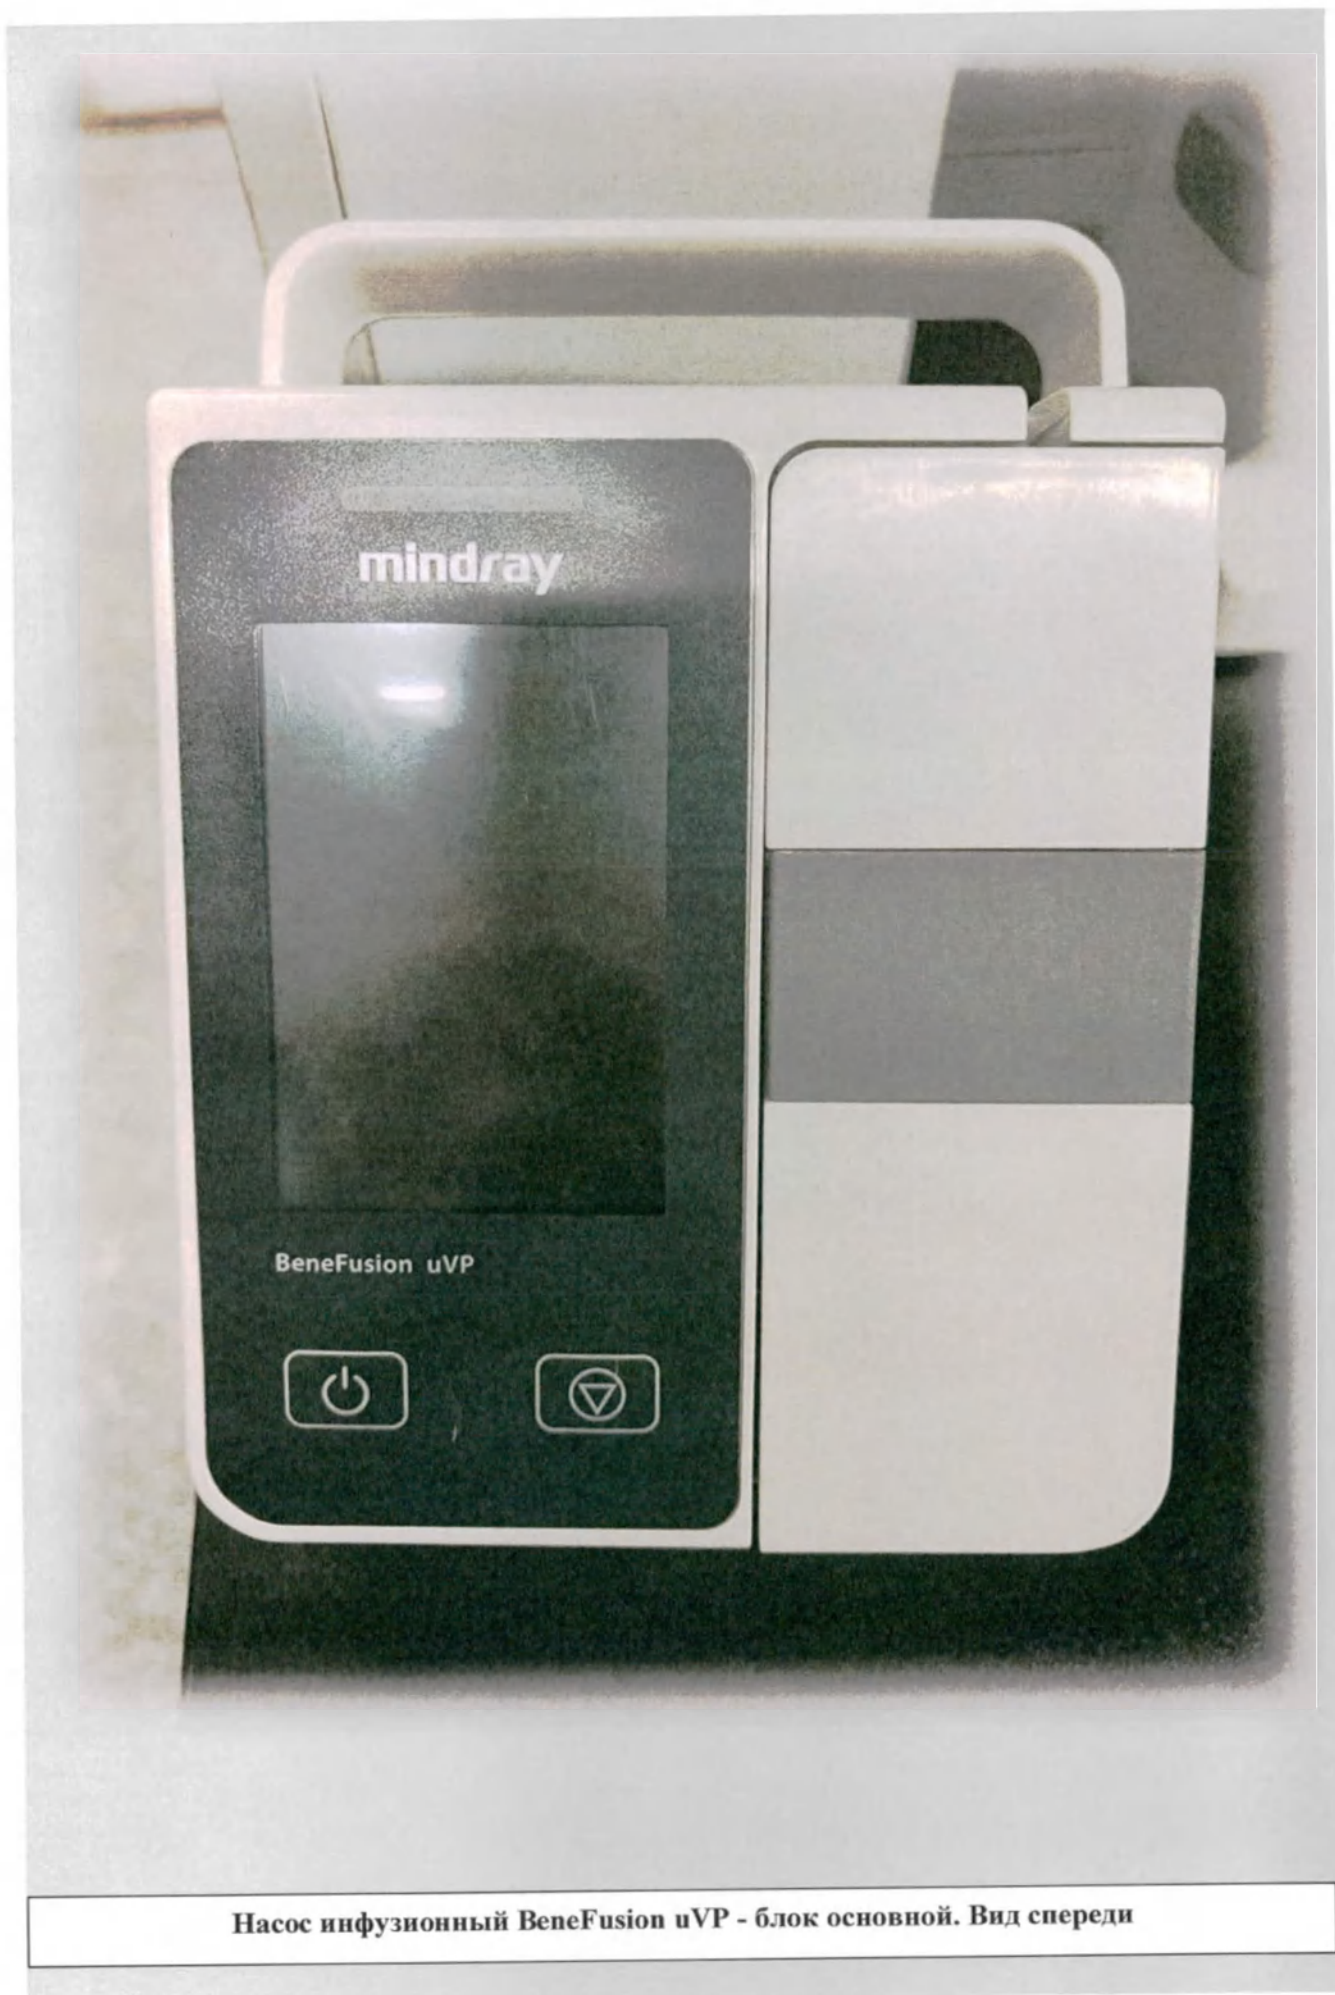

Насос инфузионный BeneFusion uVP - блок основной. Вид спереди



**Насос инфузионный BeneFusion uVP - блок основной без разъема
многофункционального. Вид сзади**




Насос инфузионный BeneFusion uVP – маркировка на корпусе блока основного

可充电锂离子电池
Rechargeable Li-ion Battery

Model No. LI131001G
31NR19/66
DC10.8V 2900mAh 31.32Wh

⊕ Red
⊖ Black

S/N: I01100G-B2419000805



警告:

使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。切勿挤压、刺破、拆卸或使电池短路。切勿放置于火中或水中。在-20°C (-4°F) 到60°C (140°F) 温度下存储。只能使用指定的充电器。请阅读本产品的操作说明。

CAUTION:

Risk of fire, explosion or burns. Do not crush, puncture, disassemble or short circuit the battery. Do not dispose of the battery in fire or water. Store the battery in the -20°C (-4°F) to 60°C (140°F) environment. Use the specified charger only. Read instructions for use.


mindray

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

中国制造
MADE IN CHINA


Смарт-аккумулятор. Вид спереди. Маркировка на корпусе

Кабель питания. Вид сверху. Маркировка

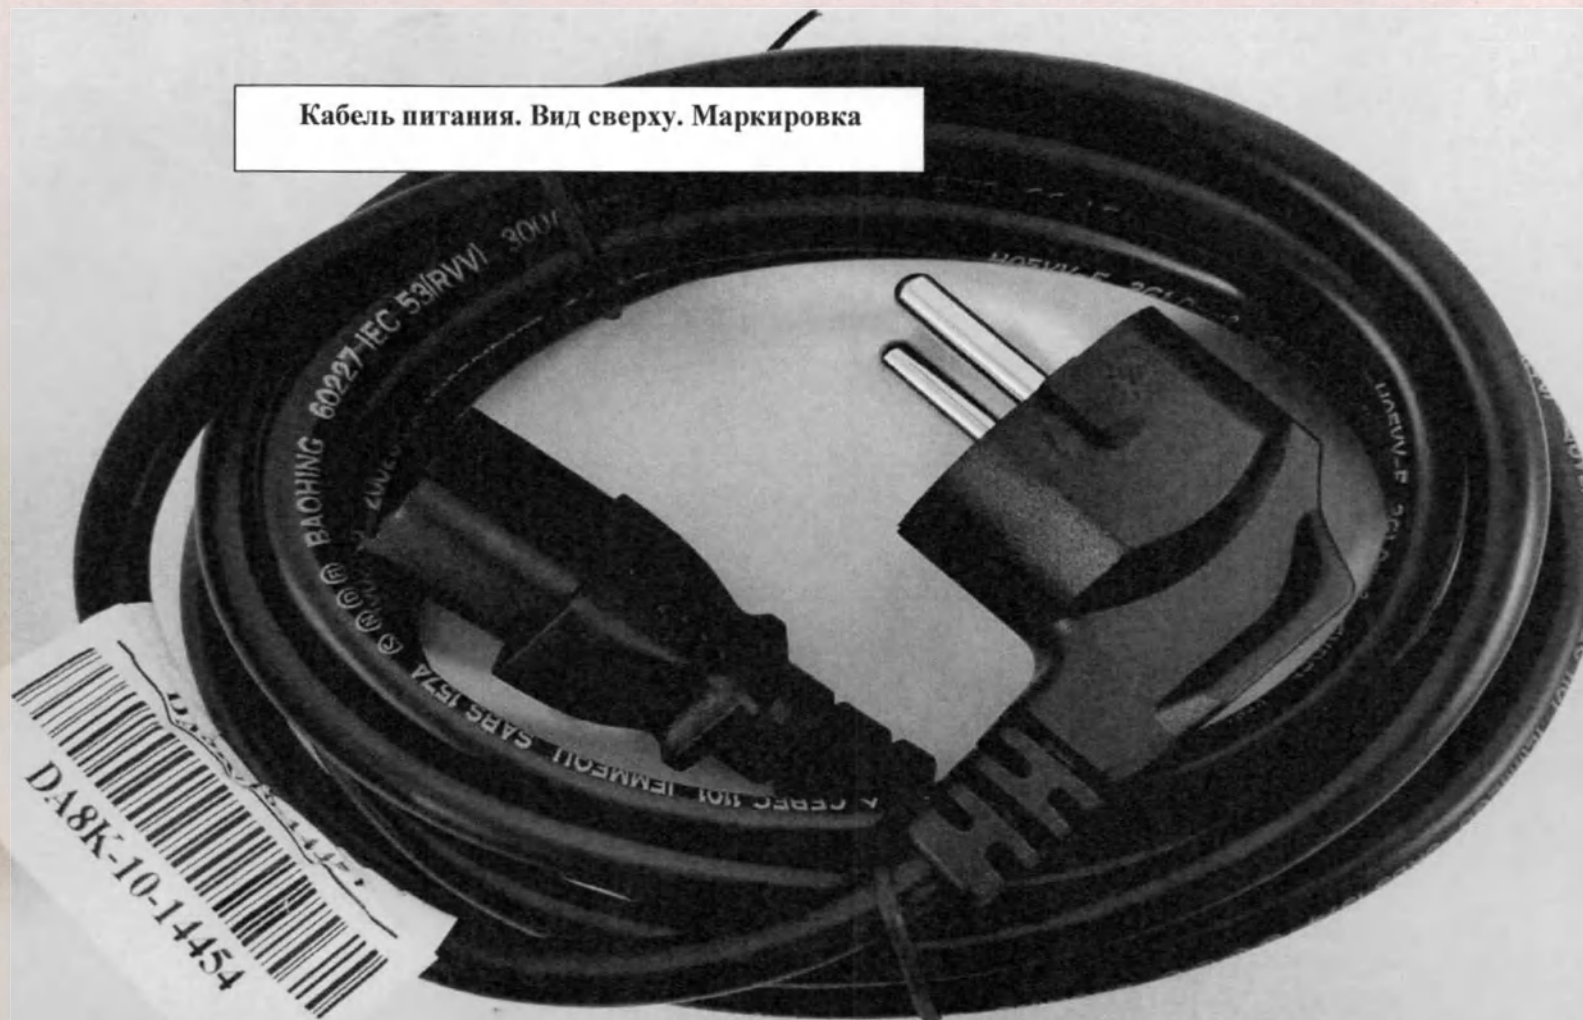

Зажим-фиксатор для крепления на стойке (стандартный). Вид сверху



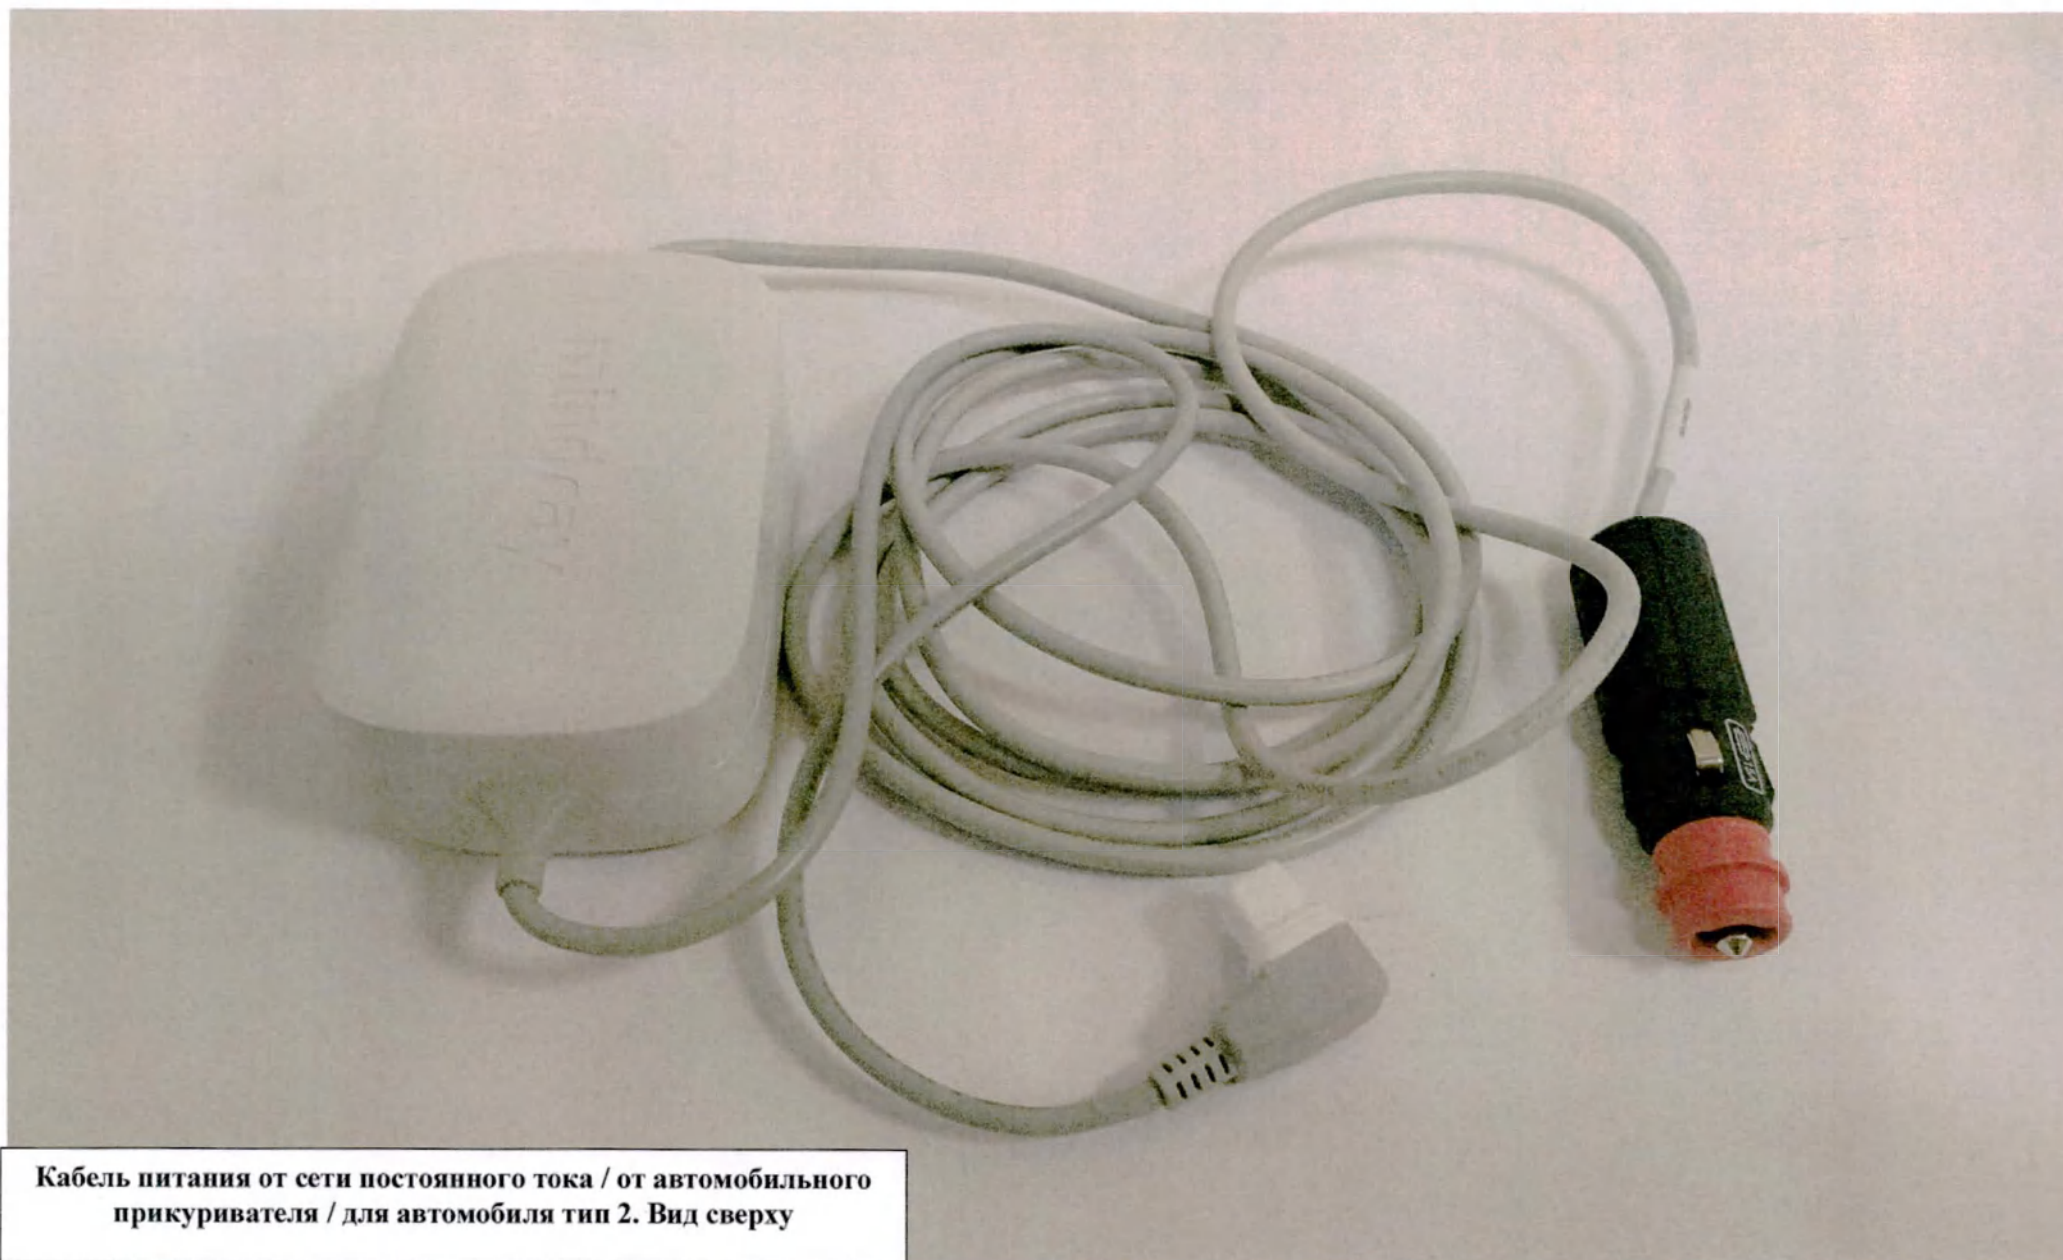

Кабель питания от сети постоянного тока / от автомобильного прикуривателя / для автомобиля тип 2. Вид сверху

Кабеля питания от сети постоянного тока / от автомобильного прикуривателя / для автомобиля тип 2 –
маркировка на корпусе

i/u系直流适配器
i/u Series DC Adapter

SN SN-120230425001


2023-04-28

UDI

(01)06946988800628

(11)230428

(21)SN-120230425001



10-16V

4A MAX

深圳迈瑞科技有限公司

住所: 深圳市光明区玉塘街道南环大道1203号2号楼6楼 邮编: 518106

SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. Made in China




6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block,
Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)


EC REP

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg Germany



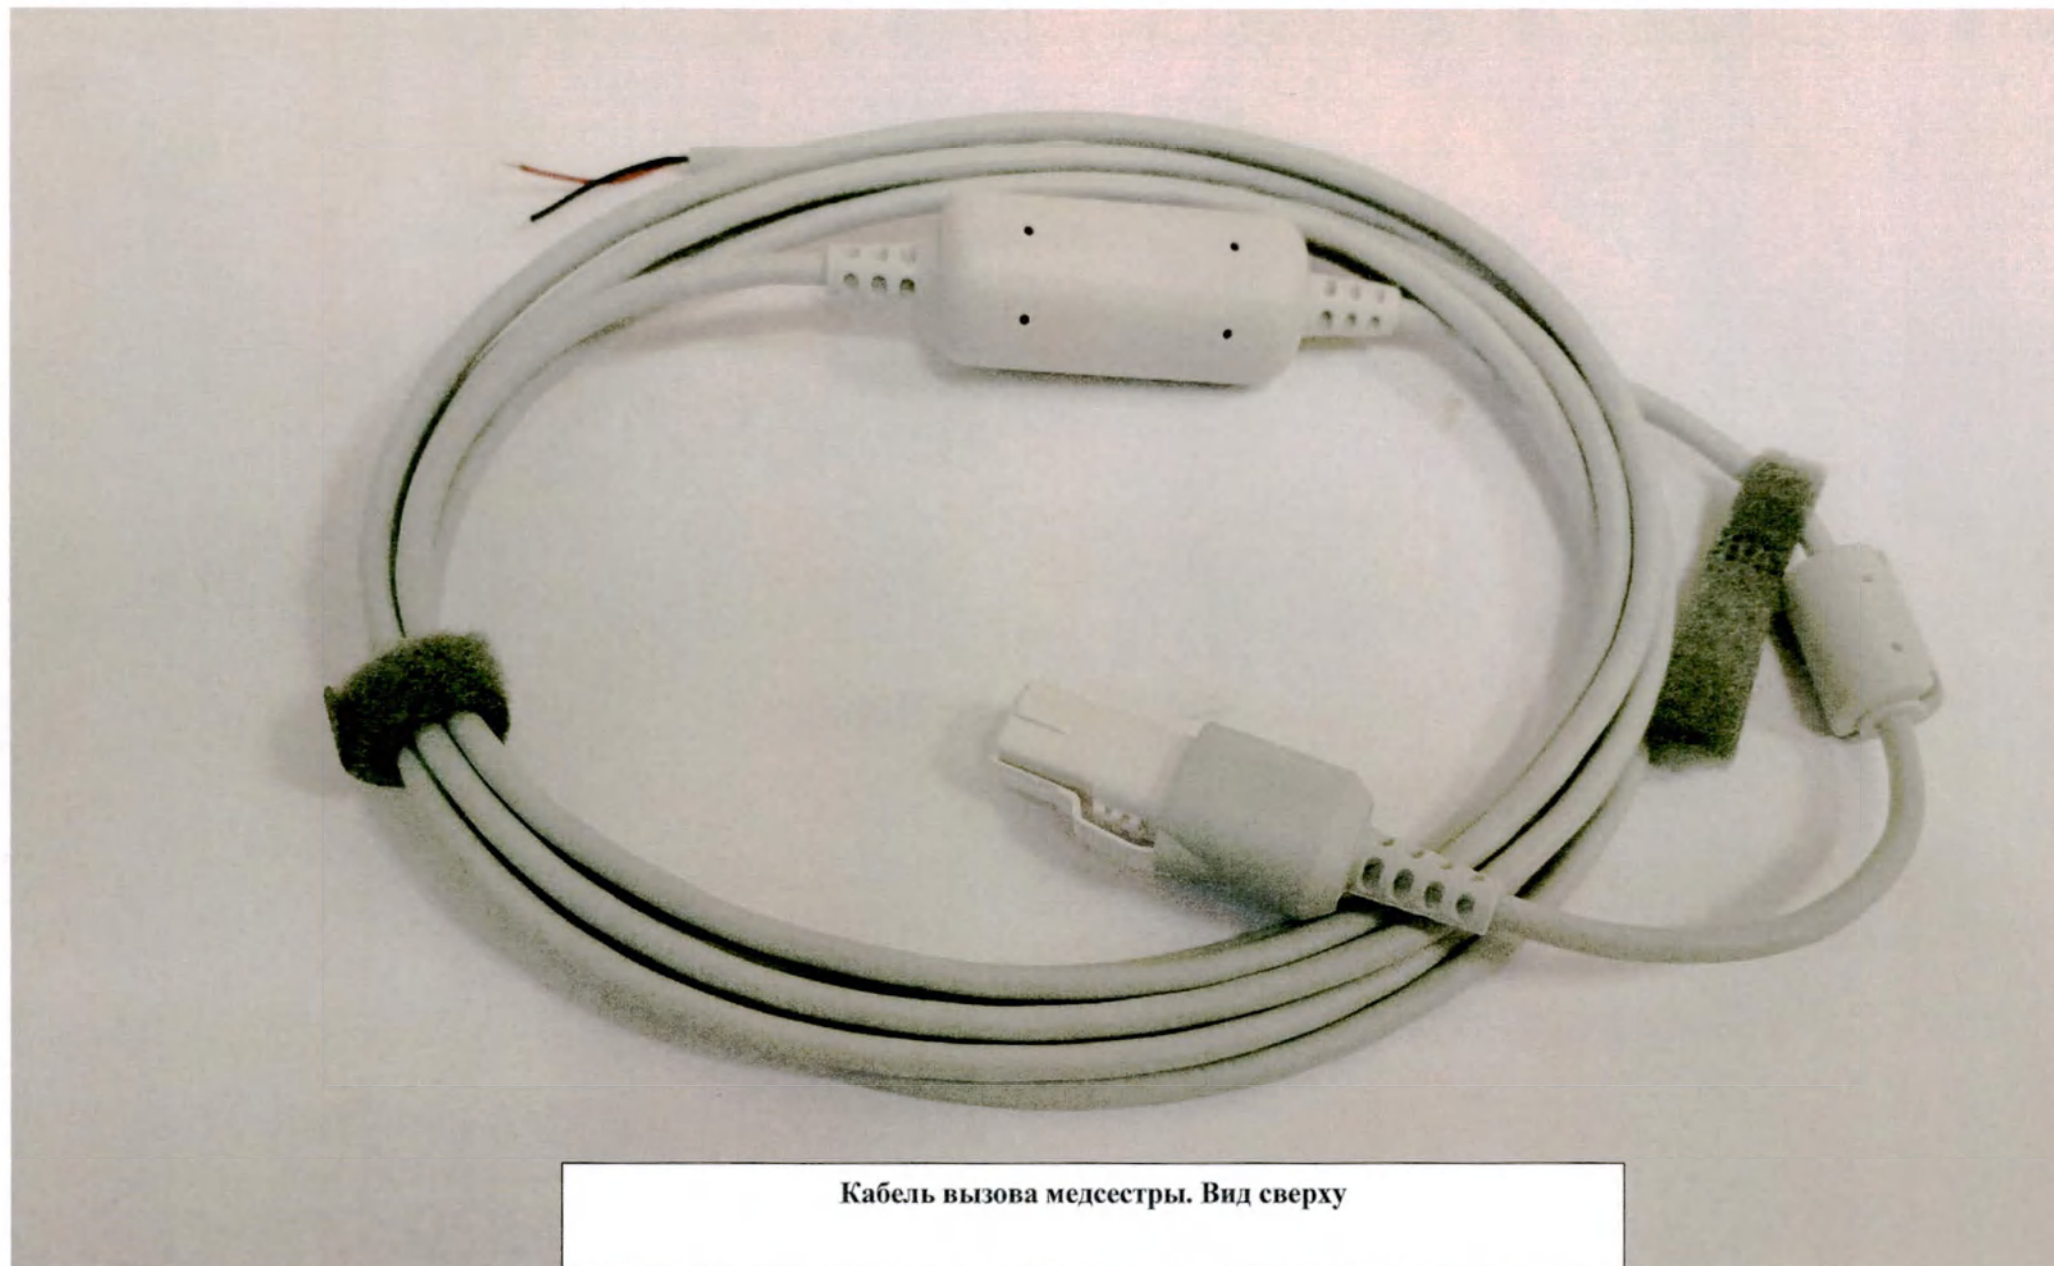


Кабель вызова медсестры. Вид сверху

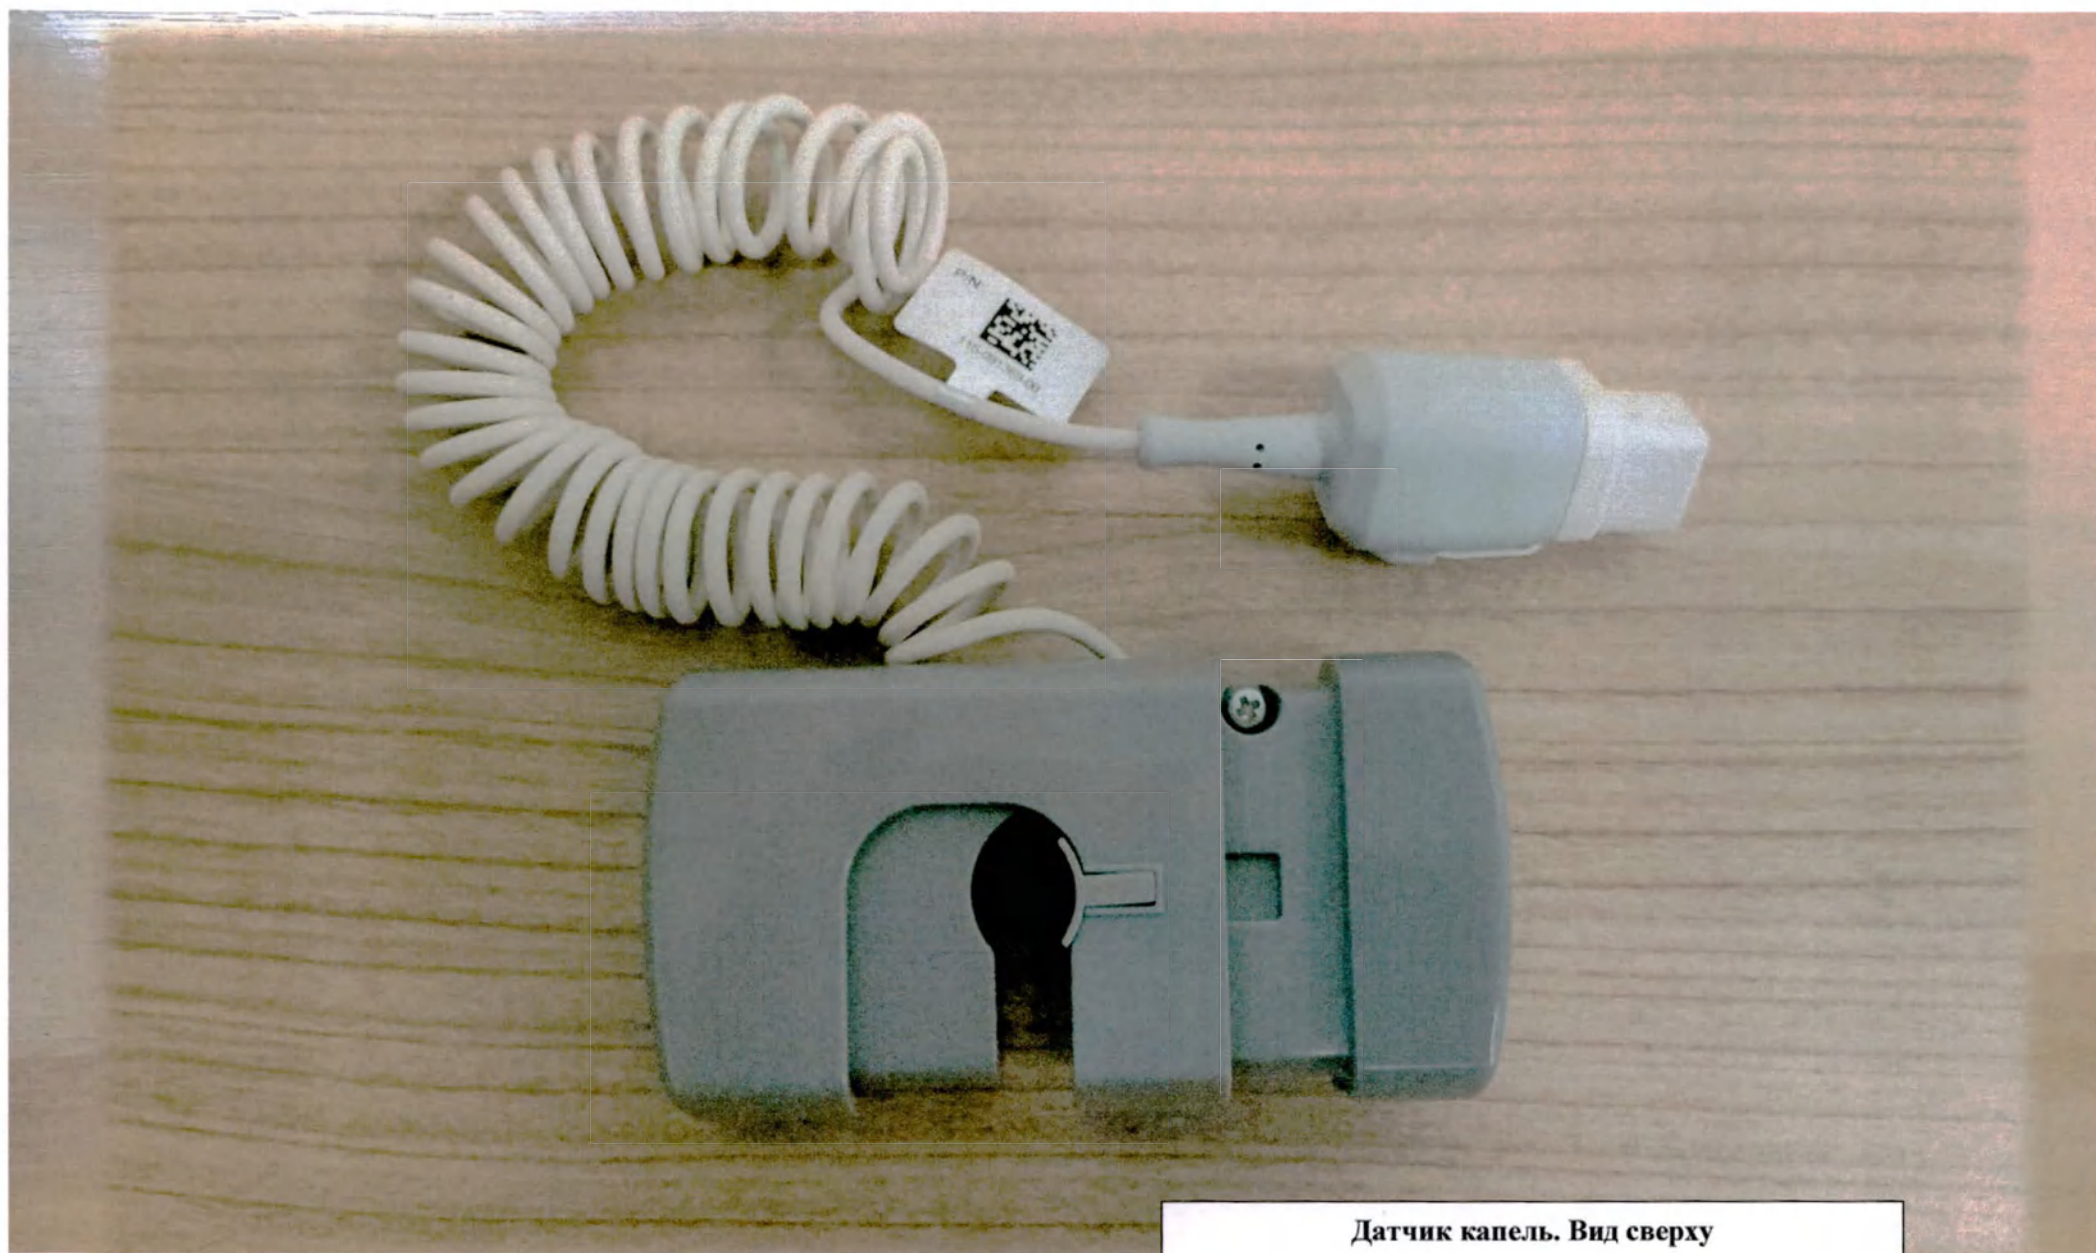

Датчик капель. Вид сверху



**Стойка для внутривенных вливаний
(базовая), модель МІР-300.
Вид спереди**

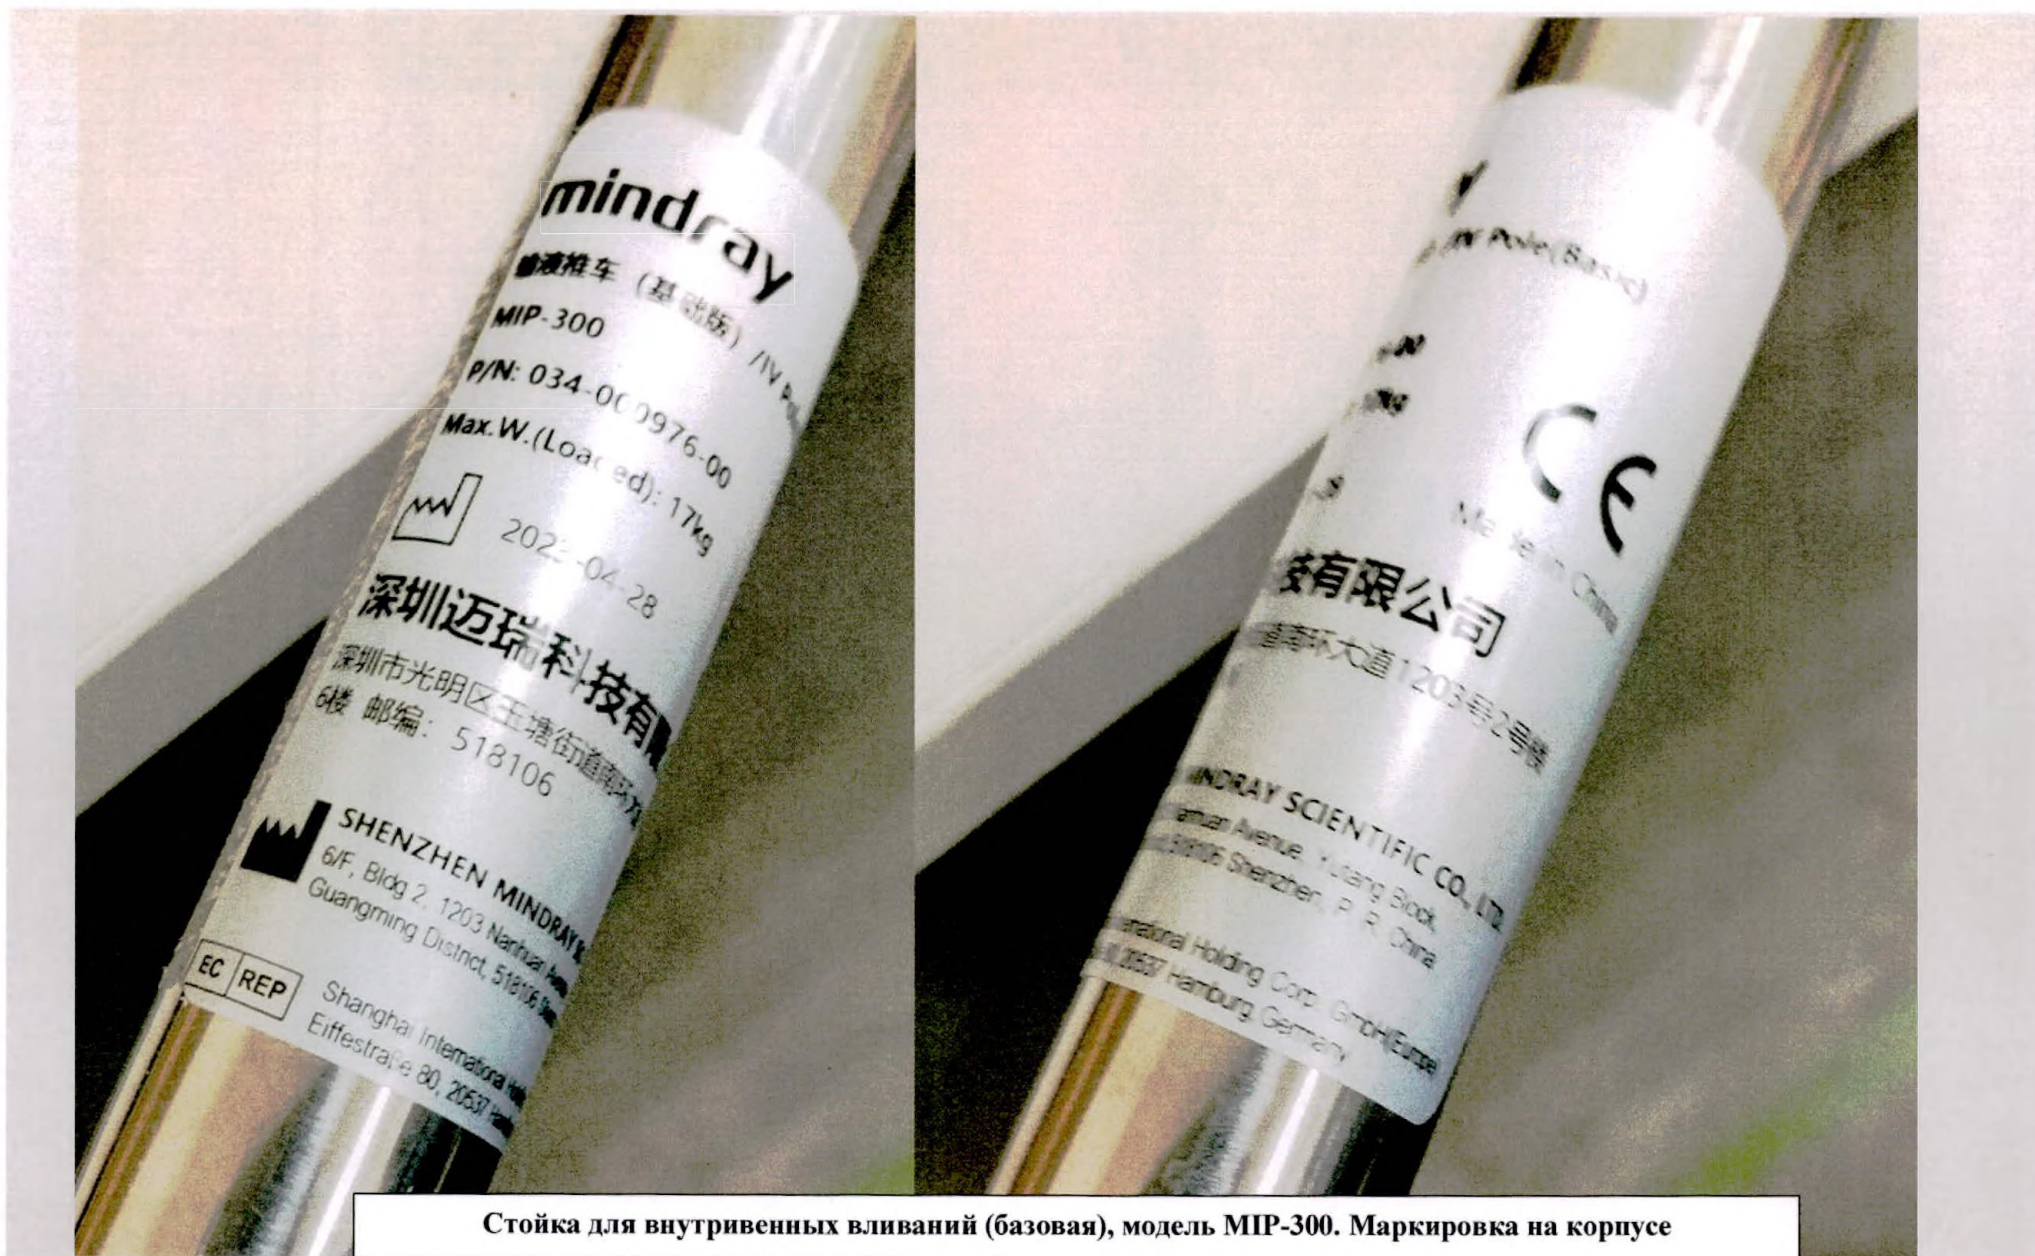

Стойка для внутривенных вливаний (базовая), модель MIP-300. Маркировка на корпусе




Стойка для внутривенных вливаний (базовая), модель МІР-300. Маркировка на корпусе



**Стойка для внутривенных вливаний
(улучшенная), модель МІР-600.
Вид спереди**



Стойка для внутривенных вливаний (улучшенная), модель MIP-600 - маркировка на корпусе

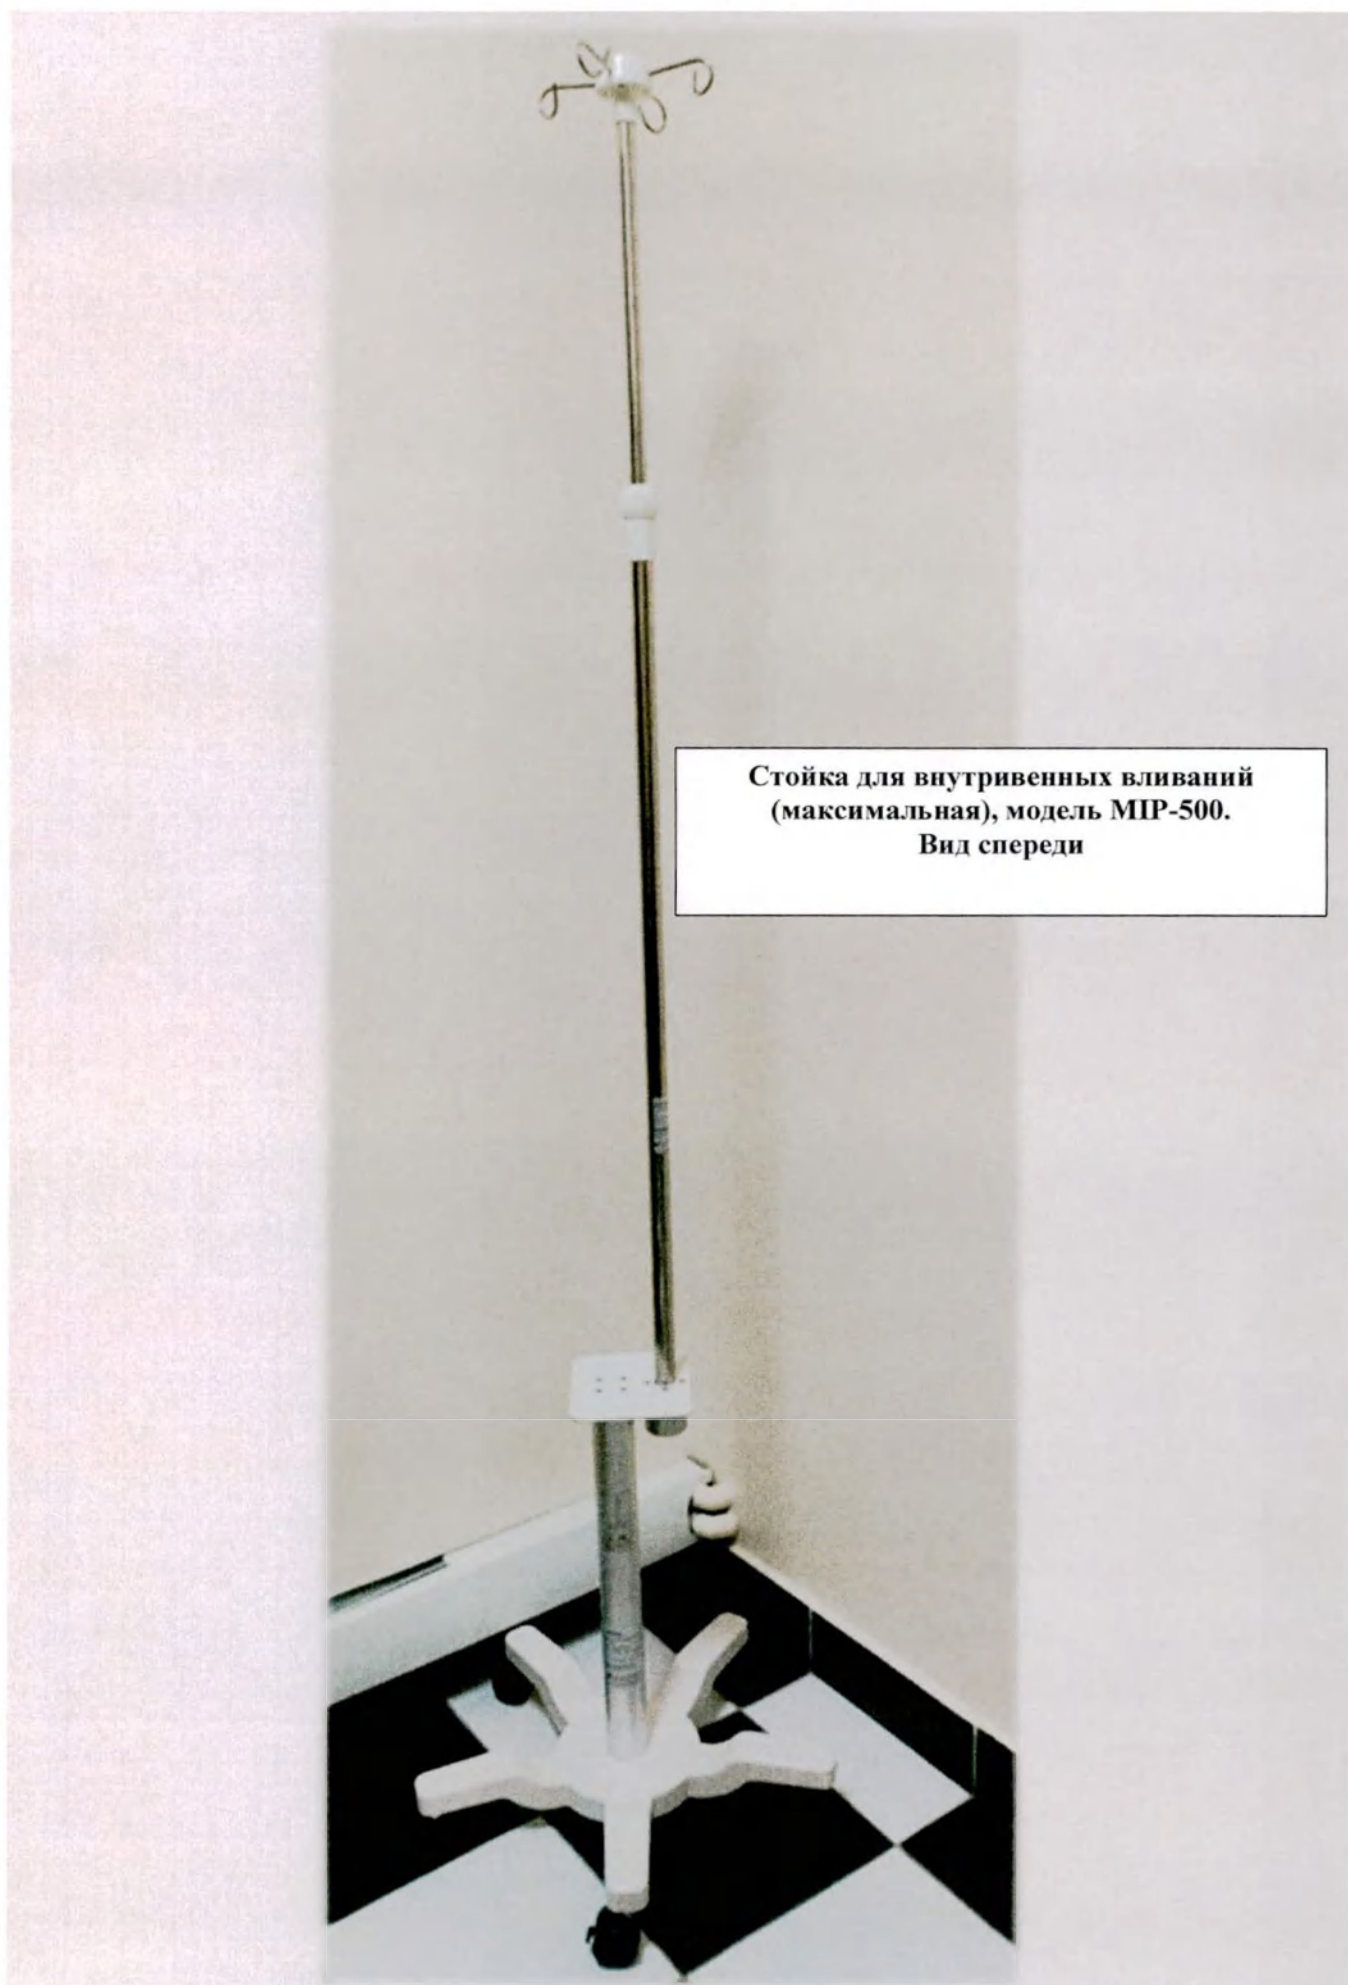



**Стойка для внутривенных вливаний
(максимальная), модель МІР-500.
Вид спереди**

Стойка для внутривенных вливаний (улучшенная), модель MIP-500 - маркировка на корпусе




Стойка для внутривенных вливаний (улучшенная), модель MIP-500 - маркировка на корпусе

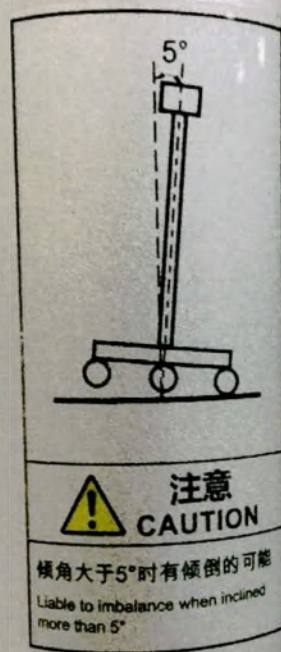

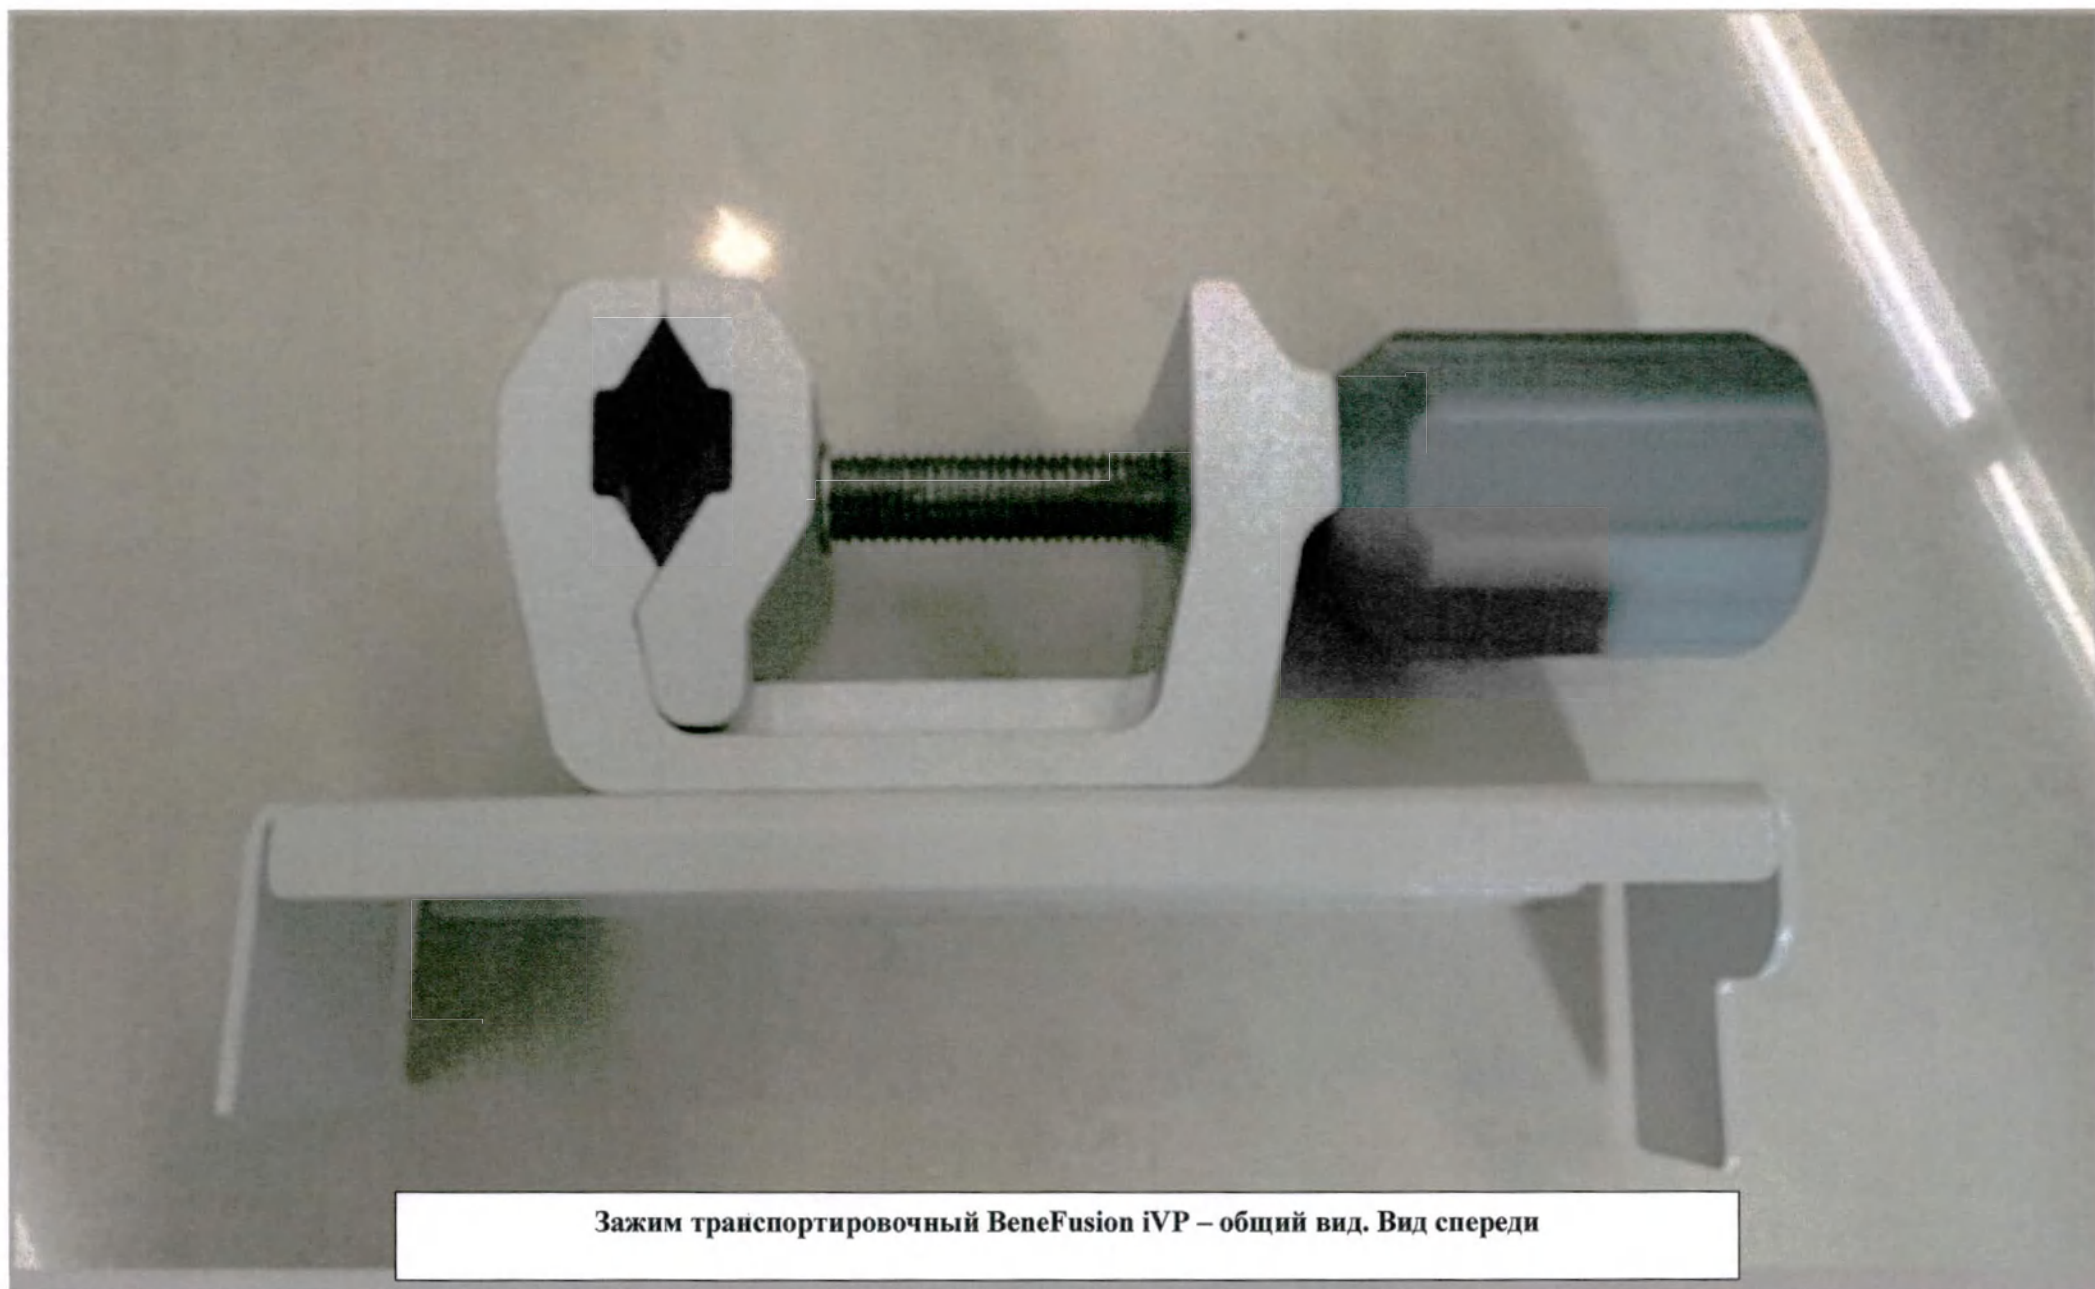

Зажим транспортировочный BeneFusion iVP – общий вид. Вид спереди

Зажим-фиксатор для крепления на стойке
(улучшенный)

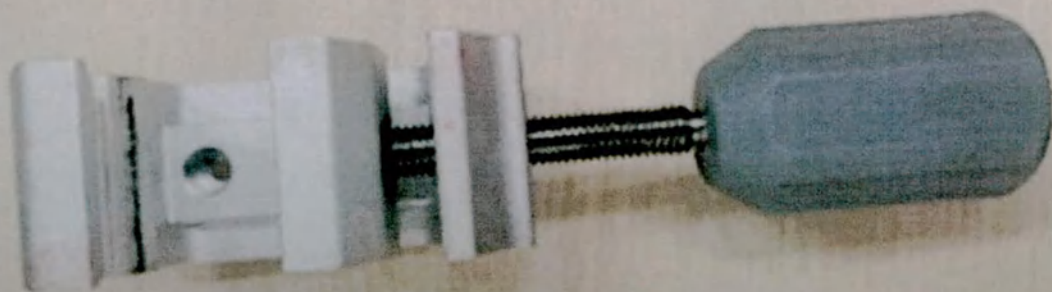

Фиксатор насосов на зажиме для насоса
инфузионного BeneFusion iVP



Винт
комбинированный
M4X12



Заглушка резиновая переменного тока



Пробка резиновая






**Индивидуальная (транспортная) упаковка
Насоса инфузионного BeneFusion iVP. Вид спереди.
Маркировка на индивидуальной (транспортной) упаковке**

Индивидуальная (транспортная) упаковка
Насоса инфузионного BeneFusion iVP, Вид сбоку.



**Индивидуальная (транспортная) упаковка
Насоса инфузионного BeneFusion iVP,
Вид в открытой упаковке.**

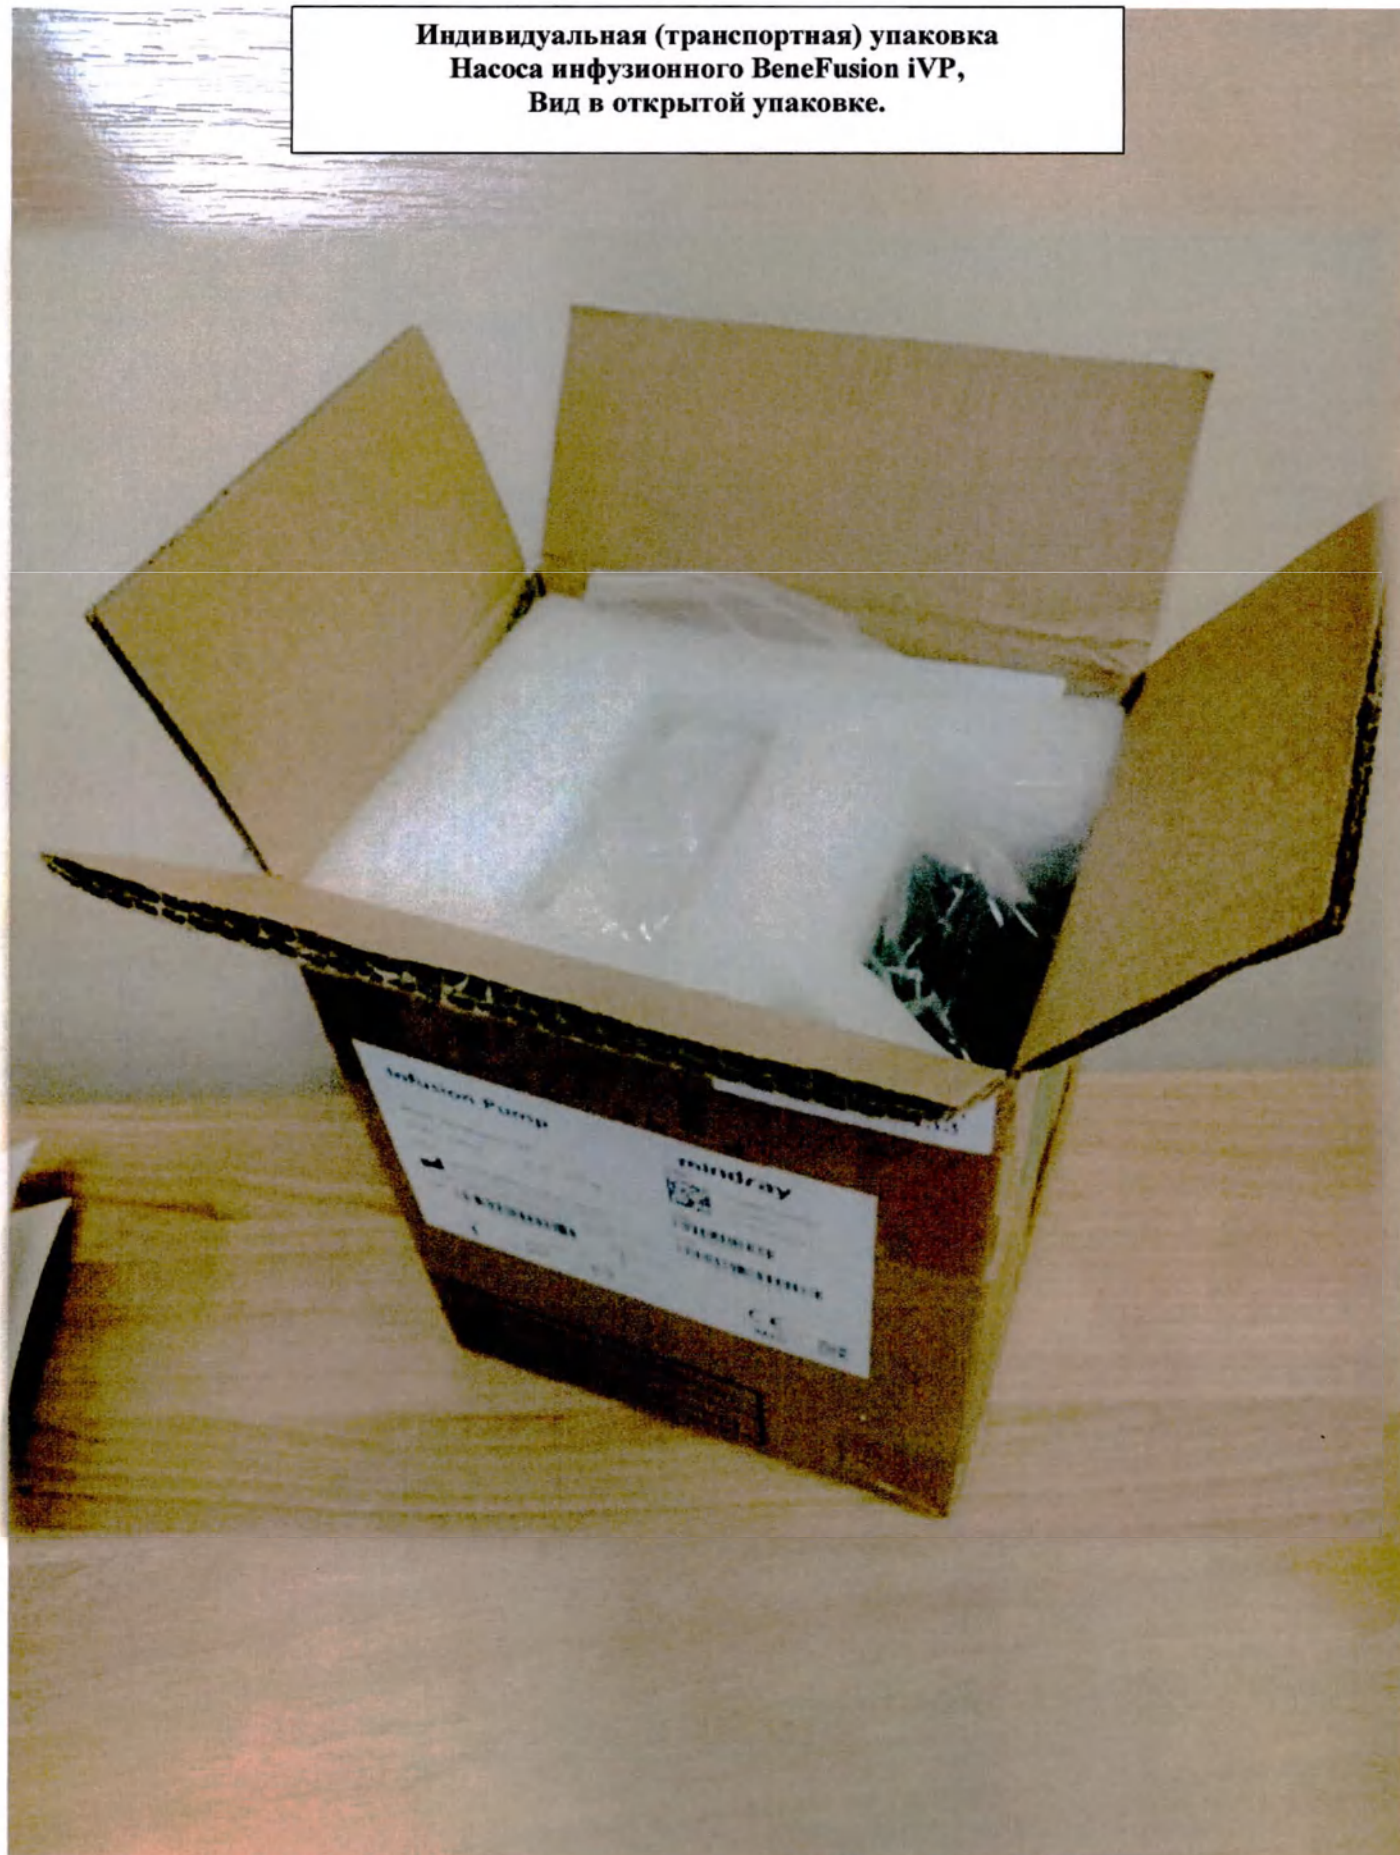



**Индивидуальная (транспортная) упаковка
Зажима-фиксатора для крепления на стойке (стандартный).
Вид сбоку**



**Индивидуальная (транспортная) упаковка
Зажима-фиксатора для крепления на стойке
(стандартный). Вид в открытой упаковке**

Индивидуальная (потребительская) упаковка
Датчика капель. Вид спереди
Маркировка на индивидуальной (потребительской) упаковке





Индивидуальная (потребительская) упаковка
Датчика капель. Вид в открытой упаковке



**Индивидуальная (потребительская) упаковка
Зажима транспортировочного BeneFusion iVP/ BeneFusion uVP. Вид сбоку**

Индивидуальная (потребительская) упаковка
Зажима транспортировочного BeneFusion iVP/ BeneFusion uVP.
Вид в открытой упаковке





Индивидуальная (потребительская) упаковка Кабеля питания от сети постоянного тока / от автомобильного прикуривателя / для автомобиля тип 2. Вид спереди



Индивидуальная (потребительская) упаковка Кабеля питания от сети постоянного тока / от автомобильного прикуривателя / для автомобиля тип 2. Вид в открытой упаковке




Индивидуальная (потребительская) упаковка Кабеля
вызова медсестры. Вид спереди



**Индивидуальная (потребительская) упаковка Кабеля
вызова медсестры. Вид в открытой упаковке**

Индивидуальная (транспортная) упаковка:
Стойка для внутривенных вливаний (базовая), модель МІР-300;
Стойка для внутривенных вливаний (улучшенная), модель МІР-600;
Стойка для внутривенных вливаний (максимальная), модель МІР-500

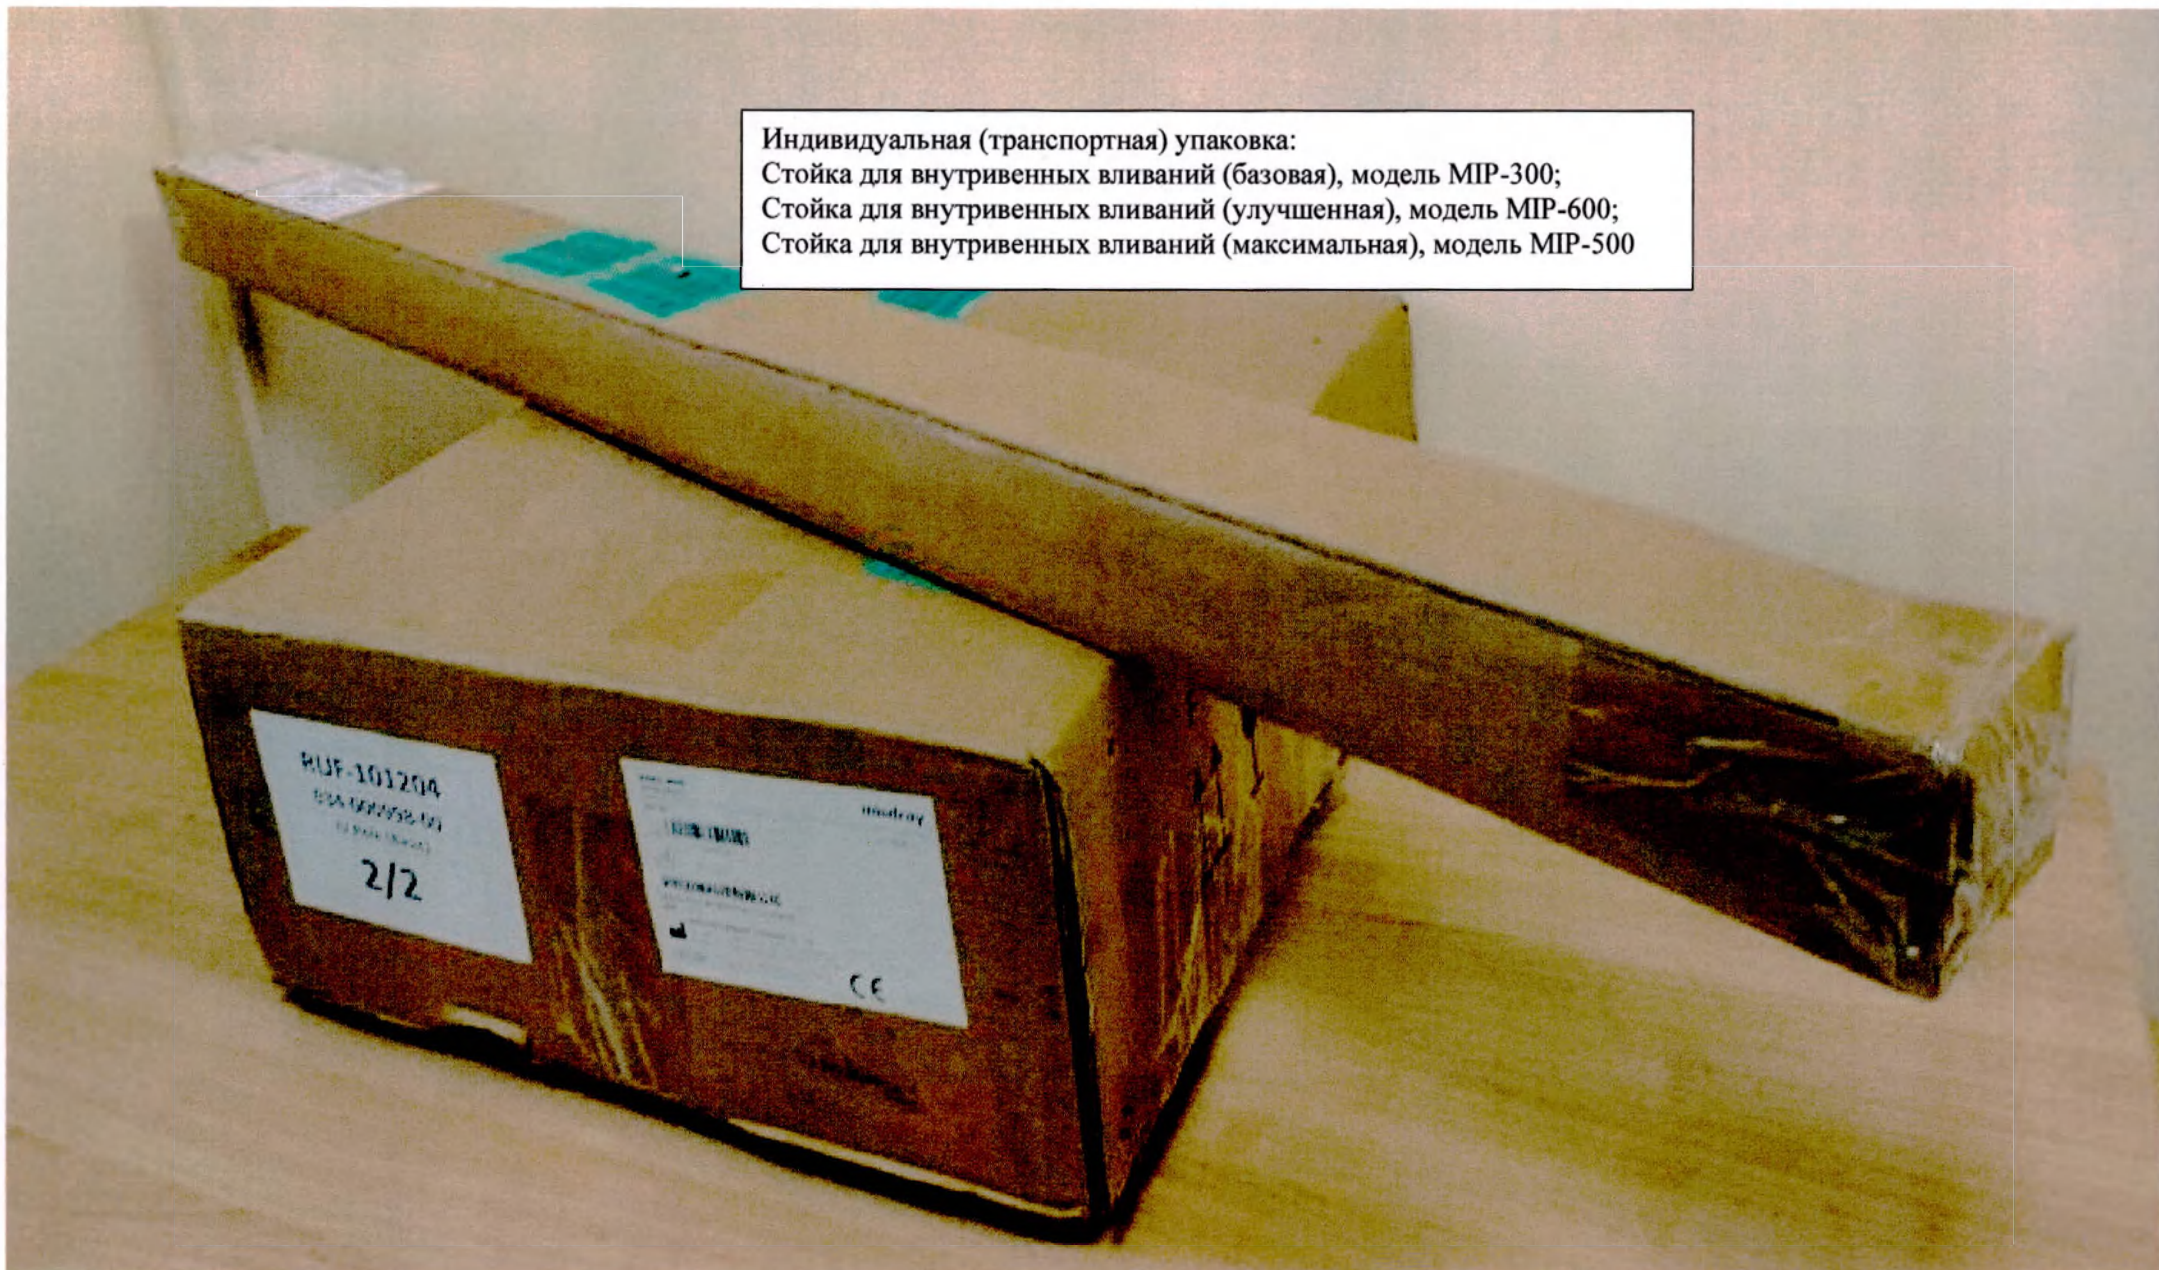


Транспортная упаковка принадлежностей насосов инфузионных.
Вид спереди





Транспортная упаковка принадлежностей насосов инфузионных.
Вид в открытой упаковке


Примеры макетов маркировочных этикеток на корпусе, на индивидуальных (потребительских) упаковках и на индивидуальных (транспортных) упаковках медицинских изделий и их принадлежностей

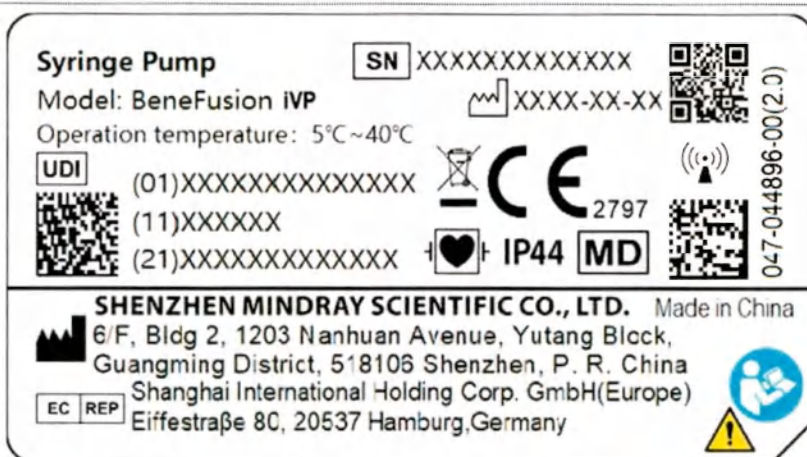

Макет маркировочной этикетки на корпусе блока основного насоса инфузионного BeneFusion iVP (с функцией Wi-Fi) на английском языке



Макет маркировочной этикетки на корпусе блока основного насоса инфузионного BeneFusion iVP (без функции Wi-Fi) на английском языке

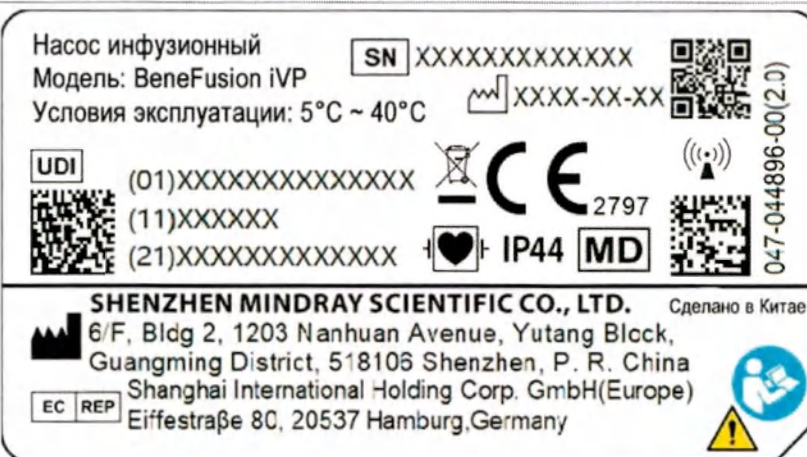

Макет маркировочной этикетки на корпусе блока основного насоса инфузионного BeneFusion iVP (с функцией Wi-Fi) на русском языке



Макет маркировочной этикетки на корпусе блока основного насоса инфузионного BeneFusion iVP (без функции Wi-Fi) на русском языке

Syringe Pump

Model: BeneFusion uVP

Operation temperature: 5°C~40°C

UDI

(01)XXXXXXXXXXXXXXXX

(11)XXXXXX

(21)XXXXXXXXXXXXXXXX



2797

IP44 MD



047-044896-00(2.0)

SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. Made in China6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block,
Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

EC REP

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



Макет маркировочной этикетки на корпусе блока основного насоса инфузионного BeneFusion uVP (с функцией Wi-Fi) на английском языке

Syringe Pump

Model: BeneFusion uVP

Operation temperature: 5°C~40°C

UDI

(01)XXXXXXXXXXXXXXXX

(11)XXXXXX

(21)XXXXXXXXXXXXXXXX



2797

IP44 MD



047-044896-00(2.0)

SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. Made in China6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block,
Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

EC REP

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



Макет маркировочной этикетки на корпусе блока основного насоса инфузионного BeneFusion uVP (без функции Wi-Fi) на английском языке

Насос инфузионный

Модель: BeneFusion uVP

Условия эксплуатации: 5°C ~ 40°C

UDI

(01)XXXXXXXXXXXXXXXX

(11)XXXXXX

(21)XXXXXXXXXXXXXXXX



2797

IP44 MD



047-044896-00(2.0)

SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. Сделано в Китае6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block,
Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

EC REP

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



Макет маркировочной этикетки на корпусе блока основного насоса инфузионного BeneFusion uVP (с функцией Wi-Fi) на русском языке

Насос инфузионный

Модель: BeneFusion uVP

Условия эксплуатации: 5°C ~ 40°C

UDI

(01)XXXXXXXXXXXXXXXX

(11)XXXXXX

(21)XXXXXXXXXXXXXXXX



2797

IP44 MD



047-044896-00(2.0)

SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. Сделано в Китае6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block,
Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

EC REP

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



Макет маркировочной этикетки на корпусе блока основного насоса инфузионного BeneFusion uVP (без функции Wi-Fi) на русском языке

Infusion Pump

Model: BeneFusion iVP

N.W.: G.W.:

Qty.:

SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block,
Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Elffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

SN



ГТТТ-ММ-ДД
XX-XXXXXXXXXX

-20°C 60°C 95% 10% 16kPa 107.4kPa
MADE IN CHINA



mindray

UDI



(01)XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(11)XXXXXX
(21)XX-XXXXXXXXXXXXXX

W#:



XX-XXXXXXXXXX

P/N:



XX-XXXXXXXXXX

Насос инфузионный

Модель: BeneFusion iVP

Масса Нетто: Масса Брутто:

Количество:

SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block,
Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Elffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

SN



ГТТТ-ММ-ДД
XX-XXXXXXXXXX

-20°C 60°C 95% 10% 16kPa 107.4kPa
СДЕЛАНО В КИТАЕ



mindray

UDI



(01)XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(11)XXXXXX
(21)XX-XXXXXXXXXXXXXX

Условный номер по кодировке производителя:



XX-XXXXXXXXXX

Архитектурный номер:



XX-XXXXXXXXXX

Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (транспортной) упаковке блока основного насоса инфузионного BeneFusion iVP на английском языке

Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (транспортной) упаковке блока основного насоса инфузионного BeneFusion iVP на русском языке

Infusion Pump

Model: BeneFusion uVP

N.W.: G.W.:

Qty.:

SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block,
Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Elffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

SN



ГТТТ-ММ-ДД
XX-XXXXXXXXXX

-20°C 60°C 95% 10% 16kPa 107.4kPa
MADE IN CHINA



mindray

UDI



(01)XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(11)XXXXXX
(21)XX-XXXXXXXXXXXXXX

W#:



XX-XXXXXXXXXX

P/N:



XX-XXXXXXXXXX

Насос инфузионный

Модель: BeneFusion uVP

Масса Нетто: Масса Брутто:

Количество:

SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block,
Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Elffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

SN



ГТТТ-ММ-ДД
XX-XXXXXXXXXX

-20°C 60°C 95% 10% 16kPa 107.4kPa
СДЕЛАНО В КИТАЕ



mindray

UDI



(01)XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(11)XXXXXX
(21)XX-XXXXXXXXXXXXXX

Условный номер по кодировке производителя:



XX-XXXXXXXXXX

Архитектурный номер:



XX-XXXXXXXXXX

Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (транспортной) упаковке блока основного насоса инфузионного BeneFusion uVP на английском языке

Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (транспортной) упаковке блока основного насоса инфузионного BeneFusion uVP на русском языке

可充电锂离子电池 Rechargeable Li-ion Battery

Model No. XXXXXXXXXX ⊕ Red
XXXXXXXXXX ⊖ Black

DCX.XV ==XXXXmAhXX.XXWh

警告:

使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。切勿挤压、刺破、拆卸或使电池短路。切勿放置于火中或水中。在-20°C (-4°F) 至60°C (140°F) 温度下存储。只能使用指定的充电器。请阅读本产品的操作说明。

CAUTION:

Risk of fire, explosion, or burns. Do not crush, puncture, disassemble or short circuit the battery. Do not dispose of the battery in fire or water. Store the battery in the -20°C (-4°F) to 60°C (140°F) environment. Use the specified charger only. Read instructions for use.

mindray

深圳迈瑞科技有限公司
Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.

中国 制造
MADE IN CHINA



可充电锂离子电池 Rechargeable Li-ion Battery

Model No. XXXXXXXXXX ⊕ Red
XXXXXXXXXX ⊖ Black

DCX.XV ==XXXXmAhXX.XXWh

警告:

使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。切勿挤压、刺破、拆卸或使电池短路。切勿放置于火中或水中。在-20°C (-4°F) 至60°C (140°F) 温度下存储。只能使用指定的充电器。请阅读本产品的操作说明。

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Опасность пожара, взрыва или ожогов. Не раздвигайте, не прокалывайте, не разбирайте и не закорачивайте аккумулятор. Не бросайте аккумулятор в огонь или воду. Храните аккумулятор при температуре от -20° (-4°F) C до 60° C (140°F). Используйте только указанное зарядное устройство. Прочтите руководство по эксплуатации.

mindray

深圳迈瑞科技有限公司
Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.

中国 制造
СДЕЛАНО В КИТАЕ



Макет маркировочной этикетки на корпусе аккумулятора стандартного
на английском языке

Макет маркировочной этикетки на корпусе аккумулятора стандартного
на русском языке

可充电锂离子电池组 Rechargeable Li-ion Battery

Model No. XXXXXXXXXX ⊕ Red
XXXXXXXXXX ⊖ Black
DCXX.XV ==XXXXmAhXX.XXWh

XXXXXXXXXXXXXXX
S/N:XXXXXXXXXXXXXXX



警告:

使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。切勿挤压、刺破、拆卸或使电池短路。切勿放置于火中或水中。在-20°C (-4°F) 到60°C (140°F) 温度下存储。只能使用指定的充电器。请阅读本产品的操作说明。

CAUTION:

Risk of fire, explosion or burns. Do not crush, puncture, disassemble or short circuit the battery. Do not dispose of the battery in fire or water. Store the battery in the -20°C (-4°F) to 60°C (140°F) environment. Use the specified charger only. Read instructions for use.

mindray

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

中国 制造
MADE IN CHINA

Макет маркировочной этикетки на корпусе смарт-аккумулятора
на английском языке

可充电锂离子电池组 Rechargeable Li-ion Battery

Номер модели: XXXXXXXXXX ⊕ Красный
XXXXXXXXXX ⊖ Черный
DCXX.X B == XXXX mAh XX.XX Wh

XXXXXXXXXXXXXXX
S/N:XXXXXXXXXXXXXXX



警告:

使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。切勿挤压、刺破、拆卸或使电池短路。切勿放置于火中或水中。在-20°C (-4°F) 到60°C (140°F) 温度下存储。只能使用指定的充电器。请阅读本产品的操作说明。

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Опасность пожара, взрыва или ожогов. Не раздвигайте, не прокалывайте, не разбирайте и не закорачивайте аккумулятор. Не бросайте аккумулятор в огонь или воду. Храните аккумулятор при температуре от -20° (-4°F) C до 60° C (140°F). Используйте только указанное зарядное устройство. Прочтите руководство по эксплуатации.

mindray


深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

中国 制造
СДЕЛАНО В КИТАЕ

Макет маркировочной этикетки на корпусе смарт-аккумулятора
на русском языке

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX XX XXXX	XXXX-XX-XXXXX  XXXX-XX-XXXXX
Макет маркировочной этикетки, прикрепленной к гибкому шнуру кабеля питания	
i/u Series DC Adapter SN SN - XXXXXXXXXXXXX ГГГГ-ММ-ДД UDI (01) XXXXXXXXXXXXXXXX (11) XXXXXX (21) SN - XXXXXXXXXXXXX 10 - 16 V 4 A MAX. SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. Made in China 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Gamburg, Germany	Кабель питания от сети постоянного тока / от автомобильного прикуривателя / для автомобиля тип 2 SN SN - XXXXXXXXXXXXX ГГГГ-ММ-ДД UDI (01) XXXXXXXXXXXXXXXX (11) XXXXXX (21) SN - XXXXXXXXXXXXX 10 - 16 B 4 A Макс. SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. Сделано в Китае 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Gamburg, Germany
Макет маркировочной этикетки на корпусе кабеля питания от сети постоянного тока / от автомобильного прикуривателя / для автомобиля тип 2 на английском языке	Пример макета маркировочной этикетки на корпусе кабеля питания от сети постоянного тока / от автомобильного прикуривателя / для автомобиля тип 2 на русском языке

I/u Series DC Adapter P/N:  XXX-XXXXXX-XX Qty.: X  ГТТГ-ММ-ДД  (01) XXXXXXXXXXXXXXXX (11) XXXXXX (21) SN - XXXXXXXXXXXXXXXX  SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhu Avenue, Yutang Block, Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany  MADE IN CHINA 	Кабель питания от сети постоянного тока / от автомобильного прикуривателя / для автомобиля тип 2 P/N:  XXX-XXXXXX-XX Кол.: X  ГТТГ-ММ-ДД  (01) XXXXXXXXXXXXXXXX (11) XXXXXX (21) SN - XXXXXXXXXXXXXXXX  SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhu Avenue, Yutang Block, Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany  СДЕЛАНО В КИТАЕ 
Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (потребительской) упаковке кабеля питания от сети постоянного тока / от автомобильного прикуривателя / для автомобиля тип 2 на английском языке	Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (потребительской) упаковке кабеля питания от сети постоянного тока / от автомобильного прикуривателя / для автомобиля тип 2 на русском языке
description: WOLF Nurse Call Cable (P/N:) XXX-XXXXXX-XX (2.0) (LOT NO:) LOTXXXXXXXXXXXX (Qty.): X PCS (Date): XXXX.XX.XX	  P/N XXX-XXXXXX-XX Made in China
Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (потребительской) упаковке изделия (пакете) на английском языке	
Кабель вызова медсестры (P/N:) XXX-XXXXXX-XX (2.0) (LOT NO:) LOTXXXXXXXXXXXX (Qty.): X PCS (Date): XXXX.XX.XX	  P/N XXX-XXXXXX-XX Сделано в Китае
Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (потребительской) упаковке изделия (пакете) на русском языке	

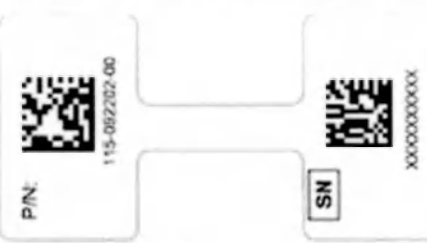NAME: Nurse Call Cable Qty: X REF  XXX-XXXXXX-XX  GTT-MM Order No.:  XXXXXXXXXXXXX  SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, Shenzhen, P. R. China Made in China	Кабель вызова медсестры Кол.: X REF  XXX-XXXXXX-XX  GTT-MM Заказ №:  XXXXXXXXXXXXX  SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, Shenzhen, P. R. China Сделано в Китае
Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (потребительской) упаковке изделия (картонной коробке) на английском языке	Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (потребительской) упаковке изделия (картонной коробке) на русском языке
	
Макет маркировочной этикетки, прикрепленной к гибкому шнуру кабеля датчика капель	
NAME: Drop Sensor Qty: X REF XXX-XXXXXX-XX  GTT-MM-DD Order No.:  Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, Shenzhen, P. R. China Made in China	Датчик капель Кол-во: X REF XXX-XXXXXX-XX  GTT-MM-DD Заказ №:  Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, Shenzhen, P. R. China Сделано в Китае
Макет маркировки потребительской (индивидуальной) упаковки датчика капель на английском языке	Макет маркировки потребительской (индивидуальной) упаковки датчика капель на английском языке

locking clip for mounting on a rack (standard) Qty: X REF XXX-XXXXXX-XX ГТТГ-ММ-ДД Order No.: Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, Shenzhen, P. R. China Made in China	Зажим-фиксатор для крепления на стойке (стандартный) Кол-во: X REF XXX-XXXXXX-XX ГТТГ-ММ-ДД Заказ №: Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, Shenzhen, P. R. China Сделано в Китае
Макет этикетки на индивидуальной (потребительской) упаковке зажима-фиксатора для крепления на стойке (стандартный) на английском языке	Макет этикетки на индивидуальной (потребительской) упаковке зажима-фиксатора для крепления на стойке (стандартный) на русском языке
NAME: Transport Clamp (iVP) Qty: X REF XXX-XXXXXX-XX ГТТГ-ММ-ДД Order No.: Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, Shenzhen, P. R. China Made in China	Зажим транспортировочный BeneFusion iVP Кол-во: X REF XXX-XXXXXX-XX ГТТГ-ММ-ДД Заказ №: Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, Shenzhen, P. R. China Сделано в Китае
Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (потребительской) упаковке Зажима транспортировочного BeneFusion iVP на английском языке	Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (потребительской) упаковке Зажима транспортировочного BeneFusion iVP на русском языке

NAME: Transport Clamp (uVP) Qty: X REF XXX-XXXXXX-XX  ГГГГ-ММ-ДД Order No.:  Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, Shenzhen, P. R. China Made in China	Зажим транспортировочный BeneFusion uVP Кол-во: X REF XXX-XXXXXX-XX  ГГГГ-ММ-ДД Заказ №:  Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, Shenzhen, P. R. China Сделано в Китае
Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (потребительской) упаковке Зажима транспортировочного BeneFusion uVP на английском языке	Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (потребительской) упаковке Зажима транспортировочного BeneFusion uVP на русском языке
Accessories Qty: X REF XXX-XXXXXX-XX  ГГГГ-ММ-ДД Order No.:  Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, Shenzhen, P. R. China Made in China	Принадлежности Кол-во: X REF XXX-XXXXXX-XX  ГГГГ-ММ-ДД Заказ №:  Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, Shenzhen, P. R. China Сделано в Китае
Макет транспортной упаковки принадлежностей медицинского изделия на английском языке	Макет транспортной упаковки принадлежностей медицинского изделия на русском языке

mindray

输液推车 (注射泵豪华款)

IV Pole (Basic)

MIP-300

P/N: XXX-XXXXX-XX

Max.W.(Loaded): XX kg



YYYY-MM-DD

CE
Made in China

深圳迈瑞科技有限公司

深圳市光明区玉塘街道南环大道1203号2号楼6楼

邮编: 518106



SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.

6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block,
Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP



Макет маркировочной этикетки на корпусе стойки для внутривенных вливаний (базовая), модель MIP-300 на английском языке

mindray

输液推车 (注射泵豪华款)

Стойка для внутривенных вливаний (базовая)

MIP-300

P/N: XXX-XXXXX-XX

Макс. нагрузка: XX кг



ГГГГ-ММ-ДД

CE
СДЕЛАНО В КИТАЕ

深圳迈瑞科技有限公司

深圳市光明区玉塘街道南环大道1203号2号楼6楼

邮编: 518106




SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.

6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block,
Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

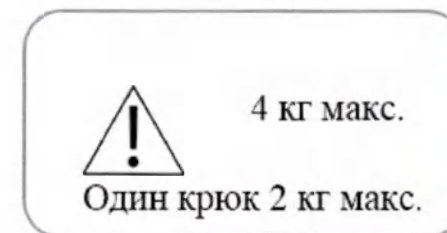

Макет маркировочной этикетки на корпусе стойки для внутривенных вливаний (базовая), модель MIP-300 на русском языке

IV Pole (Basic) mindray MIP-300 Qty.: X P/N:  XXX-XXXXXX-XX  ГГГГ-ММ-ДД  SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China  Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80. 20537 Gamburg. Germany CE Made in China	Стойка для внутривенных вливаний (базовая) mindray MIP-300 Кол.: X P/N:  XXX-XXXXXX-XX  ГГГГ-ММ-ДД  SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, 518106 Shenzhen, P. R. China  Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80. 20537 Gamburg. Germany CE Сделано в Китае
Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (транспортной) стойки для внутривенных вливаний (базовая), модель MIP-300 на английском языке	Макет маркировочной этикетки на индивидуальной (транспортной) упаковке стойки для внутривенных вливаний (базовая), модель MIP-300 на русском языке
Насос инфузионный в вариантах исполнения BeneFusion iVP, BeneFusion uVP Модель: BeneFusion iVP Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX года  Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Саинтифик Ко., Лтд.»), KHP 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, 518106 Shenzhen, People's Republic of China Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Миндрей Медикал Рус» Адрес: 129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мешанский, пр-кт Олимпийский, д 16, стр. 5, ан./пом.4/1, ком.7, 11А Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39 E-mail: info.ru@mindray.com	Насос инфузионный в вариантах исполнения BeneFusion iVP, BeneFusion uVP Модель: BeneFusion uVP Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX года  Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Саинтифик Ко., Лтд.»), KHP 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, 518106 Shenzhen, People's Republic of China Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Миндрей Медикал Рус» Адрес: 129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мешанский, пр-кт Олимпийский, д 16, стр. 5, ан./пом.4/1, ком.7, 11А Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39 E-mail: info.ru@mindray.com
Макет дополнительной этикетки для насоса инфузионного BeneFusion iVP на русском языке	Макет дополнительной этикетки для насоса инфузионного BeneFusion uVP на русском языке

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью:

58 / пятьдесят восемь лист(а/ов)

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сысоева
Слон-Вэй



ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 13.12.23г

СЫСоева Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ