

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного
определения ненасыщенной железосвязывающей способности (UIBC)
сыворотки или плазмы крови человека
колориметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity c
«UIBC Калибраторы (Alinity c UIBC Calibrator Kit)»**


Фотографическое изображение МИ ИВД UIBC Калибраторы (Alinity с UIBC Calibrator Kit)», упаковка, вид снаружи






Фотографическое изображение МИ ИВД UIBC Калибраторы (Alinity с UIBC Calibrator Kit)», упаковка, вид изнутри





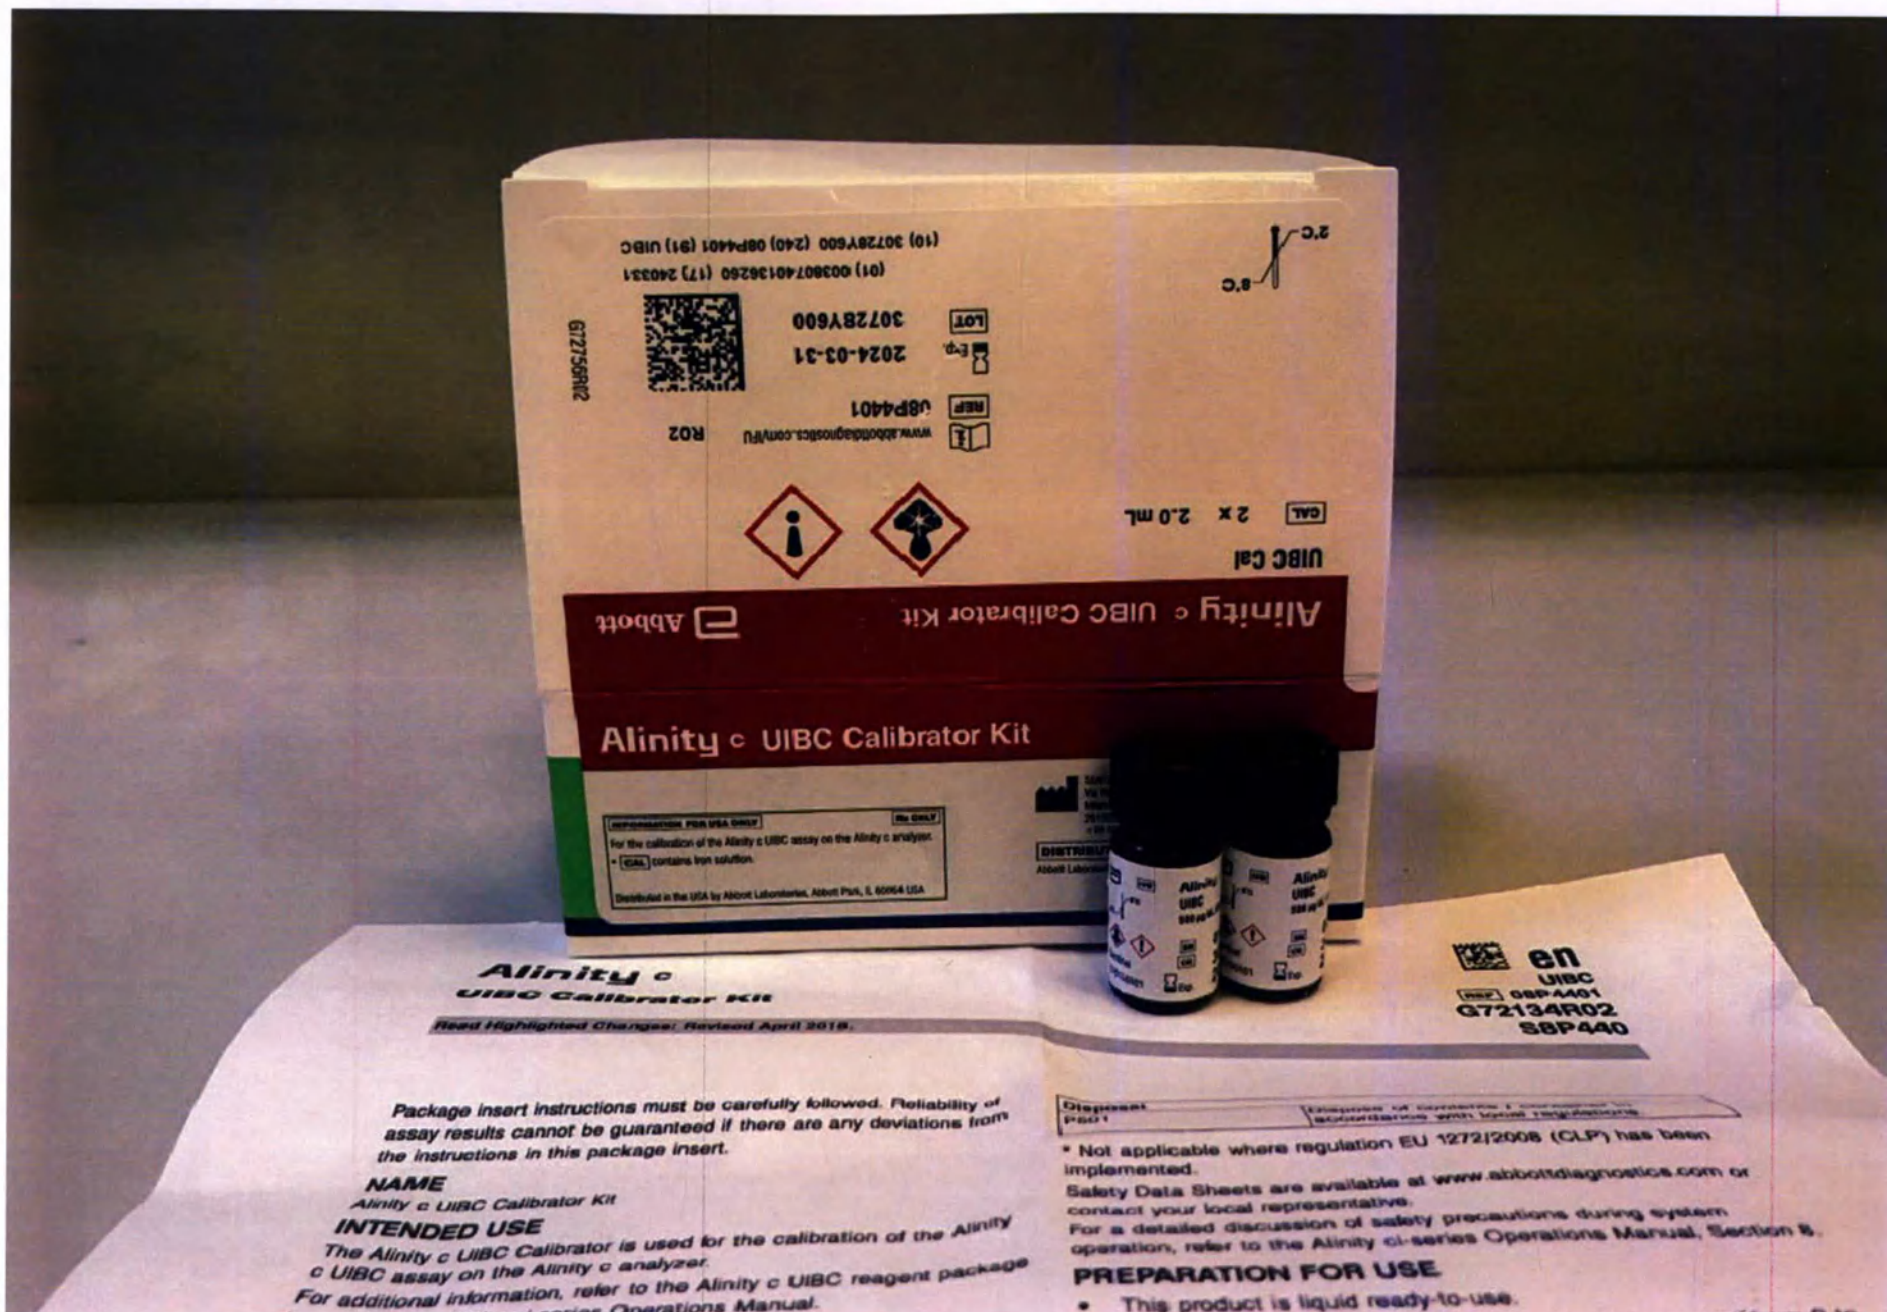

- Фотографическое изображение МИ ИВД UIBC Калибраторы (Alinity с UIBC Calibrator Kit)», Калибратор (Alinity с UIBC CAL) - 2 флакона х 2,0 мл

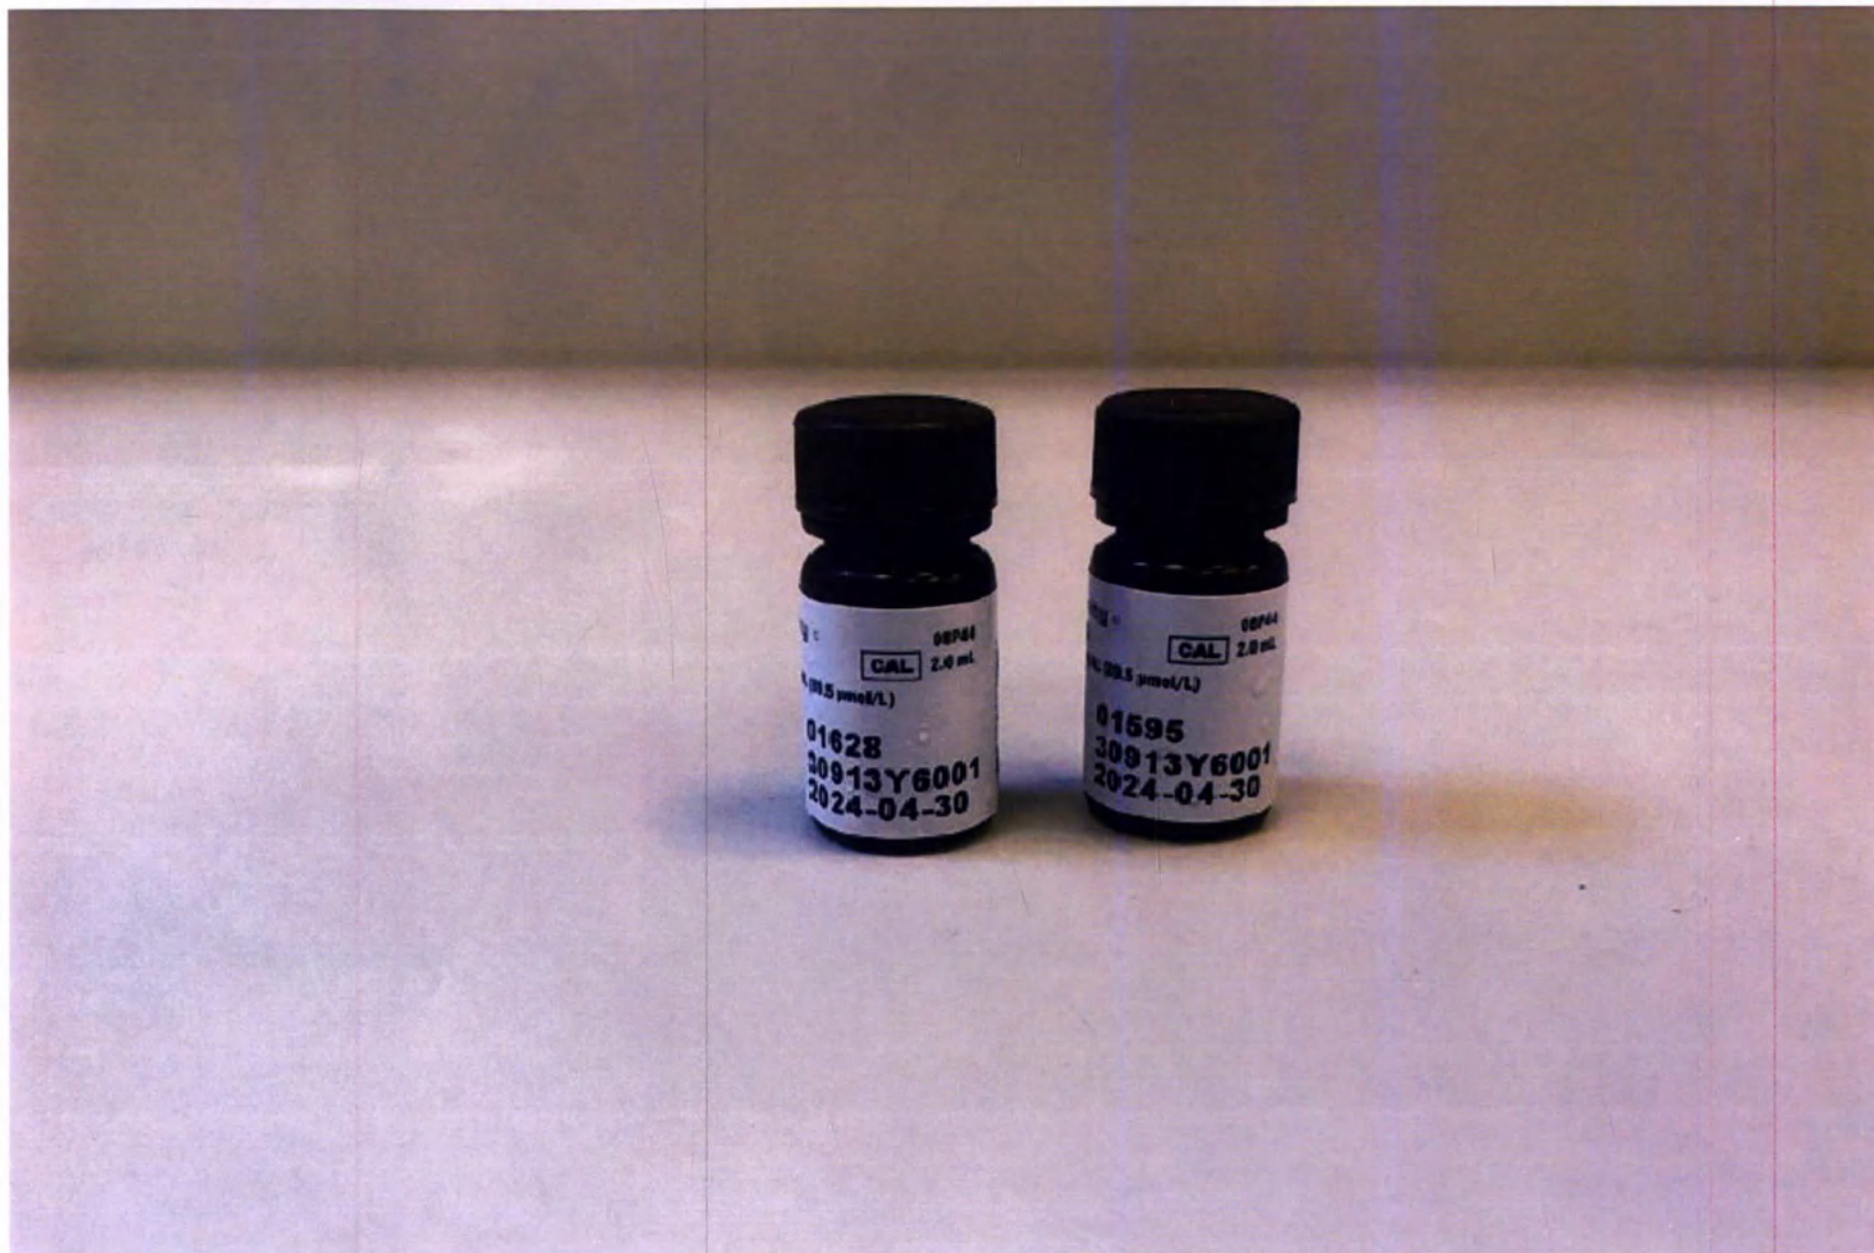

Фотографическое изображение МИ ИВД UIBC Калибраторы (Alinity с UIBC Calibrator Kit)», флакон

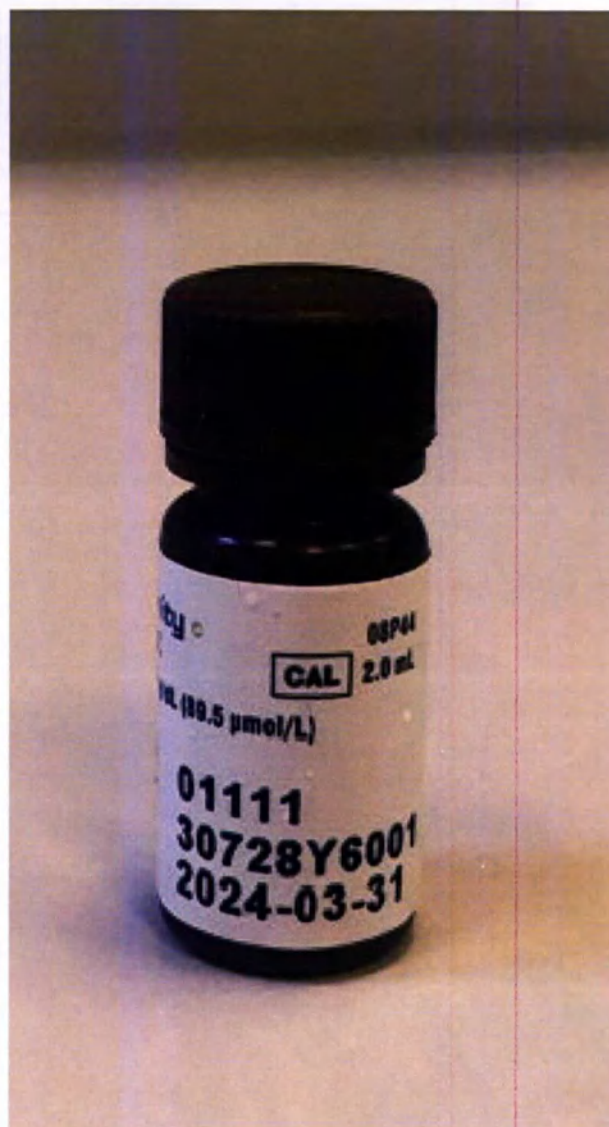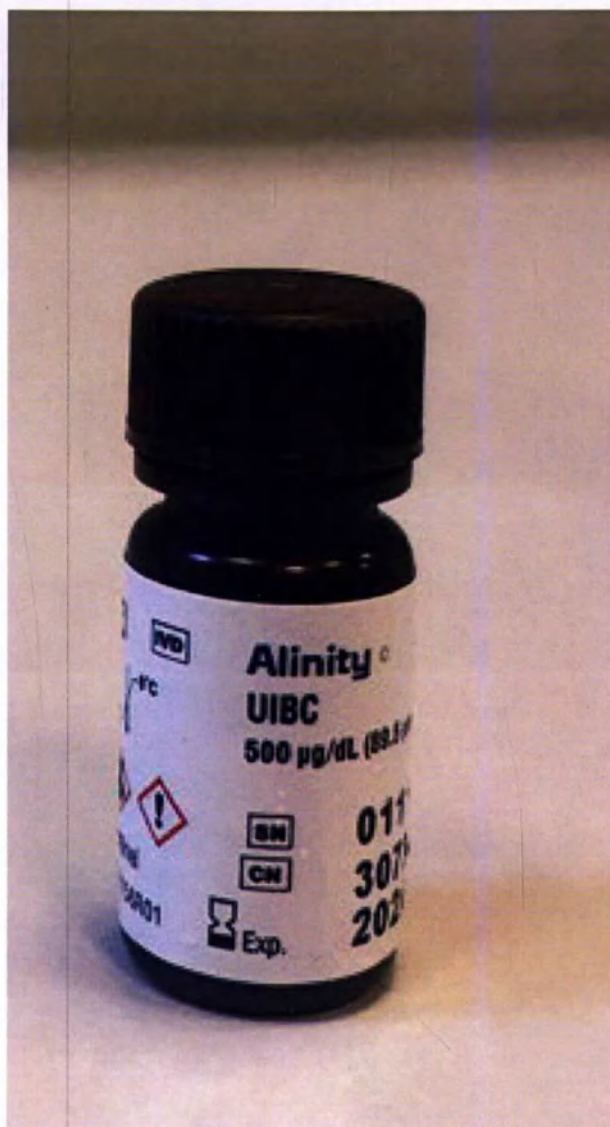

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов




Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного
определения ненасыщенной железосвязывающей способности (UIBC)
сыворотки или плазмы крови человека
колориметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity c
«UIBC Калибраторы (Alinity c UIBC Calibrator Kit)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



08P4401



Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности (UIBC) сыворотки или плазмы крови человека колориметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с


«UIBC Калибраторы (Alinity с UIBC Calibrator Kit)»

В составе: 1. Калибратор (Alinity с UIBC CAL) - 2 флакона х 2,0 мл; 2. Инструкция по применению - 1шт. / Производитель: «СЕНТИНЕЛЬ К. С.п.А.» (SENTINEL CH. S.p.A.), Via Robert Koch, 2, Milano (MI) 20152, Italy, Италия / Место производства: SENTINEL CH. S.p.A., Via Robert Koch, 2, Milano (MI) 20152, Italy / Страна происхождения: Италия / РУ № ____/____ от ____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1
Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет маркировки медицинского изделия UIBC Калибраторы (Alinity с UIBC Calibrator Kit),
внешняя (потребительская) упаковка

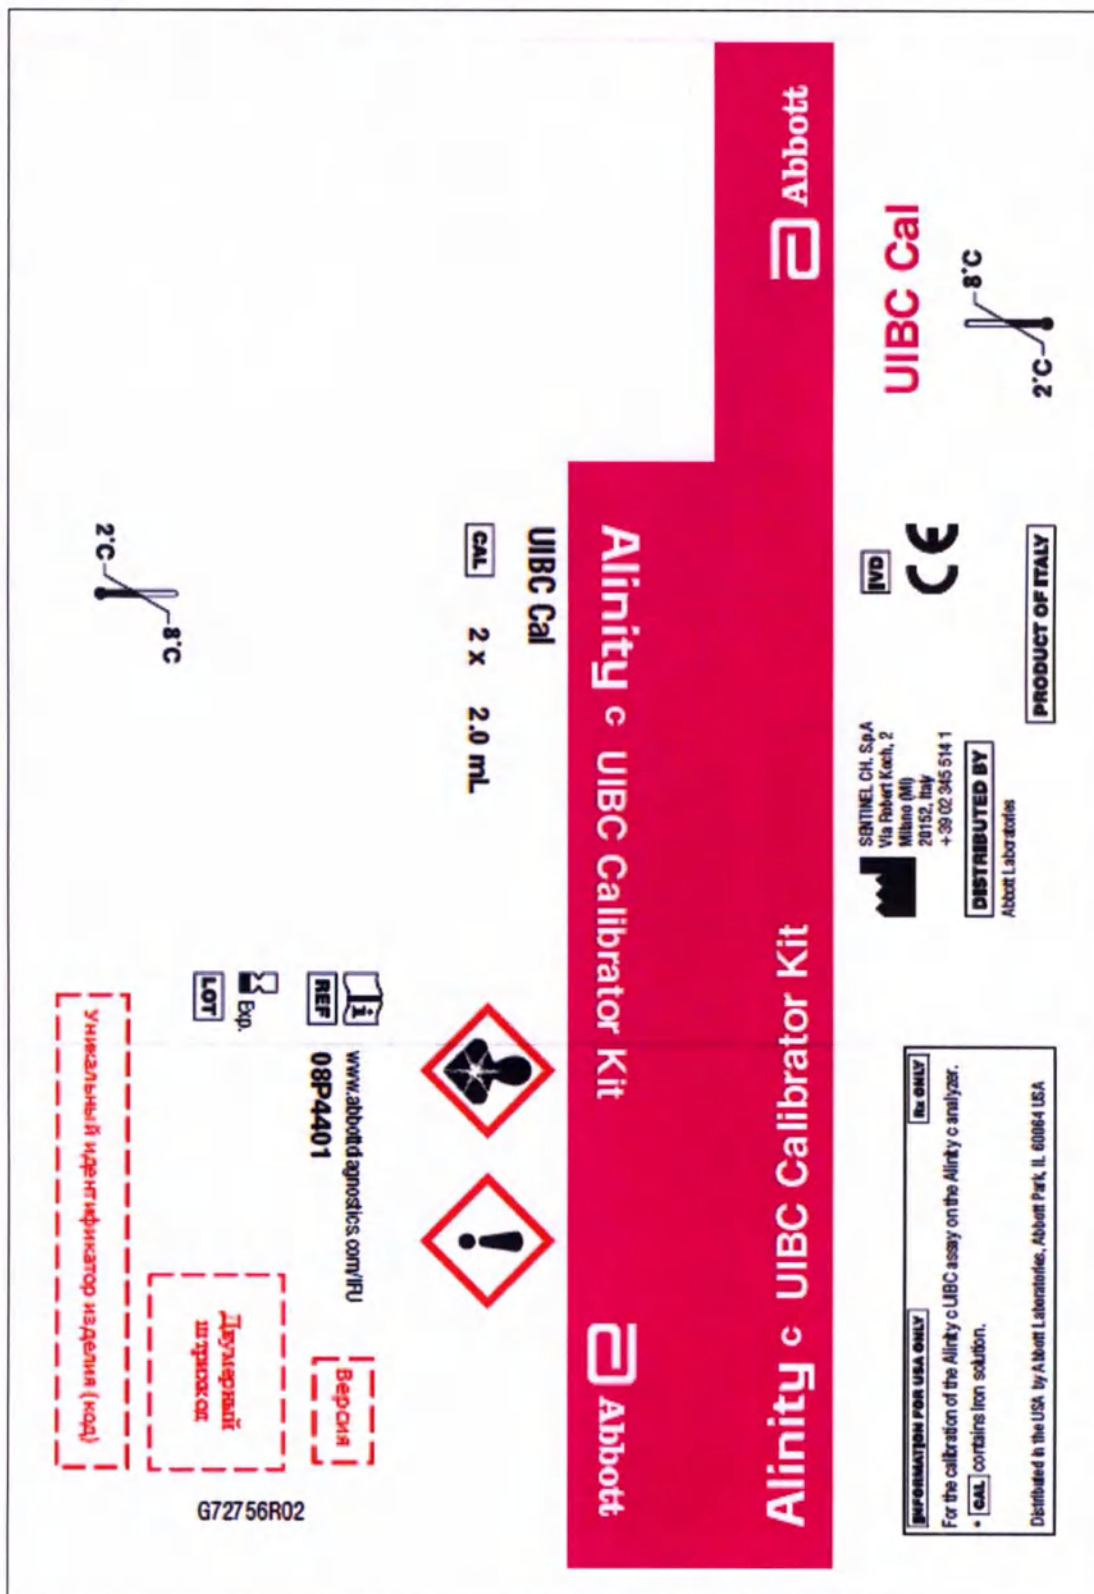

Макет маркировки компонентов медицинского изделия UIBC Калибраторы (Alinity с UIBC Calibrator Kit), флакон (внутренняя упаковка)

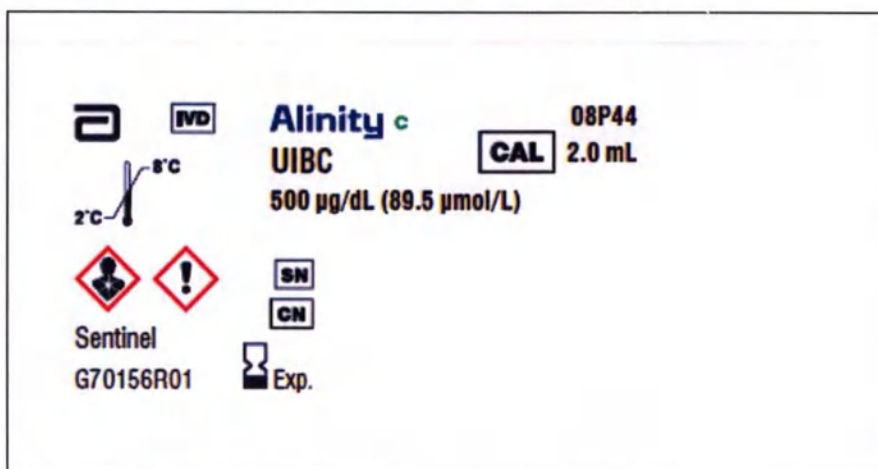

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов



Подпись _____