



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Материал калибровочный для установления референтных значений для количественного определения фибриногена (FIB), на анализаторах Succeeder для диагностики *in vitro*, в составе производства Beijing Succeeder Technology Inc., Tower 1A, No. 27 Chuangxin Rd, Tech Park Changping District, 102200 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

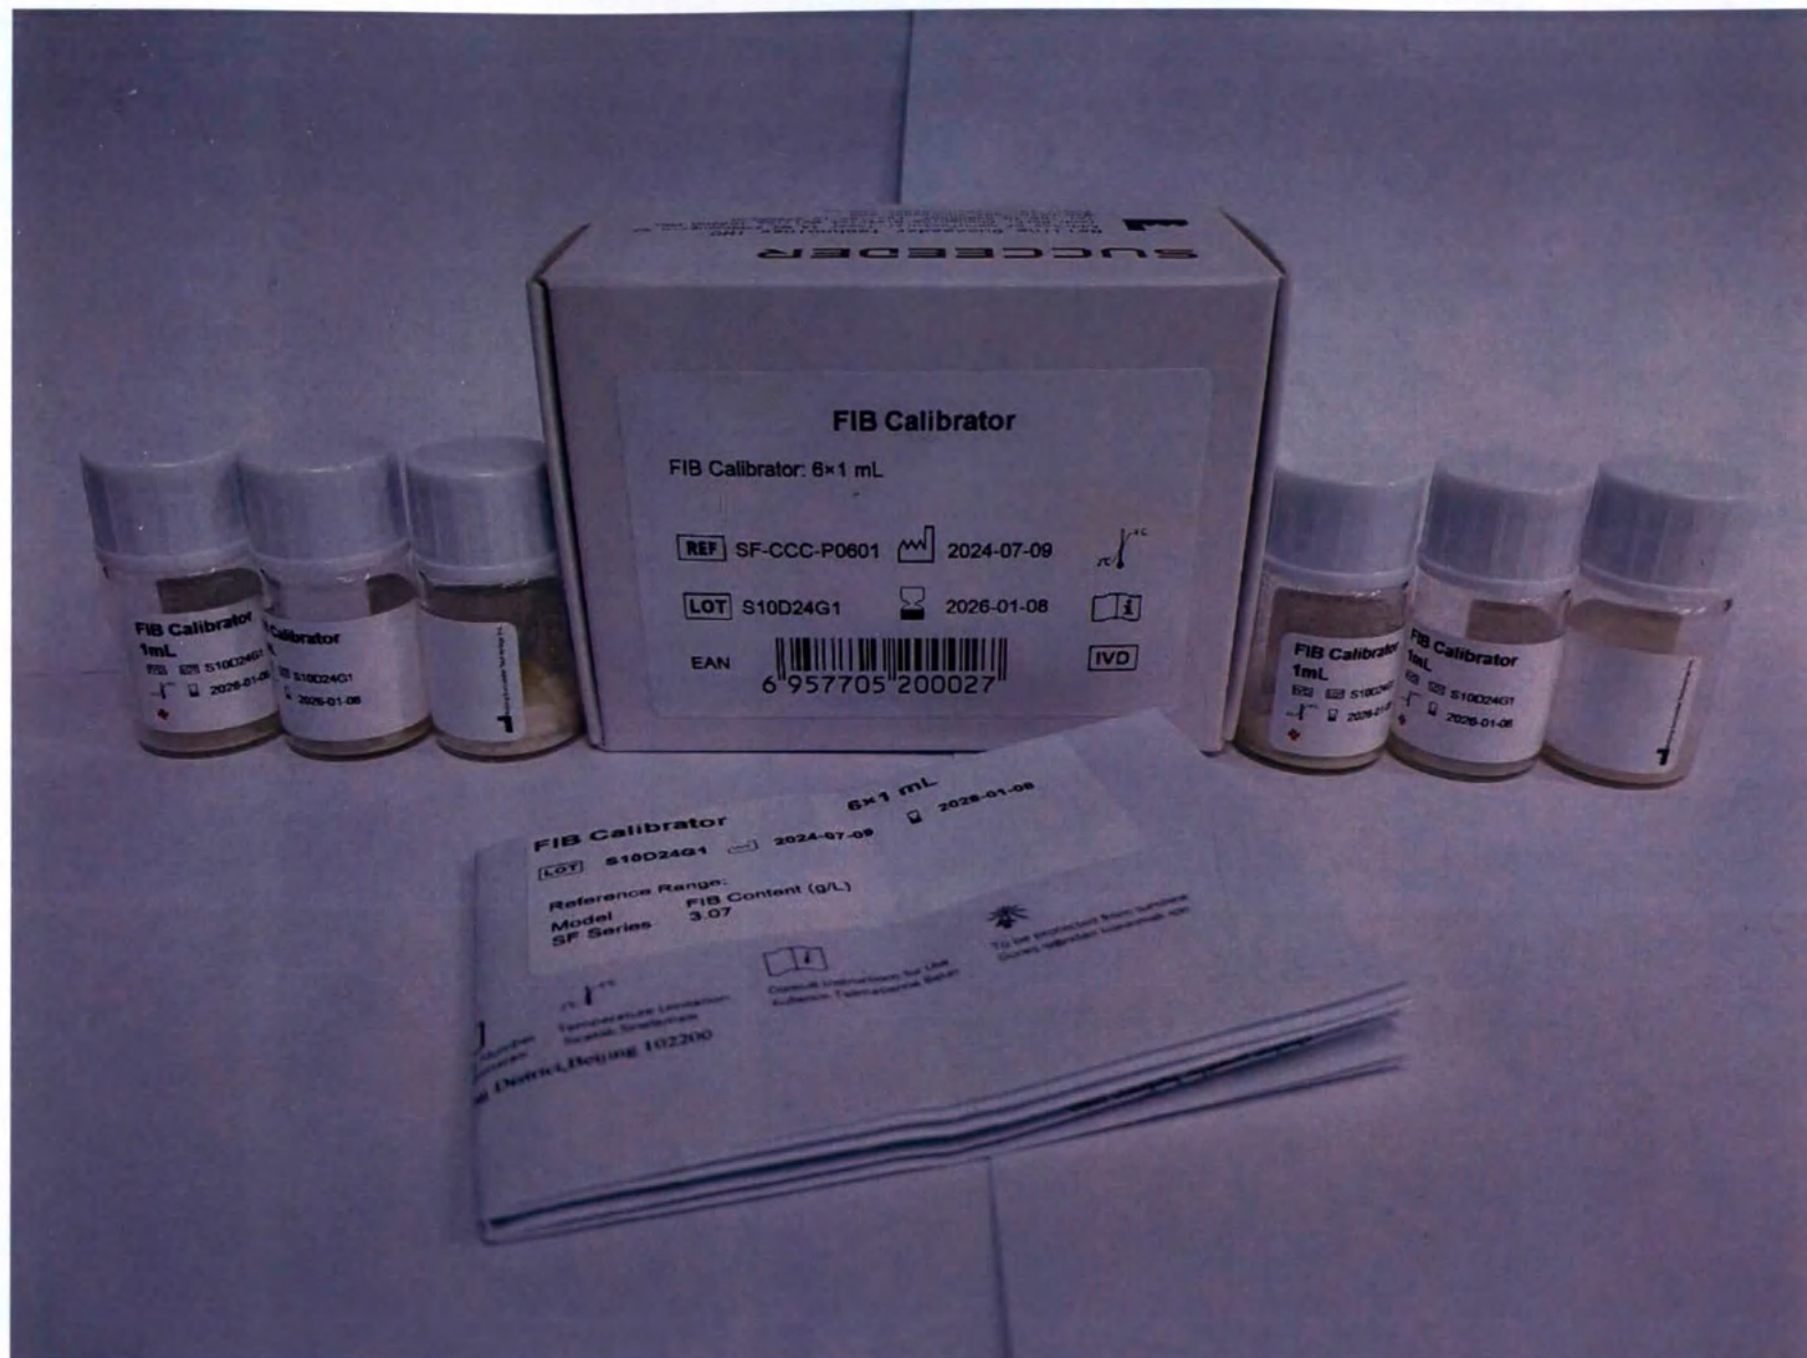


Общий вид медицинского изделия «Материал калибровочный для установления референтных значений для количественного определения фибриногена (FIB), на анализаторах Succeder для диагностики in vitro, в составе».

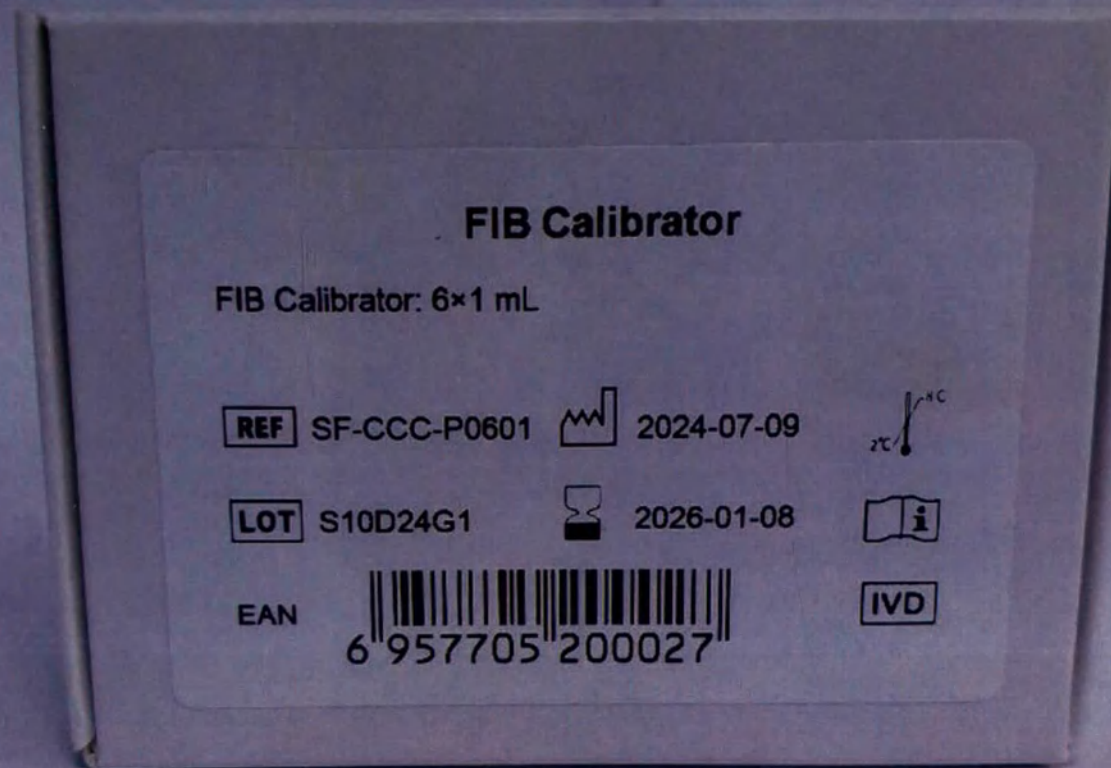

Вторичная упаковка (картонная коробка), вид сверху медицинского изделия «Материал калибровочный для установления референтных значений для количественного определения фибриногена (FIB), на анализаторах Succeder для диагностики in vitro, в составе».

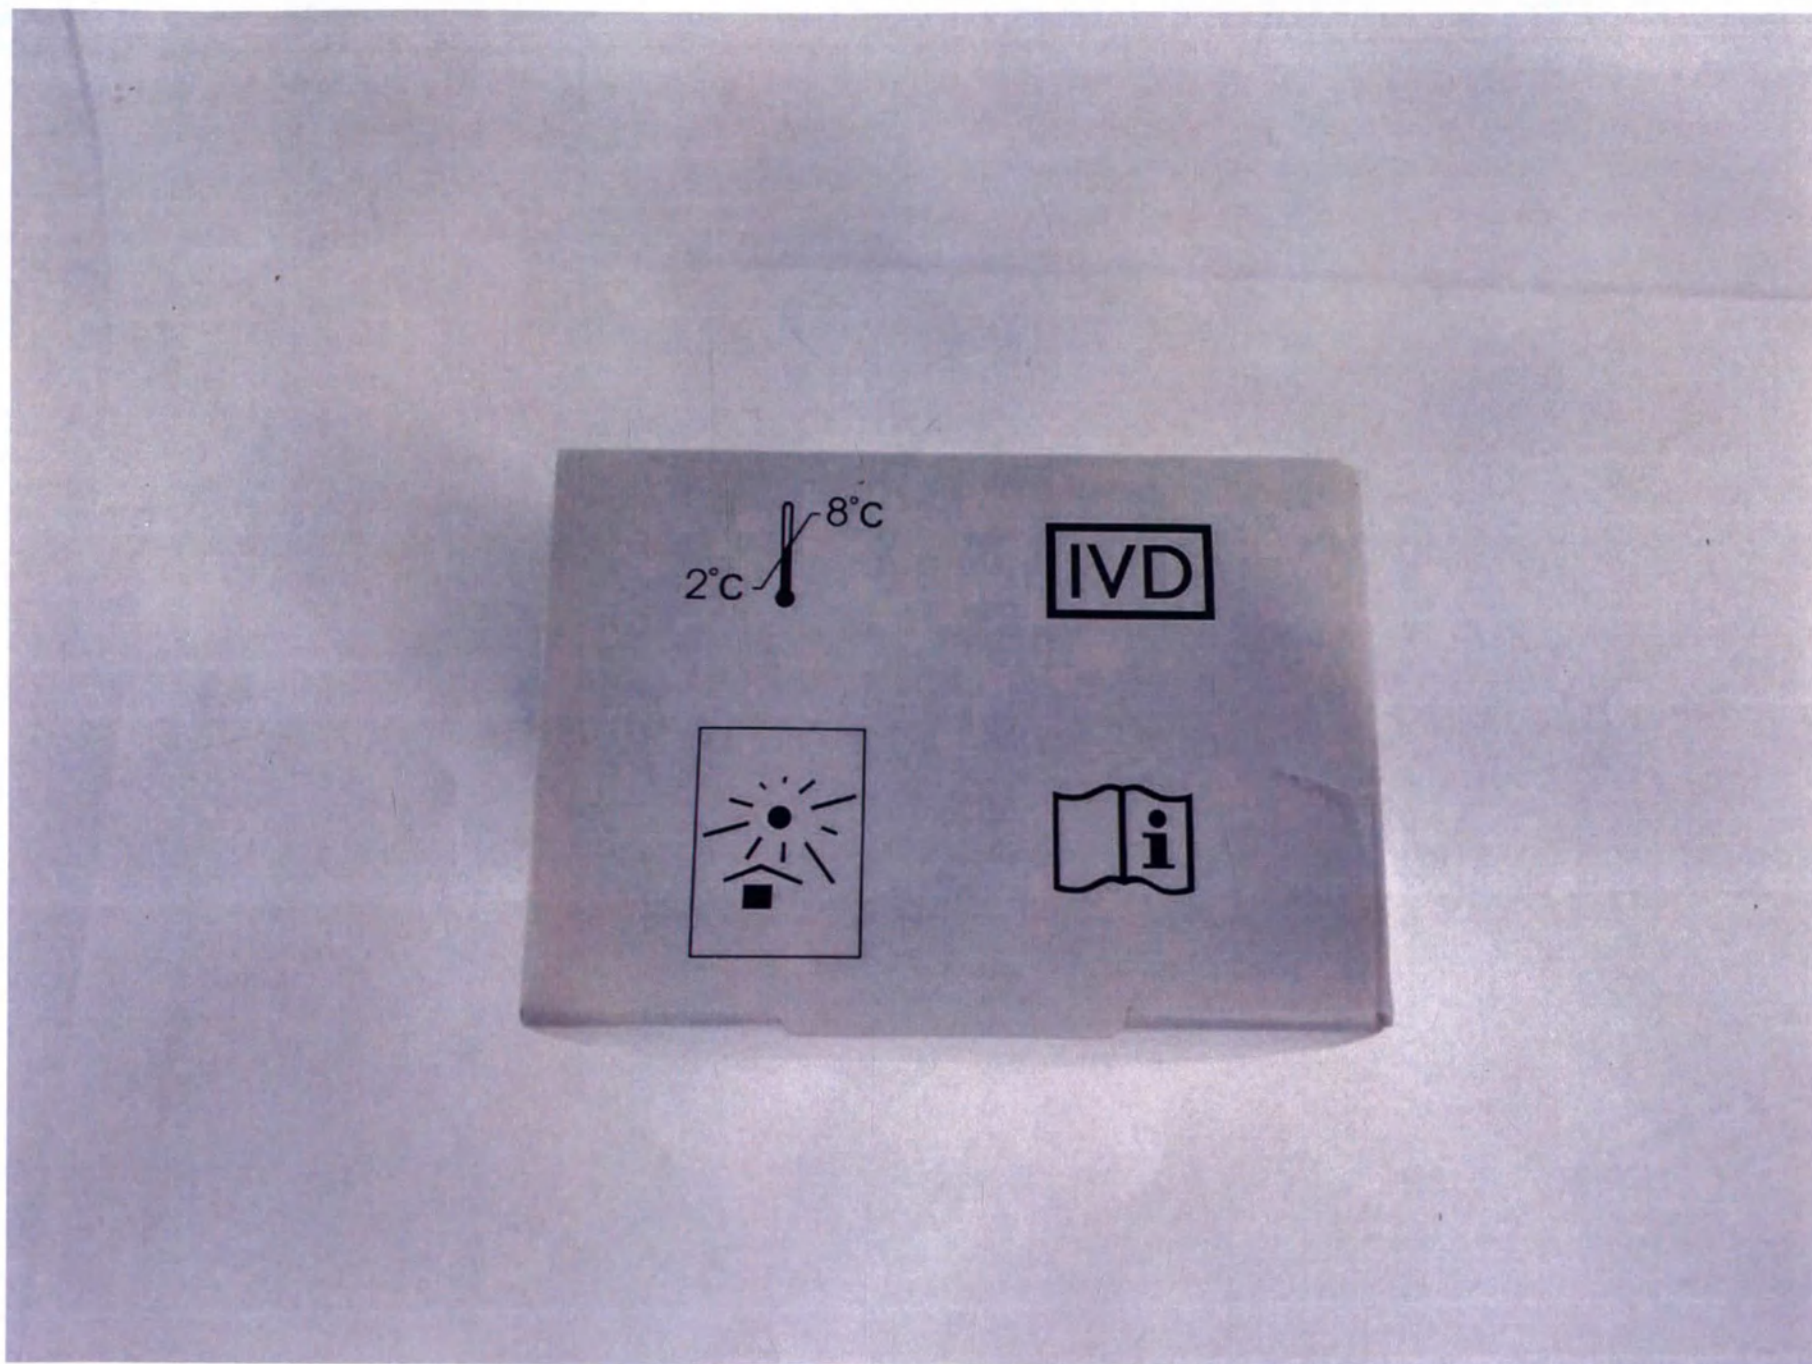

Вторичная упаковка (картонная коробка), вид сбоку медицинского изделия «Материал калибровочный для установления референтных значений для количественного определения фибриногена (FIB), на анализаторах Succeder для диагностики in vitro, в составе».

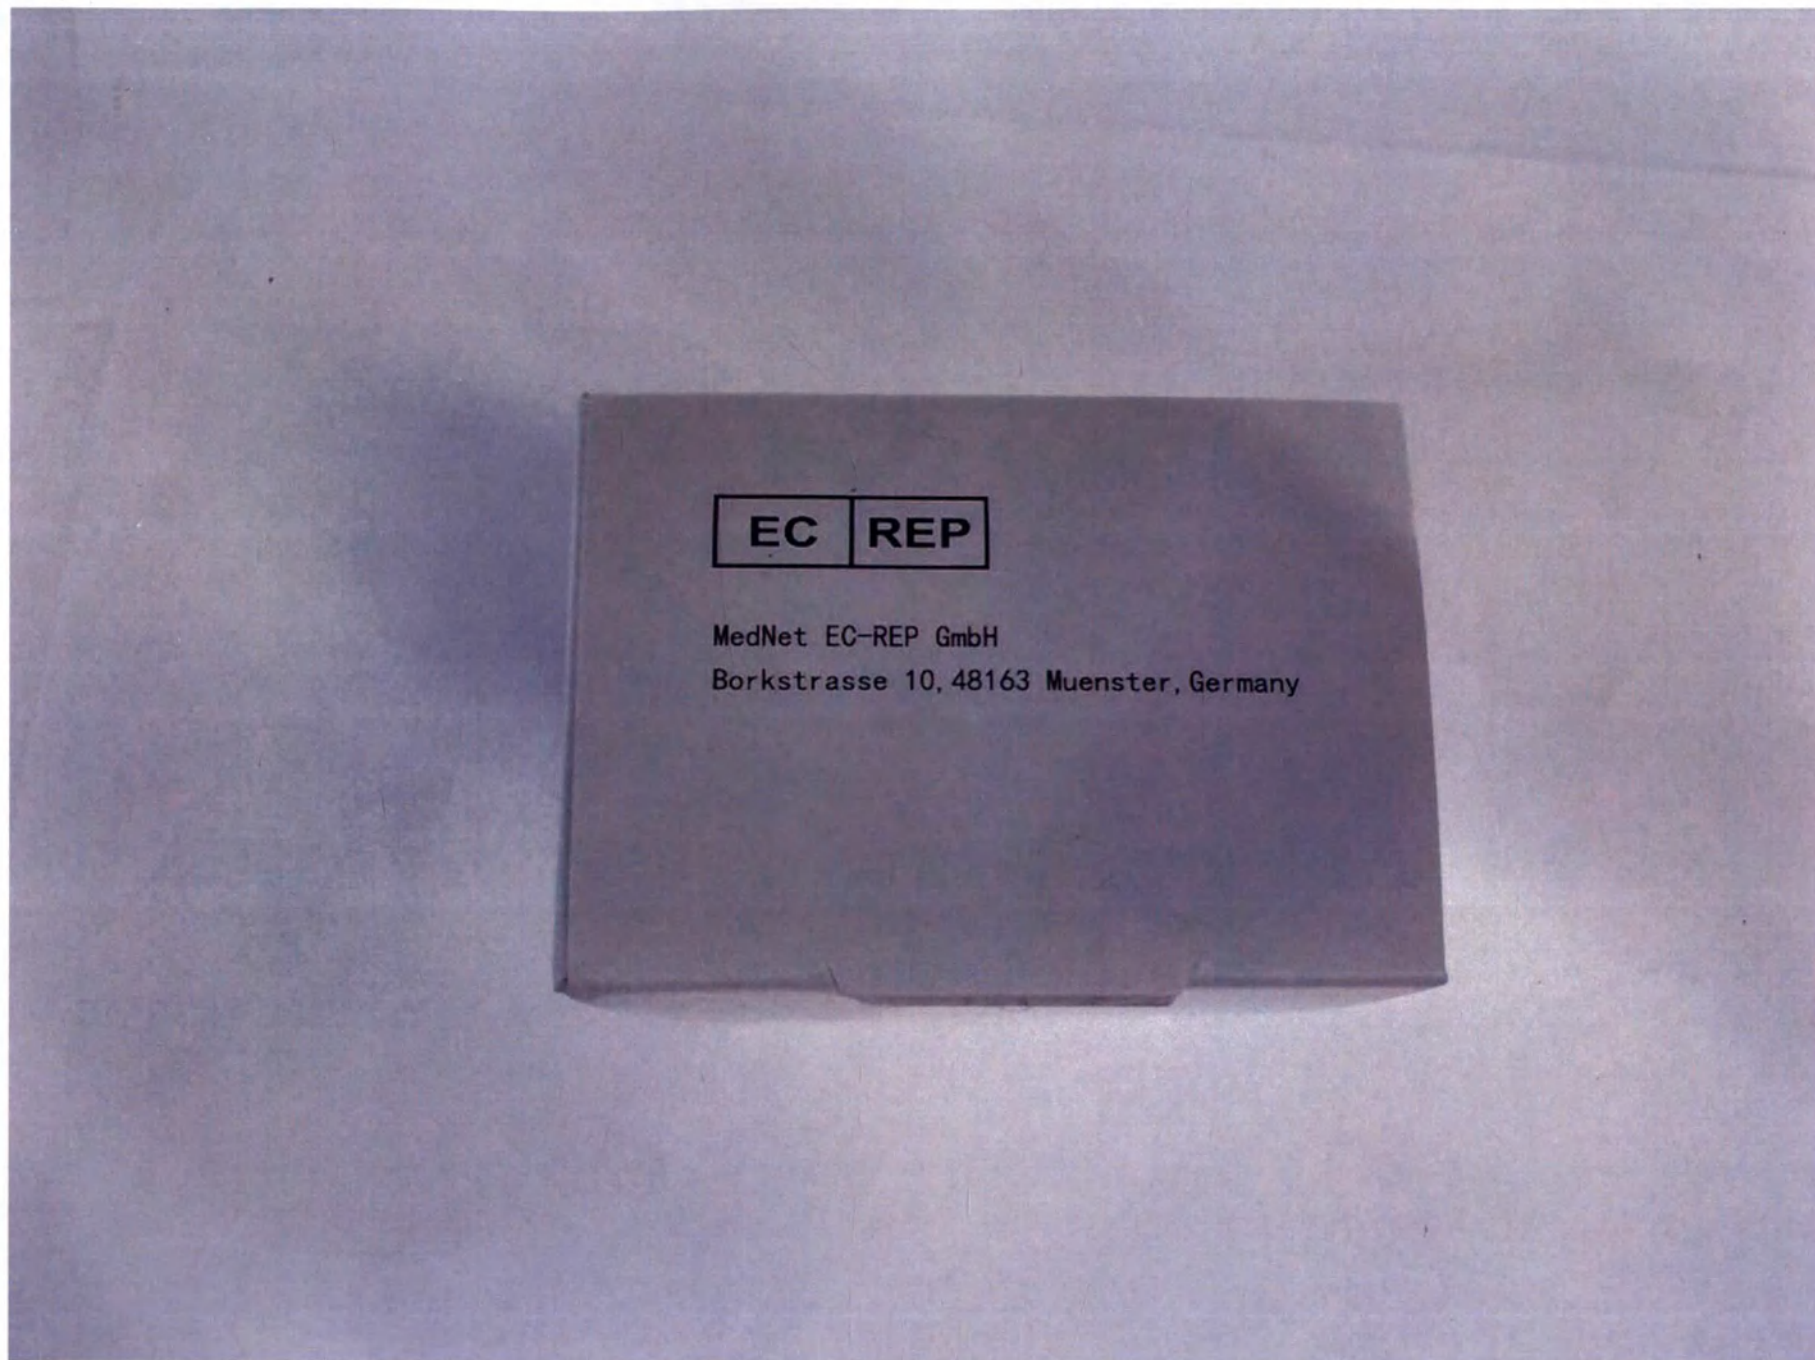

Вторичная упаковка (картонная коробка), вид сбоку медицинского изделия «Материал калибровочный для установления референтных значений для количественного определения фибриногена (FIB), на анализаторах Succeder для диагностики in vitro, в составе».

SUCCEEDER



Beijing Succeeder Technology INC.

Address of manufacturer: Tower 1A, No. 27 Chuangxin Rd.


Tech. Park, Changping District Beijing 102200 PRC.

Tel: +86-10-53855569 Fax: +86-10-53855570


Web: <http://www.succeeder.com>

Email: service@succeeder.com.cn


Вторичная упаковка (картонная коробка), вид сзади медицинского изделия «Материал калибровочный для установления референтных значений для количественного определения фибриногена (FIB), на анализаторах Succeeder для диагностики in vitro, в составе».

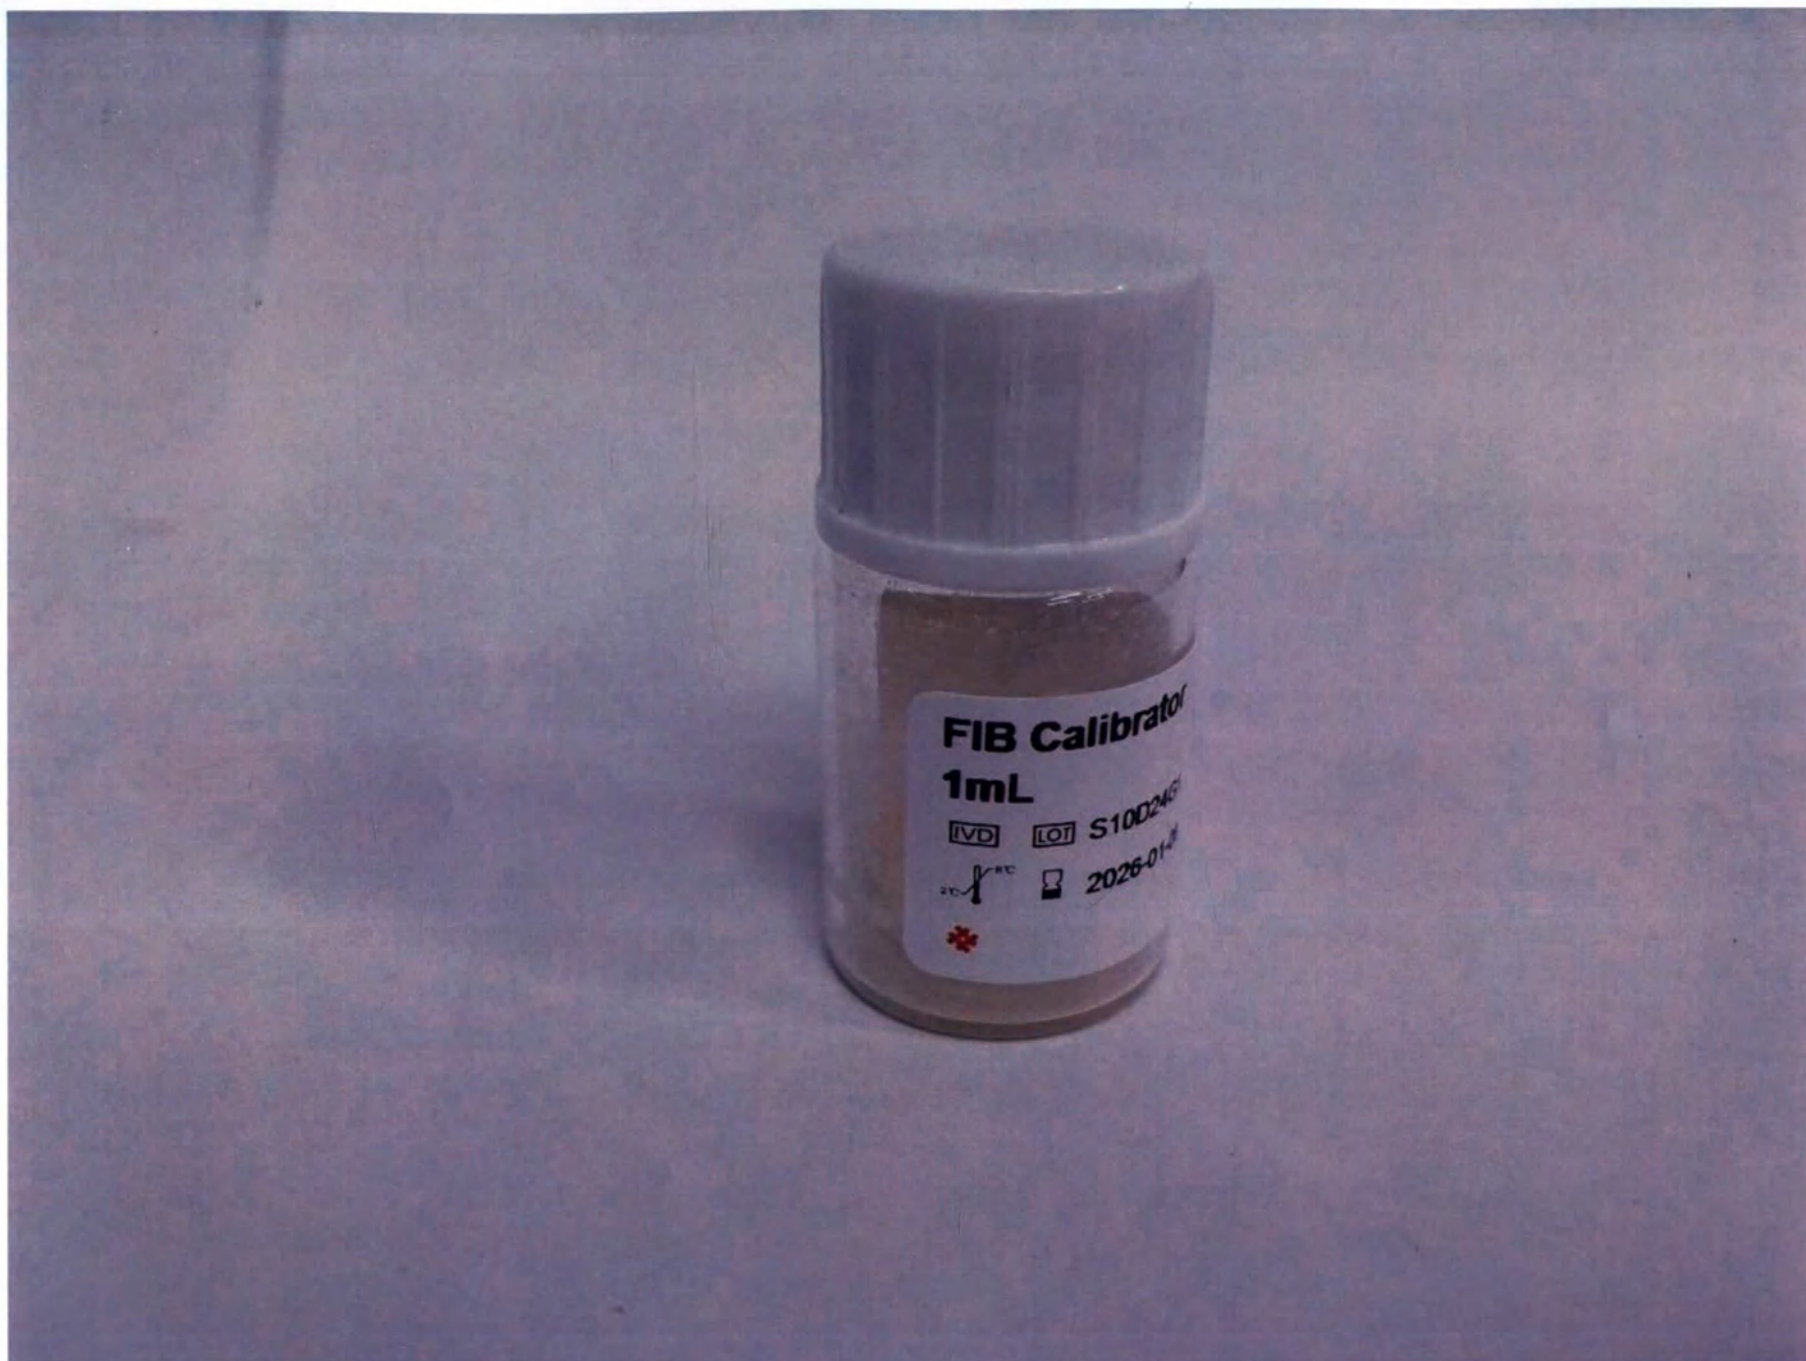

Внешний вид флакона Материал калибровочный медицинского изделия «Материал калибровочный для установления референтных значений для количественного определения фибриногена (FIB), на анализаторах Succeeder для диагностики in vitro, в составе», сторона 1.

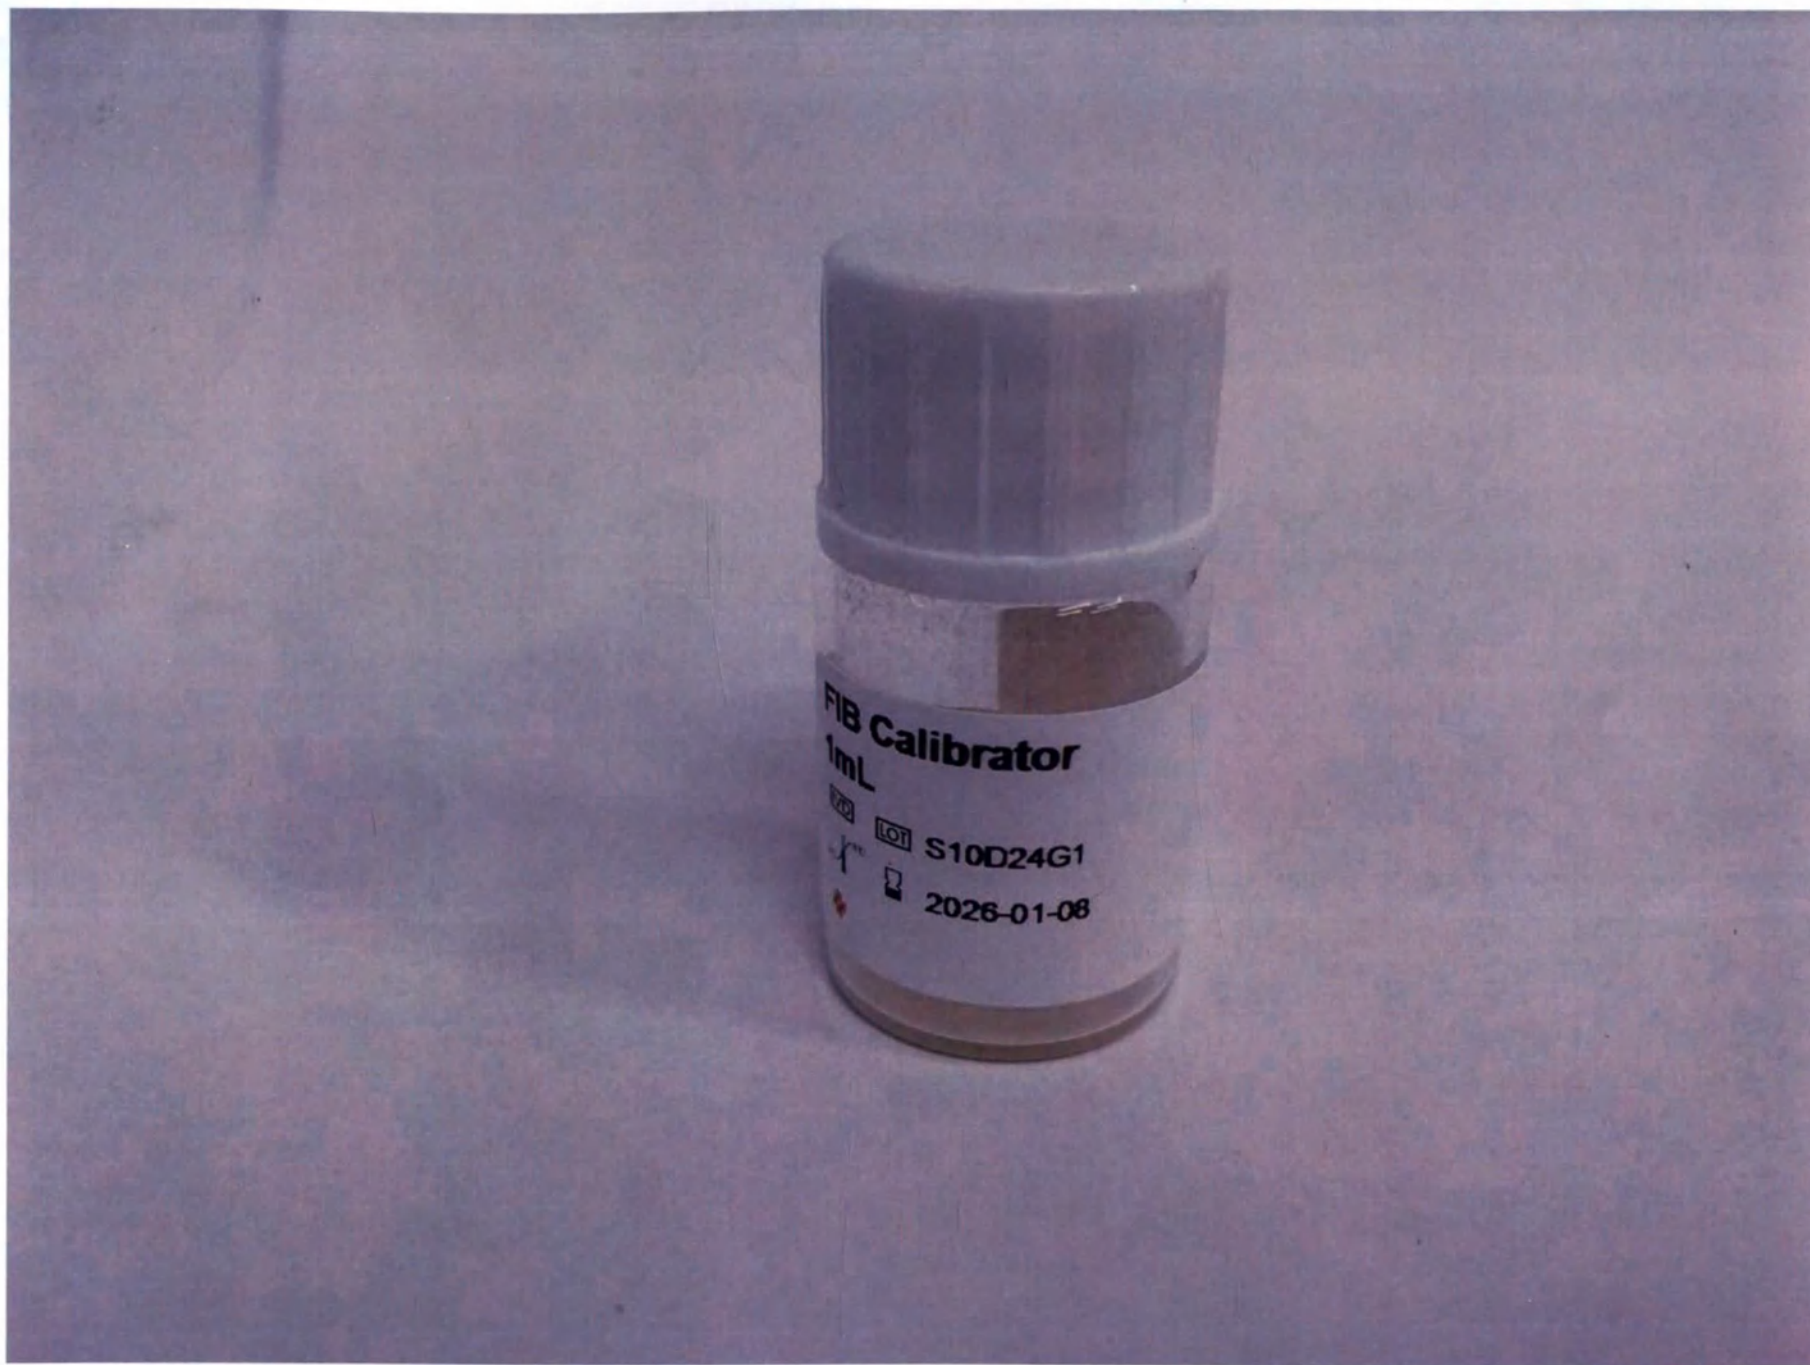

Внешний вид флакона Материал калибровочный медицинского изделия «Материал калибровочный для установления референтных значений для количественного определения фибриногена (FIB), на анализаторах Succeeder для диагностики in vitro, в составе», сторона 2.

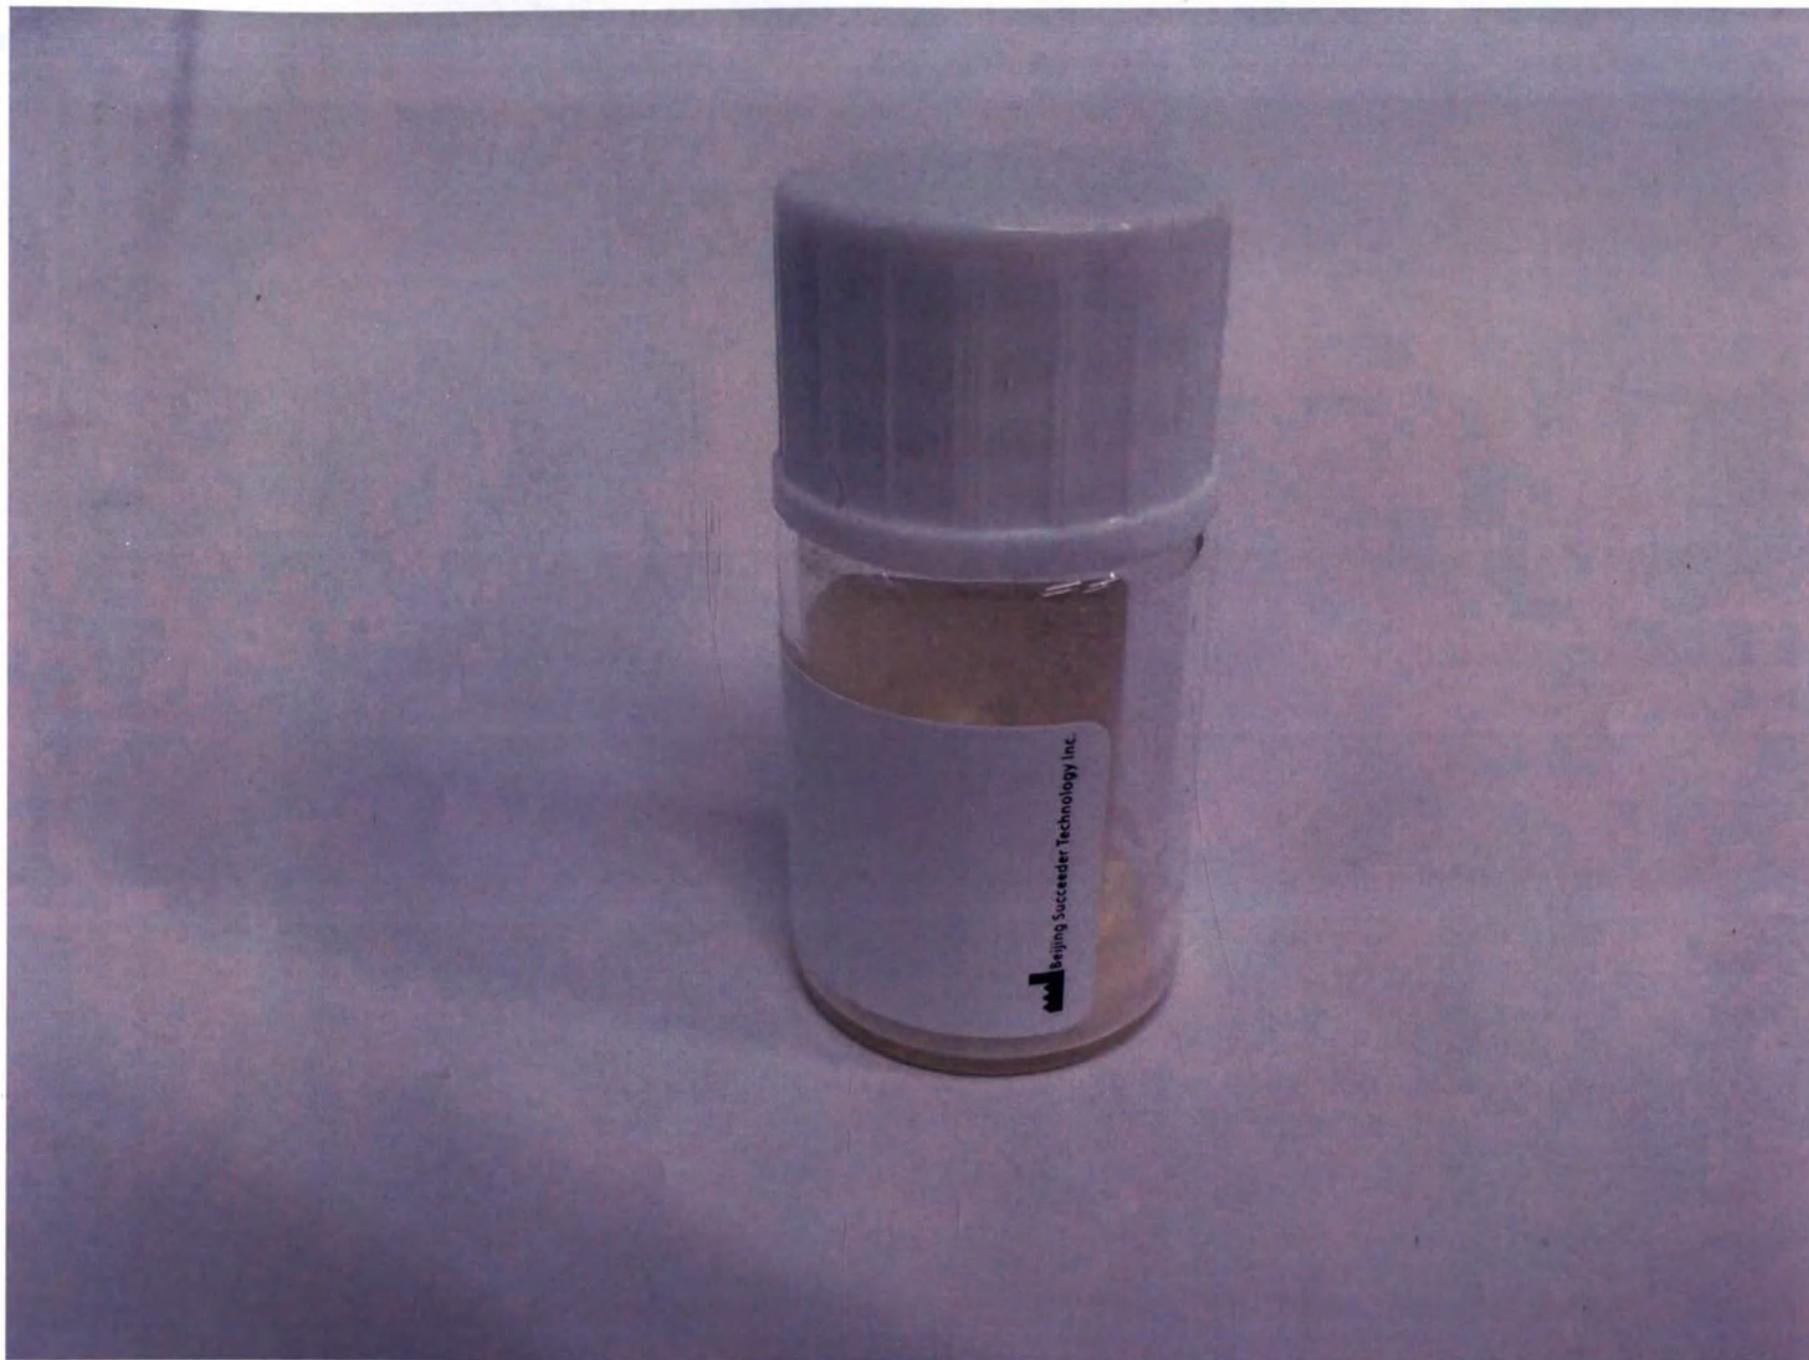

Внешний вид флакона Материал калибровочный медицинского изделия «Материал калибровочный для установления референтных значений для количественного определения фибриногена (FIB), на анализаторах Succeder для диагностики in vitro, в составе», сторона 3.



Фото транспортной упаковки медицинского изделия «Материал калибровочный для установления референтных значений для количественного определения фибриногена (FIB), на анализаторах Succeder для диагностики in vitro, в составе».

