

Фотографии общего вида

Медицинского изделия:

Автолинзметр (AUTOLENSMETER) PLM-8000

Состав:

- Основной блок PLM -8000 – 1 шт;
- Подставка для контактных линз – 1 шт;
- Кабель питания – 1 шт;
- Пылезащитный чехол – 1 шт;
- Бумага для печати для Автолинзметра (AUTOLENSMETER) PLM-8000 – от 1 до 10 рулонов;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт;

Производства

POTEC CO., LTD., ("ПОТЭК Ко., ЛТД.")

40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea



POTEC

Автолинзметр (AUTOLENSMETER) PLM-8000,
РУ № _____ от _____



Номинальное
напряжение 100-240В~, 50/60Гц

SN

L8JJ20BA

Потребляемая
мощность 35-55 ВА




2020.09.01



POTEC CO., LTD. ("ПОТЭК Ко., ЛТД.")

40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «ГМС», 127015,
г. Москва, ул. Вятская, дом 49, +7 (499)678 02 92, gmedsnab@gmail.com










Кабель питания – 1 шт.,

Пылезащитный чехол – 1 шт.,



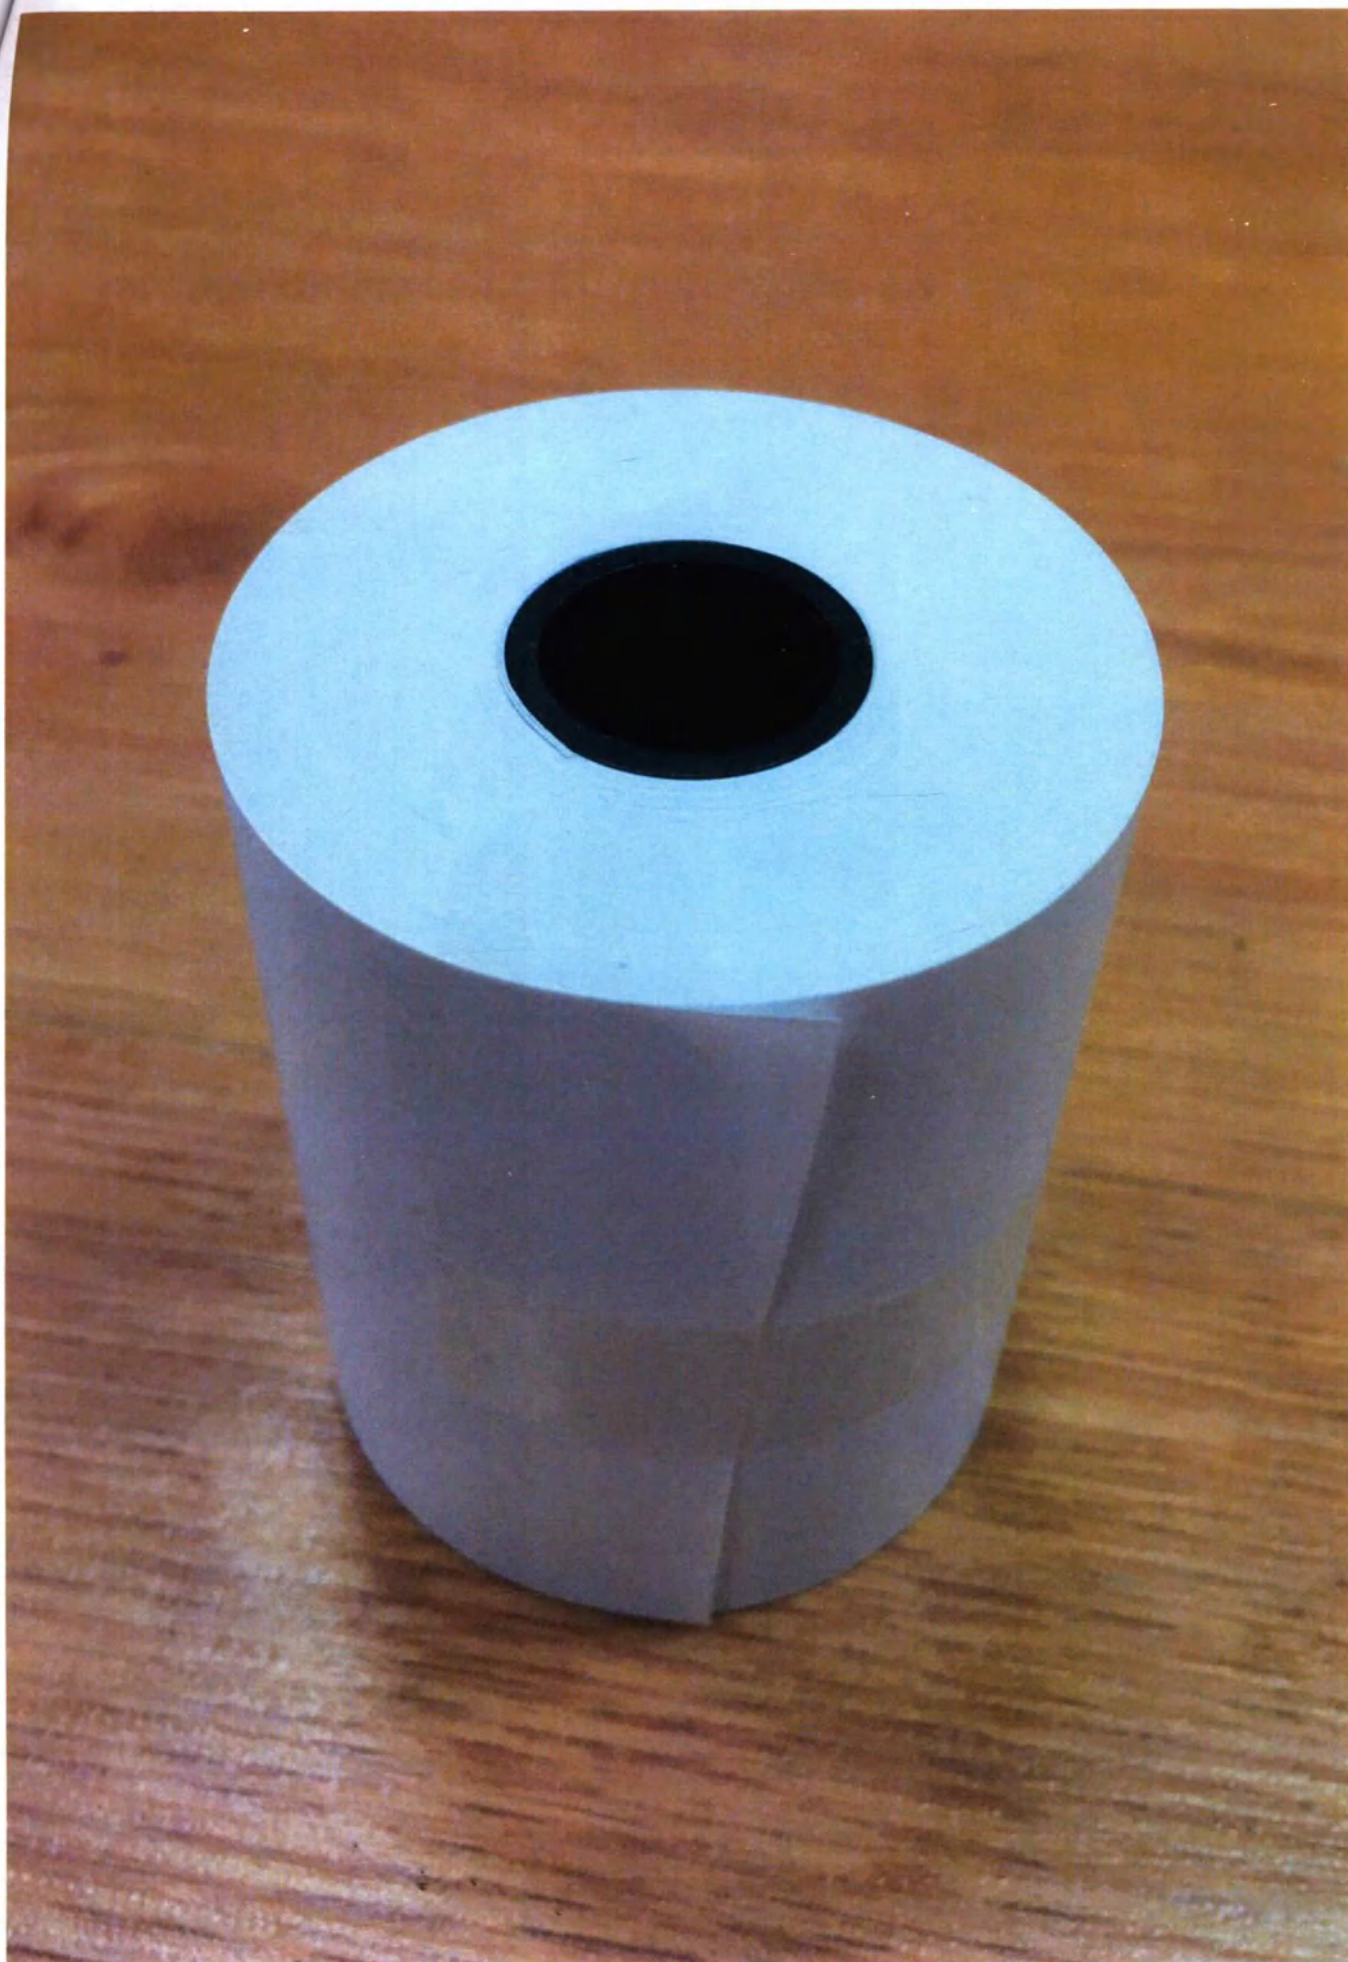

POTEC **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Автолинзметр (AUTOLENSMETER) PLM-8000

версия 3.0



Внимательно прочтите перед использованием



POTEC

Автолинзметр (AUTOLENSMETER) PLM-8000

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Бумага для печати, для Автолинзметра PLM-8000 – 1 рулон

Транспортировка и хранение: Температура: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, Влажность: 10% ~ 95% отн. влажности,
Давление: 500 ~ 1060 гПа

Эксплуатация: Температура: $+10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ Влажность: 30% ~ 90% отн. влажности
Давление: 800 ~ 1060 гПа

УТИЛИЗАЦИЯ: Отходы относятся к классу А (СанПиН 2.1.3684-21).



2020.09.01



POTEC CO., LTD.

40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «ГМС», 127015,
г. Москва, ул. Вятская, дом 49, строение 4, Тел.: +7 (499) 678-02-92






ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Макет маркировки на корпусе Автолинзметра PLM-8000 на русском языке

POTEC	Автолинзметр (AUTOLENSMETER) PLM-8000, РУ № _____ от _____	CE
Номинальное напряжение	100-240В~, 50/60Гц	SN L8JJ20BA
Потребляемая мощность	35-55 ВА	 2020.09.01
	POTEC CO., LTD. ("ПОТЭК Ко., ЛТД.") 40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «ГМС», 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом 49, +7 (499)678 02 92, gmedsnab@gmail.com	

Макет маркировки упаковки на русском языке

POTEC	Автолинзметр (AUTOLENSMETER) PLM-8000	CE
Состав: -Основной блок PLM -8000 – 1шт; -Подставка для контактных линз – 1шт; -Кабель питания – 1шт; -Пылезащитный чехол – 1шт; -Бумага для печати для Автолинзметра (AUTOLENSMETER) PLM-8000 – от 1 до 10 рулонов; -Руководство по эксплуатации – 1шт;		  
Регистрационное удостоверение № _____ от _____		
Вольт	100-240В~	SN L8JJ20BA
Мощность	40-60 ВА	 2020.09.01
Частота	50/60Гц	
Транспортировка и хранение: Температура: -40°C ~ +70°C, Влажность: 10% ~ 95% отн. влажности, Давление: 500 ~ 1060 гПа Эксплуатация: Температура: +10°C ~ +40°C Влажность: 30% ~ 90% Давление: 800 ~ 1060 гПа УТИЛИЗАЦИЯ: Отходы относятся к классу А (СанПиН 2.1.3684-21). Все электрические и электронные изделия должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов.		
	POTEC CO., LTD. 40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «ГМС», 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом 49, +7 (499)678 02 92, gmedsnab@gmail.com	

POTEC

Автолинзметр (AUTOLENSMETER) PLM-8000

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Бумага для печати, для Автолинзметра PLM-8000 – 1 рулон

Транспортировка и хранение: Температура: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, Влажность: 10% ~ 95% отн. влажности,
Давление: 500 ~ 1060 гПа

Эксплуатация: Температура: $+10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ Влажность: 30% ~ 90% отн. влажности

Давление: 800 ~ 1060 гПа

УТИЛИЗАЦИЯ: Отходы относятся к классу А (СанПиН 2.1.3684-21).



2020.09.01



POTEC CO., LTD.


40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «ГМС», 127015,
г. Москва, ул. Вятская, дом 49, строение 4, Тел.: +7 (499) 678-02-92

Прошито и пронумеровано

15 (пятнадцать) листов

Генеральный директор
ООО «ГЛАВМЕДСНАБ»



Саенков М.А

