

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4

Согласовано

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Адрес

Генеральный директор

Должность

Мартин Пьер Колас

Имя, Фамилия

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись



Фотографические изображения

Видеоэзофагоскоп гибкий CMOS, с принадлежностями

2024



Рис. 1. Видеоэзофагоскоп гибкий CMOS, с принадлежностями. Транспортная упаковка.



Рис. 2. Видеоэзофагоскоп гибкий CMOS, с принадлежностями. Маркировка на транспортной упаковке.



Рис. 3. Видеоэзофагоскоп гибкий CMOS, с принадлежностями. Упаковка



Рис. 4. Видеоэзофагоскоп гибкий CMOS, с принадлежностями. Маркировка на упаковке.



Рис. 5. Видеоэзофагоскоп гибкий CMOS, с принадлежностями.

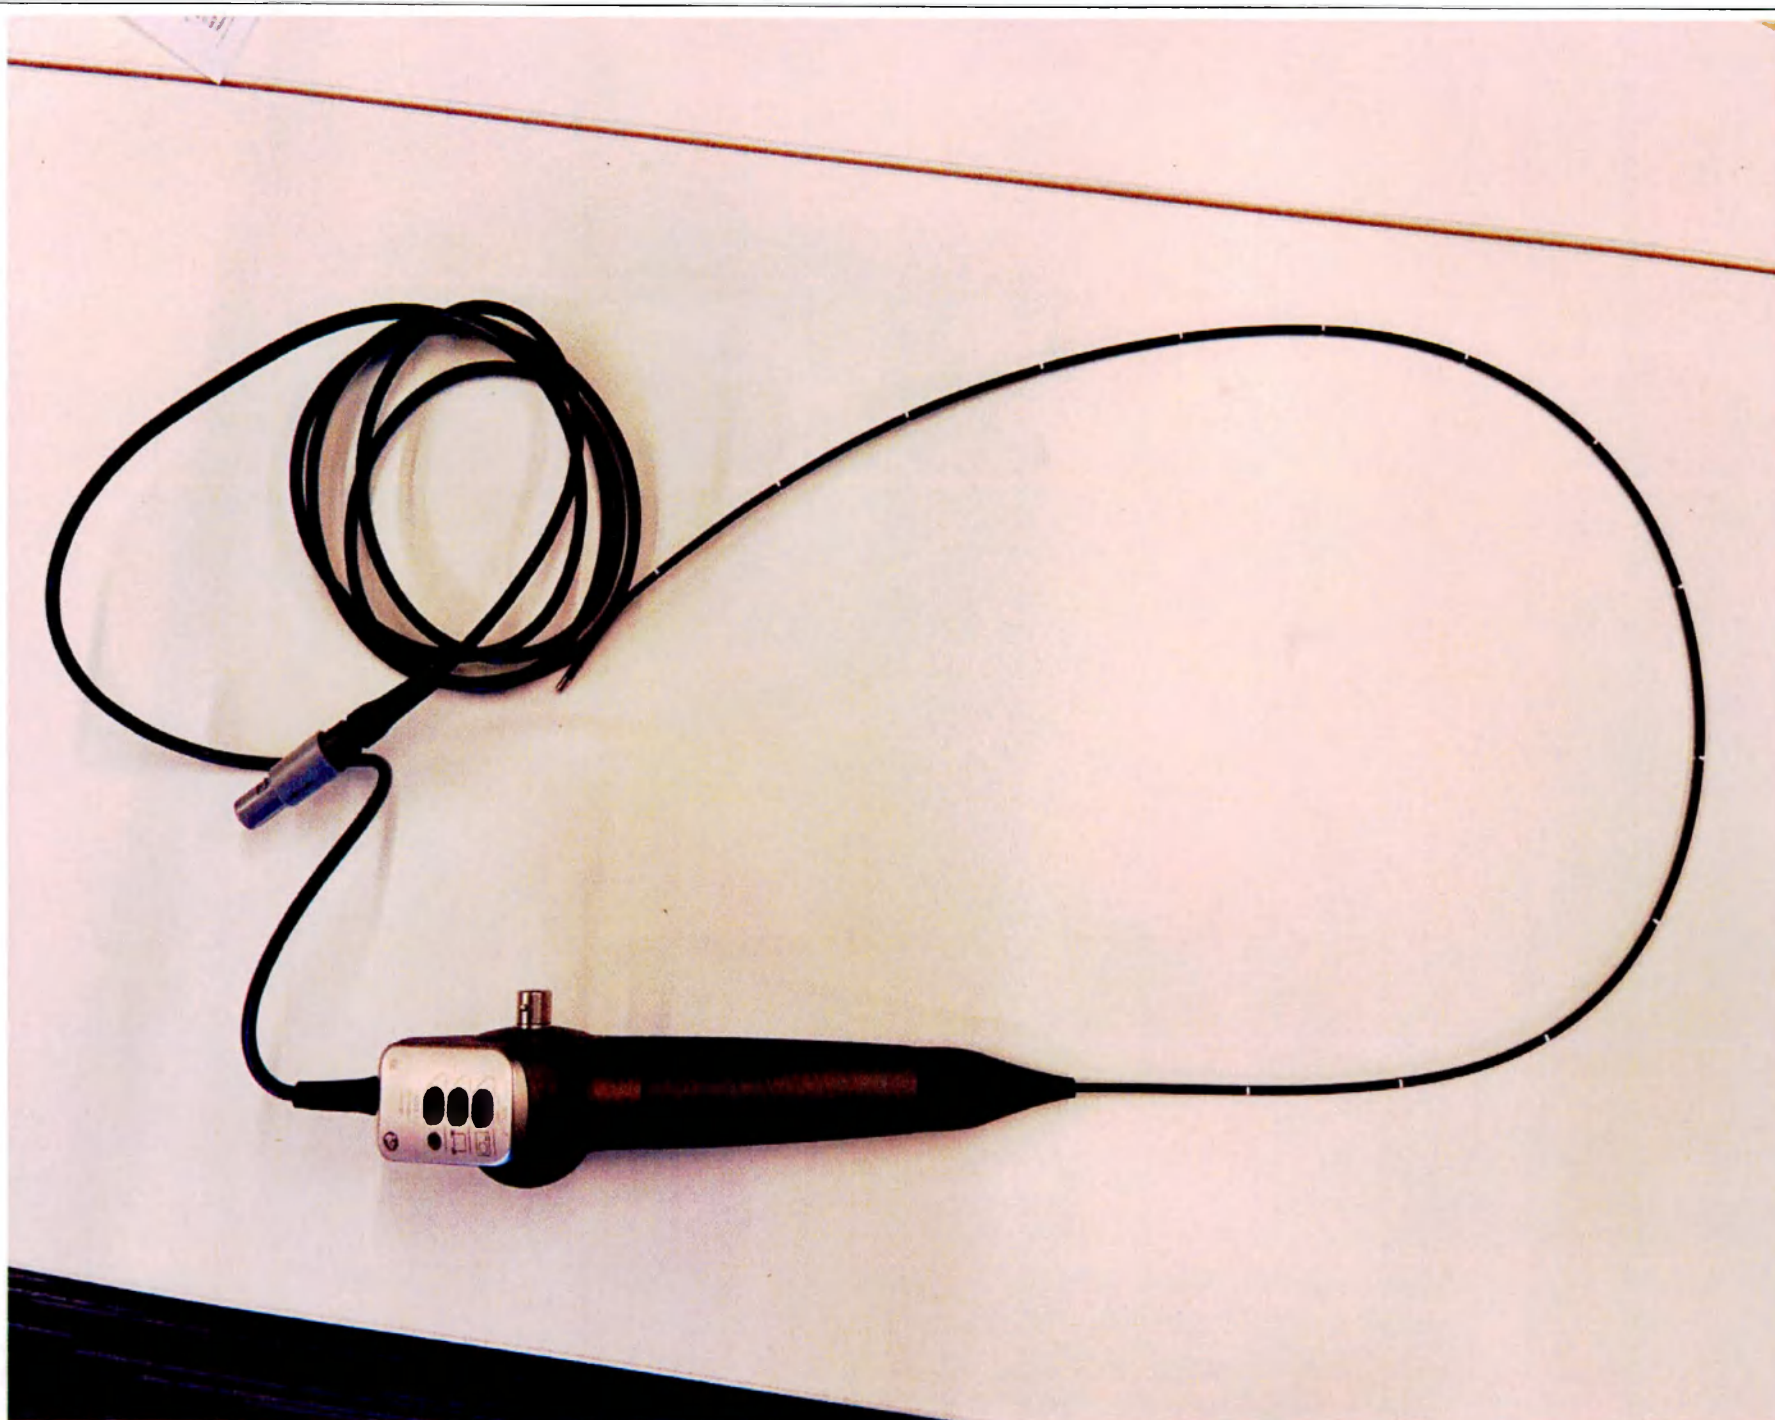


Рис. 6. Видеоэзофагоскоп гибкий CMOS, с принадлежностями.

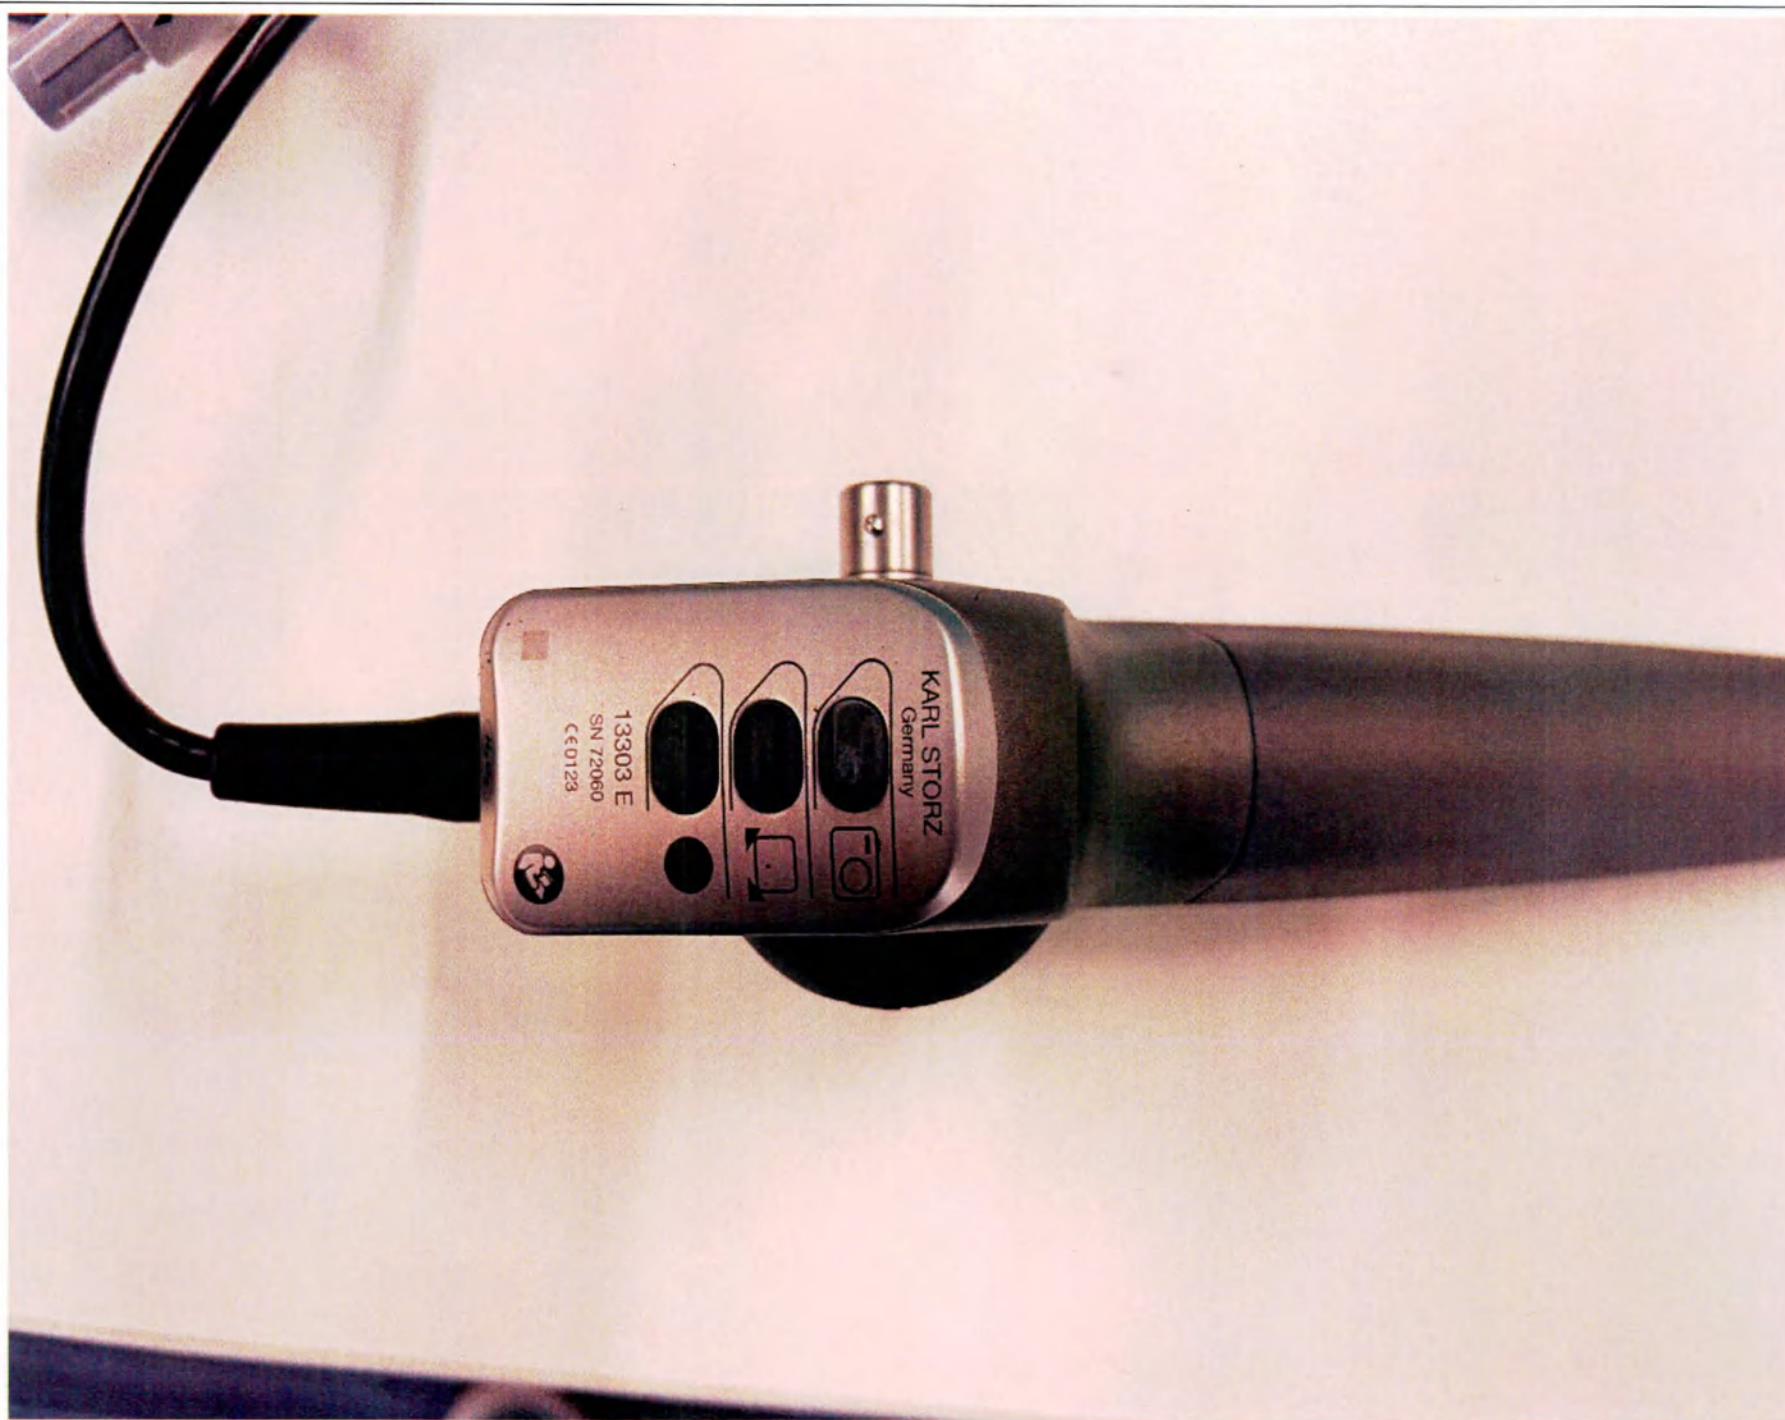


Рис. 7. Видеоэзофагоскоп гибкий CMOS, с принадлежностями.

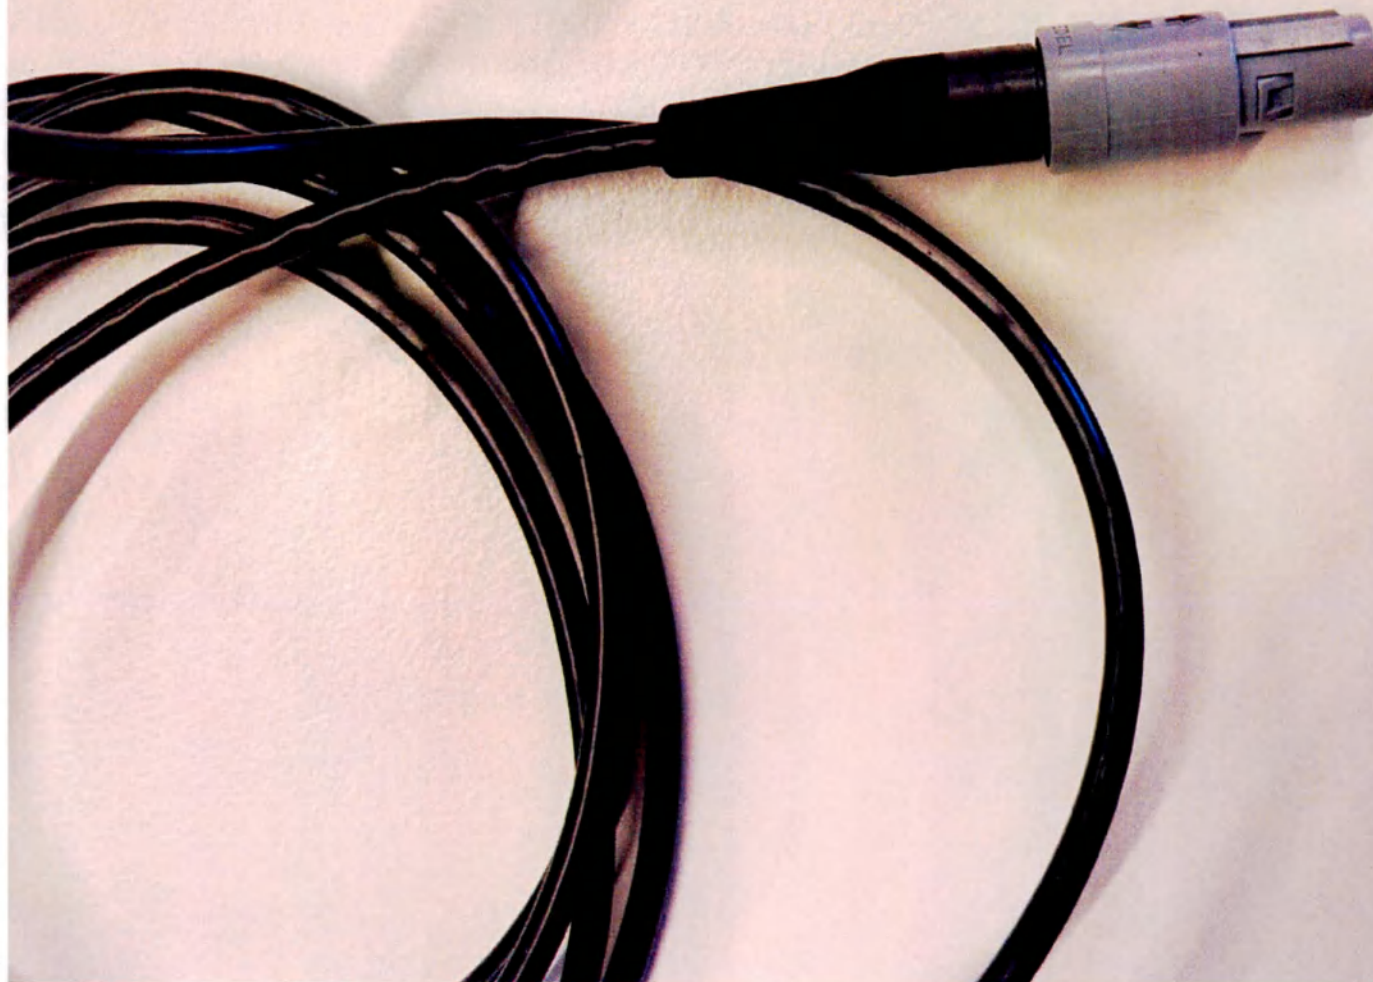


Рис. 8. Видеоэзофагоскоп гибкий CMOS, с принадлежностями.



Рис. 9. Эксплуатационная документация. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье

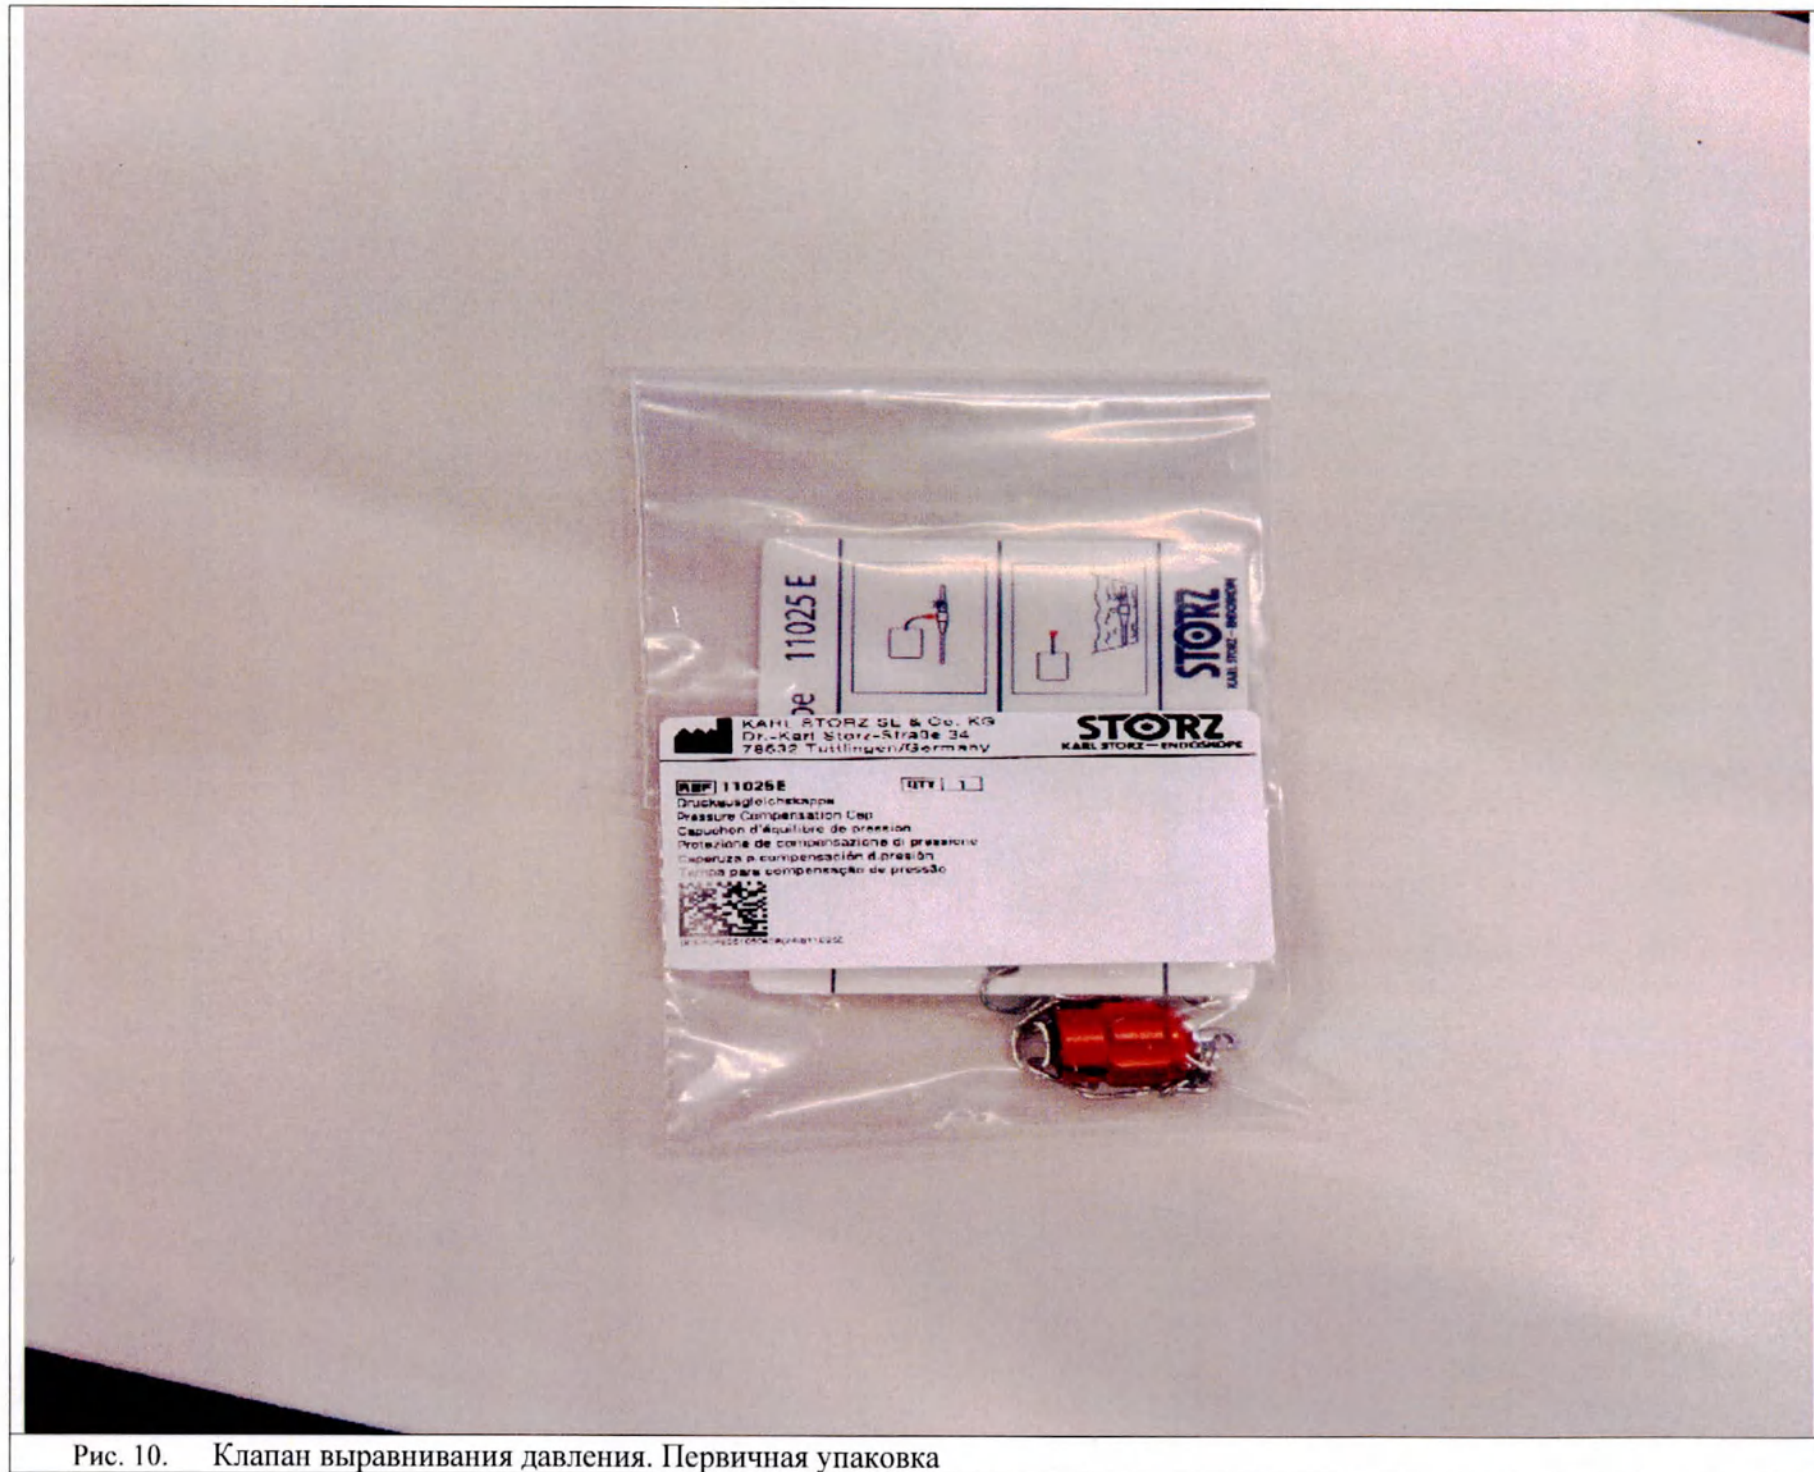


Рис. 10. Клапан выравнивания давления. Первичная упаковка



Рис. 11. Клапан выравнивания давления.

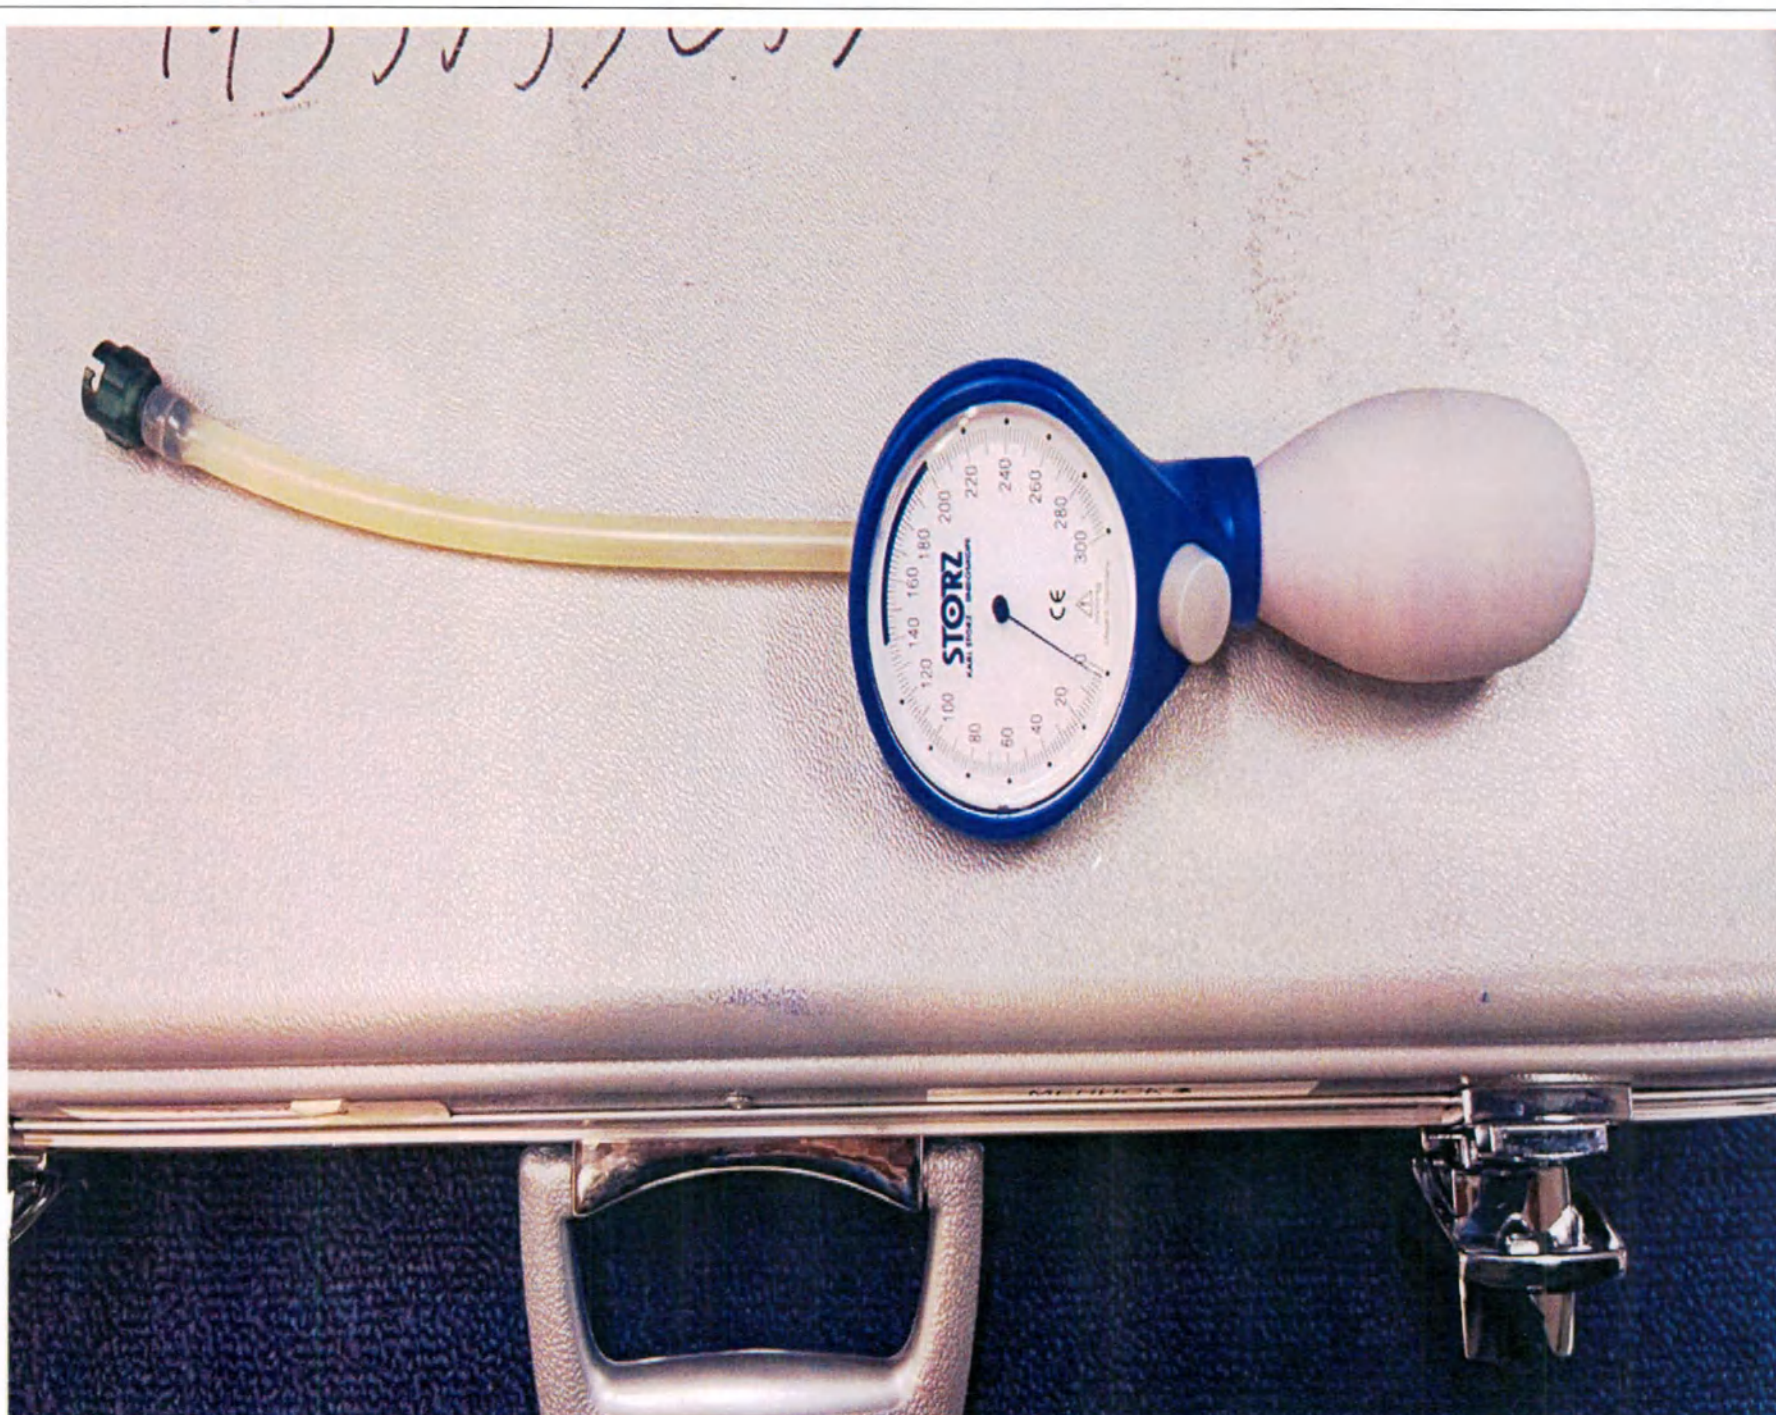


Рис. 12. Прибор проверки герметичности.



Рис. 13. Чемодан жесткий для видеоэндоскопа. Закрытый вид.



Рис. 14. Чехол жесткий для видеозондоскопа. Замкнутый вид



Рис. 15. Чемодан жесткий для видеоэндоскопа. Открытый вид



Рис. 16. Защитный колпачок. Первичная упаковка

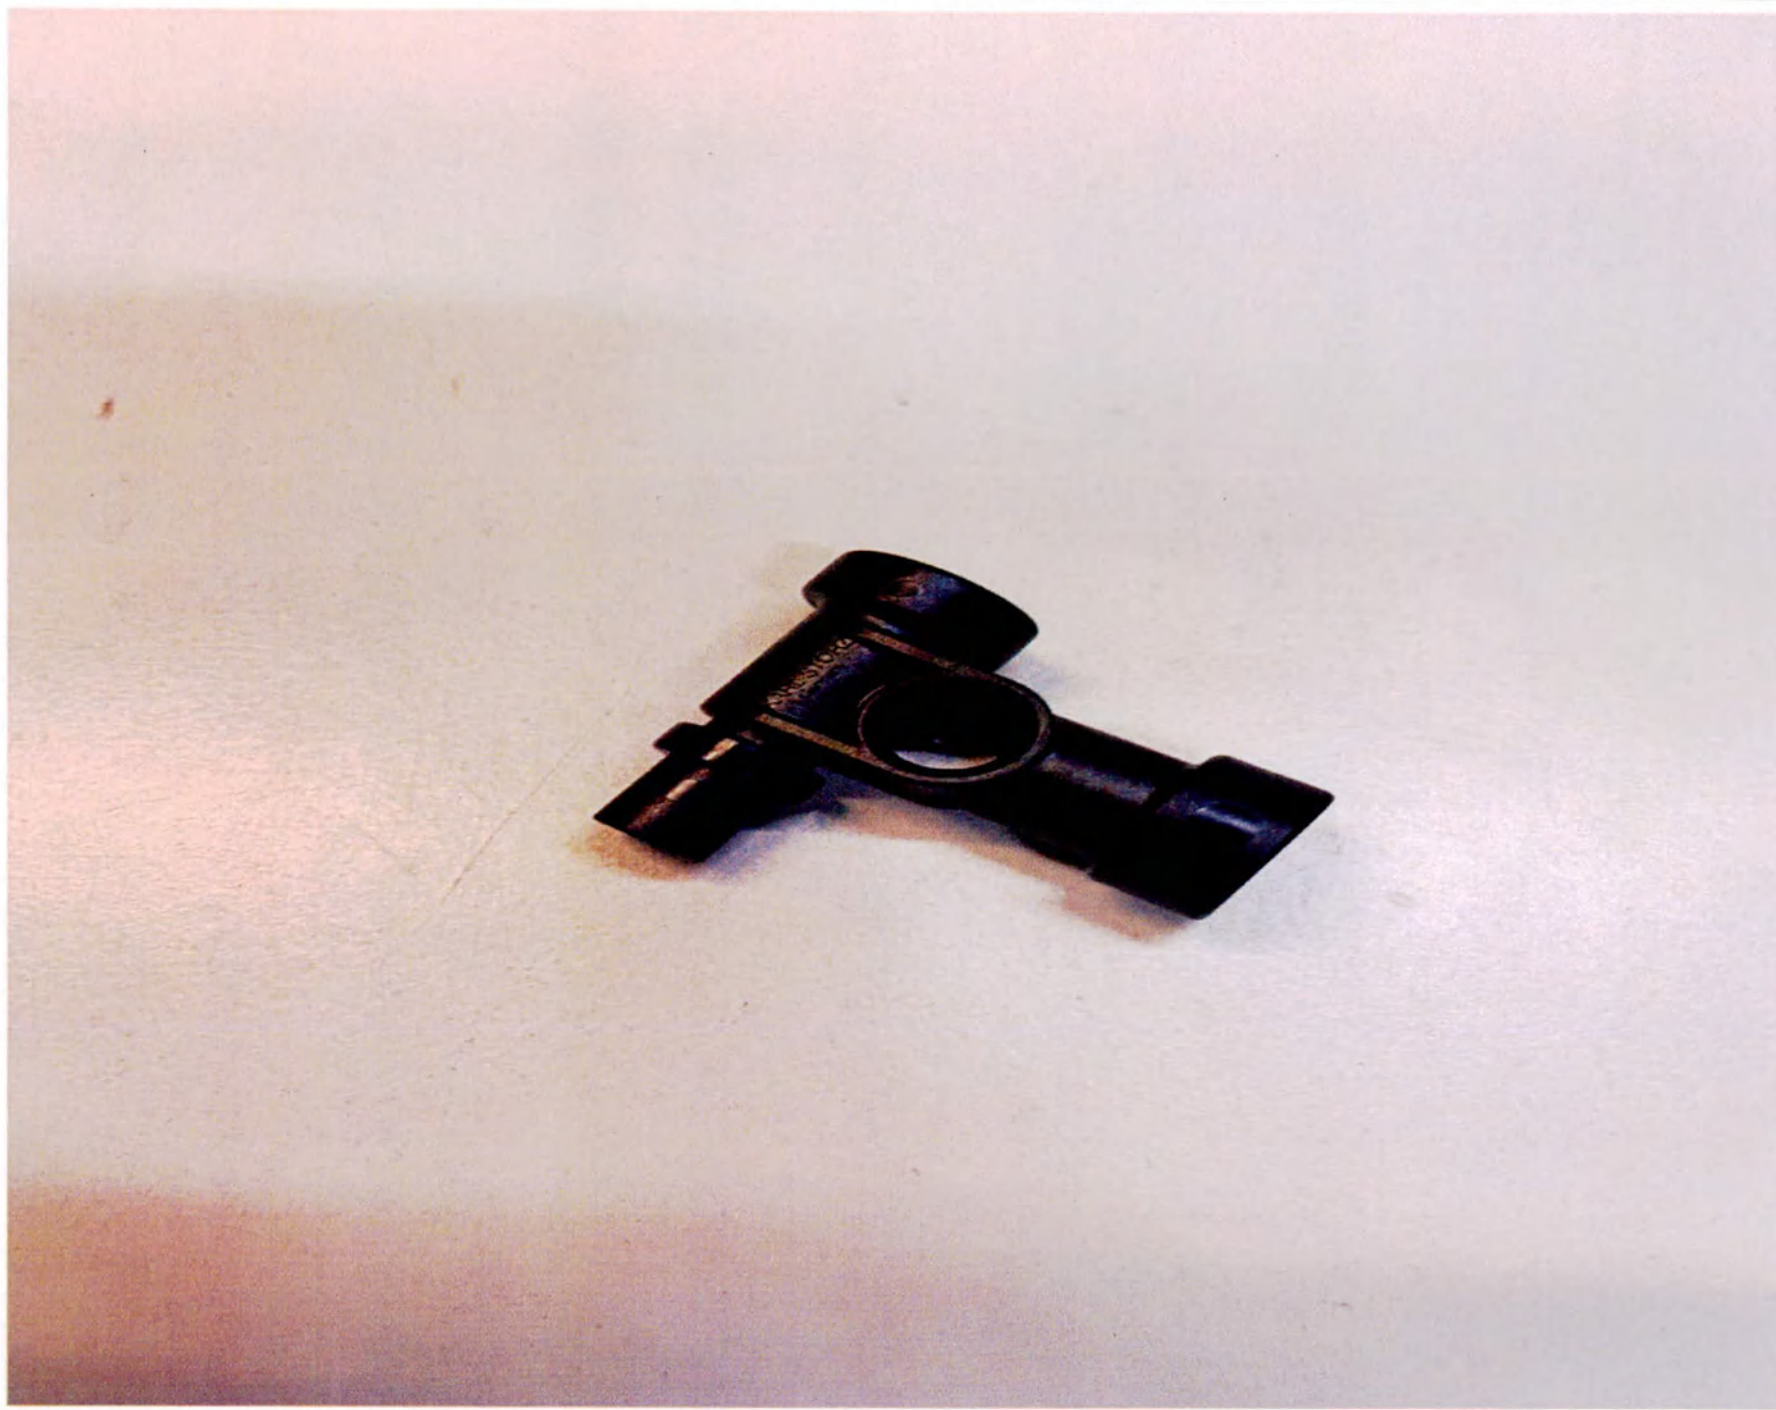


Рис. 17. Защитный колпачок.

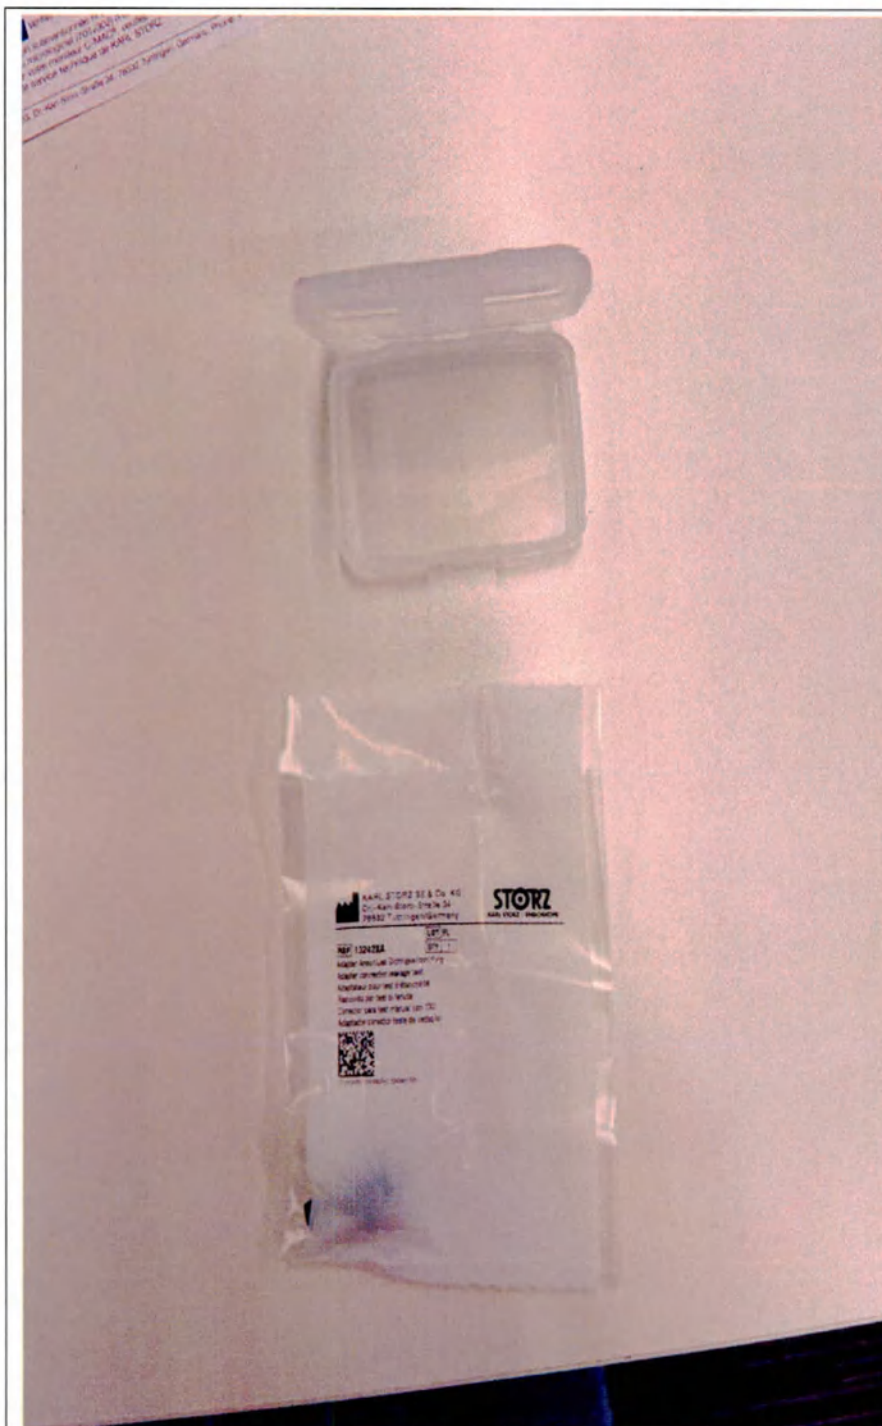


Рис. 18. Адаптер соединительный, для проверки герметичности. Первичная упаковка.

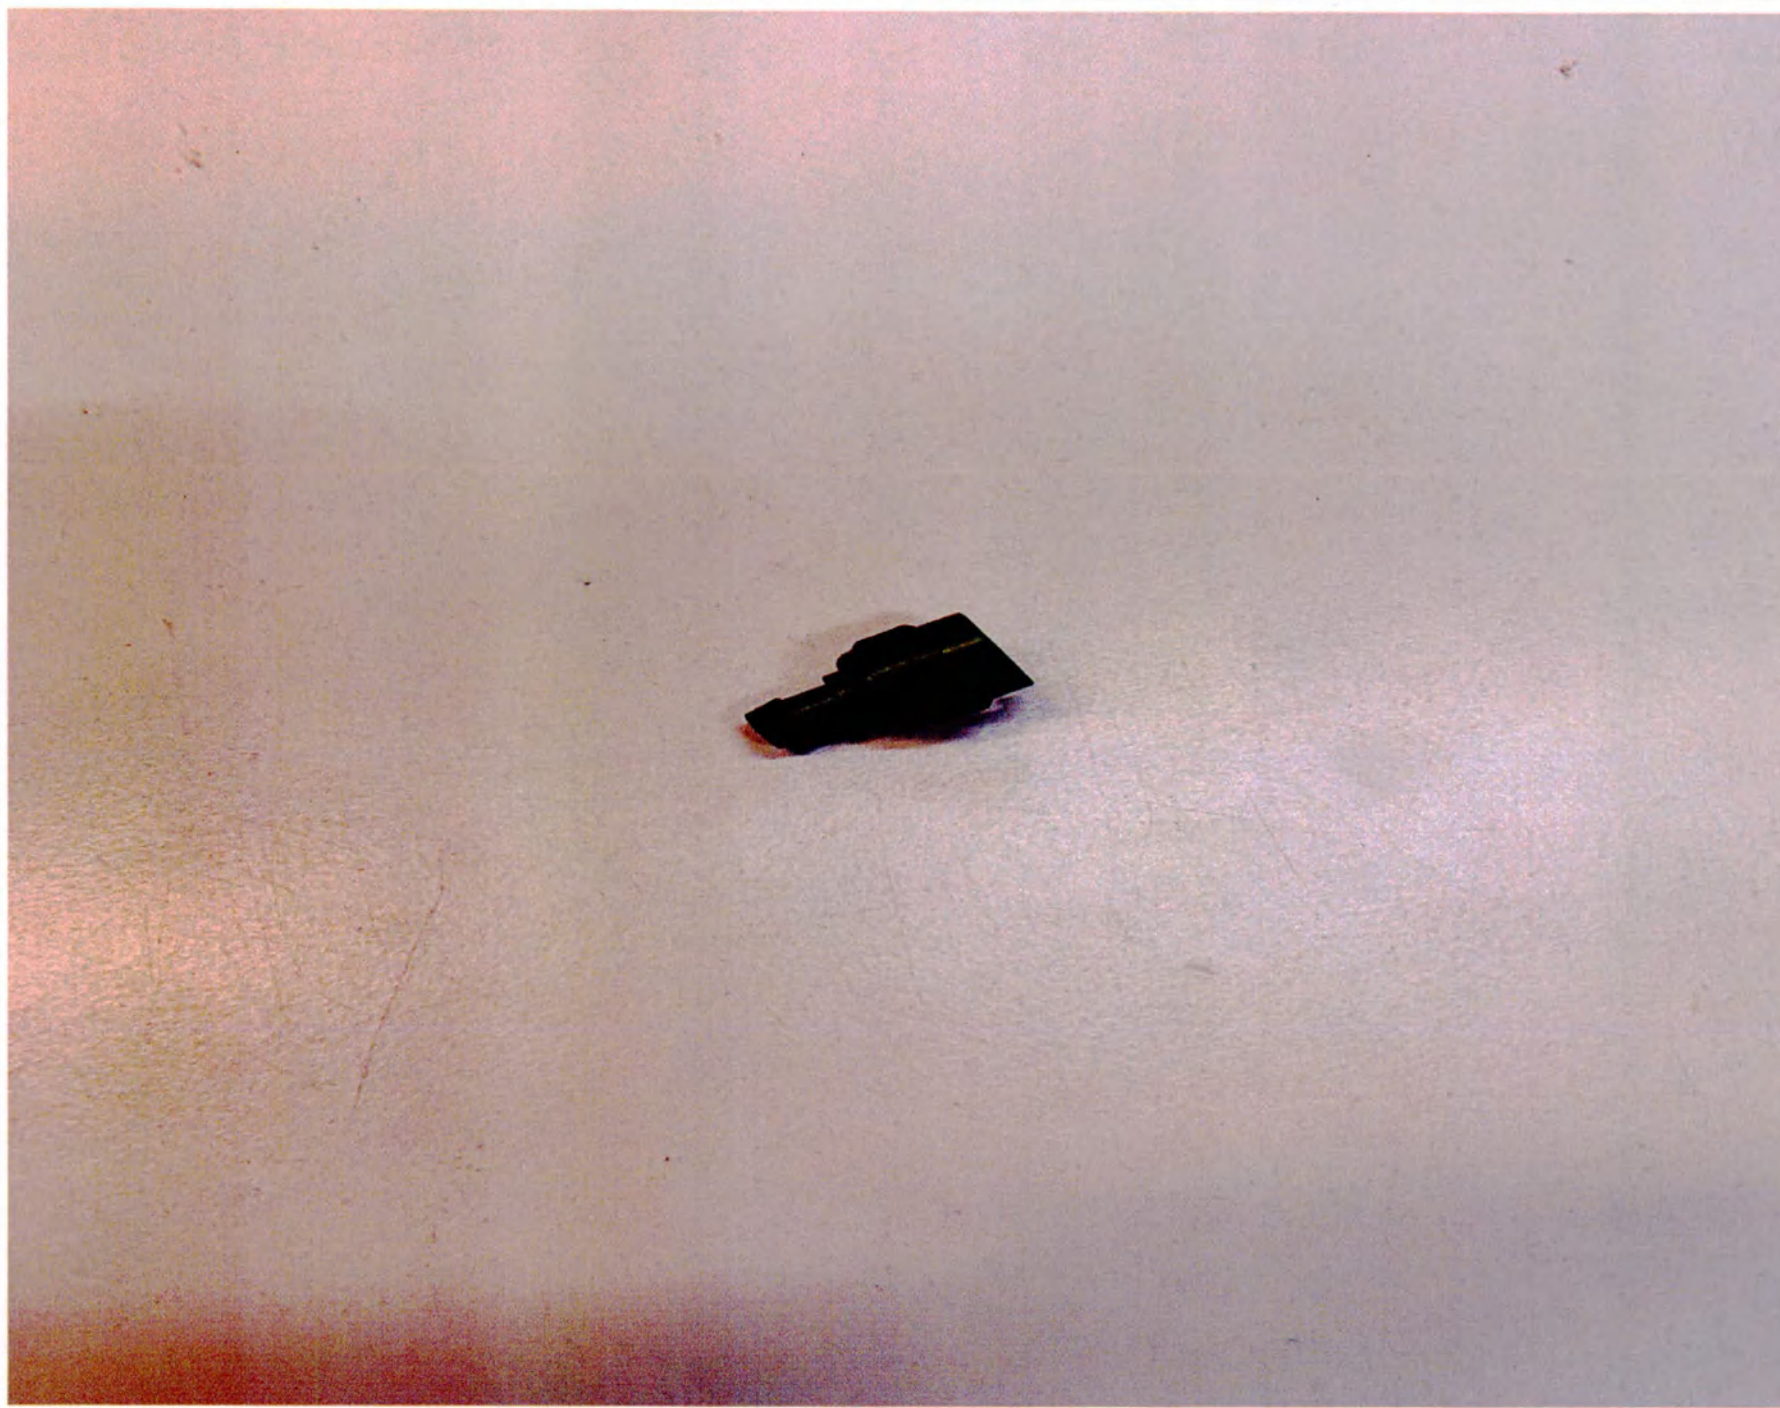


Рис. 19. Адаптер соединительный, для проверки герметичности.

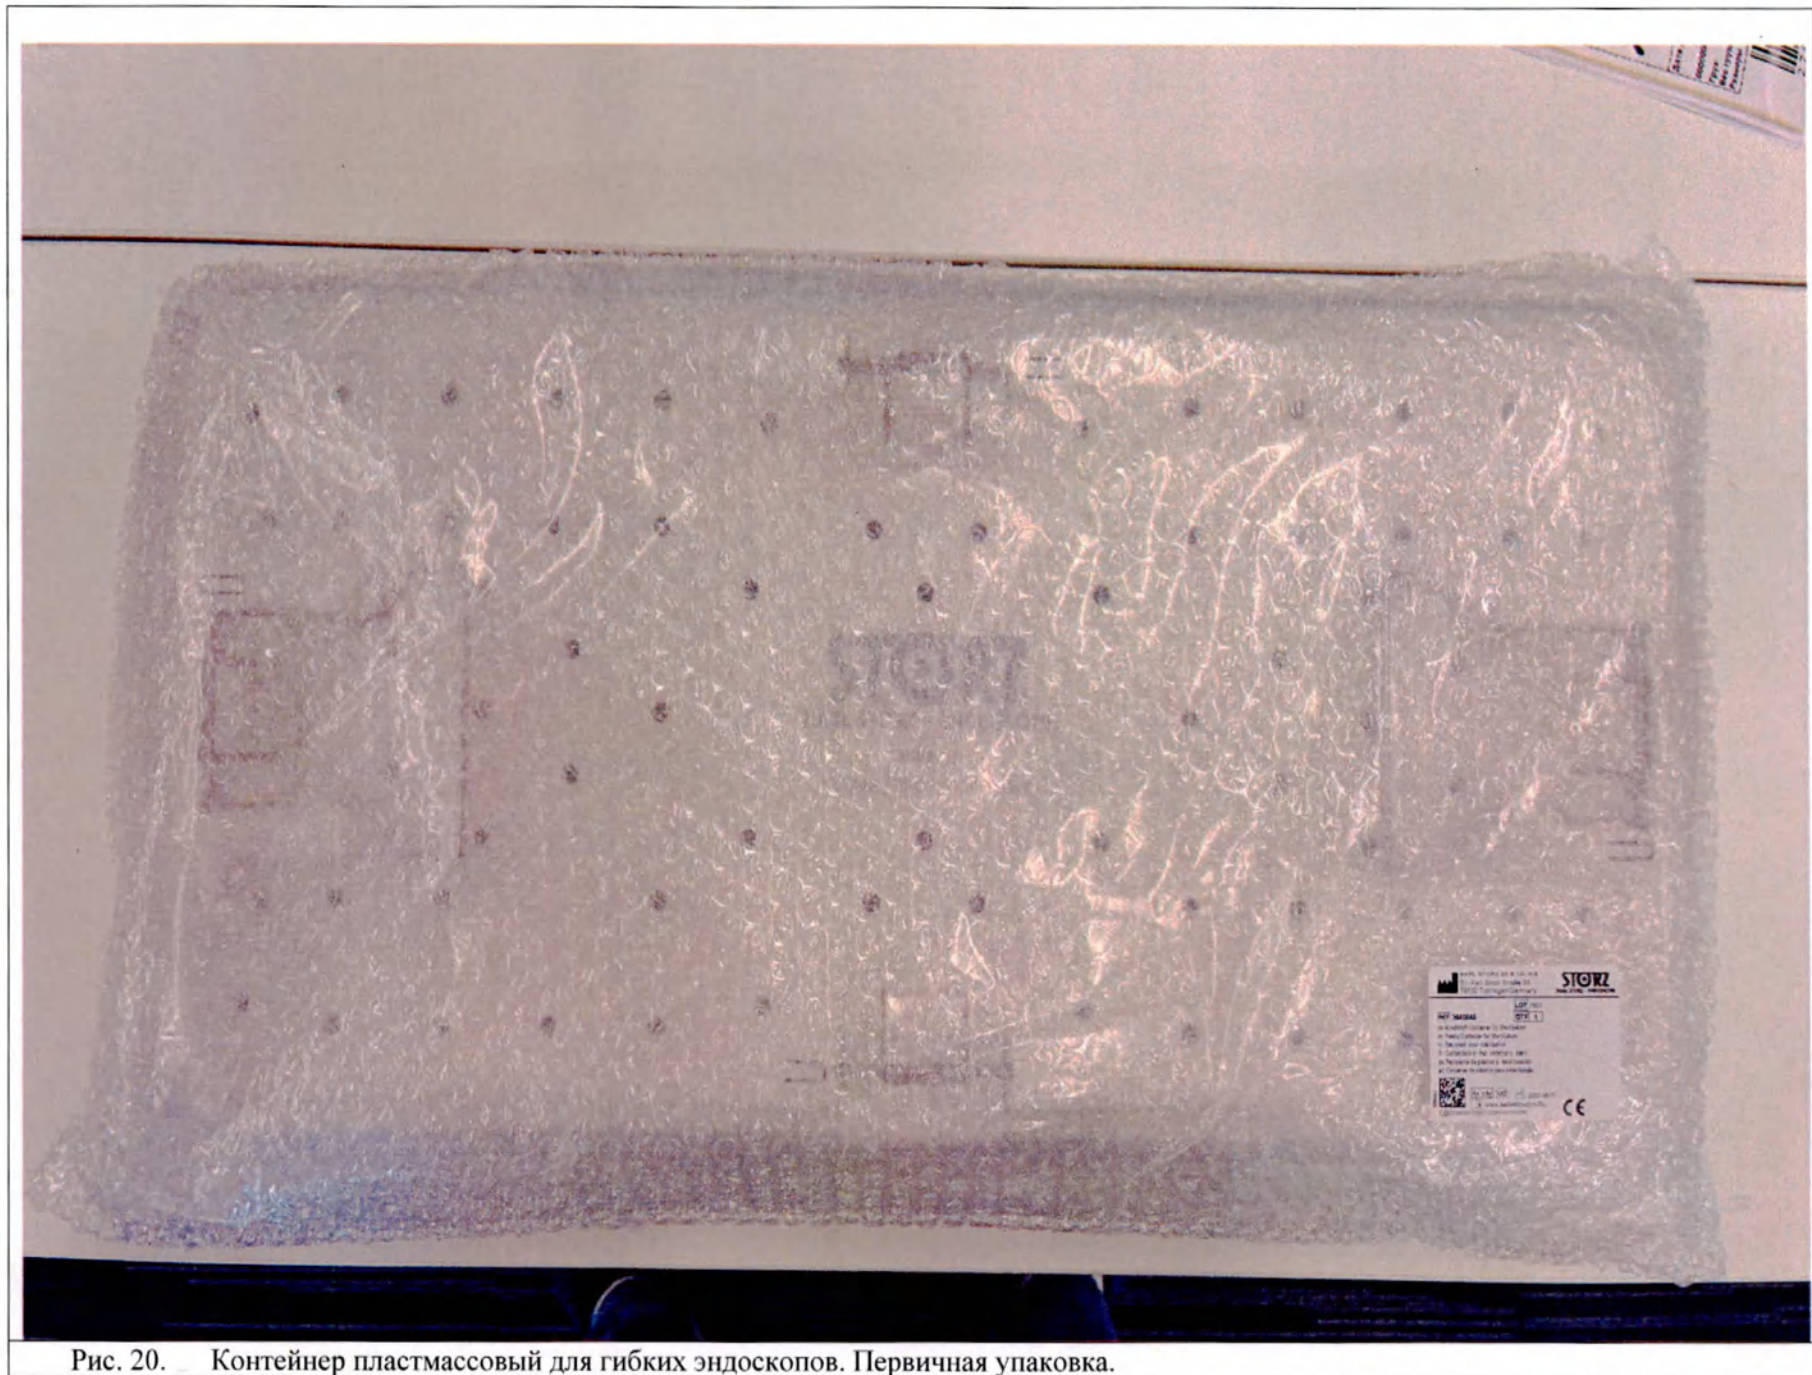


Рис. 20. – Контейнер пластмассовый для гибких эндоскопов. Первичная упаковка.

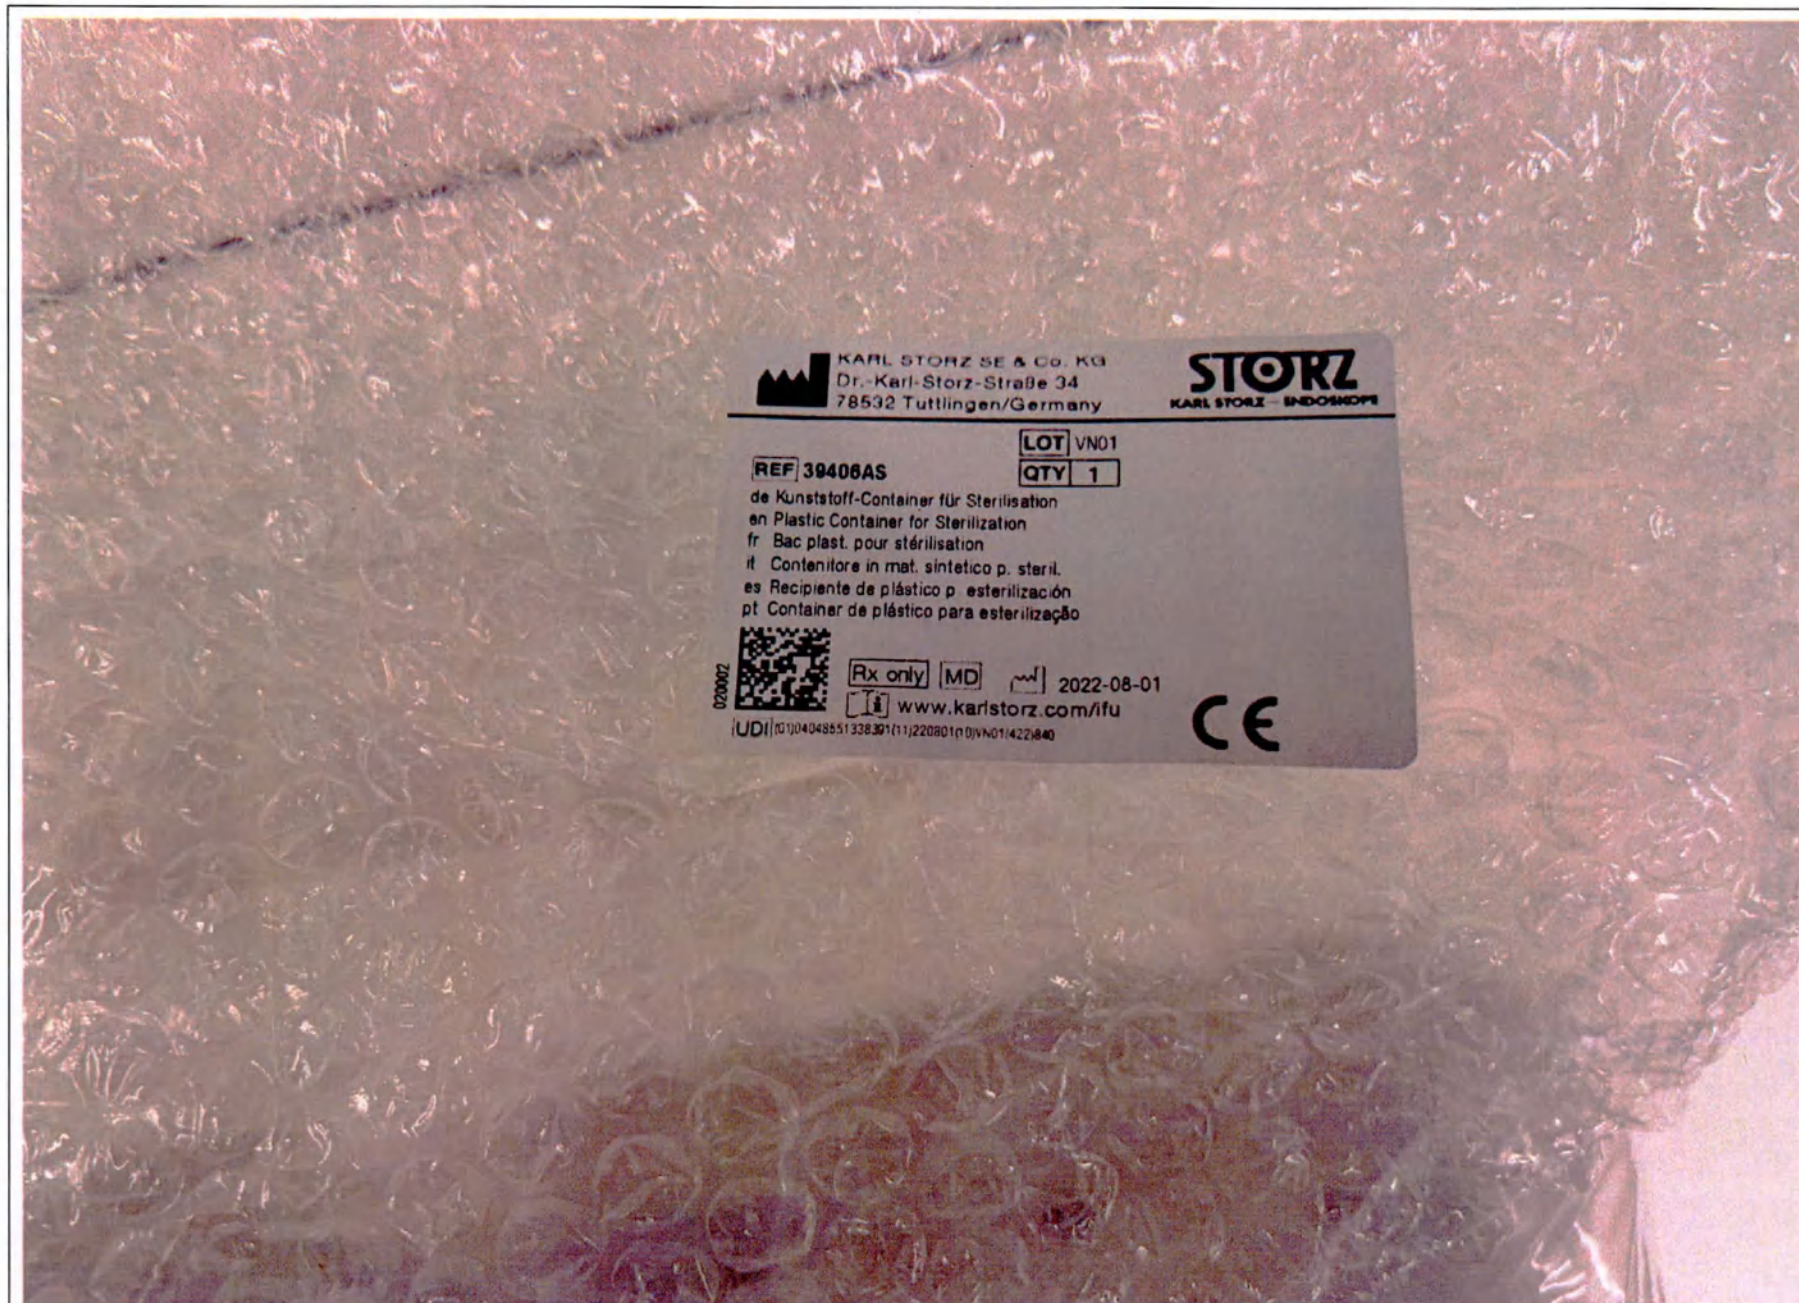


Рис. 21. Контейнер пластмассовый для гибких эндоскопов.

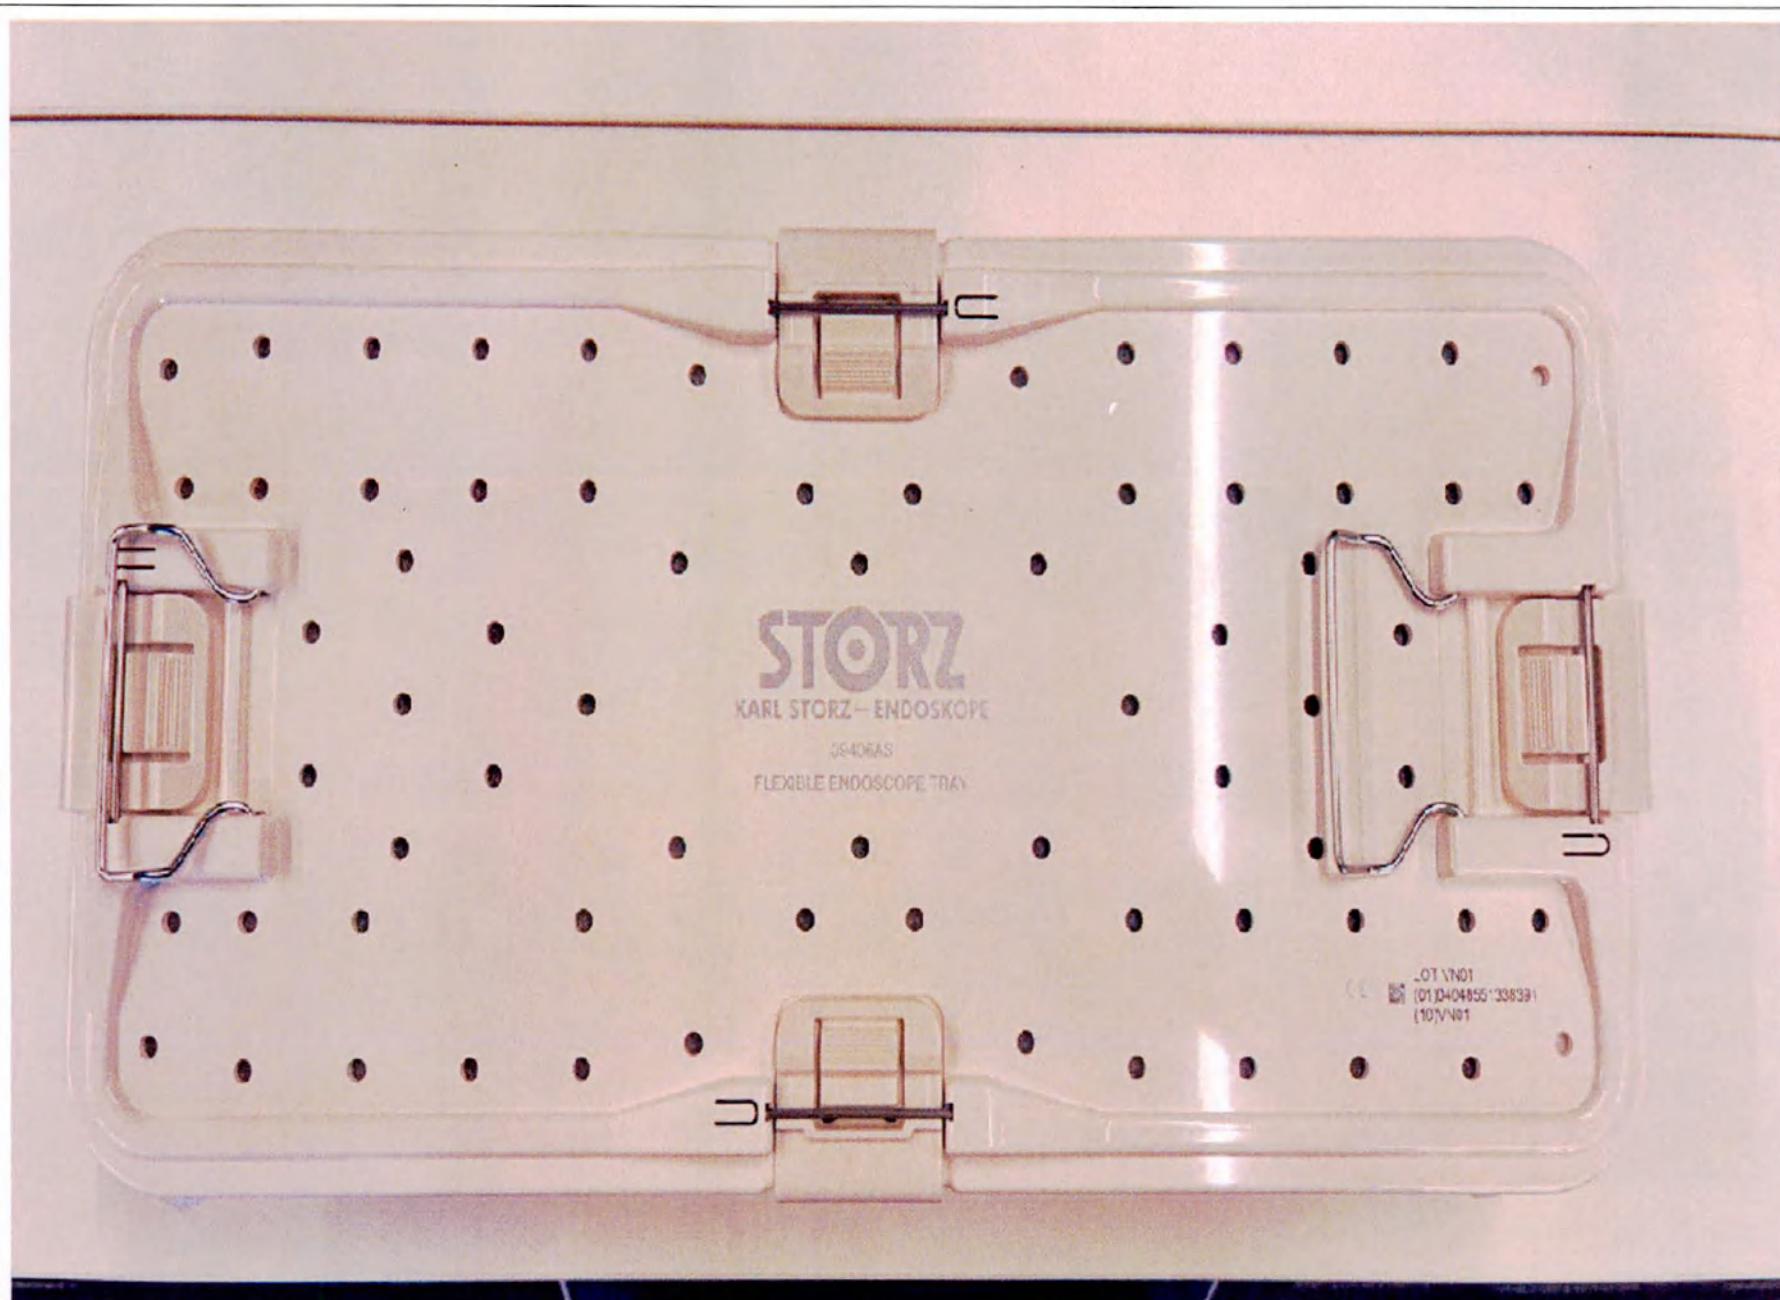


Рис. 22. Контейнер пластмассовый для гибких эндоскопов.

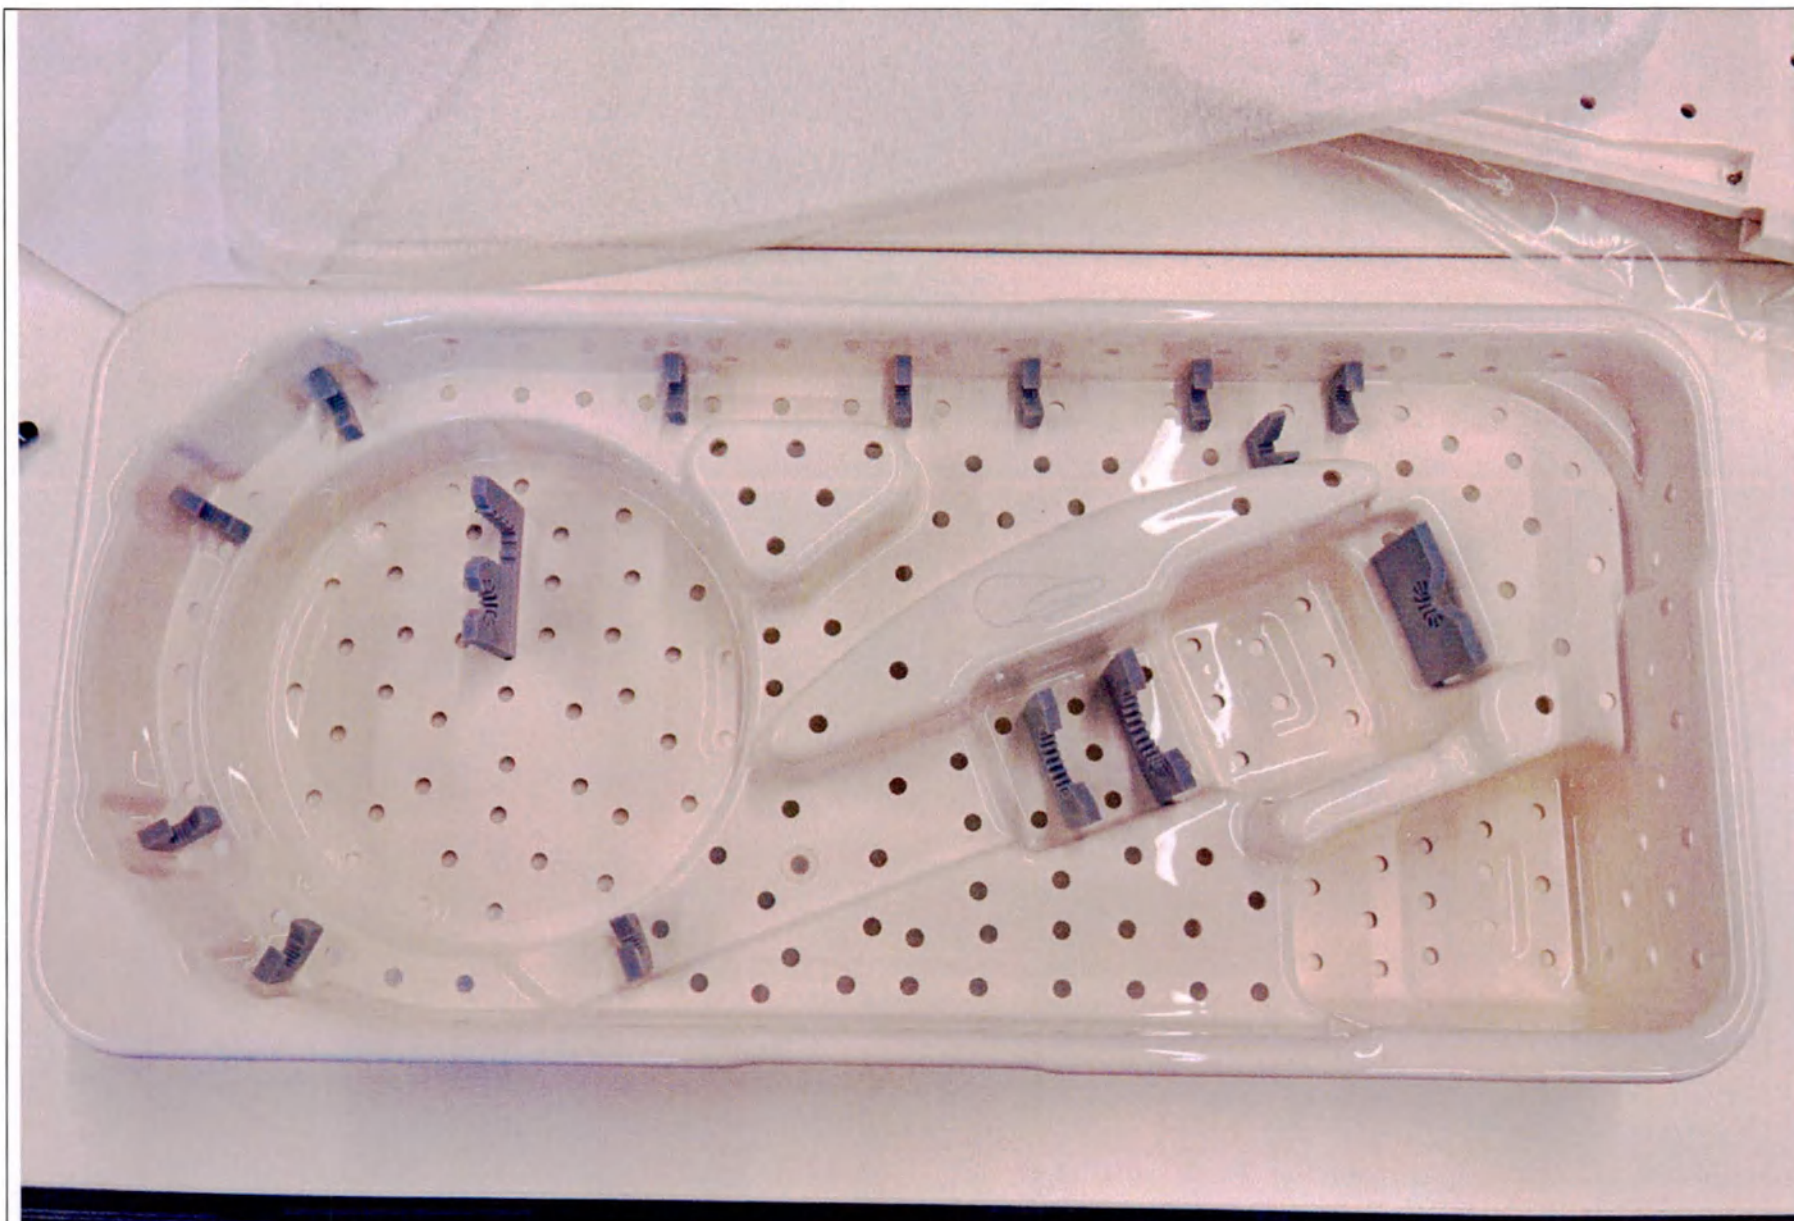


Рис. 23. Контейнер пластмассовый для гибких эндоскопов.



Рис. 24. Щетка плоская для очистки – 5 шт./уп. Первичная упаковка.



Рис. 25. Щетка плоская для очистки - 5 шт./уп

13303E



Видеоэзофагоскоп гибкий CMOS, с принадлежностями

РУ № _____ от ____ . ____ . ____ г

Информация о сроке службы – см. инструкцию по эксплуатации

Производитель

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34,
78532, Tuttlingen, Germany (Германия)

**Уполномоченный представитель
на территории РФ**

Общество с ограниченной ответствен-
ностью
КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы
ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, 7, стр.4

Рис. 26. Макет русскоязычной маркировки для Видеоэзофагоскопа гибкого CMOS, с принадлежностями.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 27
_____ листах

