

Место производства (2)

Организация-производитель
Место производства (1)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»

ООО «НПО ДНК-Технология»



С.Д. Левичев

« 16 » октября 2017г.




В.Ю. Дмитровский

« 16 » октября 2017г.

**ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ *IN VITRO* ДИАГНОСТИКИ****Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум
(*Mycoplasma genitalium*) методом полимеразной цепной реакции
(ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008**


2017 г.

Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (*Mycoplasma genitalium*) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008
ПЦР с детекцией в режиме реального времени, фасовка S, стрипы

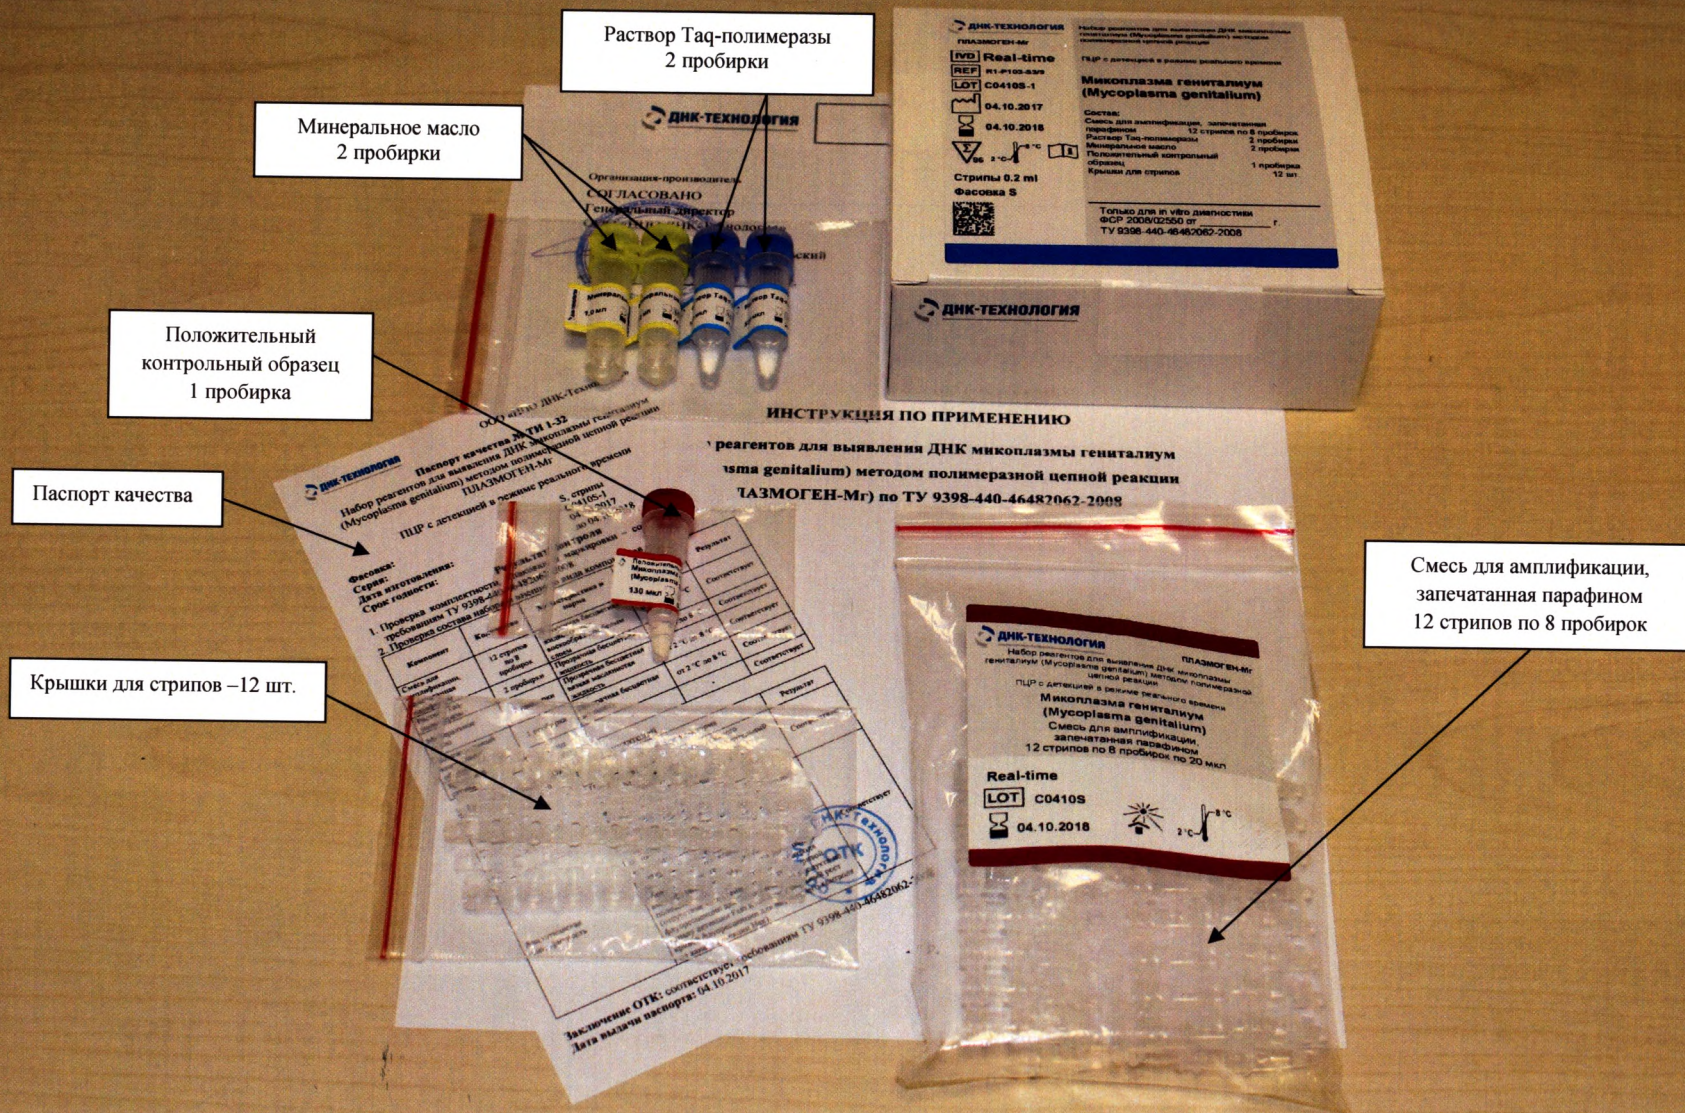


Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Mg) по ТУ 9398-440-46482062-2008

ПЦР с детекцией в режиме реального времени, фасовка S, пробирки

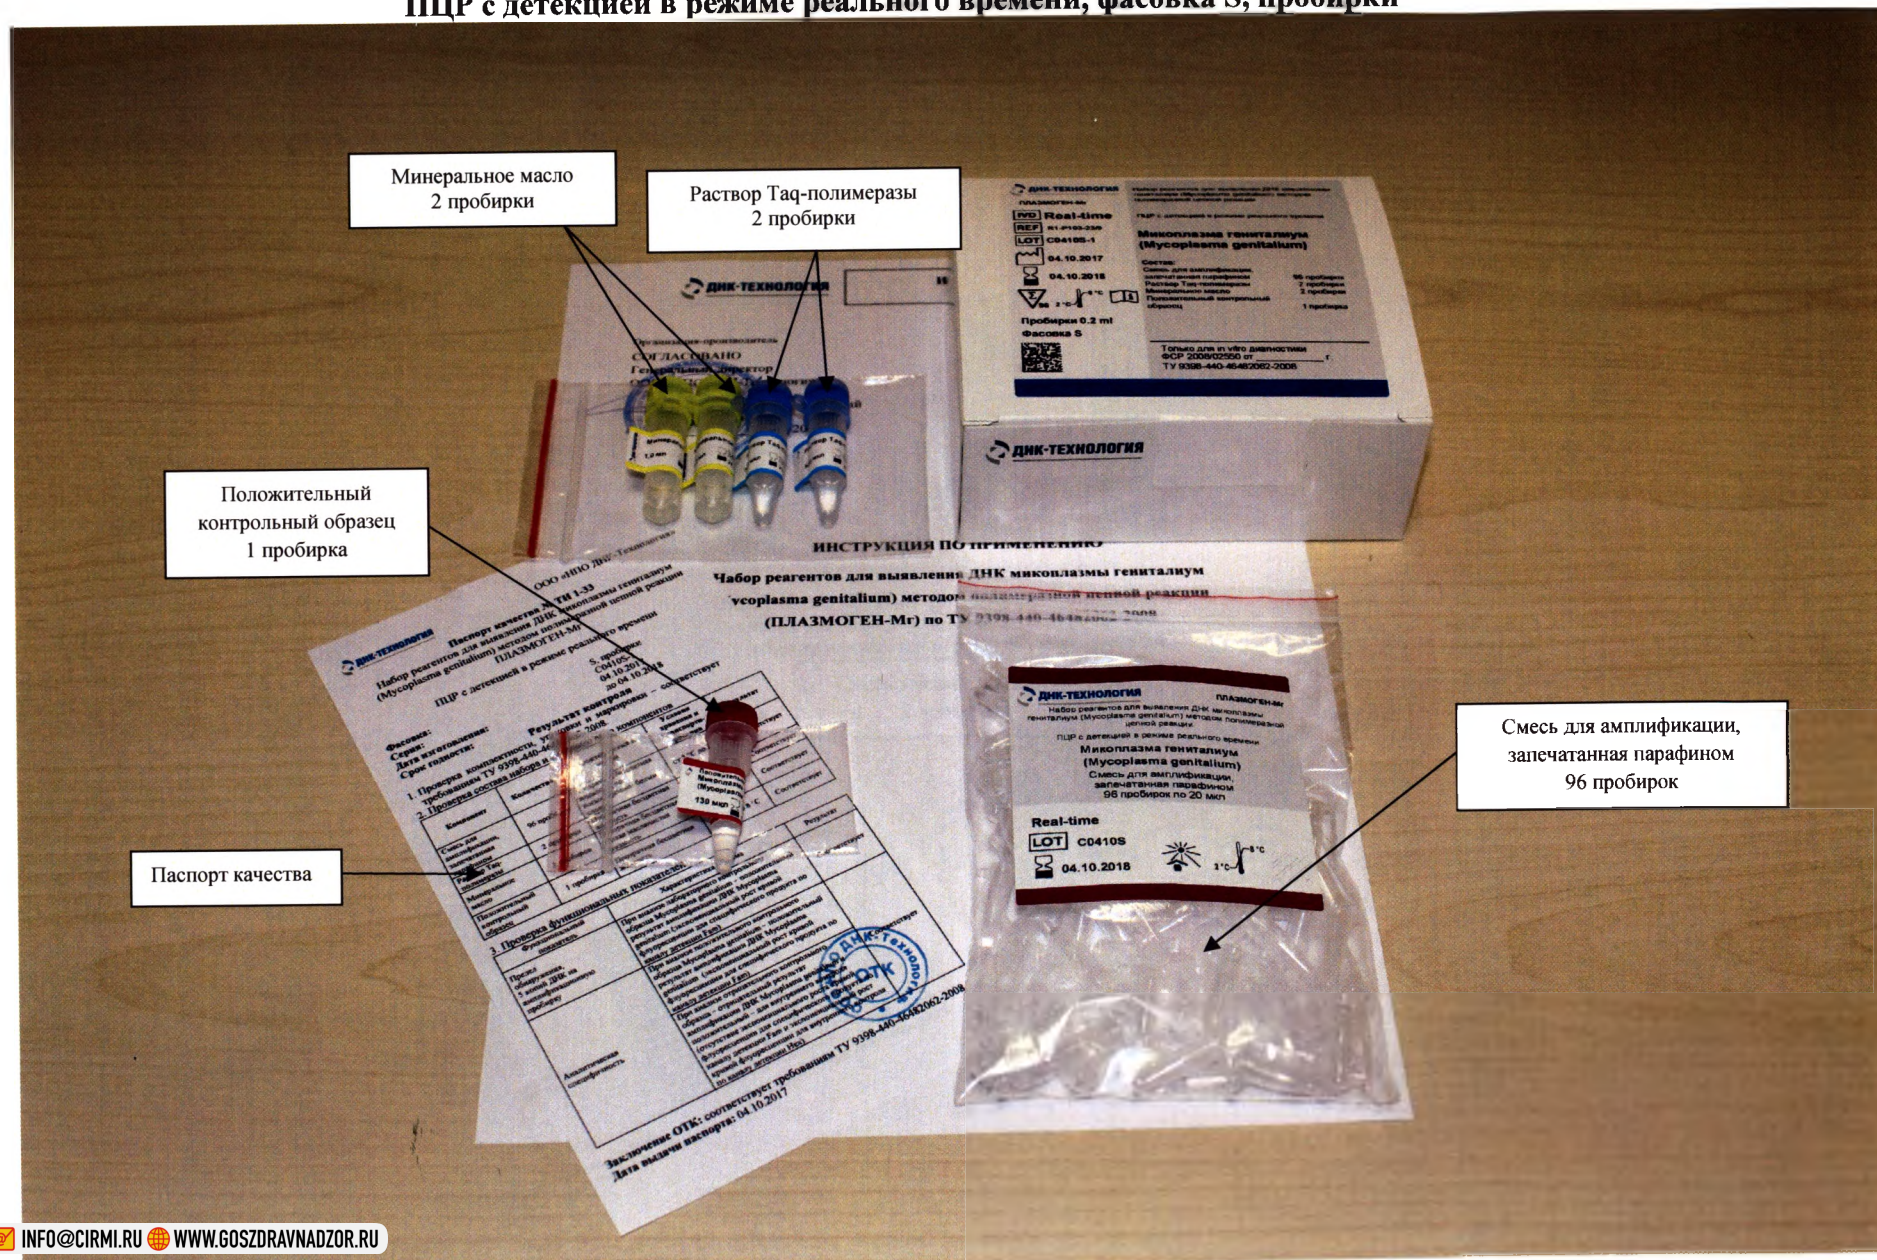


Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Mг) по ТУ 9398-440-46482062-2008

ПЦР с детекцией в режиме реального времени, фасовка W

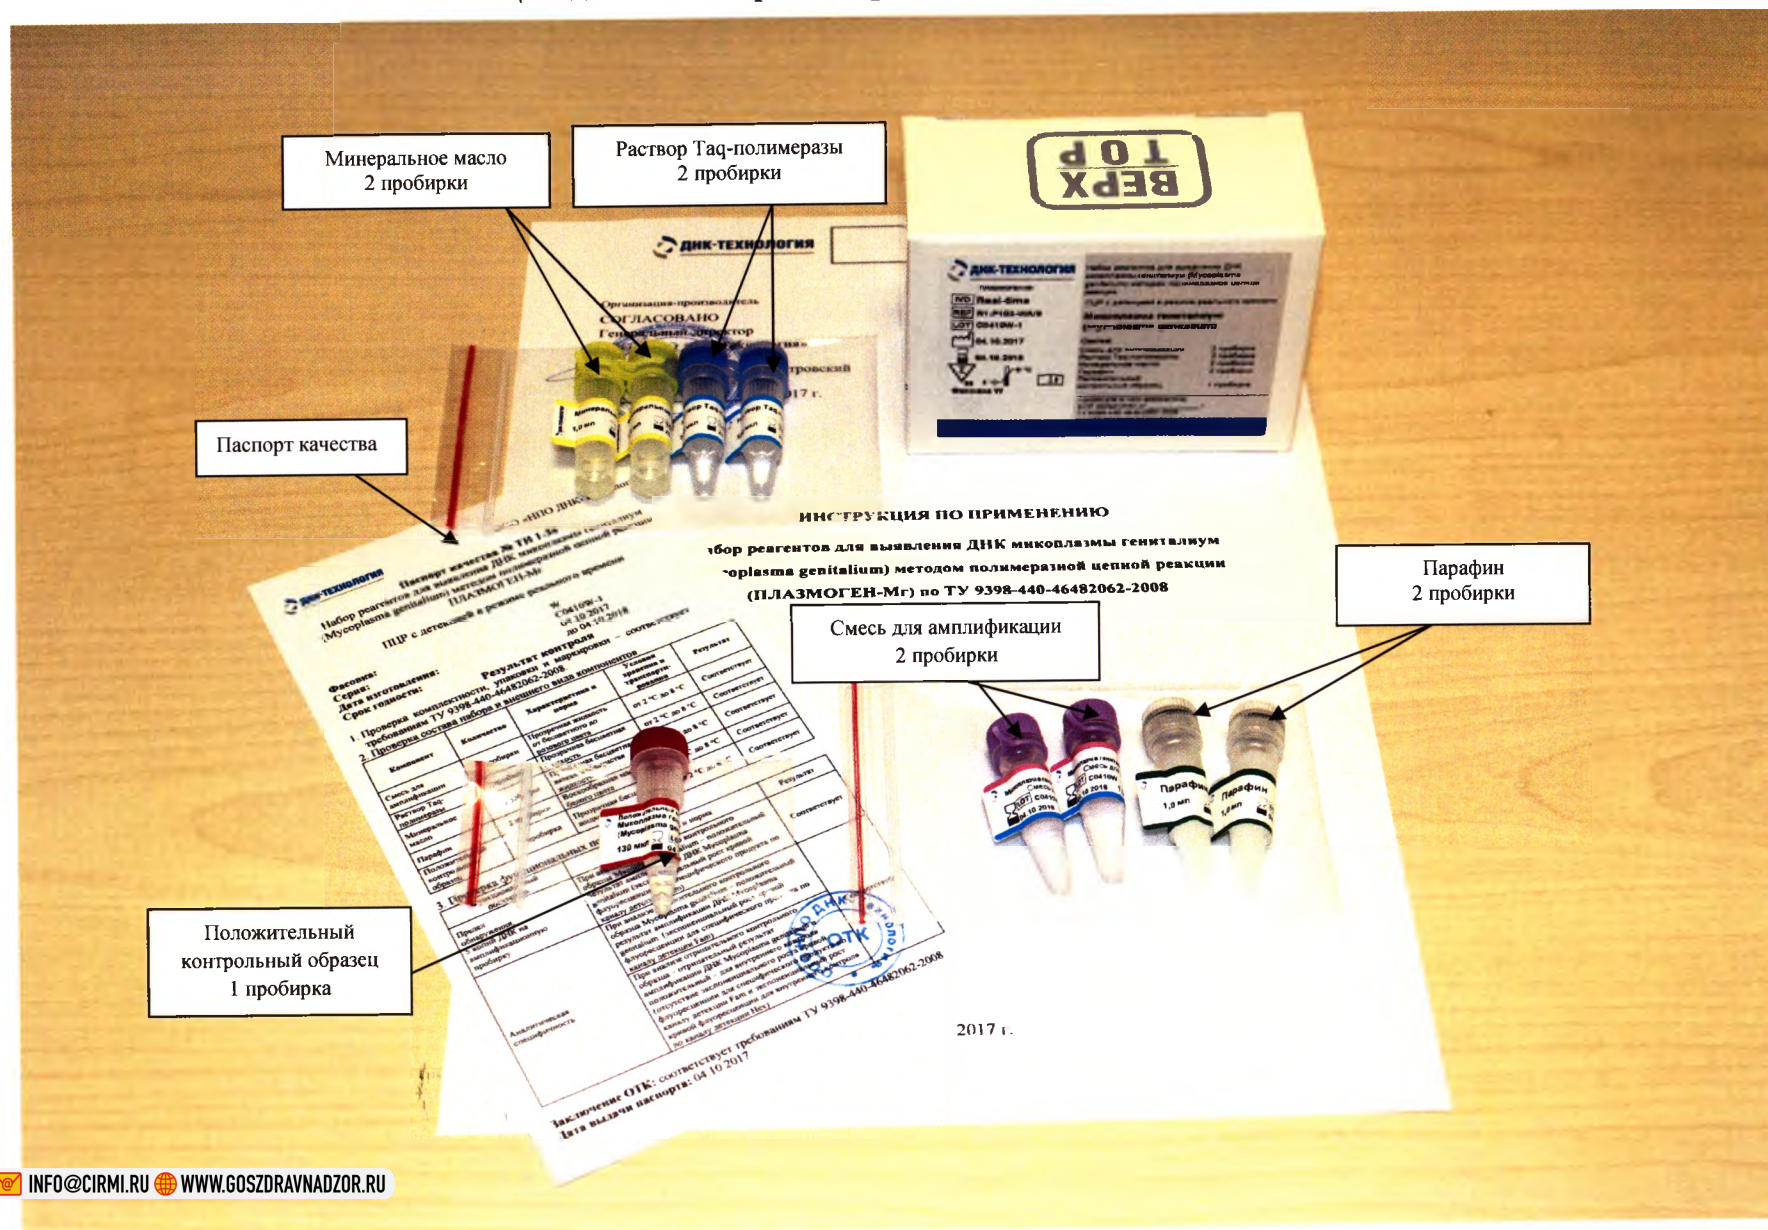


Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (*Mycoplasma genitalium*) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ПЛАЗМОГЕН-Mg) по ТУ 9398-440-46482062-2008

ПЦР с детекцией в режиме реального времени, фасовка U

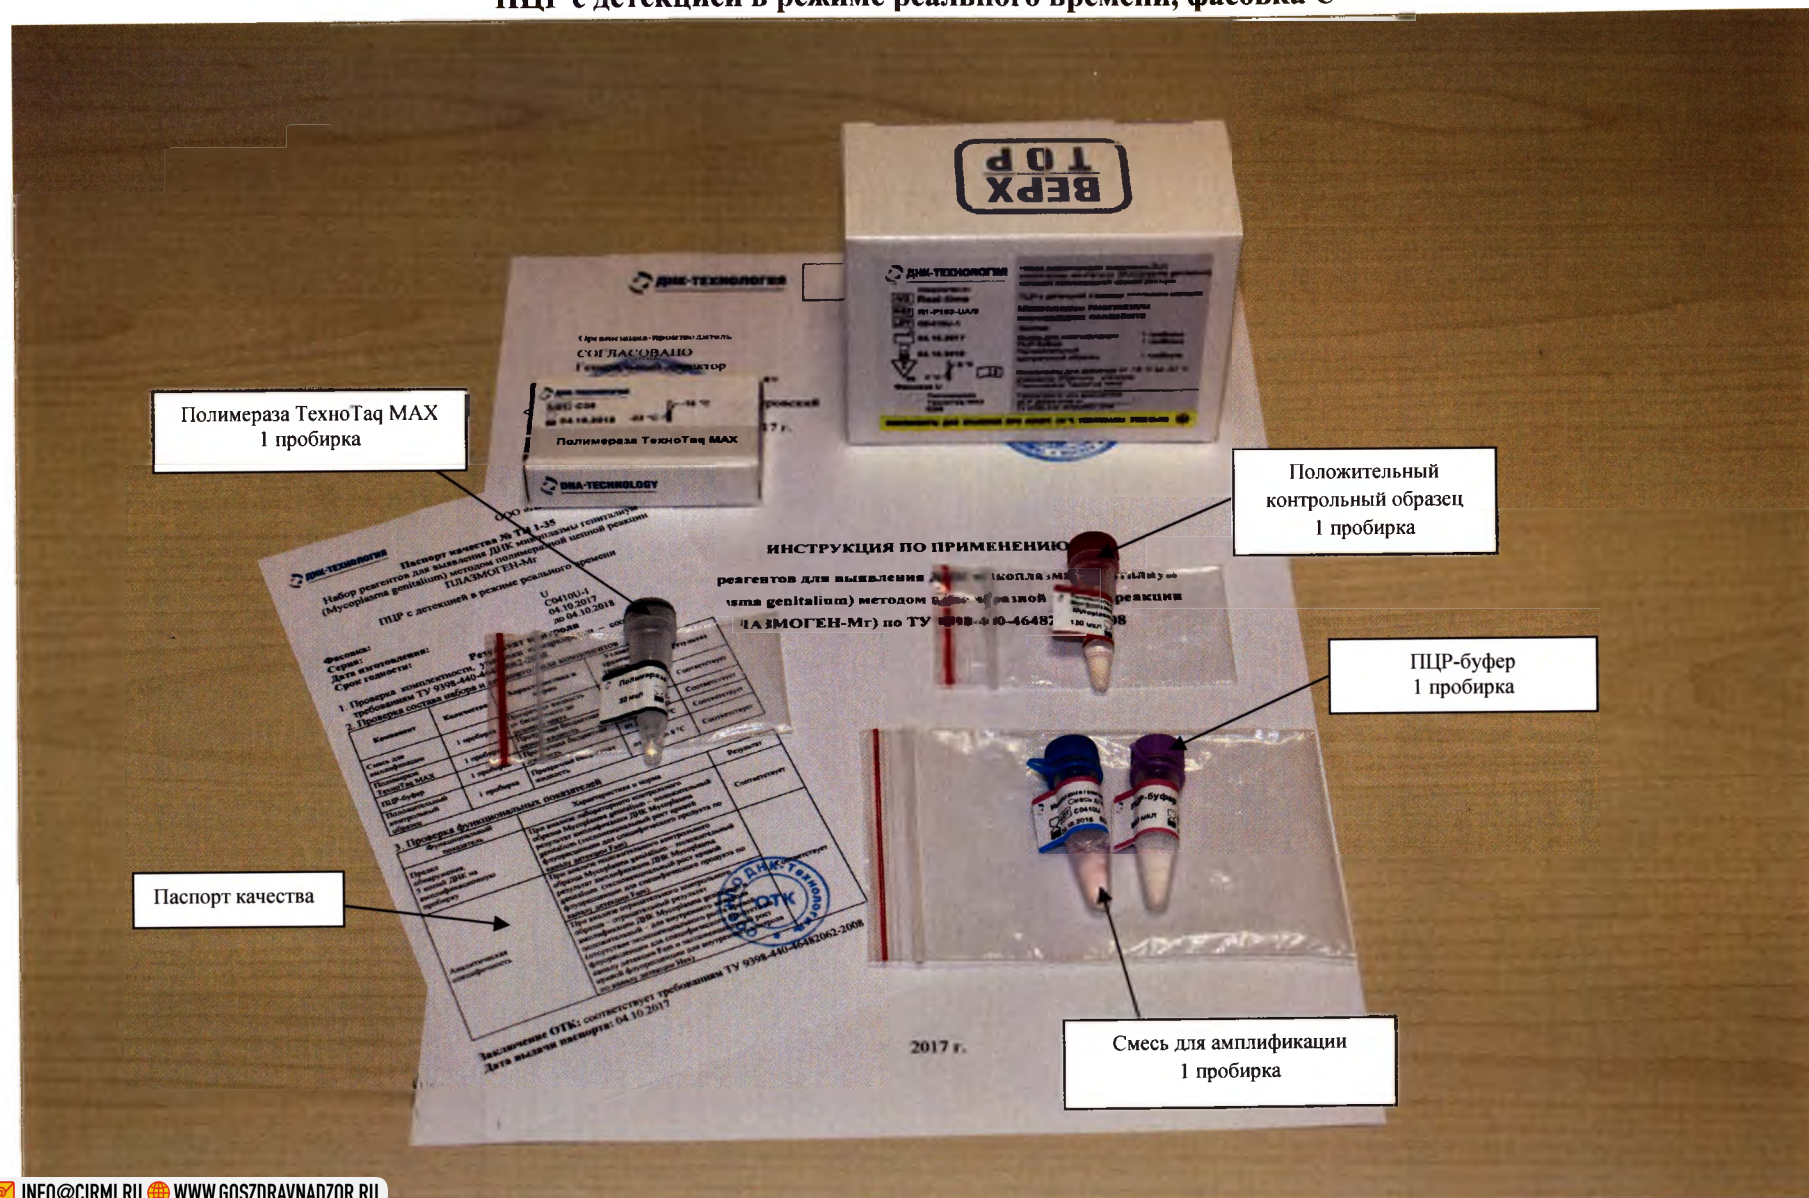


Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008

ПЦР с флуоресцентной детекцией по конечной точке, фасовка S

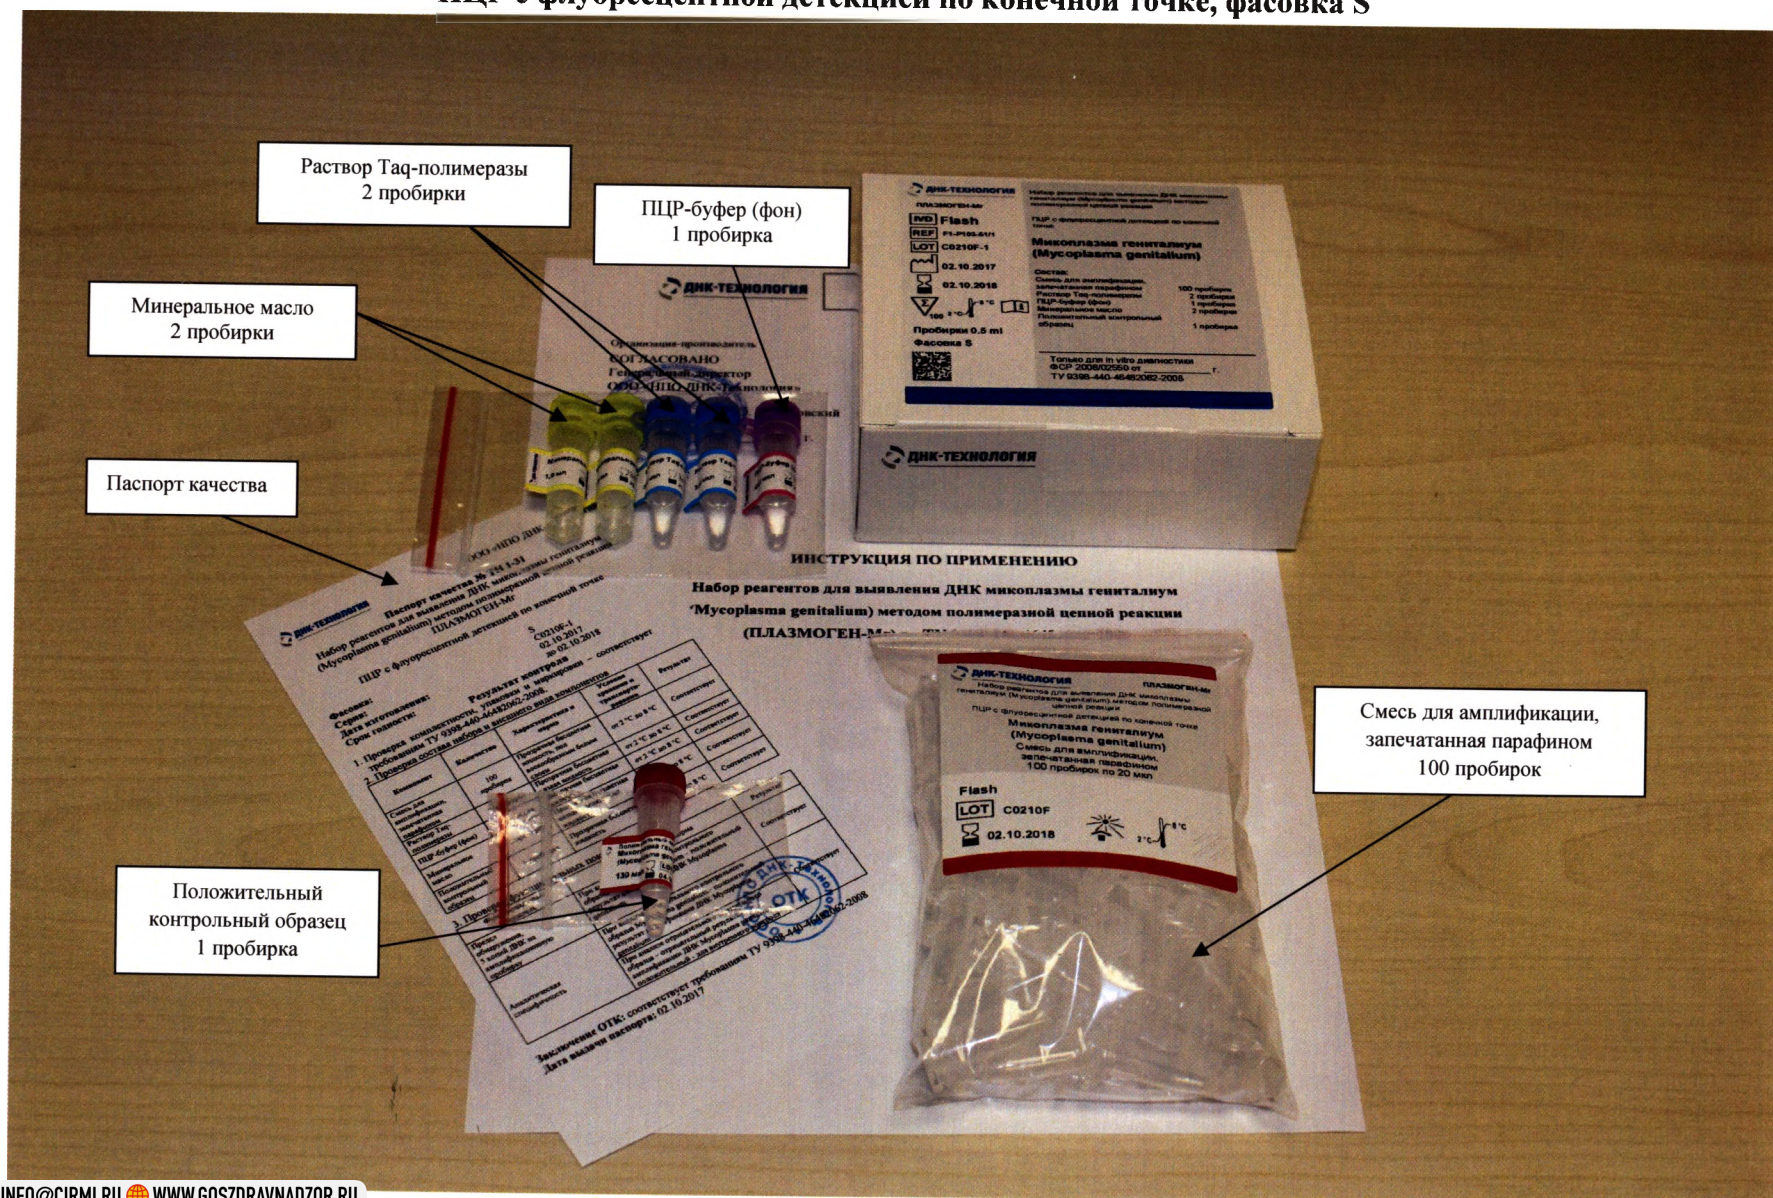

Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (*Mycoplasma genitalium*) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008


ПЦР с детекцией методом гель-электрофореза, фасовка S

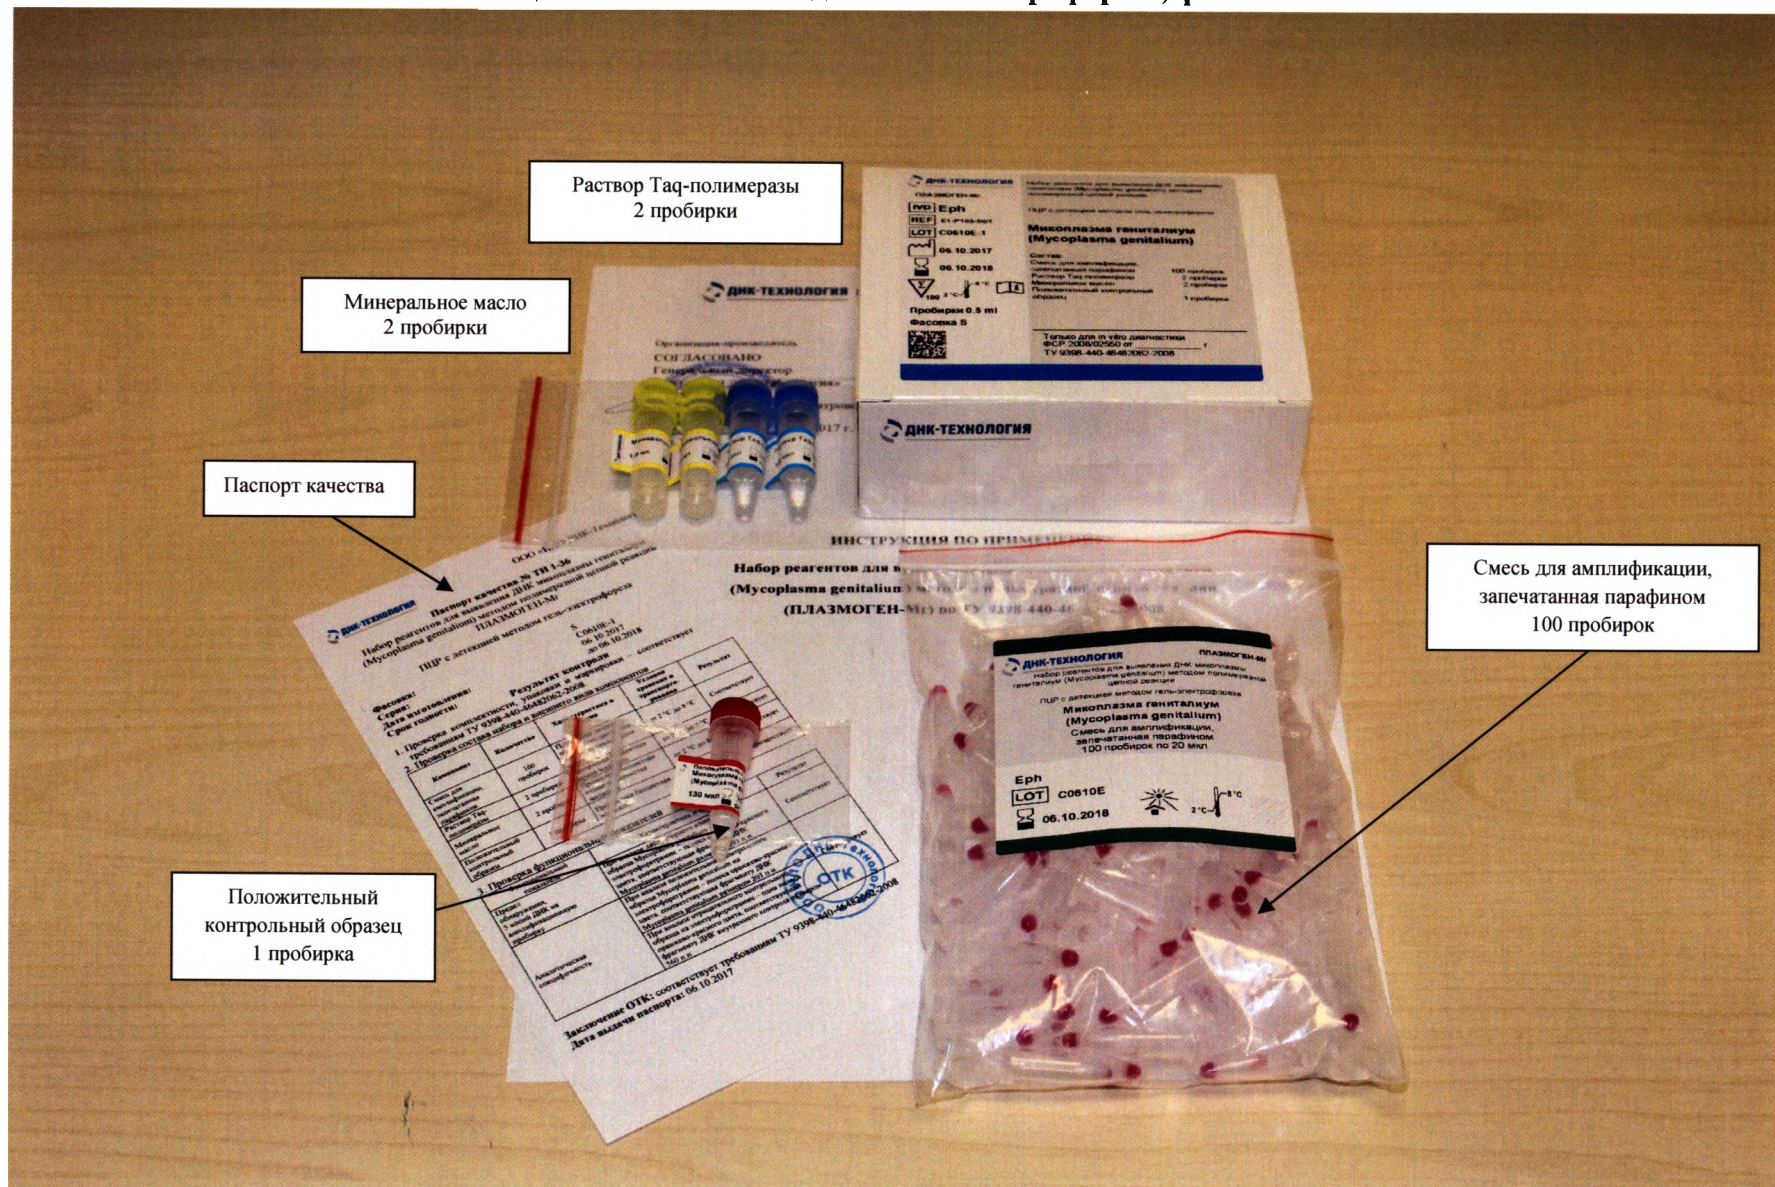

Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (*Mycoplasma genitalium*) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008

ПЦР с детекцией методом гель-электрофореза, фасовка S

Информация об изготовителе нанесена типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку.
Код изготовителя указан на этикетке
(см. последнюю цифру в серии)

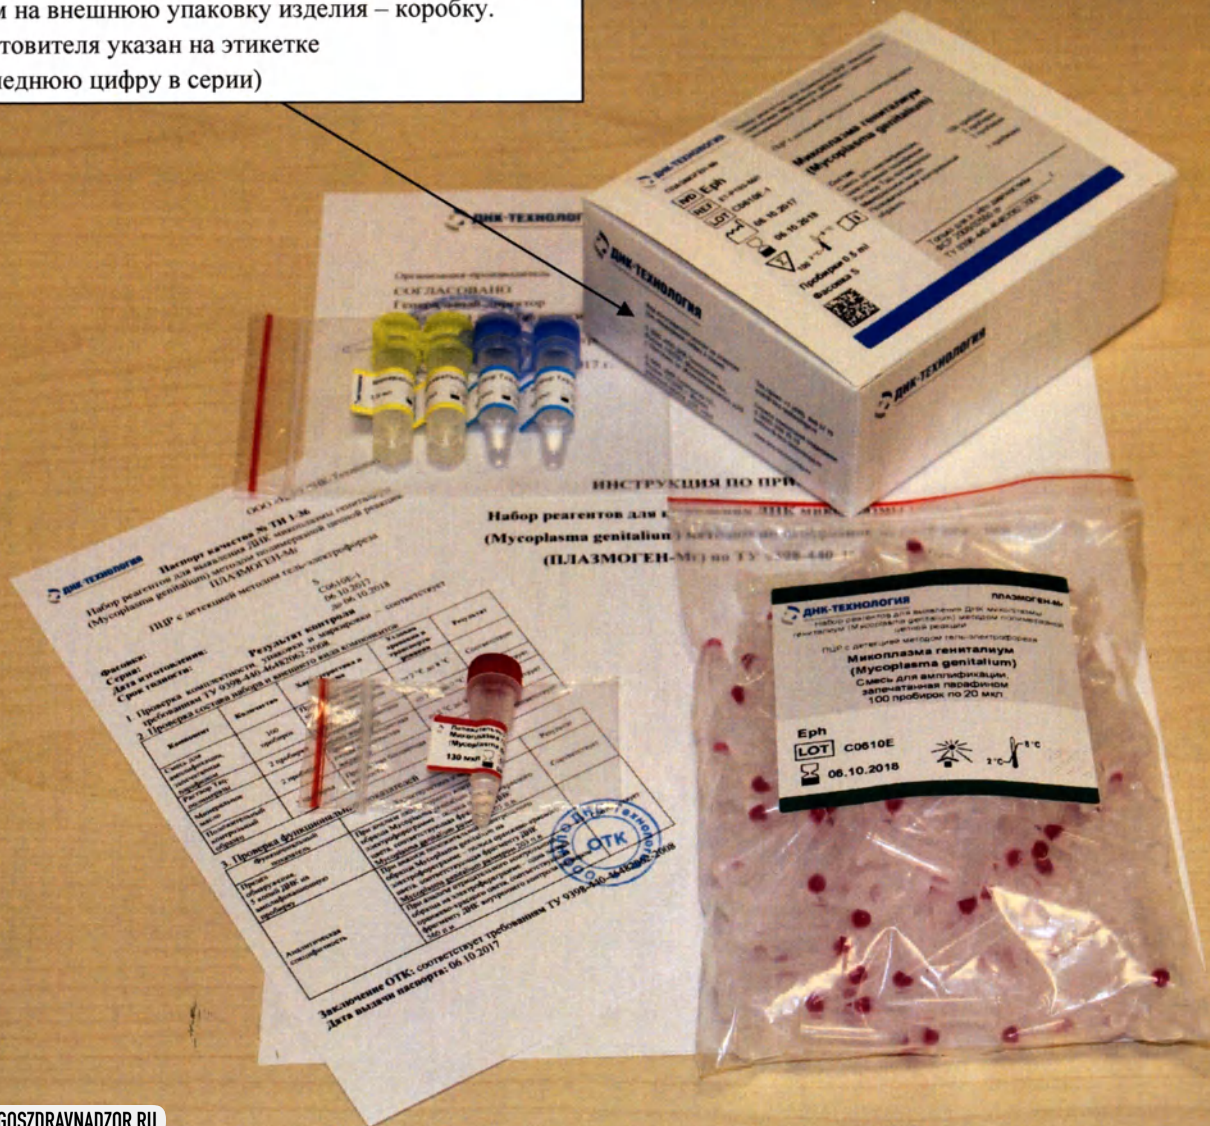

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8

(Всего) листа (ов)

специалист по регистрации
Шербакова Н.И. 