


Фотографические изображения медицинского изделия

Наконечники нестерильные объемом 1000 мкл в штативе для анализаторов и автоматизированных систем для in vitro диагностики

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе

ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»




* Данилов П. А.

«10» декабря

2024 г.



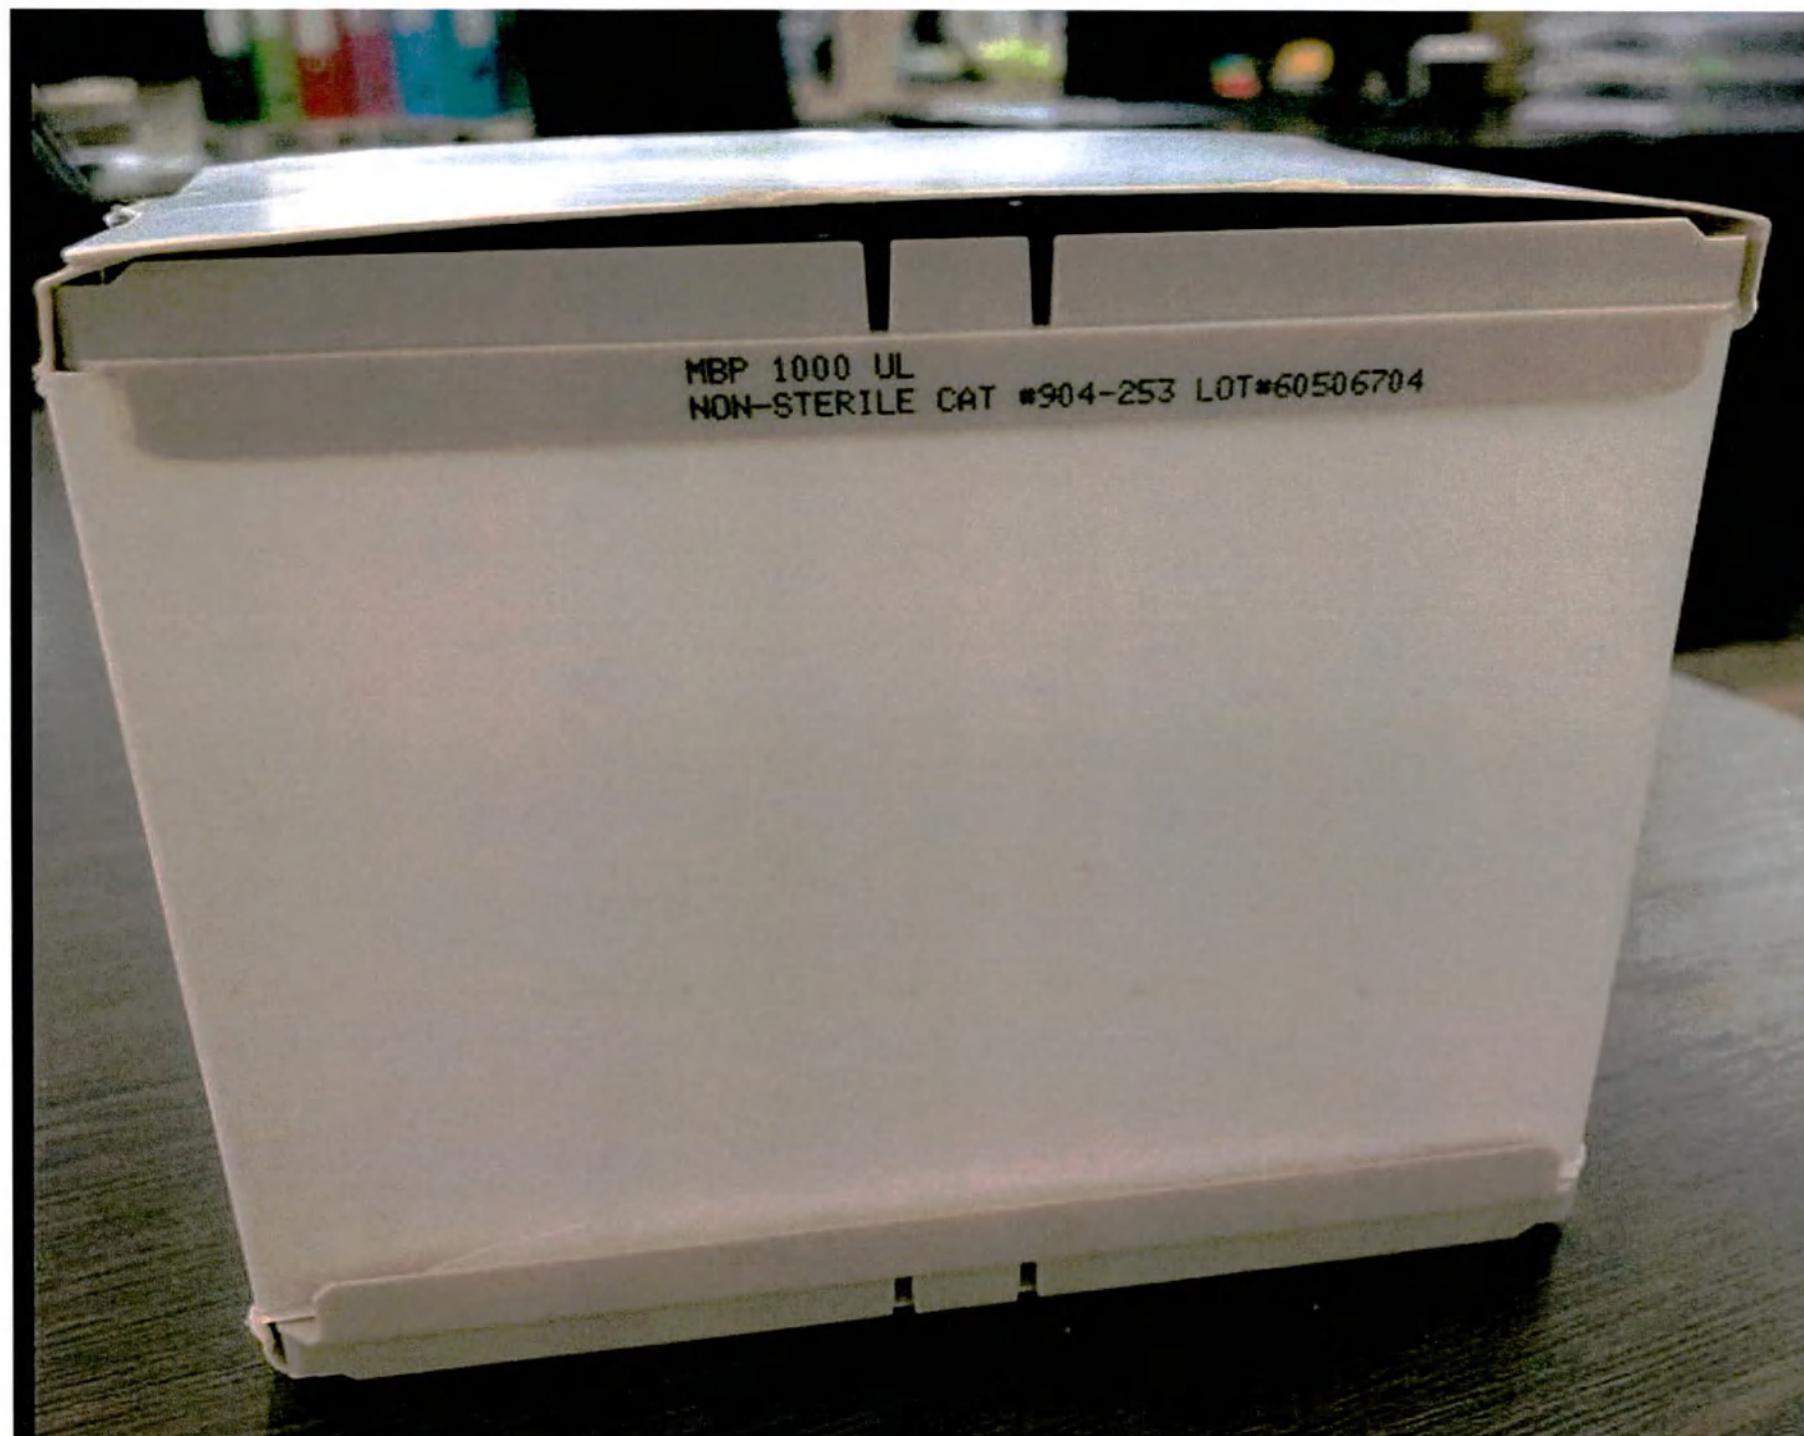


MBP 1000 UL
NON-STERILE CAT #904-253 LOT#60506704

Наконечники нестерильные объемом 1000 мкл в штативе для анализаторов и автоматизированных систем для in vitro диагностики. Общий вид медицинского изделия.




Наконечники нестерильные объёмом 1000 мкл в штативе для анализаторов и автоматизированных систем для in vitro диагностики. Общий вид медицинского изделия.

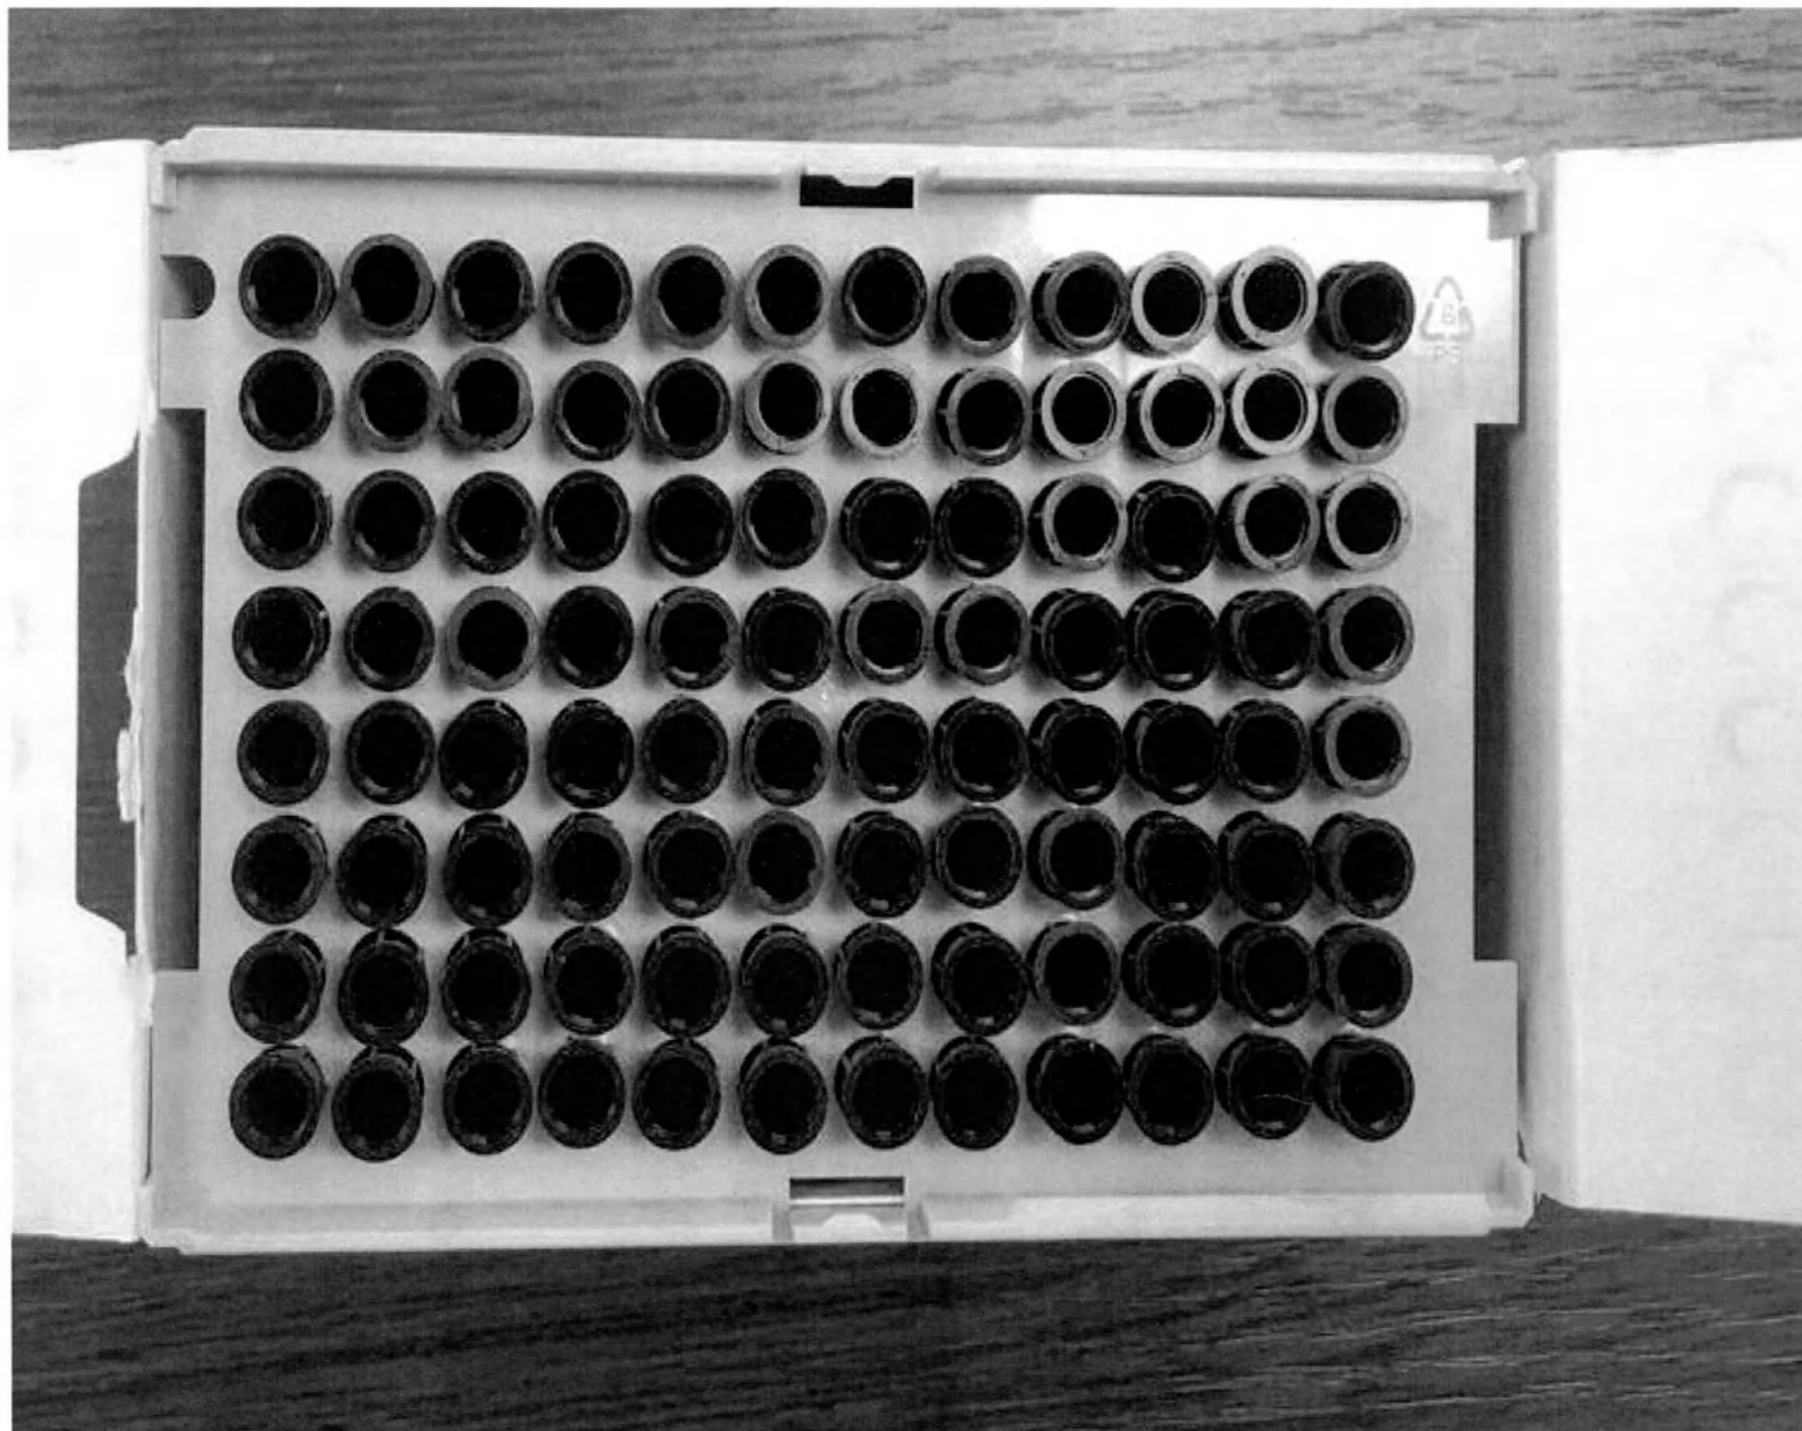

Наконечники нестерильные объемом 1000 мкл в штативе для анализаторов и автоматизированных систем для in vitro диагностики. Общий вид медицинского изделия.



Наконечники нестерильные объемом 1000 мкл в штативе для анализаторов и автоматизированных систем для *in vitro* диагностики. Общий вид медицинского изделия.

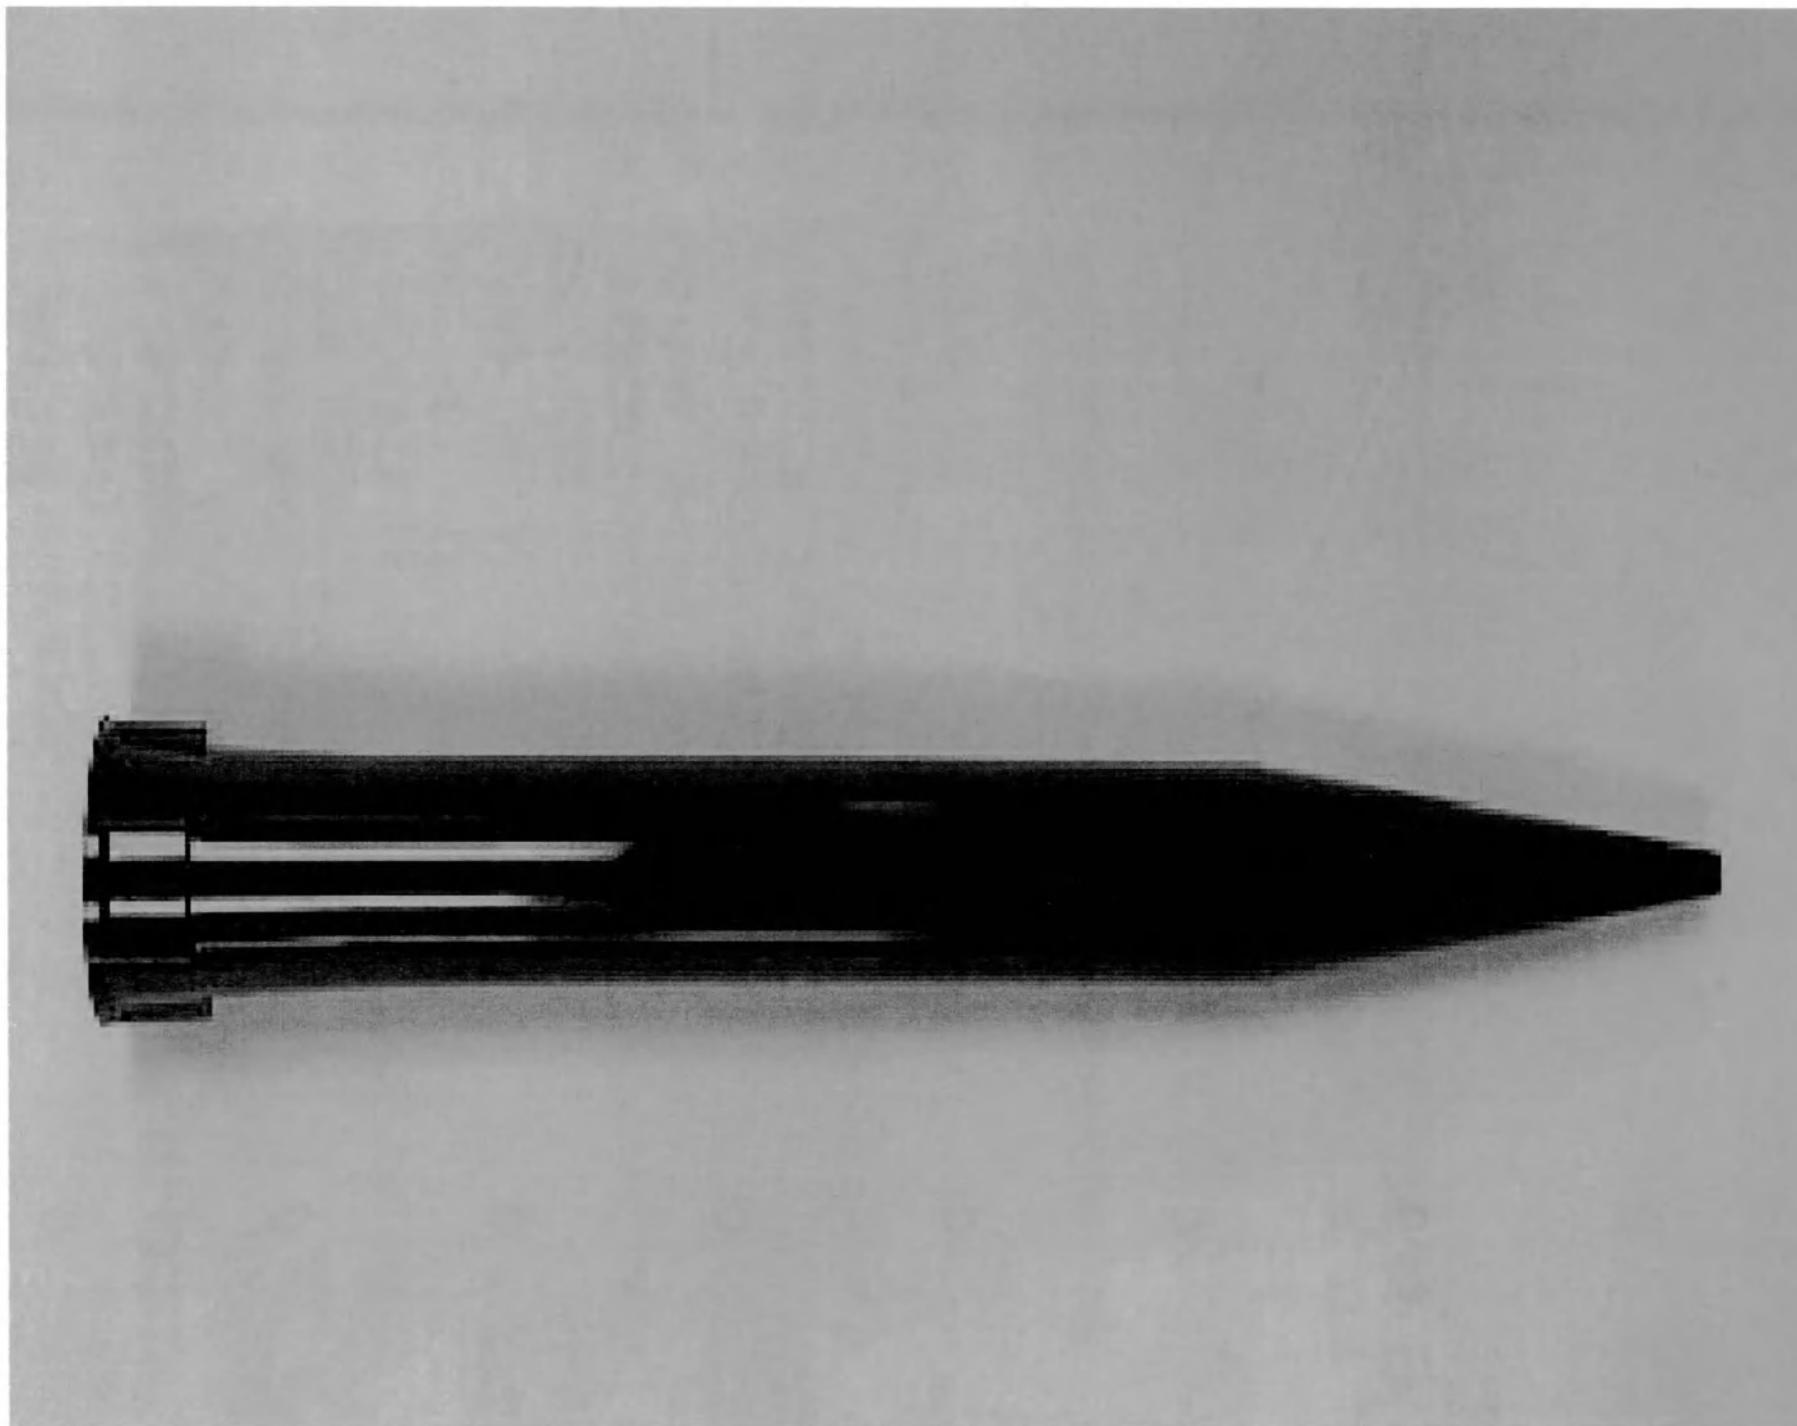

Наконечник нестерильный объемом 1000 мкл для анализаторов и автоматизированных систем для in vitro диагностики. Общий вид медицинского изделия.



Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

INSTRUCTION FOR USE / ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Non-sterile tips with a volume of 1000 µl in a tripod for analyzers
and automated systems for in vitro diagnostics / Наконечники
нестерильные объемом 1000 мкл в штативе для анализаторов и
автоматизированных систем для in vitro диагностики /**

Manufacturer/ Производитель:

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd., No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong Province, 519040,
P.R. China

«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ»

CEO / Исполнительный Директор

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

Lin Huaqing

Stamp/печать

Date: 03-03-2024

Rev. 1.0, 03-2024 / Ред. 1.0, 03-2024



Транспортная упаковка



Прошито, пронумеровано

8 (восемь) листа(ов)

ООО «Мирус Медикал»

Данилов П.А.

