

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2024 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 6134546

КУСАЙЛО Р. В.

Фотографические изображения изделия:

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. («Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.»),
Китай

Hematology Control

Packaging
Specification

Model: DM-6D

Specification: 1×3mL (H)

Lot 6D0424

20240313

20240610

CE IVD

ISO 13485

Attention:
1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.



DYMIND

EC REP

Emitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China

Certificate
Quality
Inspector


Потребительская упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (1×3,0 мл)



Индивидуальная упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики *in vitro*, в варианте исполнения Н (1×3,0 мл)




Instructions for H

Product Name
Hematology Control

Packaging

Model	Specifications
	3 mL×1 (H)
	3 mL×2 (H)
	3 mL×3 (H)
	3 mL×1 (N)
	3 mL×2 (N)

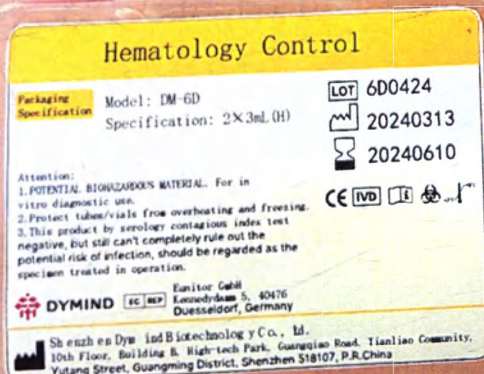

ology Co., Ltd.

GL DM-56-18-en_V1.1.0

DM-6D

HEMATOLOGY CONTROL

CONTROL

2023-09-12

2023-12-10

LOT	6D1023L	LOT	6D1023N	LOT	6D1023H
±1.20	7.76	±1.80	21.01	±3.00	
±0.40	6.23	±0.80	19.87	±2.00	
±0.40	0.97	±0.70	0.67	±1.80	
±0.40	0.26	±0.50	0.14	±0.80	
±0.40	0.22	±0.70	0.22	±1.60	
±0.40	0.09	±0.70	0.11	±1.60	
±0.50	0.46	±1.00	0.50	±2.50	
±12.0	61.3	±12.0	71.2	±12.0	
±10.0	24.4	±10.0	16.9	±10.0	
±8.0	6.5	±8.0	3.5	±8.0	
±10.0	5.5	±10.0	5.6	±10.0	
±10.0	2.3	±12.0	2.8	±12.0	
±10.0	11.7	±10.0	12.5	±10.0	
±0.20	4.58	±0.30	5.50	±0.50	
±4	135	±6	176	±8	

Общий вид МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (2×3,0 мл)

Nematology Control

Packaging Specification

Model: DM-6D

Specification: 2×3mL (H)

Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.



DYMIND



Unitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangdong Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China

Lot 6D0424

20240313

20240610



Certificate
Quality
Inspector


Потребительская упаковка МИ

Контроль гематологический (Nematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (2×3,0 мл)



Индивидуальная упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики *in vitro*, в варианте исполнения Н (2×3,0 мл)



Instructions for H

Product Name
Hematology Control

Packaging

Model	Specifications
	3 mL×1 (H)
	3 mL×2 (H)
	3 mL×3 (H)
	3 mL×1 (N)
	3 mL×2 (N)

ology Co., Ltd. GL DM-56-18-en_V1.1.0

DM-6D

HEMATOLOGY CONTROL

CONTROL

2023-09-12

2023-12-10

DM1023L	LOT	6D1023N	LOT	6D1023H
±1.20	7.76	±1.80	21.01	±3.00
±0.40	6.23	±0.80	19.87	±2.00
±0.40	0.97	±0.70	0.67	±1.80
±0.40	0.26	±0.50	0.14	±0.80
±0.40	0.22	±0.70	0.22	±1.60
±0.40	0.09	±0.70	0.11	±1.60
±0.50	0.46	±1.00	0.50	±2.50
±12.0	61.3	±12.0	71.2	±12.0
±10.0	24.4	±10.0	16.9	±10.0
±8.0	6.5	±8.0	3.5	±8.0
±10.0	5.5	±10.0	5.6	±10.0
±10.0	2.3	±12.0	2.8	±12.0
±10.0	11.7	±10.0	12.5	±10.0
±0.20	4.58	±0.30	5.50	±0.50
±4	135	±6	176	±8

Общий вид МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (3×3,0 мл)

Hematology Control

Packaging Specification

Model: DM-6D

Specification: 3×3mL (H)


LOT 6D0424

20240313

20240610

Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.



DYMIND

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China

Certificate
Quality
Inspector


Потребительская упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (3×3,0 мл)



Индивидуальная упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики *in vitro*, в варианте исполнения Н (3×3,0 мл)



Instructions for H

Product Name
Hematology Control

Packaging

Model	Specifications
	3 mLx1 (H)
	3 mLx2 (H)
	3 mLx3 (H)
	3 mLx1 (N)
	3 mLx2 (N)

ology Co., Ltd.

GL DM-56-18-en_V1.1.0


DM-6D

HEMATOLOGY CONTROL

CONTROL

2023-09-12

2023-12-10



Hematology Control

Packaging
Specification

Model: DM-6D

Specification: 1x3mL (N)

LOT 6D0424

20240313

20240610

Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology: contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

CE IVD



DYMIND

CE MDP

Enzilor Gell
Kunzelsdorf 5, 40476
Duiseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China

6D1023L	LOT	6D1023N	LOT	6D1023H
±1.20	7.76	±1.80	21.01	±3.00
±0.40	6.23	±0.80	19.87	±2.00
±0.40	0.97	±0.70	0.67	±1.80
±0.40	0.26	±0.50	0.14	±0.80
±0.40	0.22	±0.70	0.22	±1.60
±0.40	0.09	±0.70	0.11	±1.60
±0.50	0.46	±1.00	0.50	±2.50
±12.0	61.3	±12.0	71.2	±12.0
±10.0	24.4	±10.0	16.9	±10.0
±8.0	6.5	±8.0	3.5	±8.0
±10.0	5.5	±10.0	5.6	±10.0
±10.0	2.3	±12.0	2.8	±12.0
±10.0	11.7	±10.0	12.5	±10.0
±0.20	4.59	±0.30	5.50	±0.50
±4	135	±6	176	±8

Общий вид МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (1x3,0 мл)

Hematology Control

Packaging Specification

Model: DM-6D

Specification: 1×3mL (N)

LOT 6D0424

20240313

20240610

Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.




DYMIND

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany




Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China




Потребительская упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (1×3,0 мл)

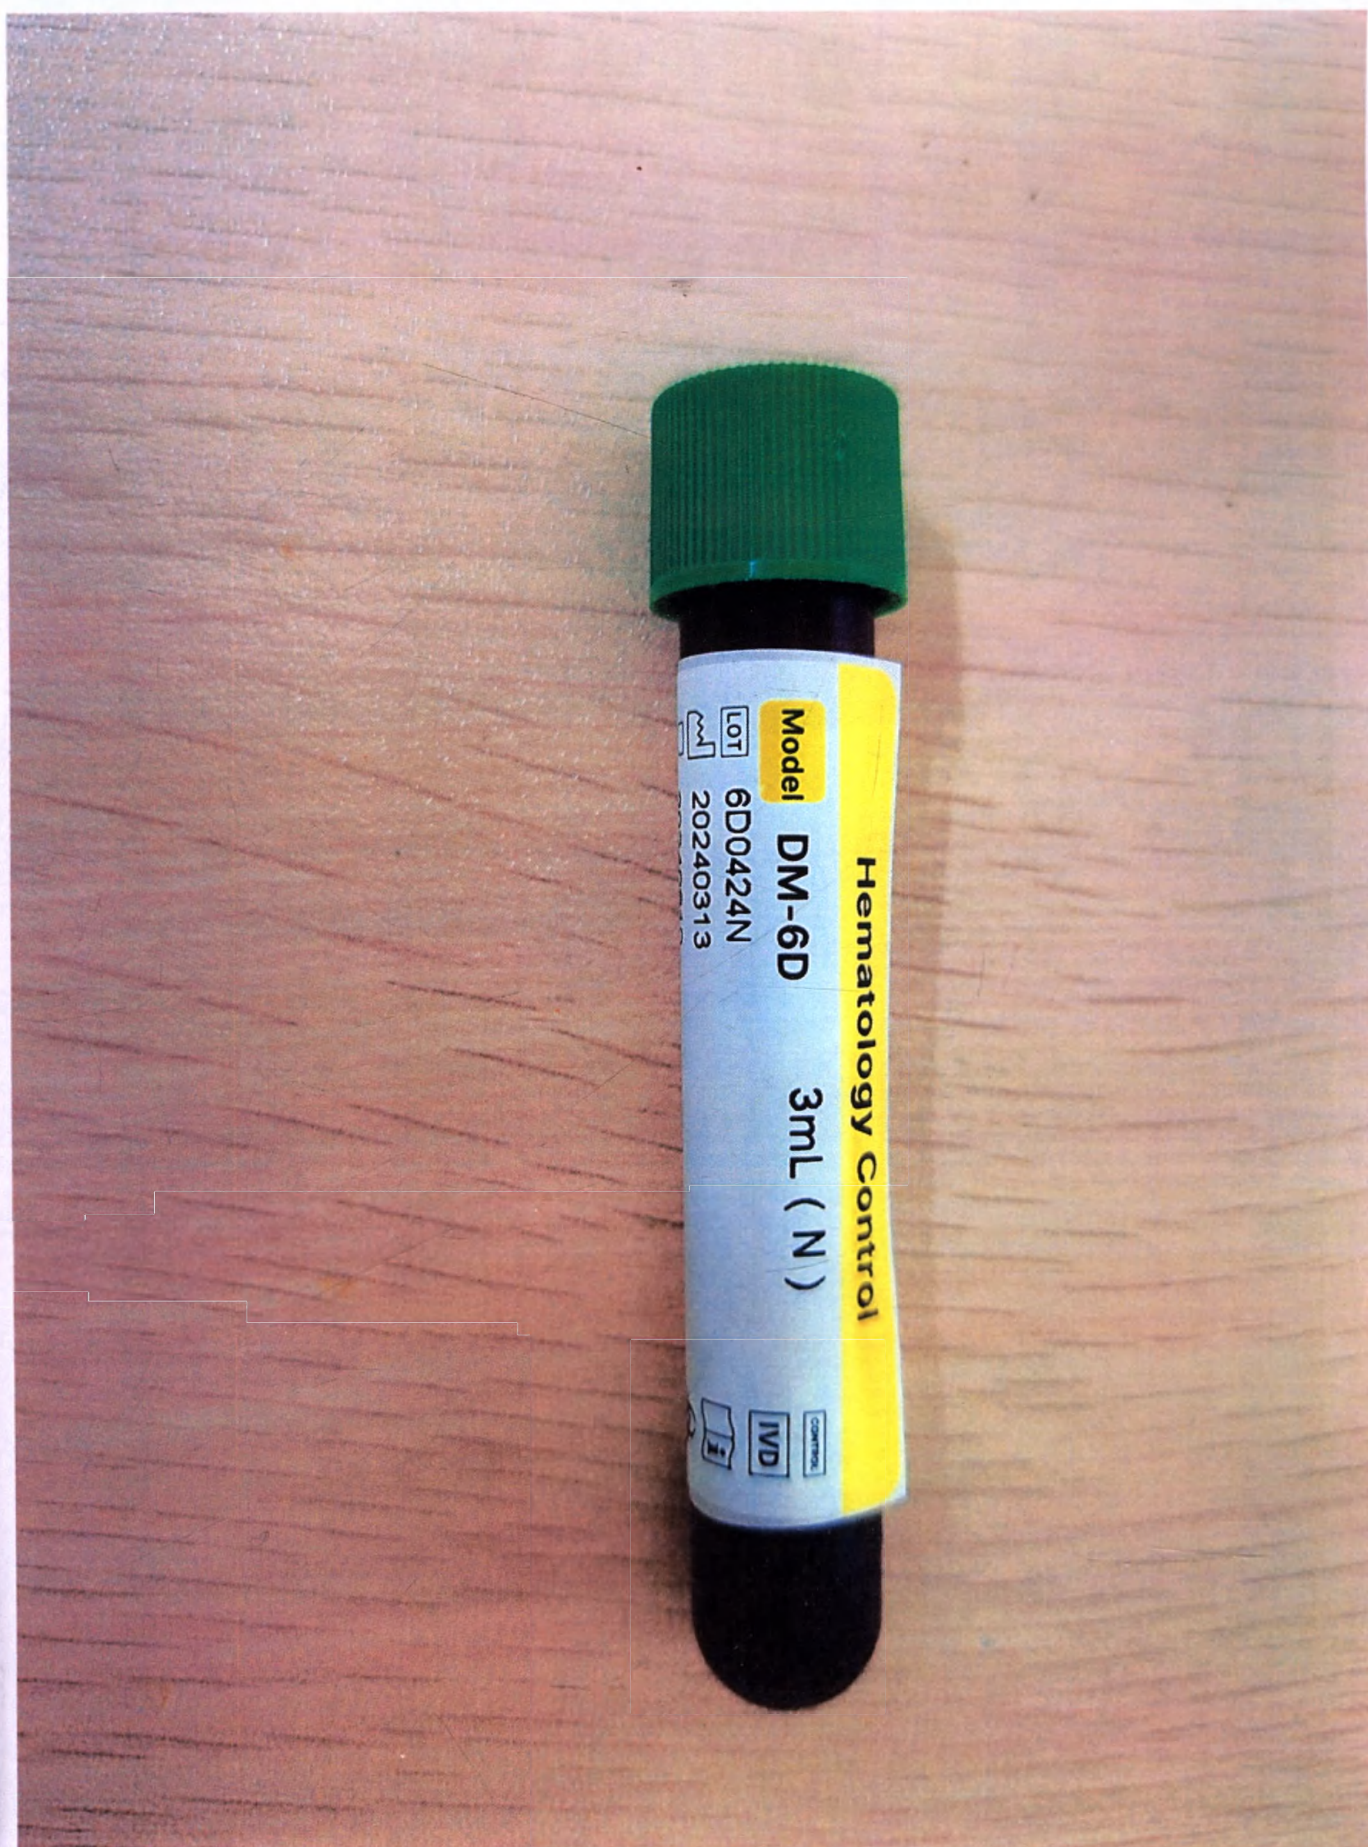

Индивидуальная упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (1×3,0 мл)



Instructions for H

Product Name
Hematology Control
Packaging

Model	Specifications
	3 mLx1 (H)
	3 mLx2 (H)
	3 mLx3 (H)
	3 mLx1 (N)
	3 mLx2 (N)



ology Co., Ltd. GL DM-56-18-en_V1.1.0

DM-6D HEMATOLOGY CONTROL CONTROL

2023-09-12

2023-12-10

DM1023L	LOT	DM1023N	LOT	DM1023H
±1.20	7.76	±1.80	21.01	±3.00
+0.40	6.23	±0.80	19.87	±2.00
±0.40	0.97	±0.70	0.67	±1.80
±0.40	0.26	±0.50	0.14	±0.80
-0.40	0.22	±0.70	0.22	±1.60
±0.40	0.09	±0.70	0.11	±1.60
±0.50	0.46	±1.00	0.50	±2.50
±12.0	61.3	±12.0	71.2	±12.0
±10.0	24.4	±10.0	16.9	±10.0
±8.0	6.5	±8.0	3.5	±8.0
±10.0	5.5	±10.0	5.6	±10.0
±10.0	2.3	±12.0	2.8	±12.0
±10.0	11.7	±10.0	12.5	±10.0
±0.20	4.58	±0.30	5.50	±0.50
±4	135	±6	176	±8

Общий вид МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (2×3,0 мл)

Hematology Control

Packaging Specification

Model: DM-6D

Specification: 2×3mL (N)

LOT 6D0424

20240313

20240610

Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.




DYMIND

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China




Потребительская упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (2×3,0 мл)



Индивидуальная упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики *in vitro*, в варианте исполнения N (2×3,0 мл)



Instructions for H

Product Name
Hematology Control
Packaging

Model	Specifications
	3 mL×1 (H)
	3 mL×2 (H)
	3 mL×3 (H)
	3 mL×1 (N)
	3 mL×2 (N)



GL DM-56-18-en V1.1.0
ology Co., Ltd.
DM-6D
HEMATOLOGY CONTROL
2023-09-12
2023-12-10

SD1023L	LOT	6D1023N	LOT	6D1023H
±1.20	7.76	±1.80	21.01	±3.00
±0.40	6.23	±0.80	19.87	±2.00
±0.40	0.97	±0.70	0.67	±1.80
±0.40	0.26	±0.50	0.14	±0.80
±0.40	0.22	±0.70	0.22	±1.60
±0.40	0.09	±0.70	0.11	±1.60
±0.50	0.46	±1.00	0.50	±2.50
±12.0	61.3	±12.0	71.2	±12.0
±10.0	24.4	±10.0	16.9	±10.0
±8.0	6.5	±8.0	3.5	±8.0
±10.0	5.5	±10.0	5.6	±10.0
±10.0	2.3	±12.0	2.8	±12.0
±10.0	11.7	±10.0	12.5	±10.0
±0.20	4.58	±0.30	5.50	±0.50
±4	135	±6	176	±8

Общий вид МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (3×3,0 мл)

Nematology Control

Packaging
Specification

Model: DM-6D

Specification: 3X3mL (N)

Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

Lot 6D0424
20240313
20240610
CE IVD



DYMIND

EC REP

Supplier GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China




Потребительская упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (3x3,0 мл)



Индивидуальная упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики *in vitro*, в варианте исполнения N (3×3,0 мл)



Instructions for H

Product Name
Hematology Control
Packaging

Model	Specifications
	3 mL×1 (H)
	3 mL×2 (H)
	3 mL×3 (H)
	3 mL×1 (N)
	3 mL×2 (N)

ology Co., Ltd. GL DM-56-18-en_V1.1.0

DM-6D HEMATOLOGY CONTROL CONTROL

2023-09-12

2023-12-10

D1023L	LOT	6D1023N	LOT	6D1023H
±1.20	7.76	±1.80	21.01	±3.00
±0.40	6.23	±0.80	19.87	±2.00
±0.40	0.97	±0.70	0.67	±1.80
±0.40	0.26	±0.50	0.14	±0.80
±0.40	0.22	±0.70	0.22	±1.60
±0.40	0.09	±0.70	0.11	±1.60
±0.50	0.46	±1.00	0.50	±2.50
±12.0	61.3	±12.0	71.2	±12.0
±10.0	24.4	±10.0	16.9	±10.0
±8.0	6.5	±8.0	3.5	±8.0
±10.0	5.5	±10.0	5.6	±10.0
±10.0	2.3	±12.0	2.8	±12.0
±10.0	11.7	±10.0	12.5	±10.0
±0.20	4.58	±0.30	5.50	±0.50
±4	135	±6	176	±8

Hematology Control

Packaging
Specification

Model: DM-6D
Specification: 1×3mL (L)

LOT 6D0424

20240313

20240610

Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product is serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.



DYMIND

CE

IVD

Manufacturer: DYMIND Co., Ltd.
Lanzhou Road 5, 40476
Düsseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangshao Road, Tianlian Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China



Общий вид МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (1×3,0 мл)

Hematology Control

Packaging
Specification

Model: DM-6D

Specification: 1×3mL (L)

LOT 6D0424

20240313

20240610

Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.



DYMIND

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany




Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China




Потребительская упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (1×3,0 мл)

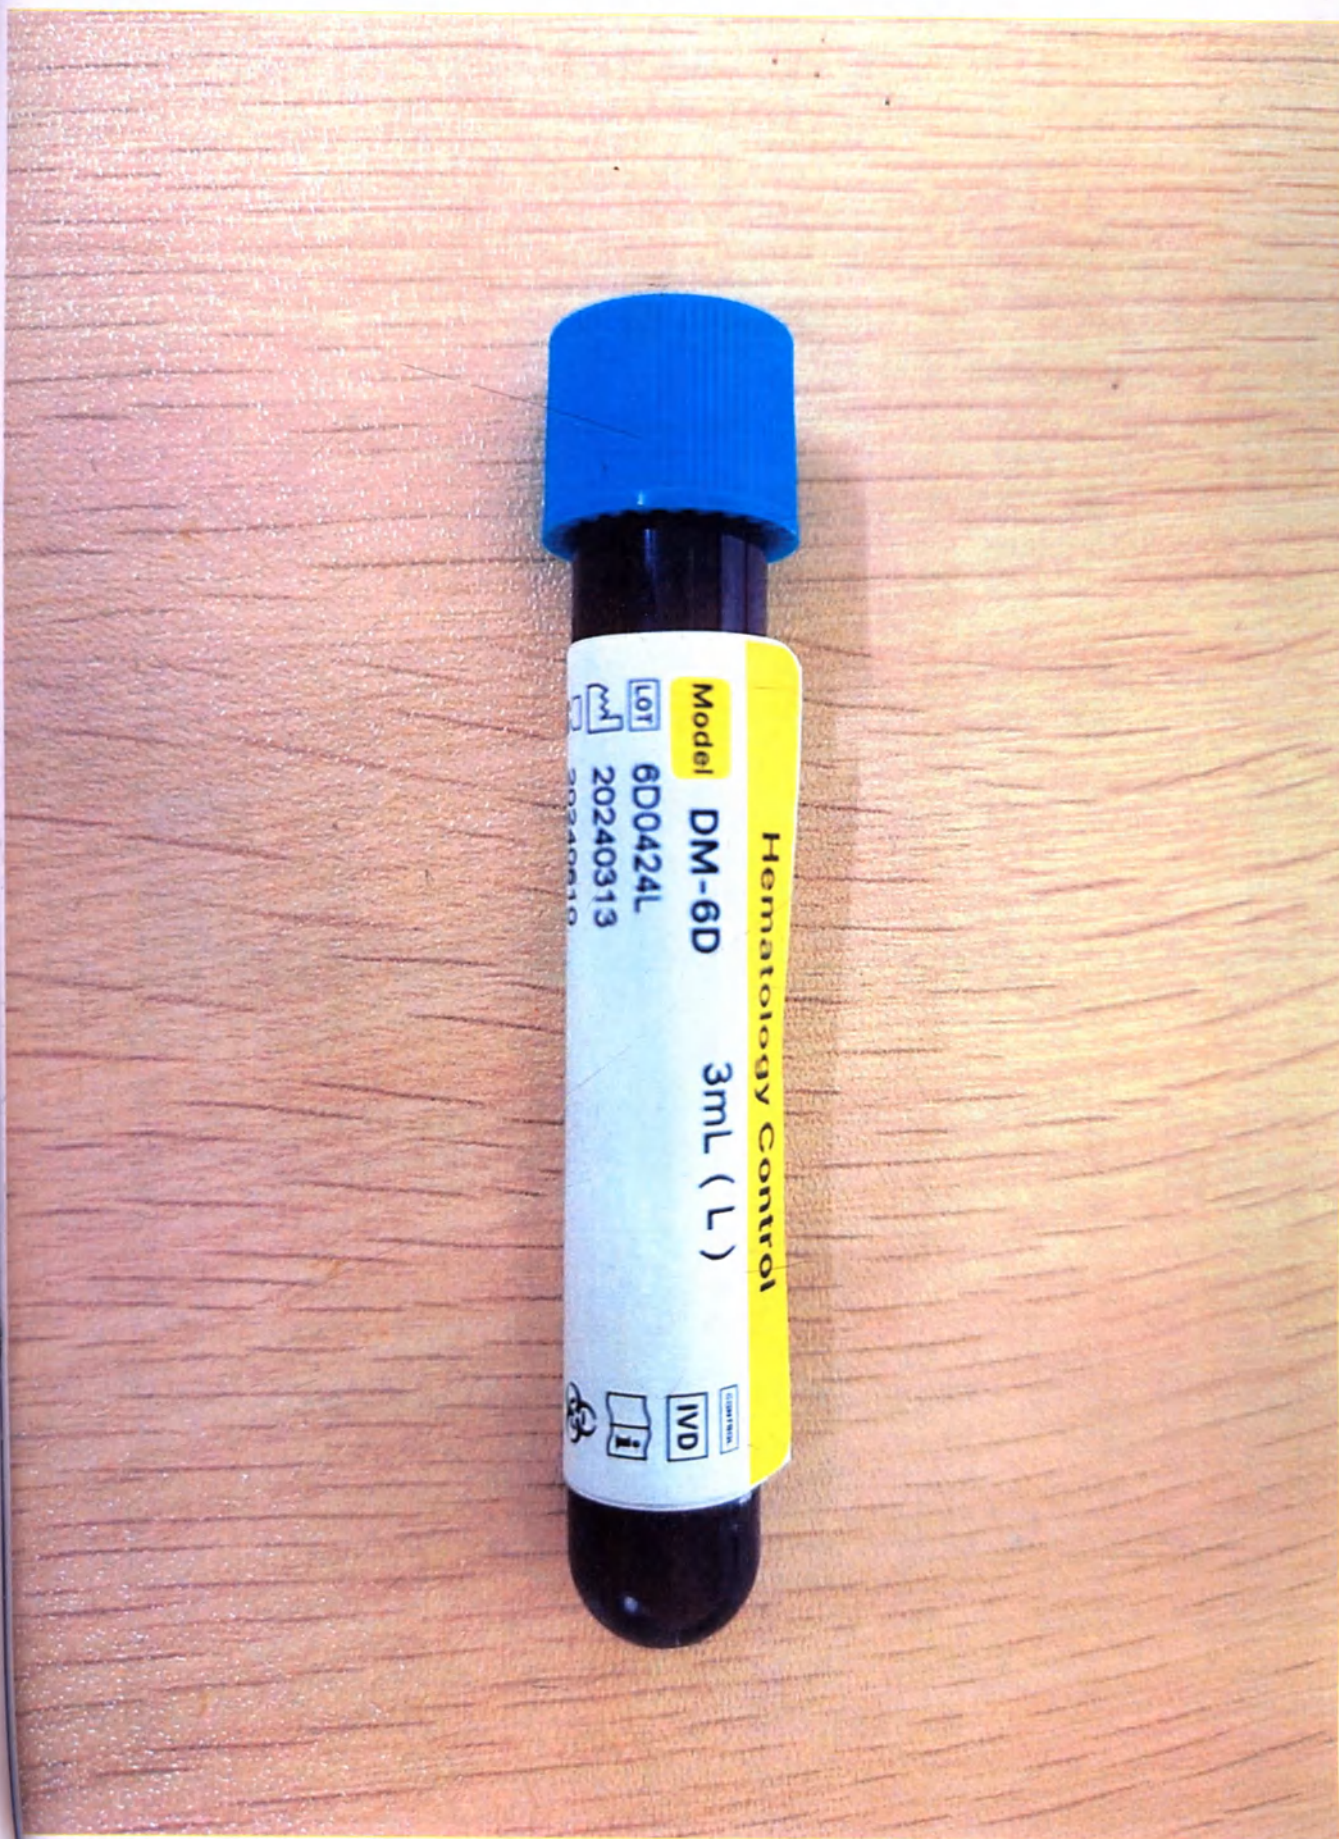

Индивидуальная упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (1×3,0 мл)



Instructions for H

Product Name
Hematology Control
Packaging

Model	Specifications
	3 mL x 1 (H)
	3 mL x 2 (H)
	3 mL x 3 (H)
	3 mL x 1 (N)
	3 mL x 2 (N)



Hematology Control

Packaging Specification: Model: DM-6D
Specification: 2x3mL (L)

LOT 6D0424
20240313
20240610

Attention:
1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

CE IVD

DYMIND
Eunitor GmbH
Lennestraße 5, 40176
Düsseldorf, Germany

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqian Road, Tianliang Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China

GL DM-56-18-cn_V1.1.0
ology Co., Ltd.

DM-6D HEMATOLOGY CONTROL CONTROL

2023-09-12

2023-12-10

DM-6D1023L	LOT	6D1023N	LOT	6D1023H
±1.20	7.76	±1.80	21.01	±3.00
±0.40	6.23	±0.80	19.87	±2.00
±0.40	0.97	±0.70	0.67	±1.80
±0.40	0.26	±0.50	0.14	±0.80
±0.40	0.22	±0.70	0.22	±1.60
±0.40	0.09	±0.70	0.11	±1.60
±0.50	0.46	±1.00	0.50	±2.50
±12.0	61.3	±12.0	71.2	±12.0
±10.0	24.4	±10.0	16.9	±10.0
±8.0	6.5	±8.0	3.5	±8.0
±10.0	5.5	±10.0	5.6	±10.0
±10.0	2.3	±12.0	2.8	±12.0
±10.0	11.7	±10.0	12.5	±10.0
±0.20	4.58	±0.30	5.50	±0.50
±4	135	±6	176	±8

Общий вид МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (2x3,0 мл)

Hematology Control

Packaging
Specification

Model: DM-6D

Specification: 2×3mL (L)

LOT 6D0424

20240313

20240610

Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.



DYMIND

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China

Quality
Inspector
Certificate



Потребительская упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеточ крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (2×3,0 мл)



Индивидуальная упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (2×3,0 мл)

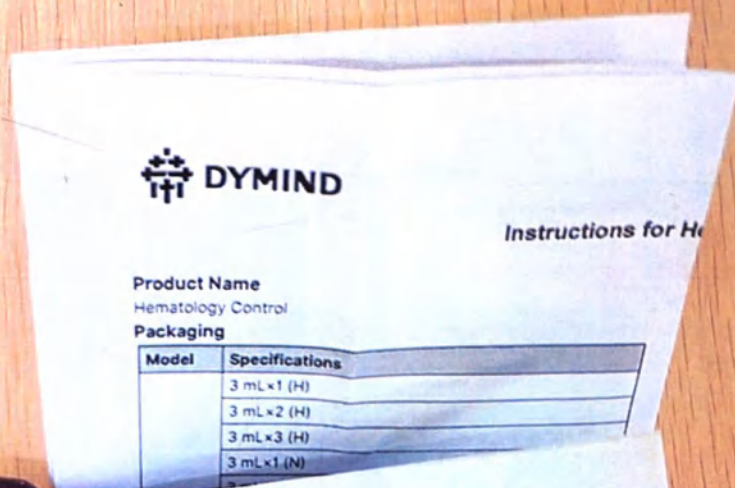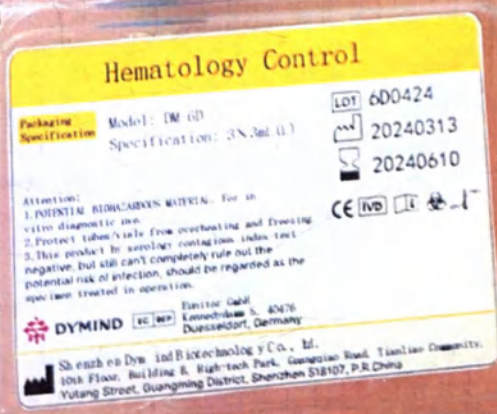

GL DM-56-18-en V1.1.0

DM-6D

HEMATOLOGY CONTROL

CONTROL

2023-09-12

2023-12-10

LOT	6D1023L	LOT	6D1023N	LOT	6D1023H
±1.20	7.76	±1.80	21.01	±3.00	
±0.40	6.23	±0.80	19.87	±2.00	
±0.40	0.97	±0.70	0.67	±1.80	
±0.40	0.26	±0.50	0.14	±0.80	
±0.40	0.22	±0.70	0.22	±1.60	
±0.40	0.09	±0.70	0.11	±1.60	
±0.50	0.46	±1.00	0.50	±2.50	
±12.0	61.3	±12.0	71.2	±12.0	
±10.0	24.4	±10.0	16.9	±10.0	
±8.0	6.5	±8.0	3.5	±8.0	
±10.0	5.5	±10.0	5.6	±10.0	
±10.0	2.3	±12.0	2.8	±12.0	
±10.0	11.7	±10.0	12.5	±10.0	
±0.20	4.58	±0.30	5.50	±0.50	
±4	135	±6	176	±8	

Общий вид МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (3×3,0 мл)

Hematology Control

Packaging Specification

Model: DM-6D

Specification: 3×3mL (L)


LOT 6D0424

20240313

20240610

Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.



DYMIND

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China


Quality
Inspector

Потребительская упаковка МИ
Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного
определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических
гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (3×3,0 мл)



Индивидуальная упаковка МИ

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики *in vitro*, в варианте исполнения L (3×3,0 мл)

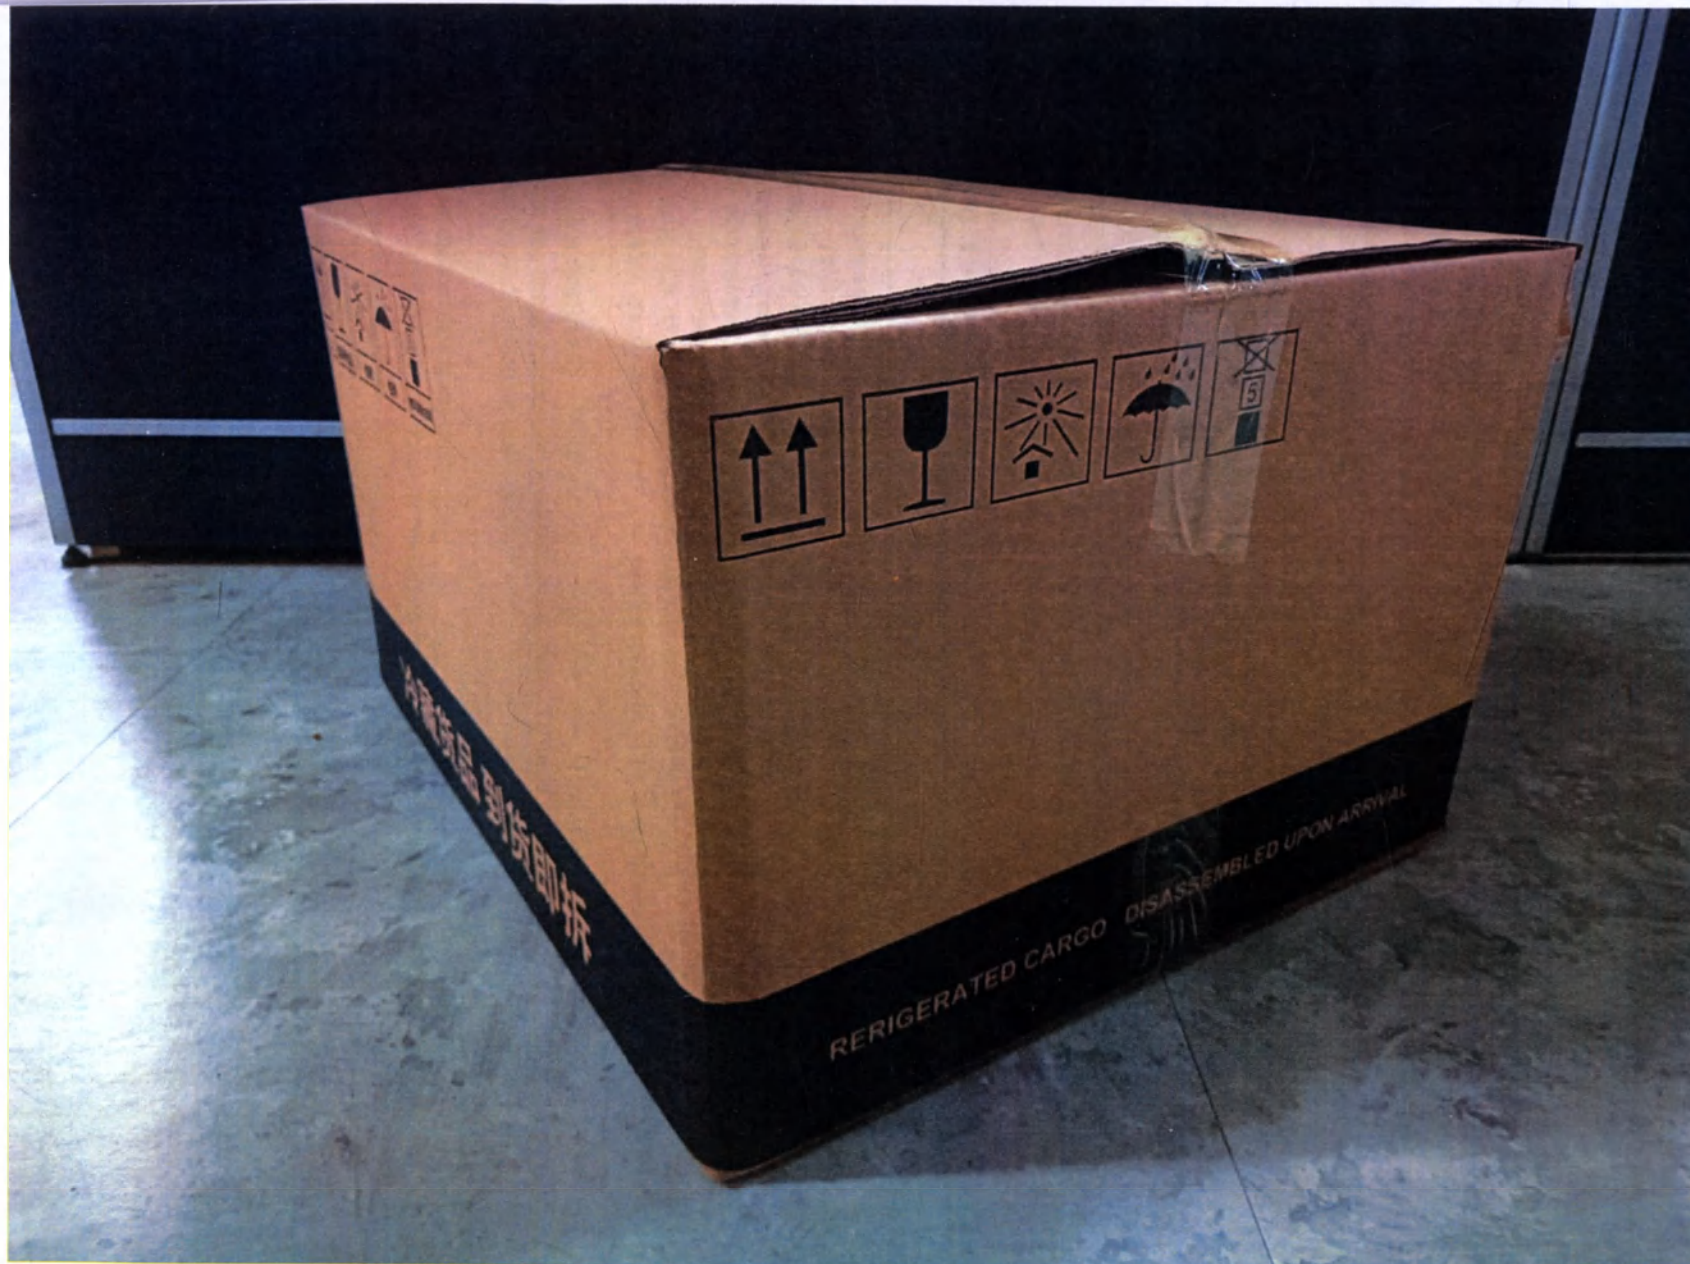

Транспортная упаковка

Информацию на стикере считать приоритетной

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (1×3,0 мл), в составе:

- Контроль Н (высокий) – 1×3,0 мл;
- Таблицы значений и диапазонов анализа компании Dymind – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологджи Ко., Лтд.»), Китай
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang
Street, Guangming District, Shenzhen, 518107, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский,
пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, помещ. 1/1.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Информацию на стикере считать приоритетной

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (2×3,0 мл), в составе:

- Контроль Н (высокий) – 2×3,0 мл;
- Таблицы значений и диапазонов анализа компании Dymind – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологджи Ко., Лтд.»), Китай
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang
Street, Guangming District, Shenzhen, 518107, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский,
пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, помещ. 1/1.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Информацию на стикере считать приоритетной

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (3×3,0 мл), в составе:

- Контроль Н (высокий) – 3×3,0 мл;
- Таблицы значений и диапазонов анализа компании Dymind – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотекнологджи Ко., Лтд.»), Китай
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang
Street, Guangming District, Shenzhen, 518107, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский,
пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, помещ. 1/1.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Информацию на стикере считать приоритетной

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (1×3,0 мл), в составе:

- Контроль N (высокий) – 1×3,0 мл;
- Таблицы значений и диапазонов анализа компании Dymind – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотекнологджи Ко., Лтд.»), Китай
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang
Street, Guangming District, Shenzhen, 518107, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский,
пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, помещ. 1/1.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Информацию на стикере считать приоритетной

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (2×3,0 мл), в составе:

- Контроль N (высокий) – 2×3,0 мл;
- Таблицы значений и диапазонов анализа компании Dymind – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.»), Китай
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang
Street, Guangming District, Shenzhen, 518107, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский,
пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, помещ. 1/1.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Информацию на стикере считать приоритетной

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (3×3,0 мл), в составе:

- Контроль N (высокий) – 3×3,0 мл;
- Таблицы значений и диапазонов анализа компании Dymind – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.»), Китай
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang
Street, Guangming District, Shenzhen, 518107, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский,
пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, помещ. 1/1.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Информацию на стикере считать приоритетной

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (1×3,0 мл), в составе:

- Контроль L (высокий) – 1×3,0 мл;
- Таблицы значений и диапазонов анализа компании Dymind – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологджи Ко., Лтд.»), Китай
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang
Street, Guangming District, Shenzhen, 518107, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский,
пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, помещ. 1/1.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Информацию на стикере считать приоритетной

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (2×3,0 мл), в составе:

- Контроль L (высокий) – 2×3,0 мл;
- Таблицы значений и диапазонов анализа компании Dymind – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологджи Ко., Лтд.»), Китай
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang
Street, Guangming District, Shenzhen, 518107, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский,
пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, помещ. 1/1.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Информацию на стикере считать приоритетной

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики *in vitro*

Вариант исполнения:

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики *in vitro*, в варианте исполнения L (3×3,0 мл), в составе:

- Контроль L (высокий) – 3×3,0 мл;
- Таблицы значений и диапазонов анализа компании Dymind – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,

(«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнолоджи Ко., Лтд.»), Китай

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen, 518107, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, помещ. 1/1.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Макет маркировки потребительской упаковки

Контроль гематологический (Hematology Control (DM-6D)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на анализаторах автоматических гематологических для диагностики *in vitro*

LOT



масса нетто _____
масса брутто _____
масса нетто потребительской упаковки _____
количество _____ шт.
габаритные размеры (ДхШхВ): _____



IVD



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,

(«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнолоджи Ко., Лтд.»), Китай

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen, 518107, P.R.China

Макет маркировки транспортной упаковки

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 34 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.

