

ЭКО-ЭКО-СЕРВИС
 ООО «ЭКО-СЕРВИС»
 125212, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 27, стр. 1
 (495) 202-199-002, 17996570-2018

Инструкция по применению
 для проведения экспресс-диагностики
 в амниотической жидкости при наличии
 в ней маркера опухоли молочной железы
 (цитоплазматический белок СМАСТ-1)

Состав: Реагент 1 1 x 10 мл
 Реагент 2 1 x 90 мл


Серия 0119 Изготовлен 01.2019
 Годен до 07.2020
 Хранить при 2-25°С

Азопирам Жидкий бирагент

RU № ФСР
 15.21.20.23.199-002-17996570-2018





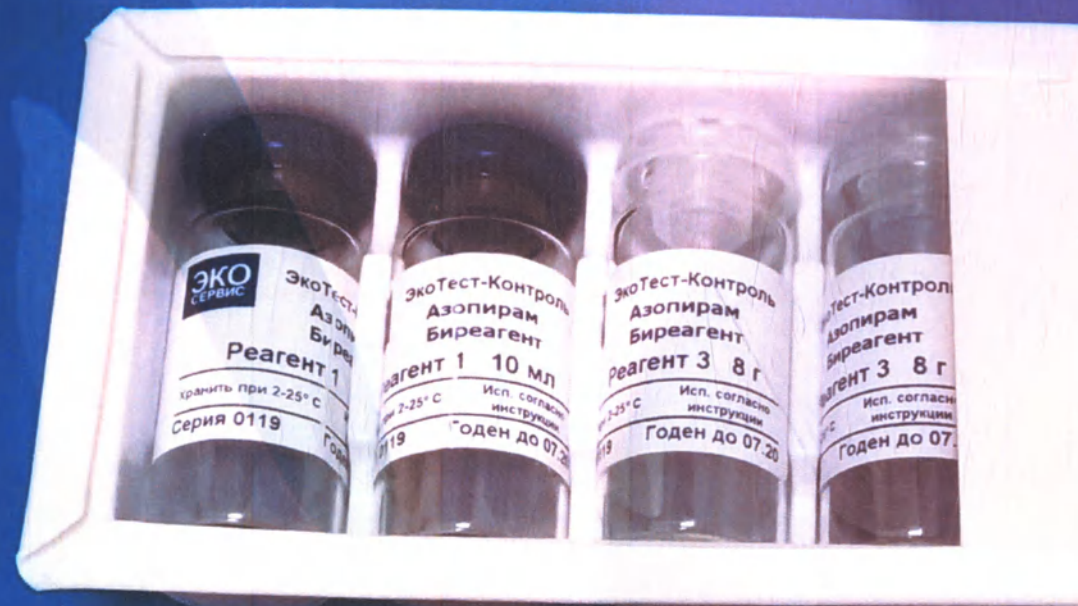

ООО "ЭКО-СЕРВИС"
191156 Санкт-Петербург
пр. Энгельса, 27, лит. Т
(812) 702-10-44 www.ecoservice-spb.ru

Индикаторы для контроля
качества предстерилизационной
очистки медицинских изделий
одноразовые ЭкоТест-Контроль

Состав Реагент 1 - 2 x 10 мл
Реагент 3 - 2 x 8 г

Серия 0119 Изготовлен 01.2019
Годен до 07.2020
Хранить при 2-25°C

Азопирам Биреагент

фасовка 2

ТУ 21.20.23.199-002-17996570-2018
РУ № ФСР



ООО "ЭКО-СЕРВИС"
191156 Санкт-Петербург
пр. Энгельса, 27, лит. Т
(812) 702-10-44 www.ecoservice-spb.ru

Индикаторы для контроля
качества предстерилизационной
очистки медицинских изделий
одноразовые ЭкоТест-Контроль

Состав Реагент 1 - 1 x 10 мл
Реагент 3 - 1 x 8 г

Серия 0119 Изготовлен 01.2019
Годен до 07.2020
Хранить при 2-25°C







Азопирам Биреагент

фасовка 1


ТУ 21.20.23.199-002-17996570-2018
РУ № ФСР





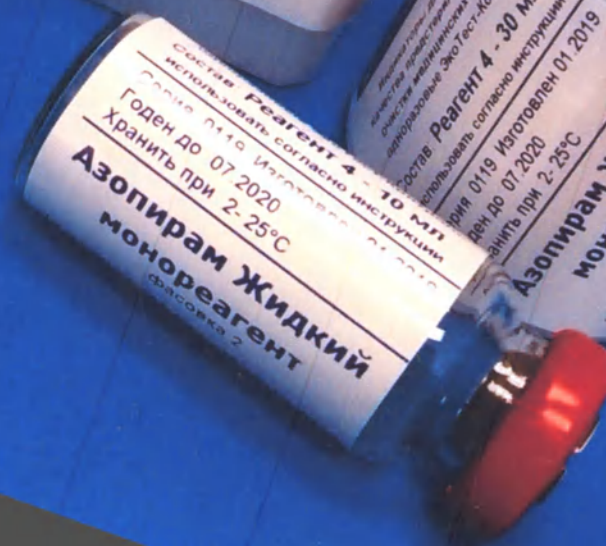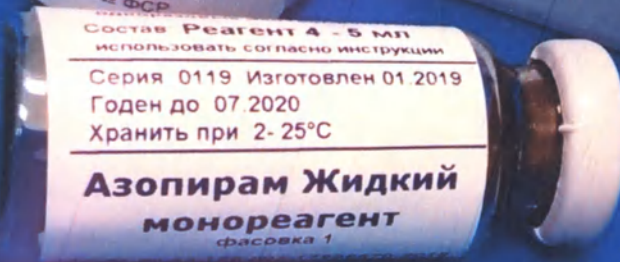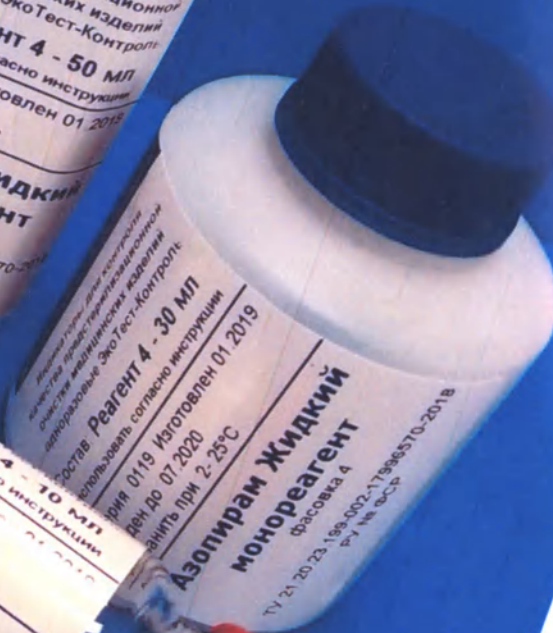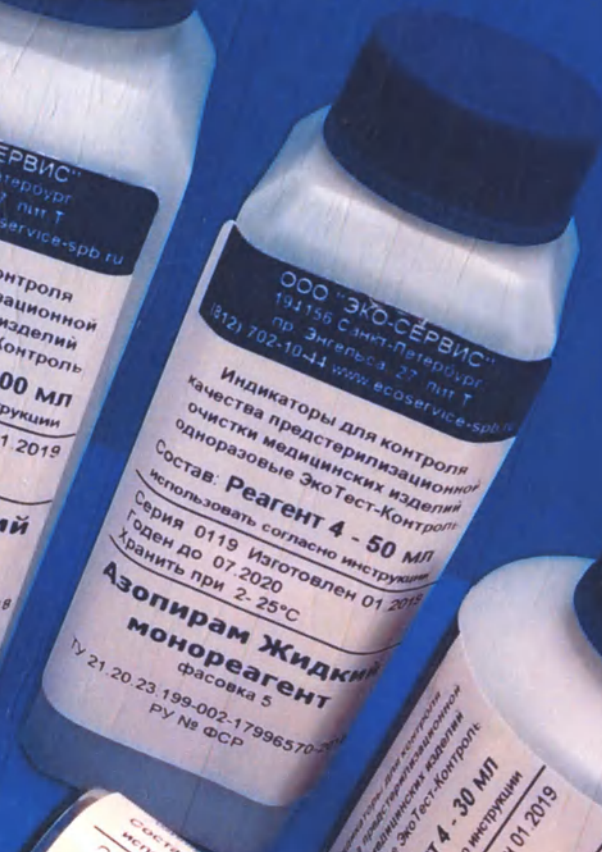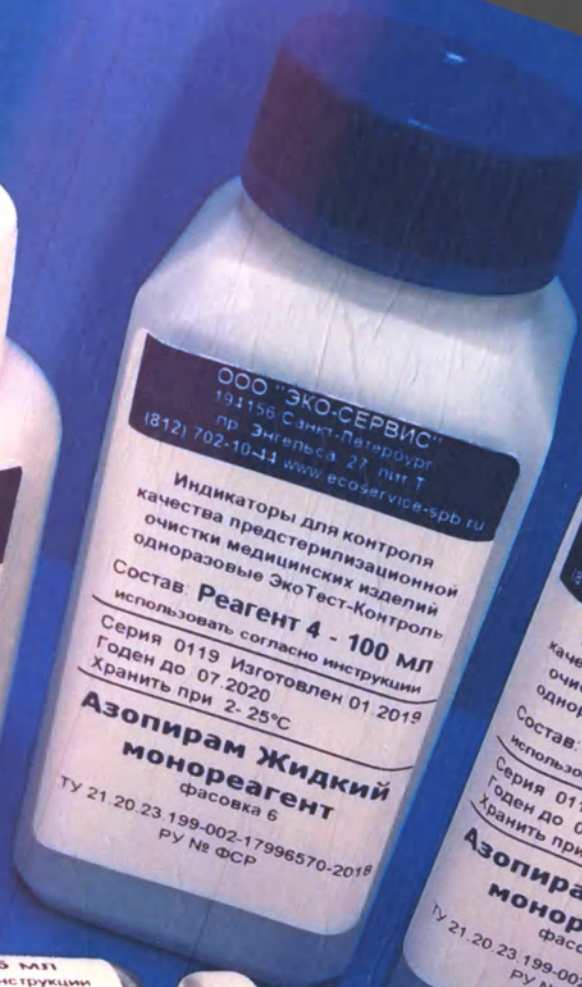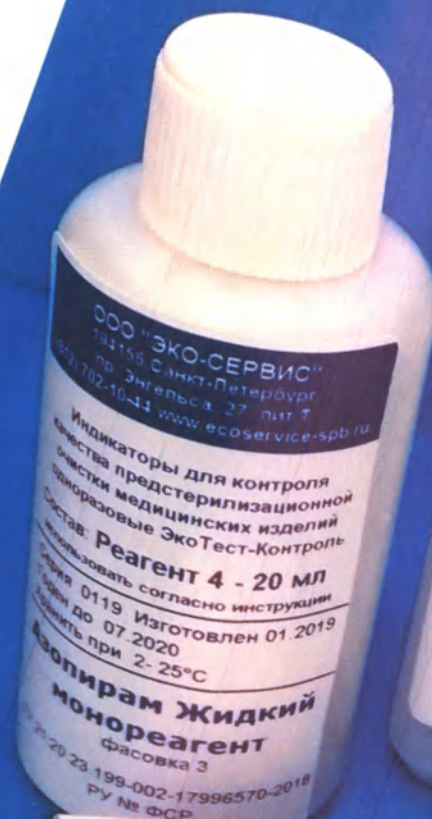



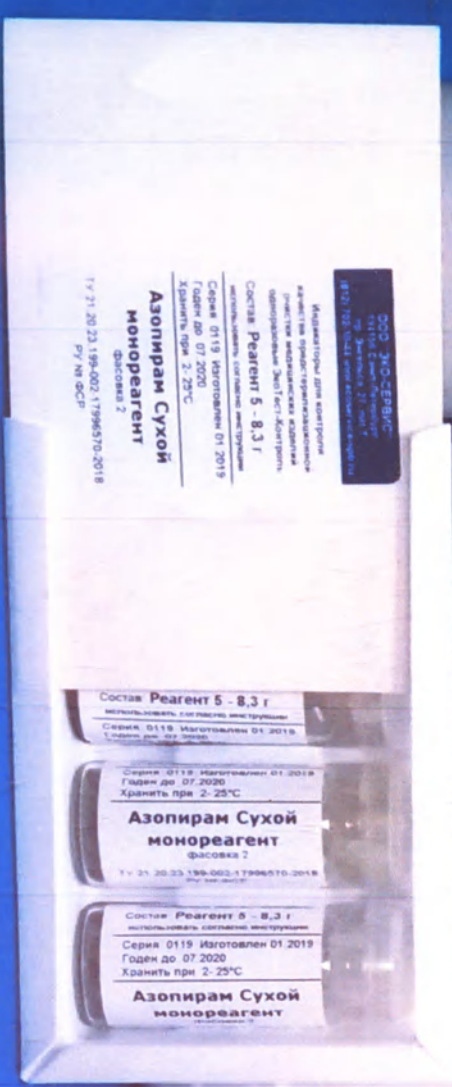





ООО "ЭКО-СЕРВИС"
194156 Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, 27, лит. Т
(812) 702-10-44 www.ecoservice-spb.ru

Индикаторы для контроля
качества предстерилизационной
очистки медицинских изделий
одноразовые ЭкоТест-Контроль

Состав **Реагент 6 - 100 мл**
готов к применению

Серия 0119 Изготовлен 01 2019
Годен до 07 2020
Хранить при 2- 25°C

Фенолфталеин
1 % спиртовой раствор

ТУ 21 20 23 199-002-17996570-2018
РУ № ФСР



ЭКО
СЕРВИС

ООО "ЭКО-СЕРВИС"

Индикаторы для контроля качества
предстерилизационной очистки
медицинских изделий одноразового
использования

Количество: 1 шт

Транспортировать при t: 30 - +30°C

Хранить при t: +2 - +25°C

Годен до: 1 - 2 - +25°C

