

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и принадлежностей
«Калибратор гематологический DM-CAL-5E для количественного определения параметров
клеток крови в клиническом образце на «Анализаторе гематологическом автоматическом DH-
615»»**

Официальный производитель:

«Шеньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.),

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China

(10-й этаж, здание В, парк высоких технологий, дорога Гуанцяо, микрорайон Тяньляо, подрайон Ютан, район Гуанмин, Шэньчжэнь 518107, КНР)

Tel: +86-755-26008015

Fax: +86 755 26746162

E-mail: intl@dymind.com

Наименование и адрес места производства:

«Шеньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.),

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China

(10-й этаж, здание В, парк высоких технологий, дорога Гуанцяо, микрорайон Тяньляо, подрайон Ютан, район Гуанмин, Шэньчжэнь 518107, КНР)

Tel: +86-755-26008015

Fax: +86 755 26746162

E-mail: intl@dymind.com

Уполномоченный представитель в Российской Федерации

ООО «РЕАГЕНТИКА»

108802, Г.МОСКВА,

ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, Д НИКОЛО-ХОВАНСКОЕ, Д. 1006, СТР. 1

Тел./Факс: +7 495 230 88 08

Электронная почта: mail@reagentika.ru

Утверждено:

Полное имя

Позднев Павел Владимирович

Должность:

Генеральный директор

Компания:

ООО «РЕАГЕНТИКА»


Подпись:

Дата:


Печать:

16 ДЕК 2024



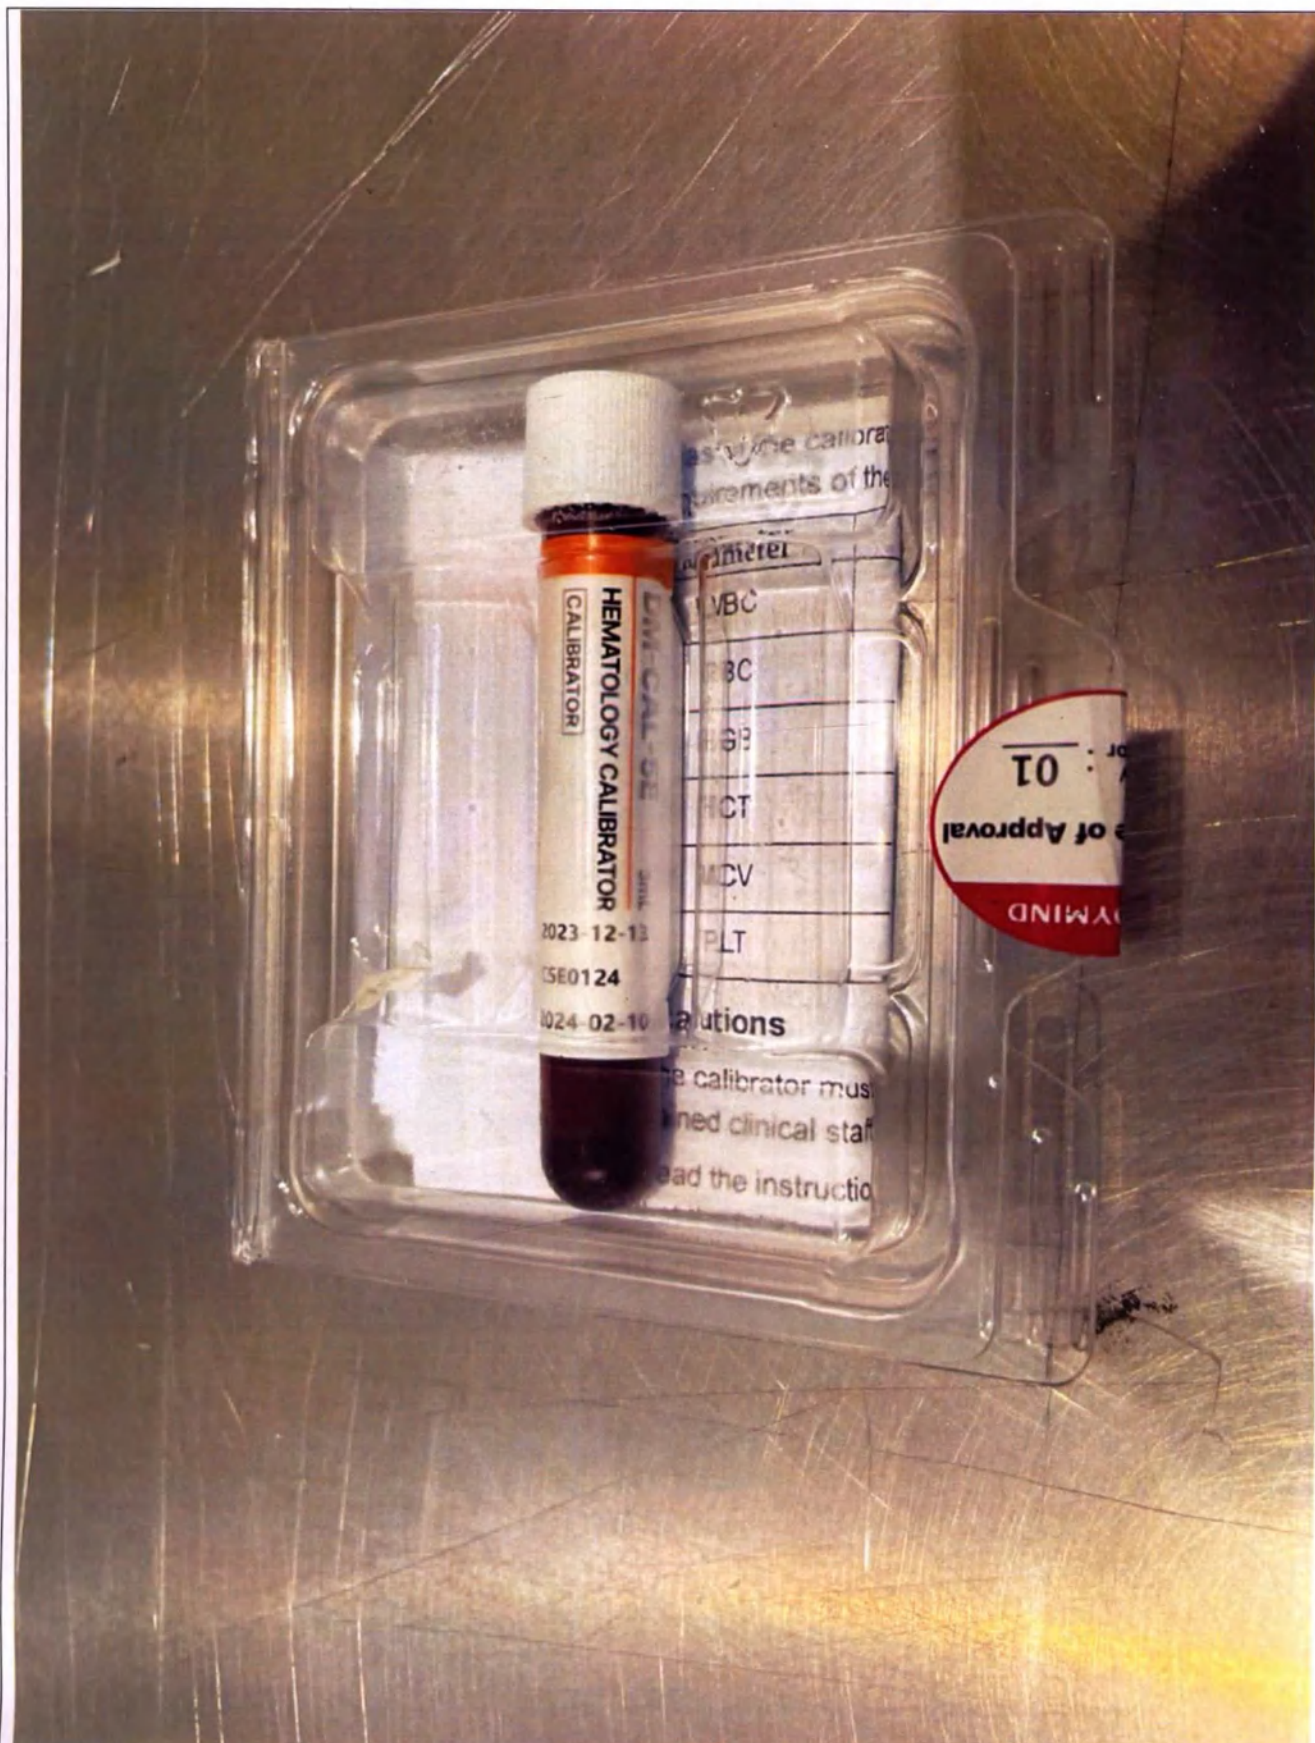

Вторичная упаковка «Калибратор гематологический DM-CAL-5E для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на «Анализаторе гематологическом автоматическом DH-615»»



Instructions for Hematology Calibrator

Product Name
Hematology Calibrator

lyzers produced by Dymind: DM79, DM78, DM72, DM71, DM79X, DM78X, DM77X, DM75X, DM72X, DM71X, DX450, DX480, DX480, DH-600, DH-602, DH-605, DH-610, DH-612 and DH-615.

Packaging


Model	Single specification	Quantity of each kit (pc)		
DM-CAL-5E	3mL	×1	×2	×3

Test Method


1. Take the calibrator out of the refrigerator and place it at room temperature (+15°C~30°C) for 15 min.




«Калибратор гематологический DM-CAL-5E для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на «Анализаторе гематологическом автоматическом DH-615»»

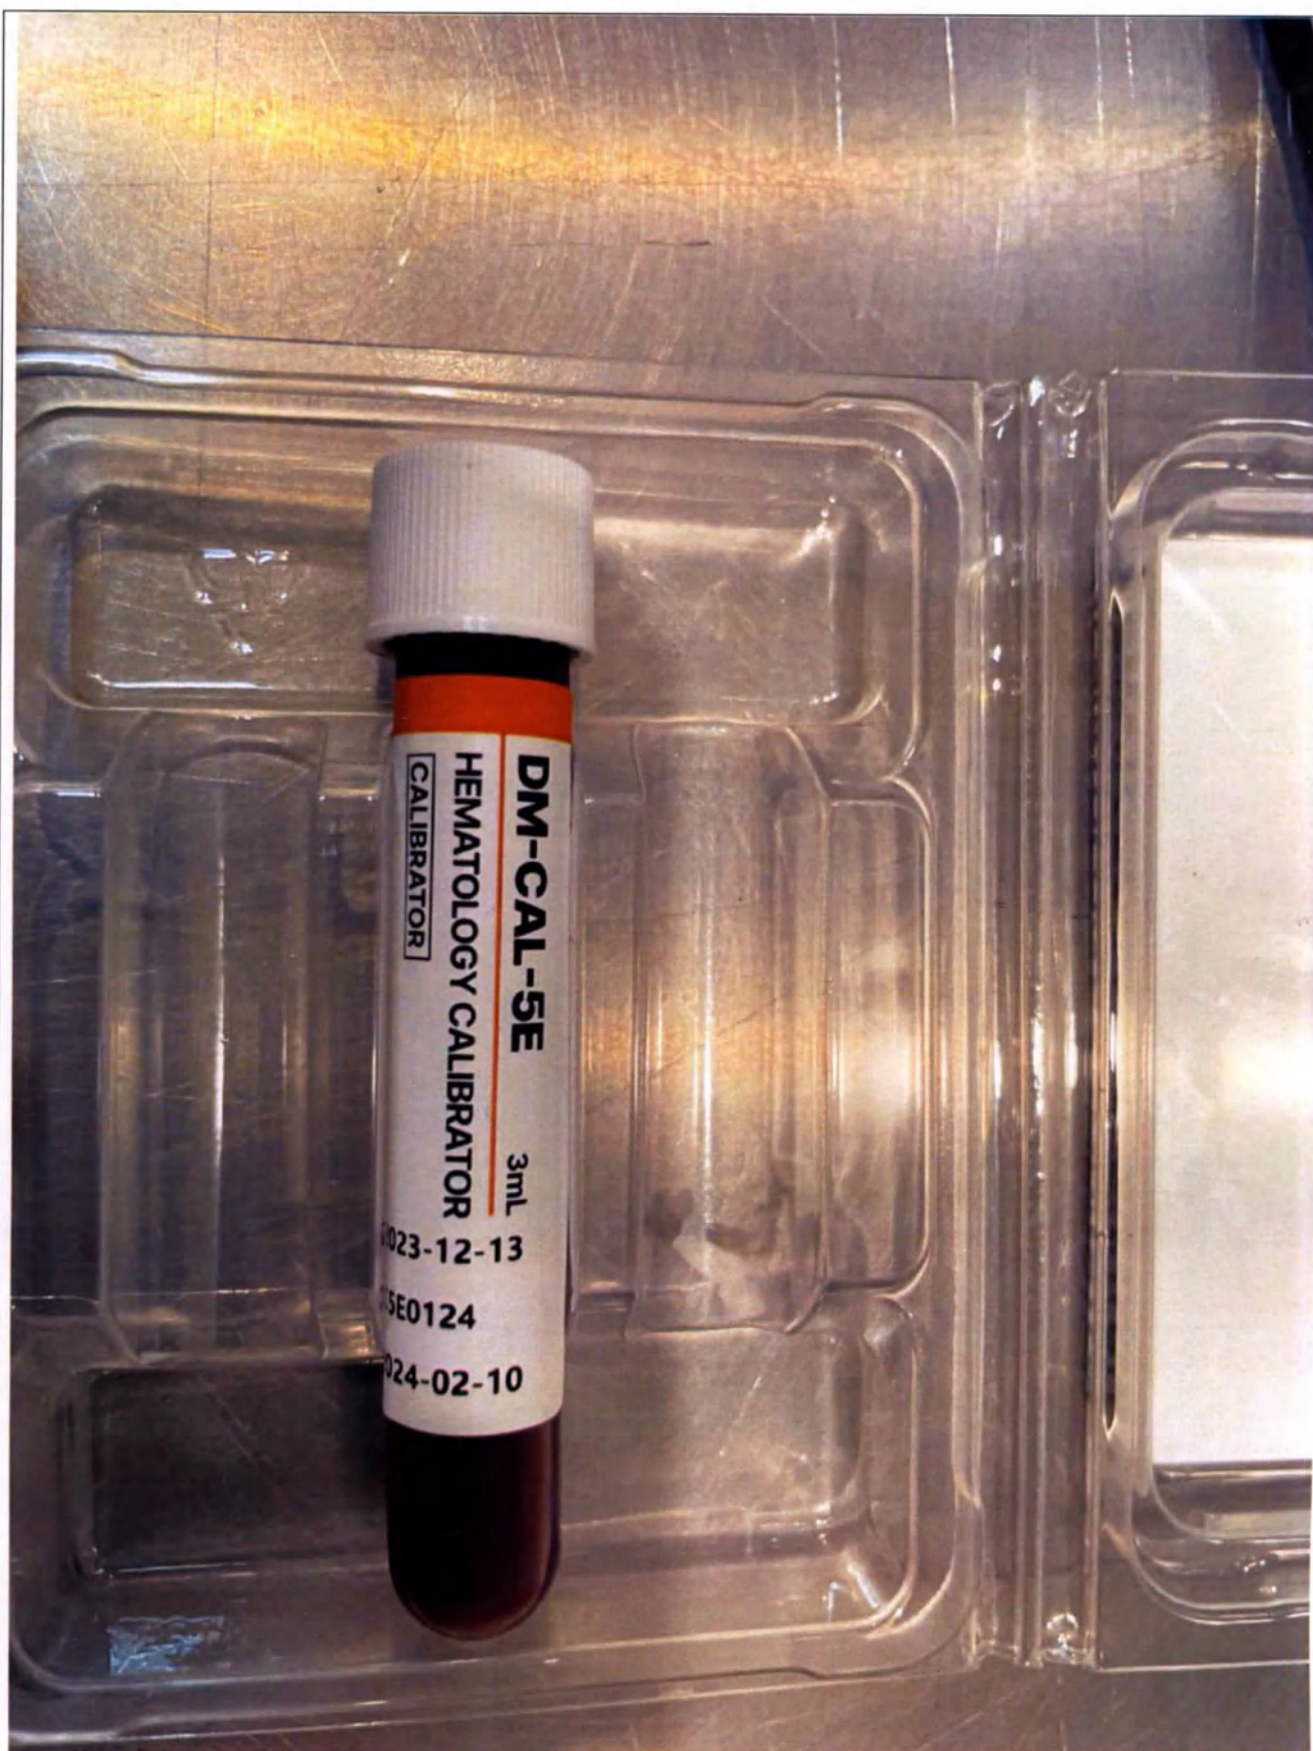

«Калибратор гематологический DM-CAL-5E для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на «Анализаторе гематологическом автоматическом DH-615»». Компонент медицинского изделия: 1. Калибратор гематологический DM-CAL-5E (1 флакон по 3 мл) – 1 шт.

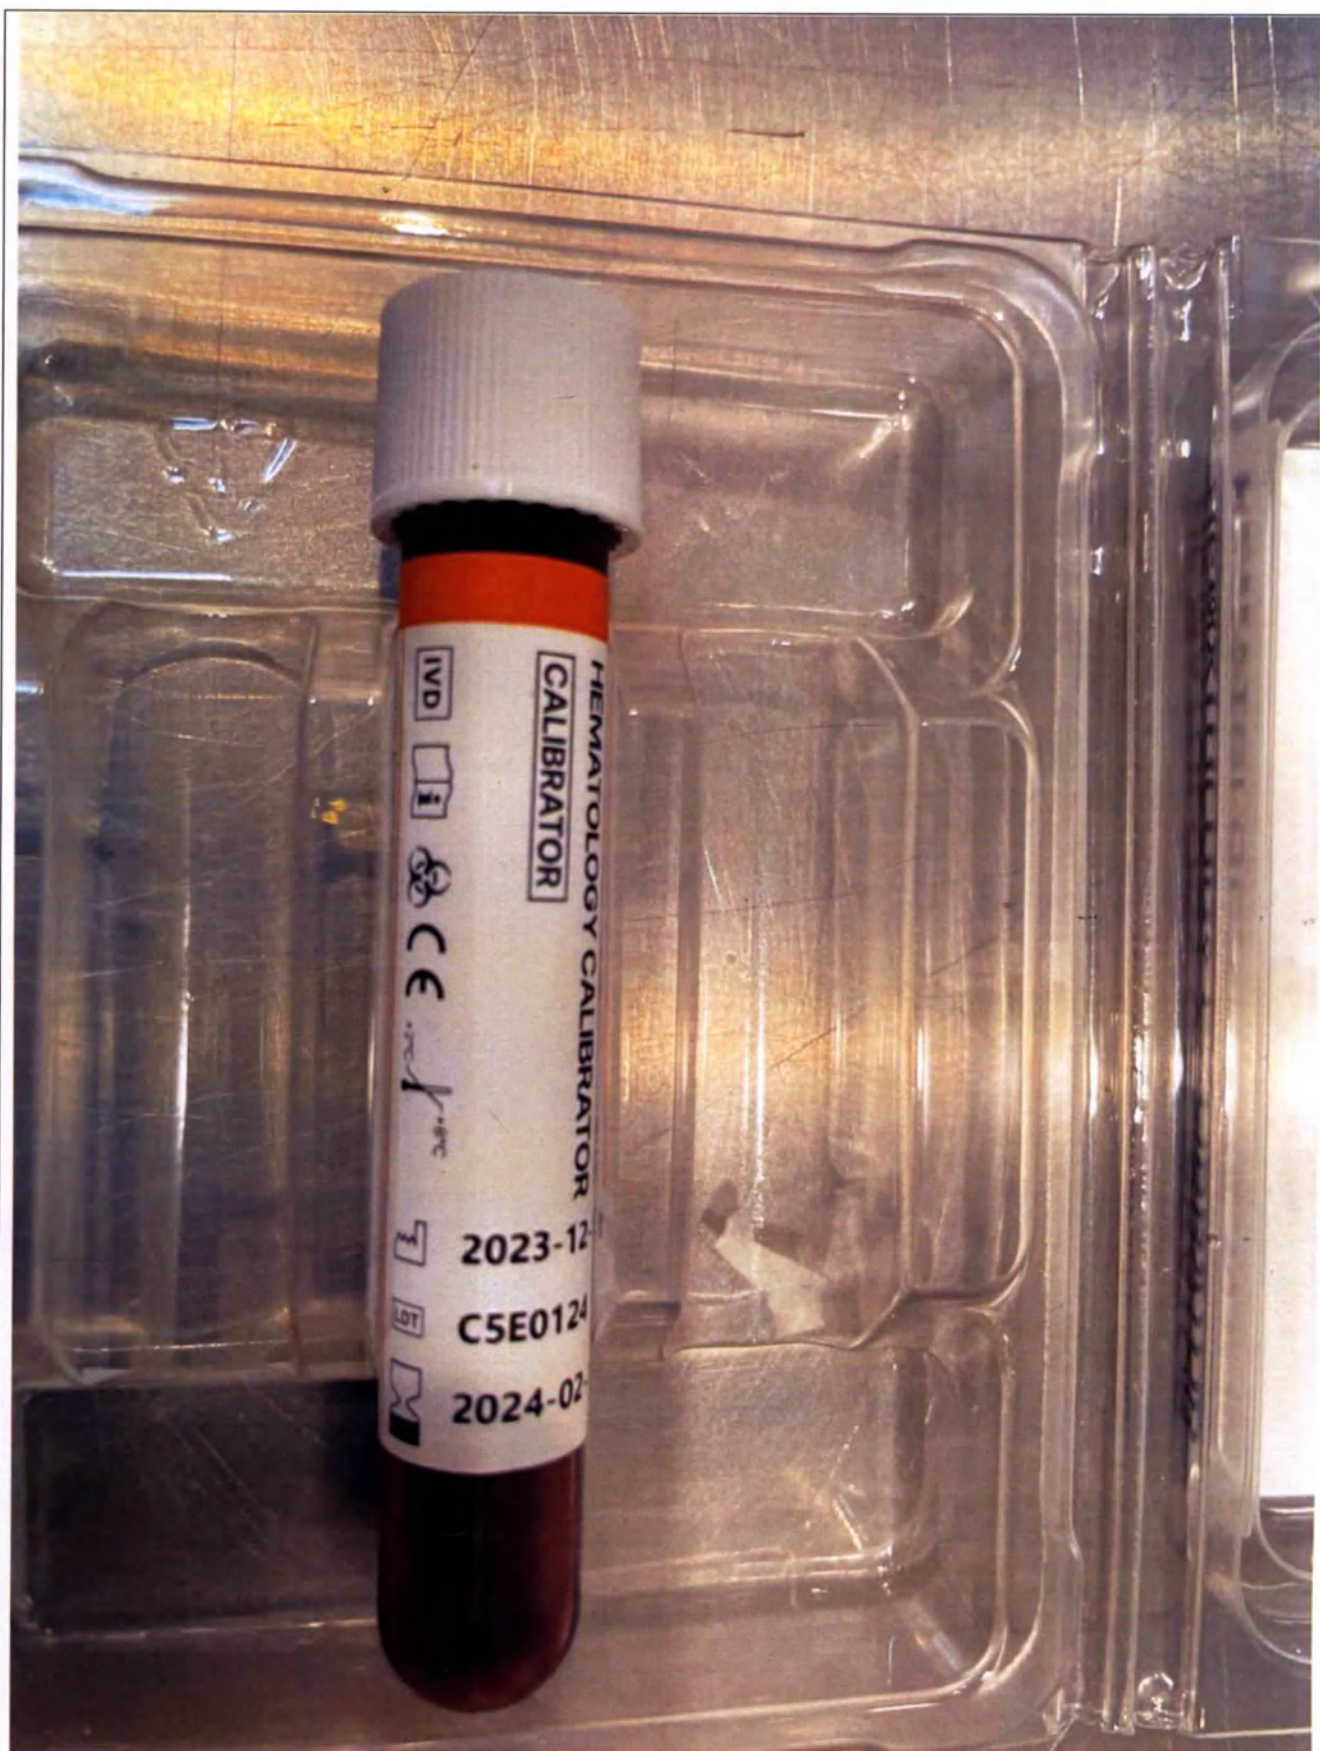

«Калибратор гематологический DM-CAL-5E для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на «Анализаторе гематологическом автоматическом DH-615»». Компонент медицинского изделия: 1. Калибратор гематологический DM-CAL-5E (1 флакон по 3 мл) – 1 шт.

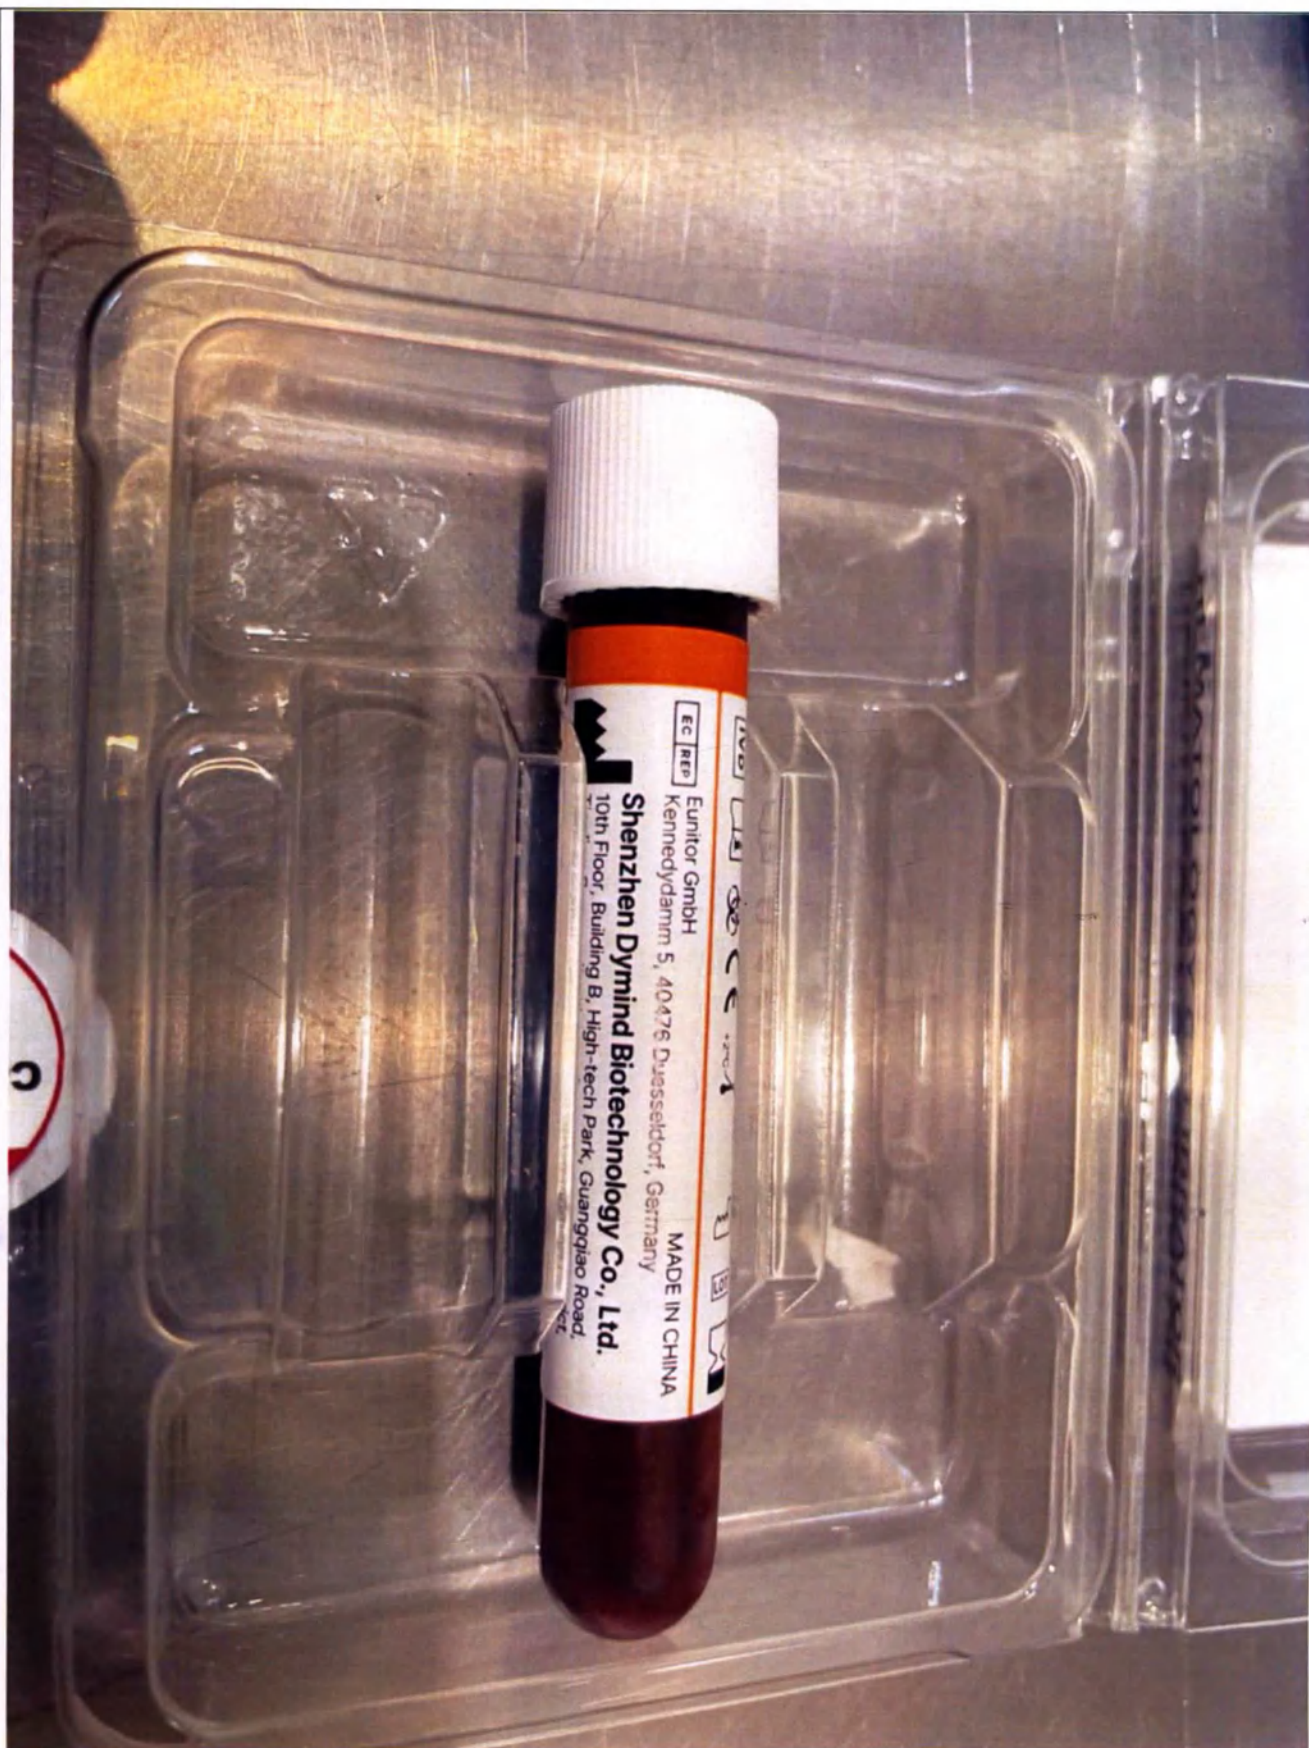

«Калибратор гематологический DM-CAL-5E для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на «Анализаторе гематологическом автоматическом DH-615»». Компонент медицинского изделия: 1. Калибратор гематологический DM-CAL-5E (1 флакон по 3 мл) – 1 шт.



«Калибратор гематологический DM-CAL-5E для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на «Анализаторе гематологическом автоматическом DH-615»». Компонент медицинского изделия: 1. Калибратор гематологический DM-CAL-5E (1 флакон по 3 мл) – 1 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия
для диагностики *in vitro*

«Калибратор гематологический DM-CAL-5E для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на «Анализаторе гематологическом автоматическом DH-615»»,
производства

«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.), КНР

«Калибратор гематологический DM-CAL-5E для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на «Анализаторе гематологическом автоматическом DH-615»». Компонент медицинского изделия: 2. Инструкция по применению – 1 шт.

ПРОШНО
ПРОНУМЕРОВАНО
СК. ЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ

8/восьмь,матов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Позднев П.В.

