

Место производства (2)

Организация-производитель
Место производства (1)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ДНК-Технология ТС»

Генеральный директор
ООО «НПО ДНК-Технология»

 С.П. Левичев

 В.Ю. Дмитровский

« 19 » сентября 2017г.


« 19 » сентября 2017г.

**ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ *IN VITRO* ДИАГНОСТИКИ**

**Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис
(*Mycoplasma hominis*) методом полимеразной цепной реакции
(ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008**


2017 г.

Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (*Mycoplasma hominis*) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008
ПЦР с детекцией в режиме реального времени, фасовка S, стрипы

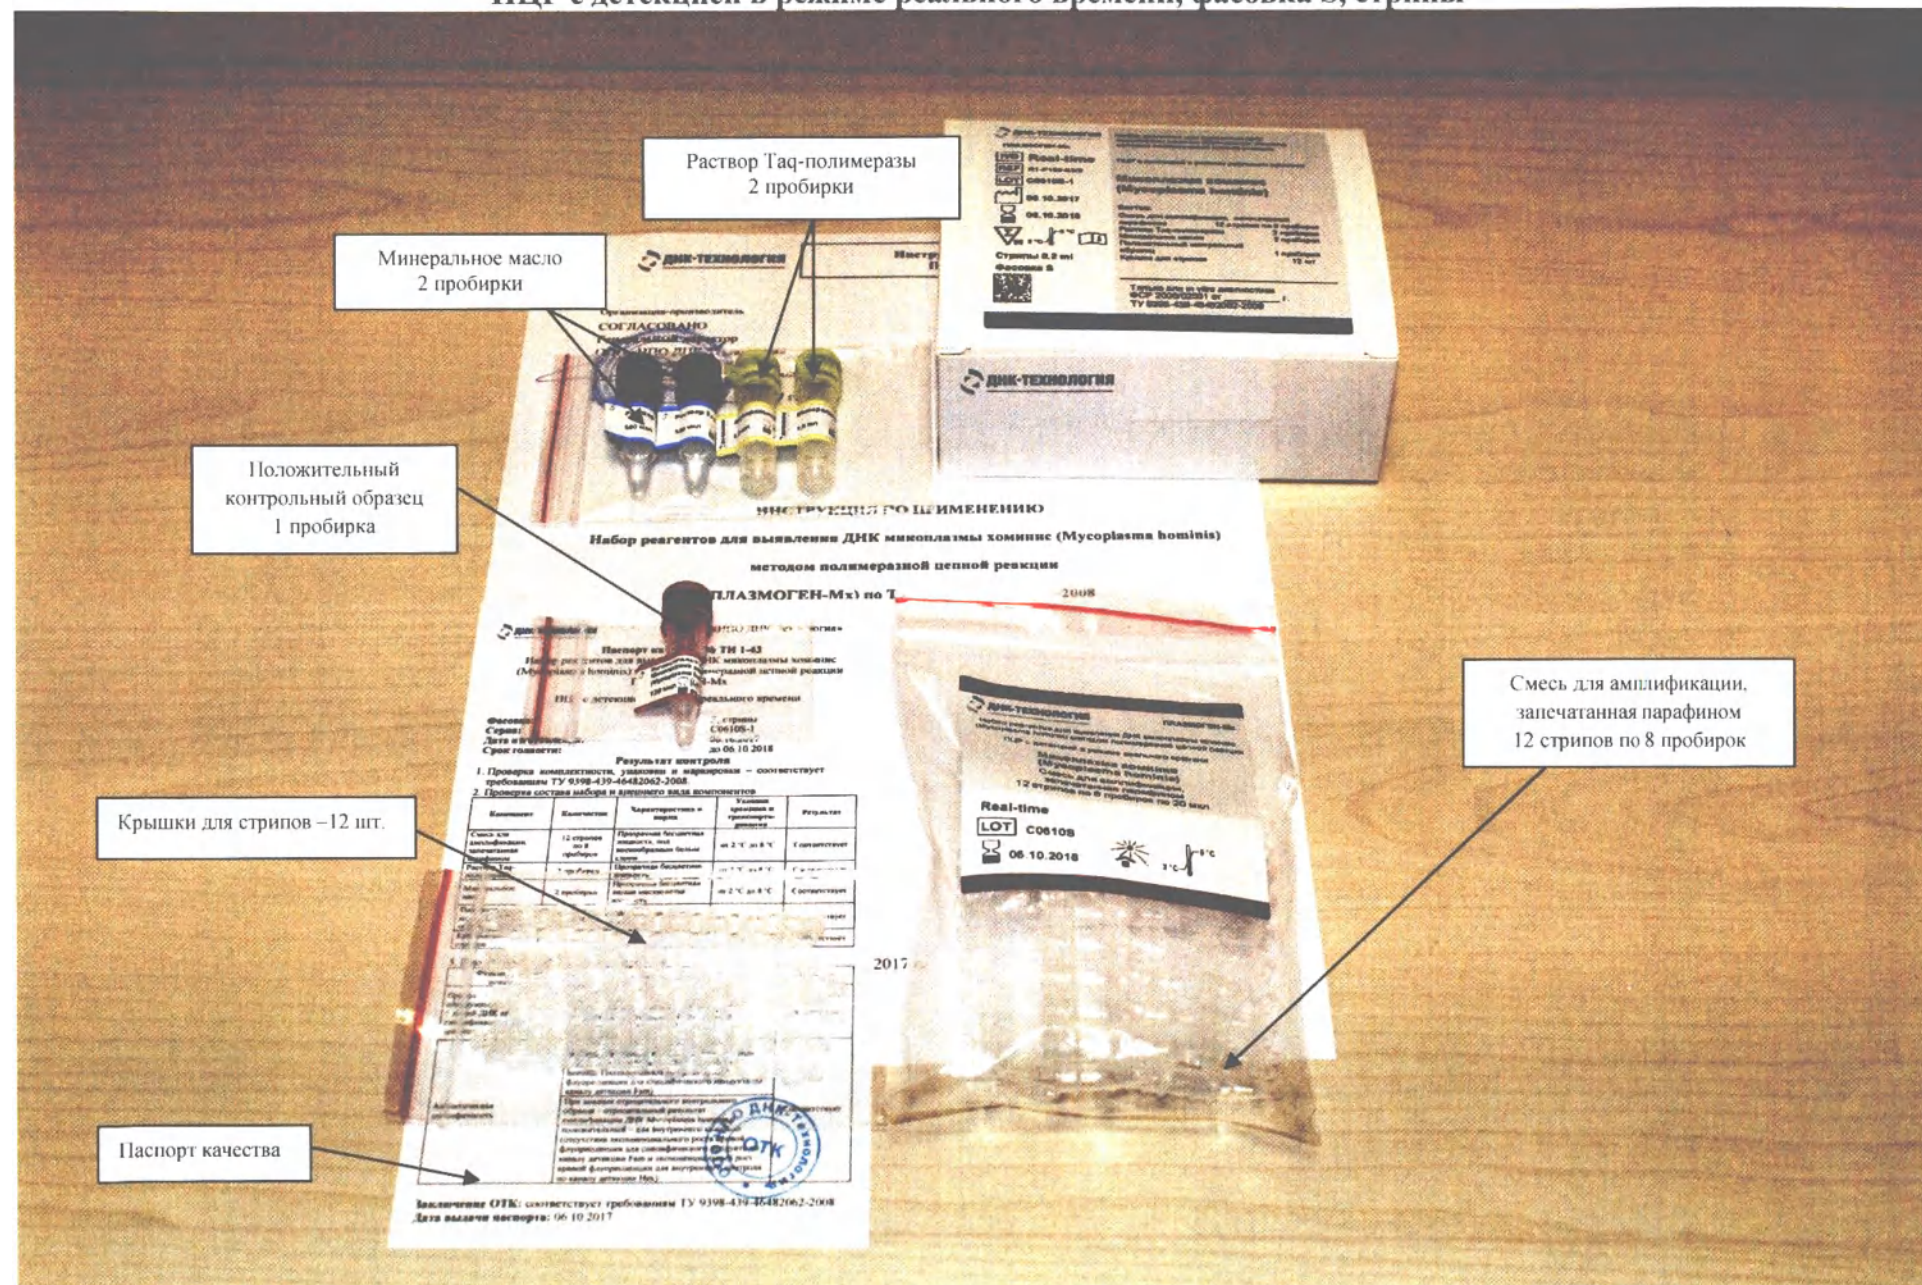


Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (*Mycoplasma hominis*) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008

ПЦР с детекцией в режиме реального времени, фасовка S, пробирки

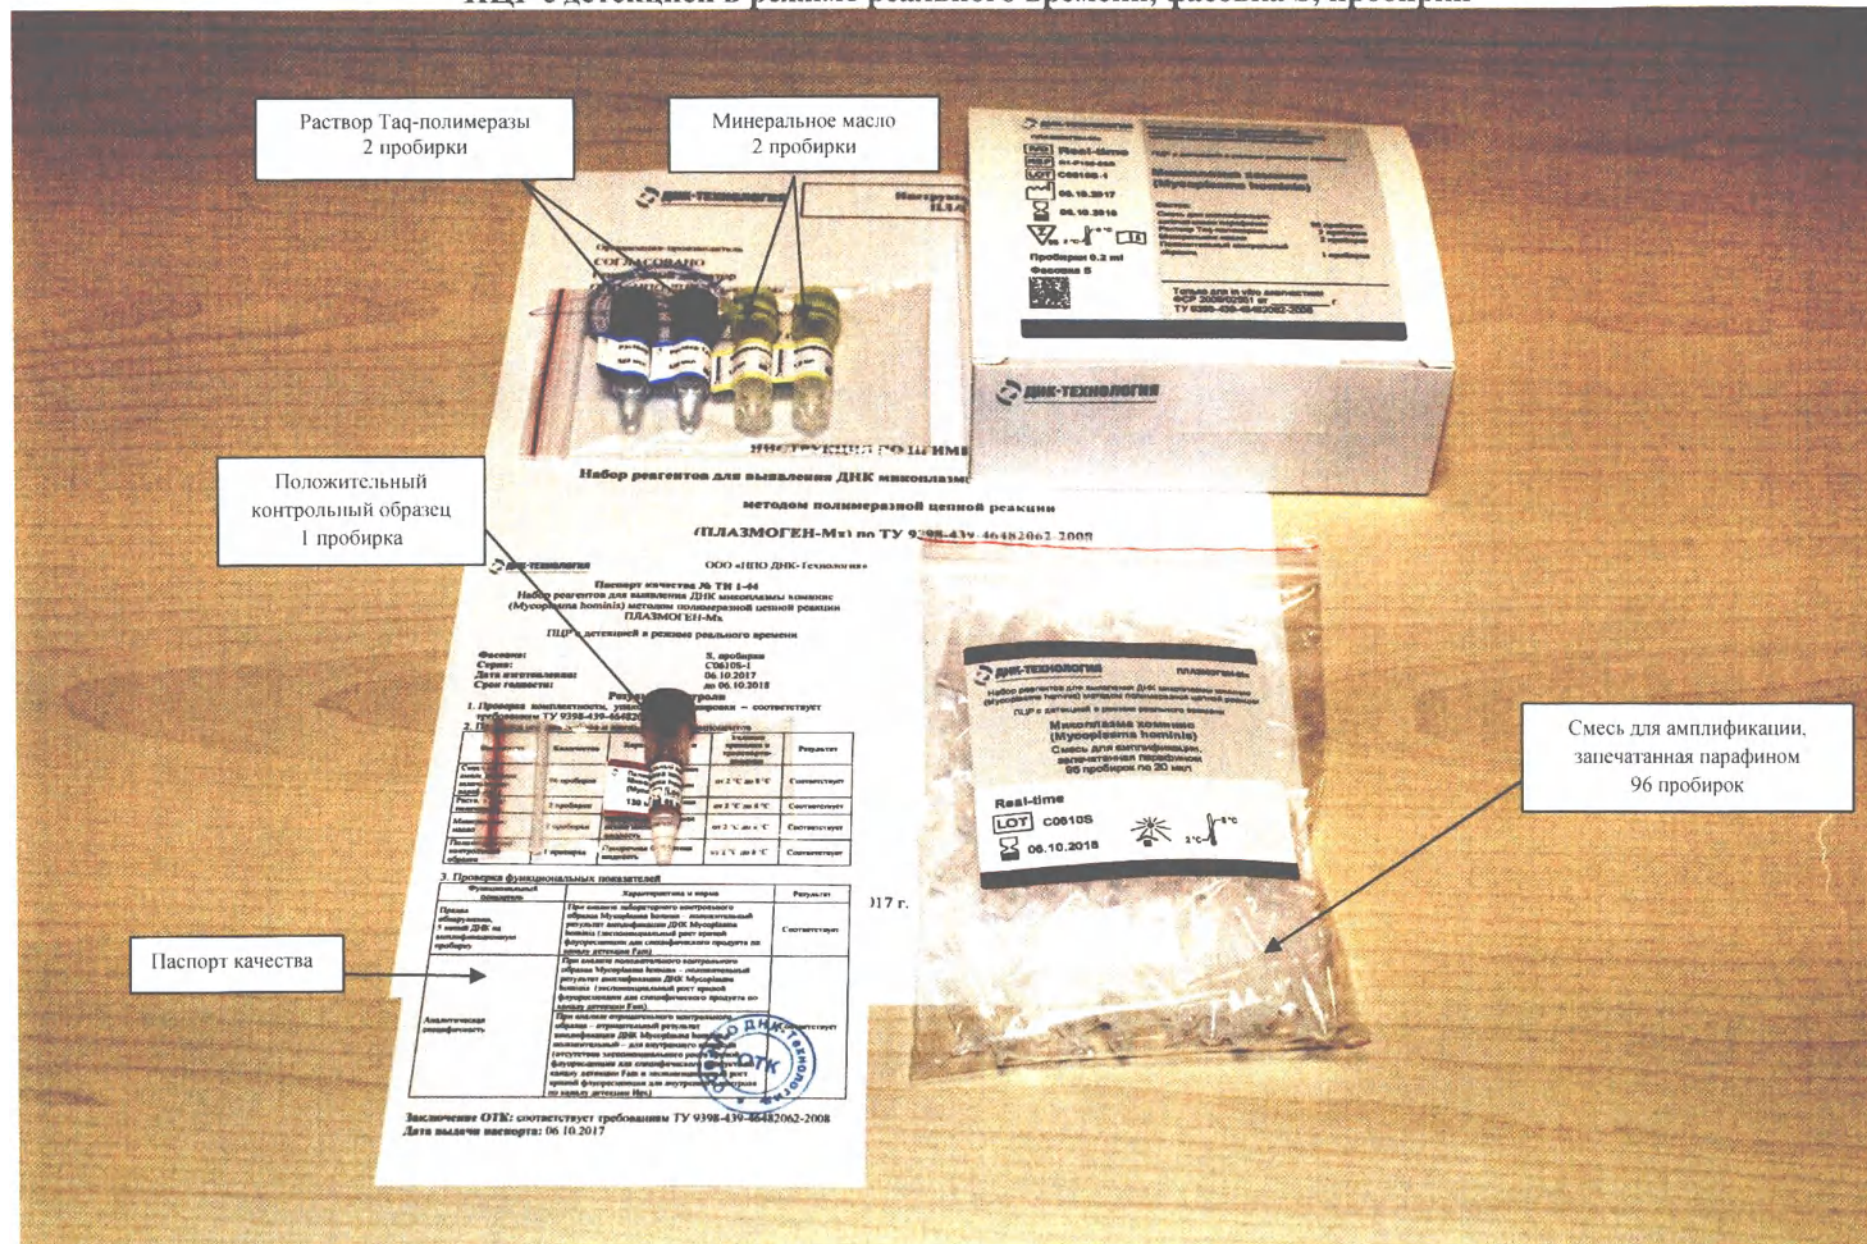


Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (*Mycoplasma hominis*) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008

ПЦР с детекцией в режиме реального времени, фасовка W

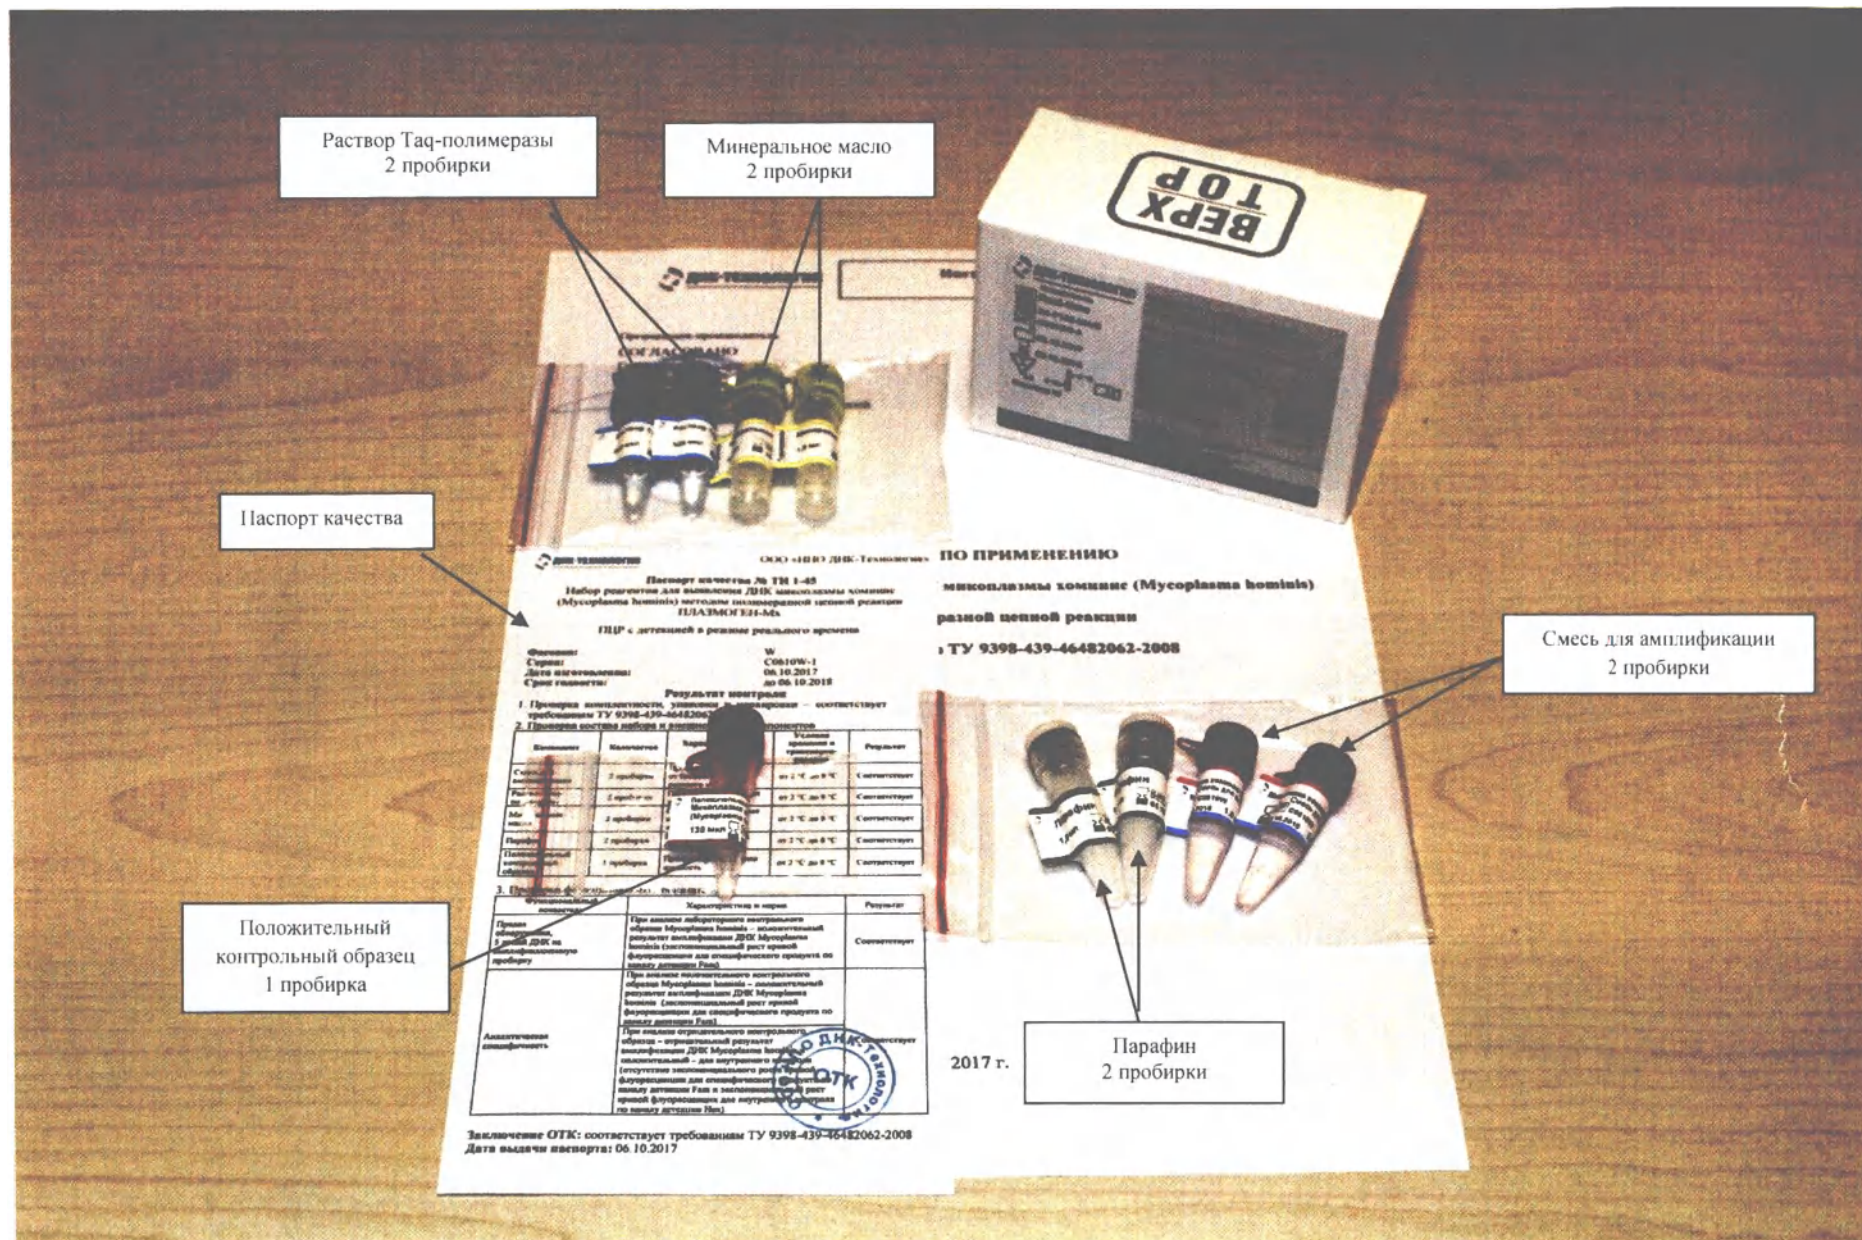


Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (*Mycoplasma hominis*) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008

ПЦР с детекцией в режиме реального времени, фасовка U

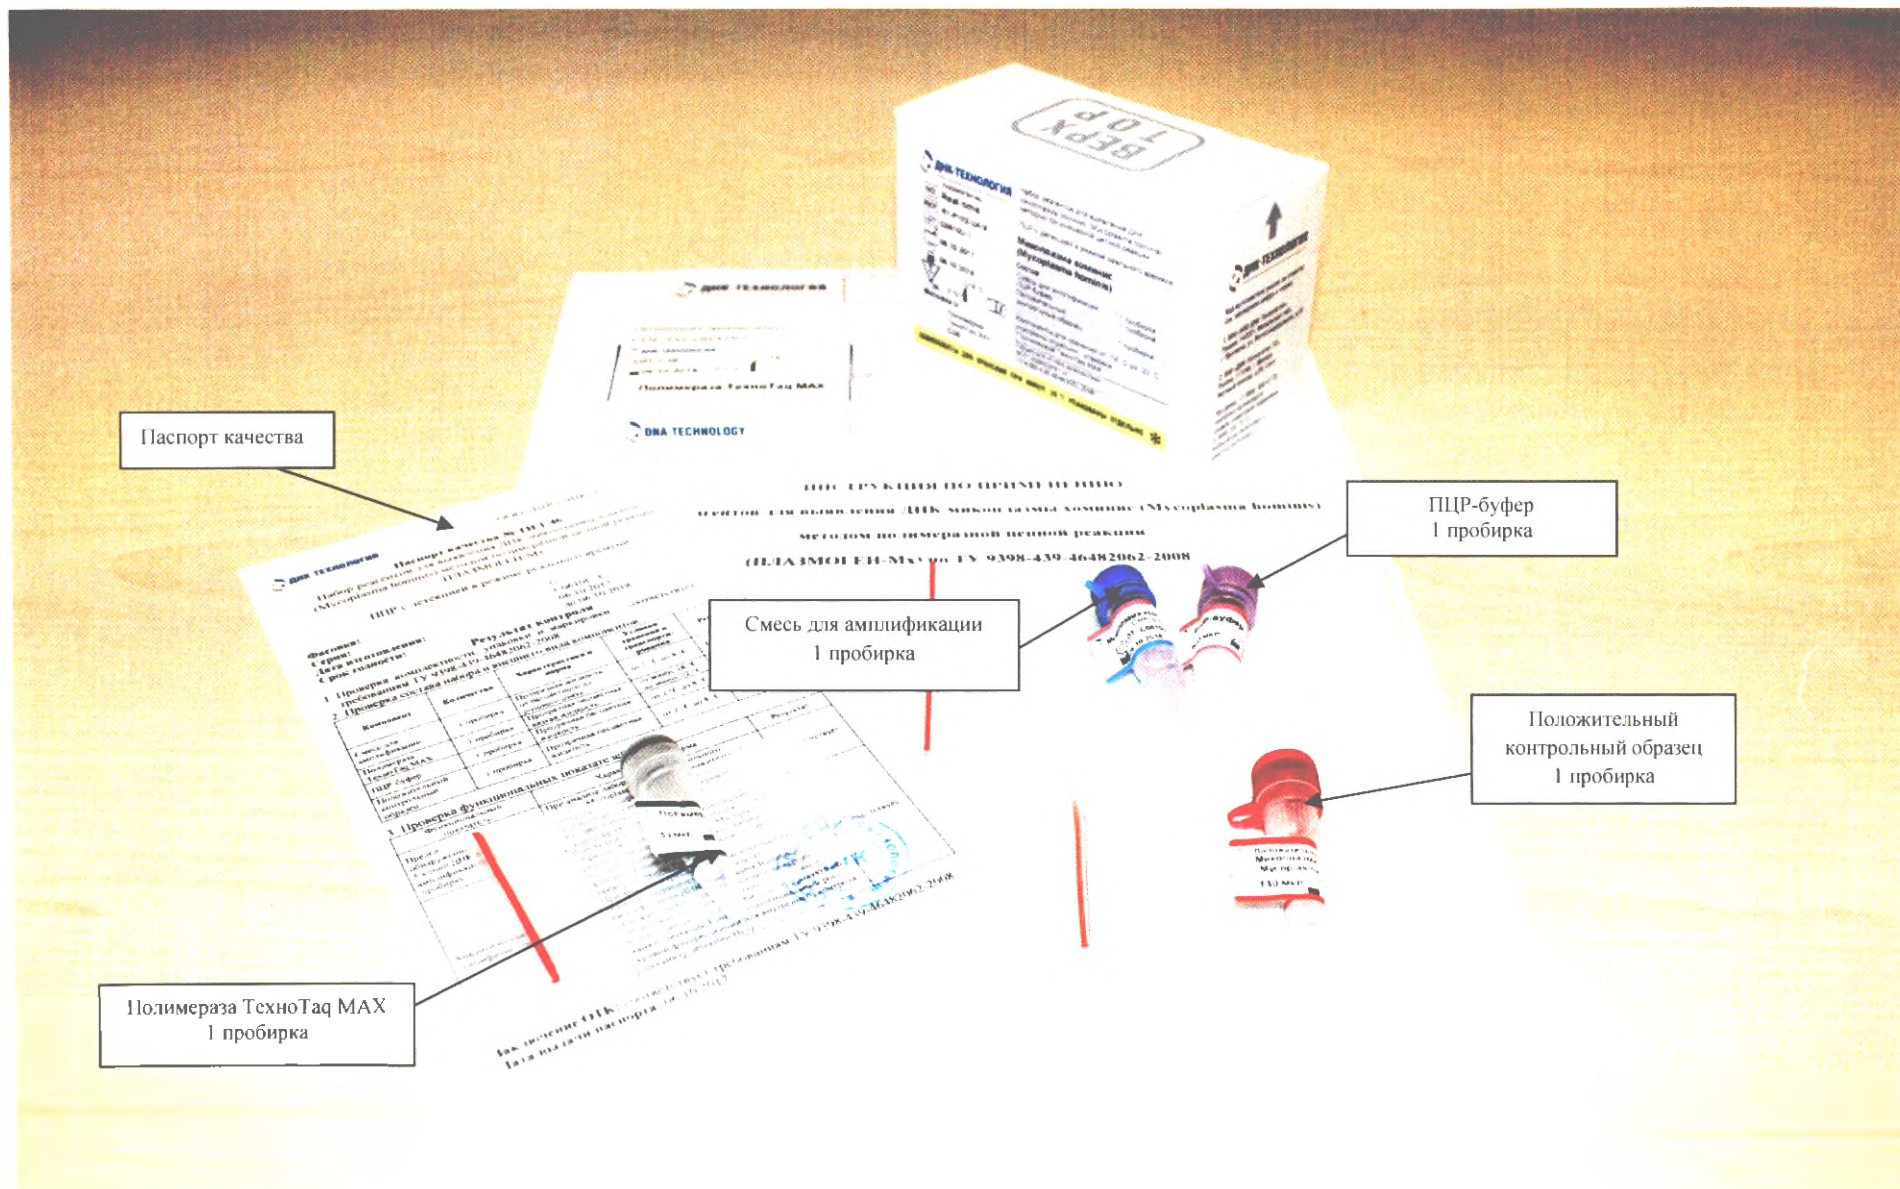


Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (*Mycoplasma hominis*) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008

ПЦР с флуоресцентной детекцией по конечной точке, фасовка S

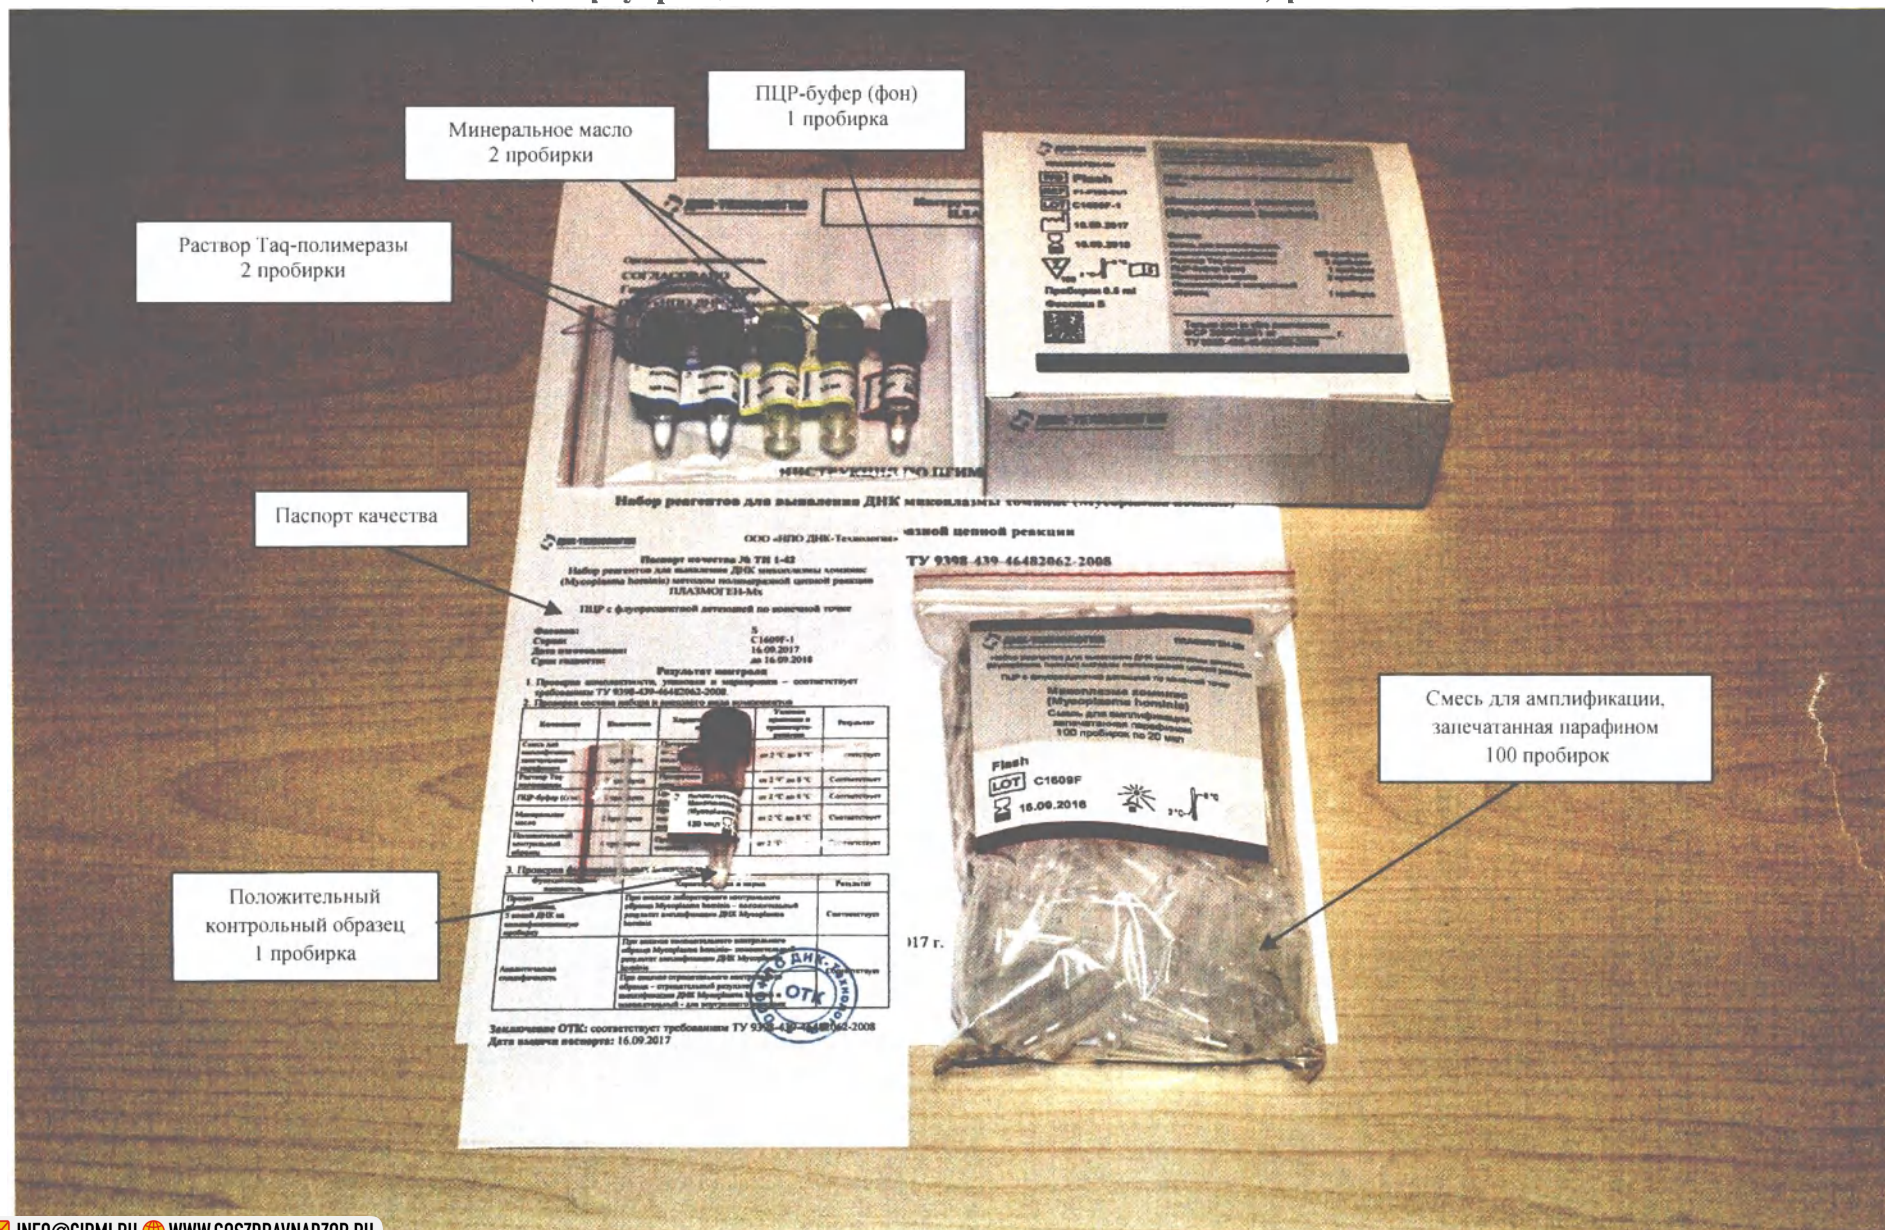

Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (*Mycoplasma hominis*) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008

ПЦР с детекцией методом гель-электрофореза, фасовка S

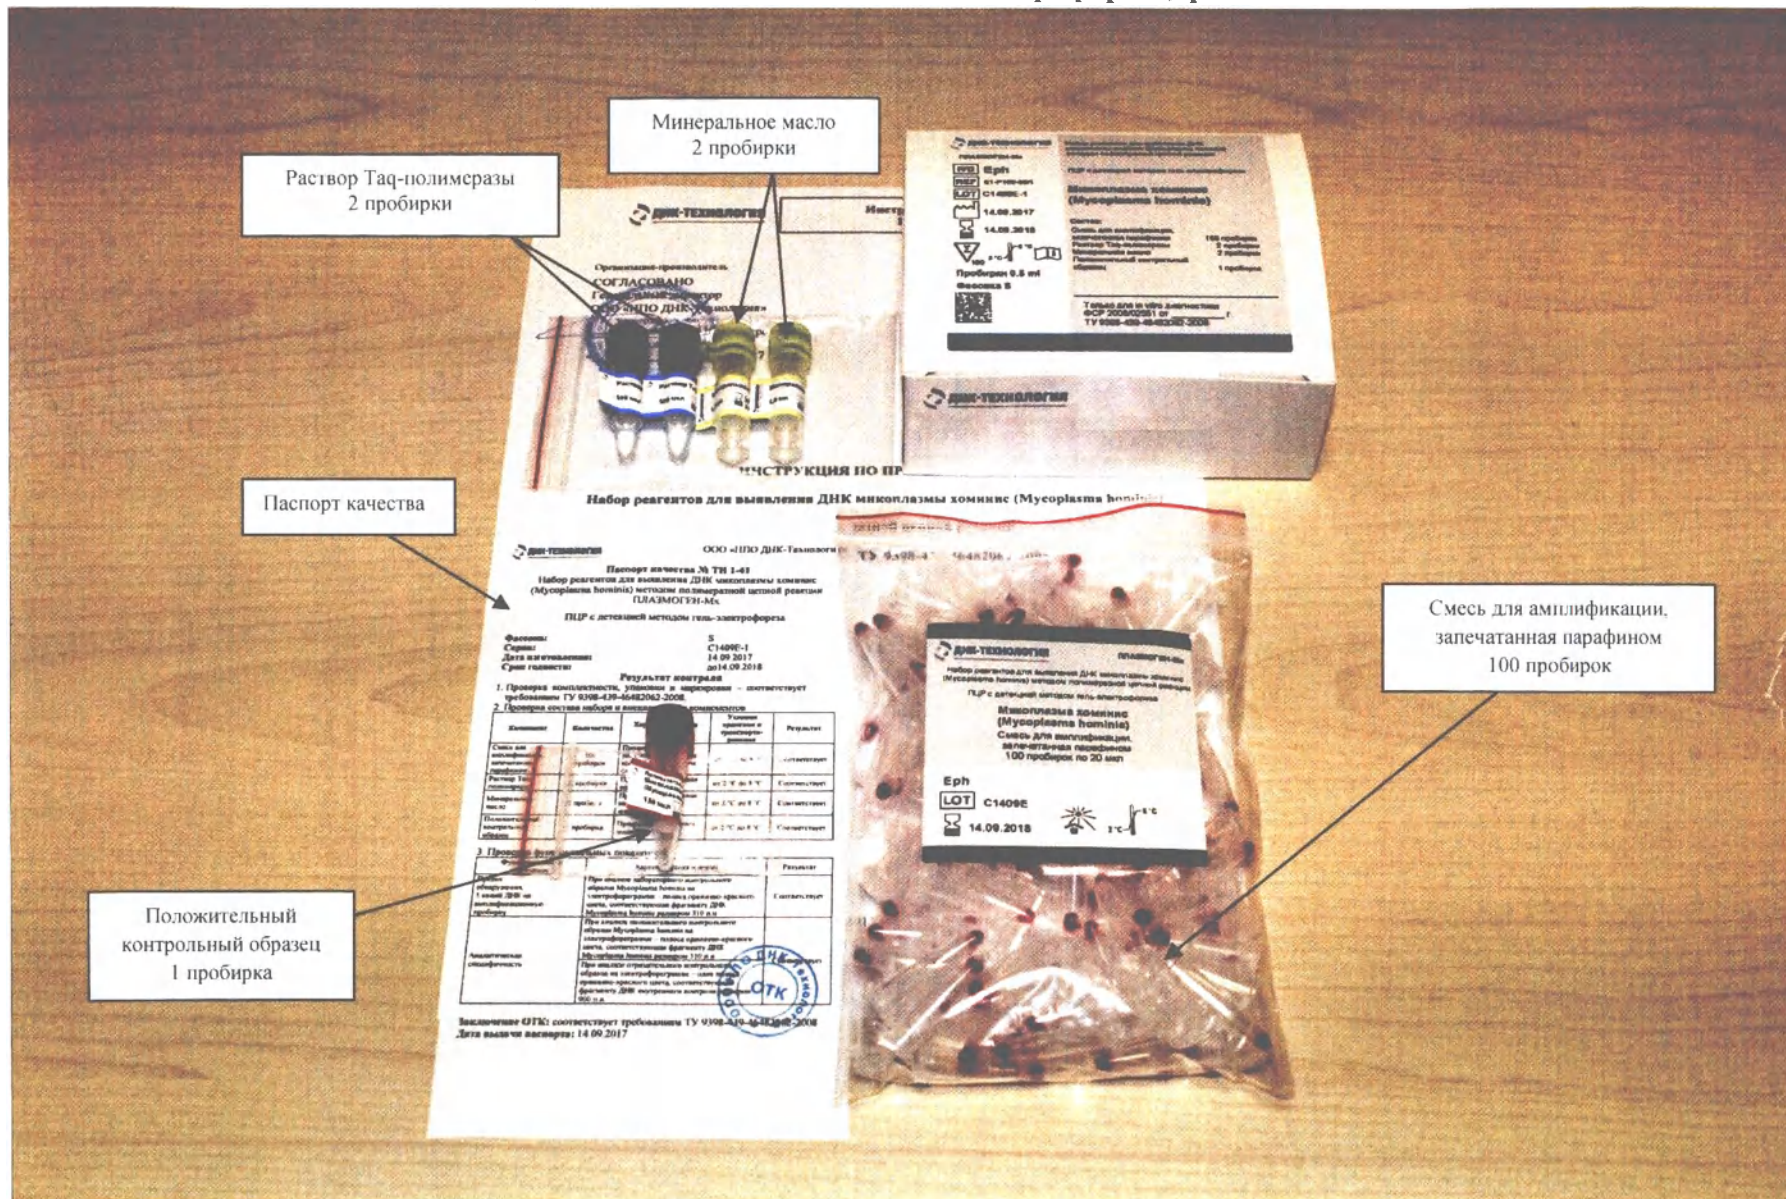

Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (*Mycoplasma hominis*) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008

ПЦР с детекцией методом гель-электрофореза, фасовка S

Информация об изготовителе нанесена типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку.
Код изготовителя указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии)

