



НОВАДИАЛ
Сила, защищающая жизнь

125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе,
д. 16А, стр. 3

+74957287603
info@novadial.ru
www.novadial.ru

УТВЕРЖДАЮ

НЕПОМНЯШАЯ Е.В.

Генеральный директор

ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 75/НД

ООО «Новадиял»

01.08.07.2024

А.Н. Катаев



12 2024 г.

**Фотографические изображения общего
вида медицинского изделия**

**Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции NOVADIAL, модель
5000,**

производства

SWS Hemodialysis Care Co., Ltd., Китай

2024

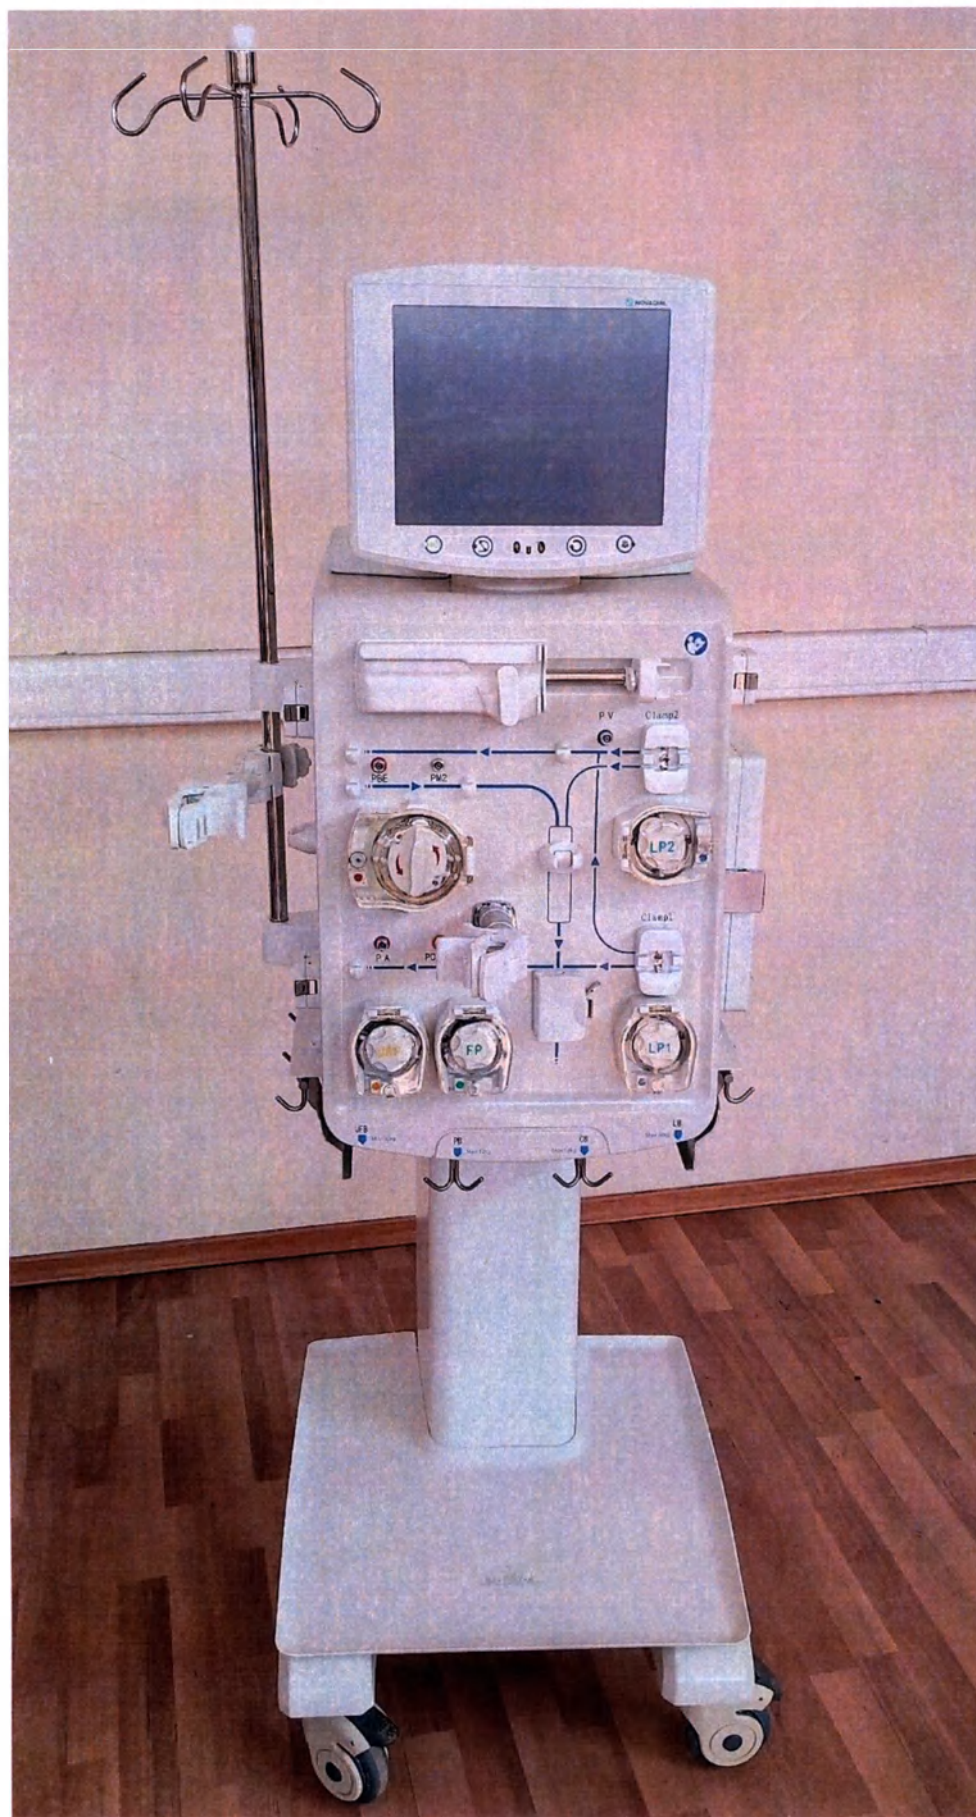


Рисунок 1 – Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции NOVADIAL, модель 5000, общий вид спереди

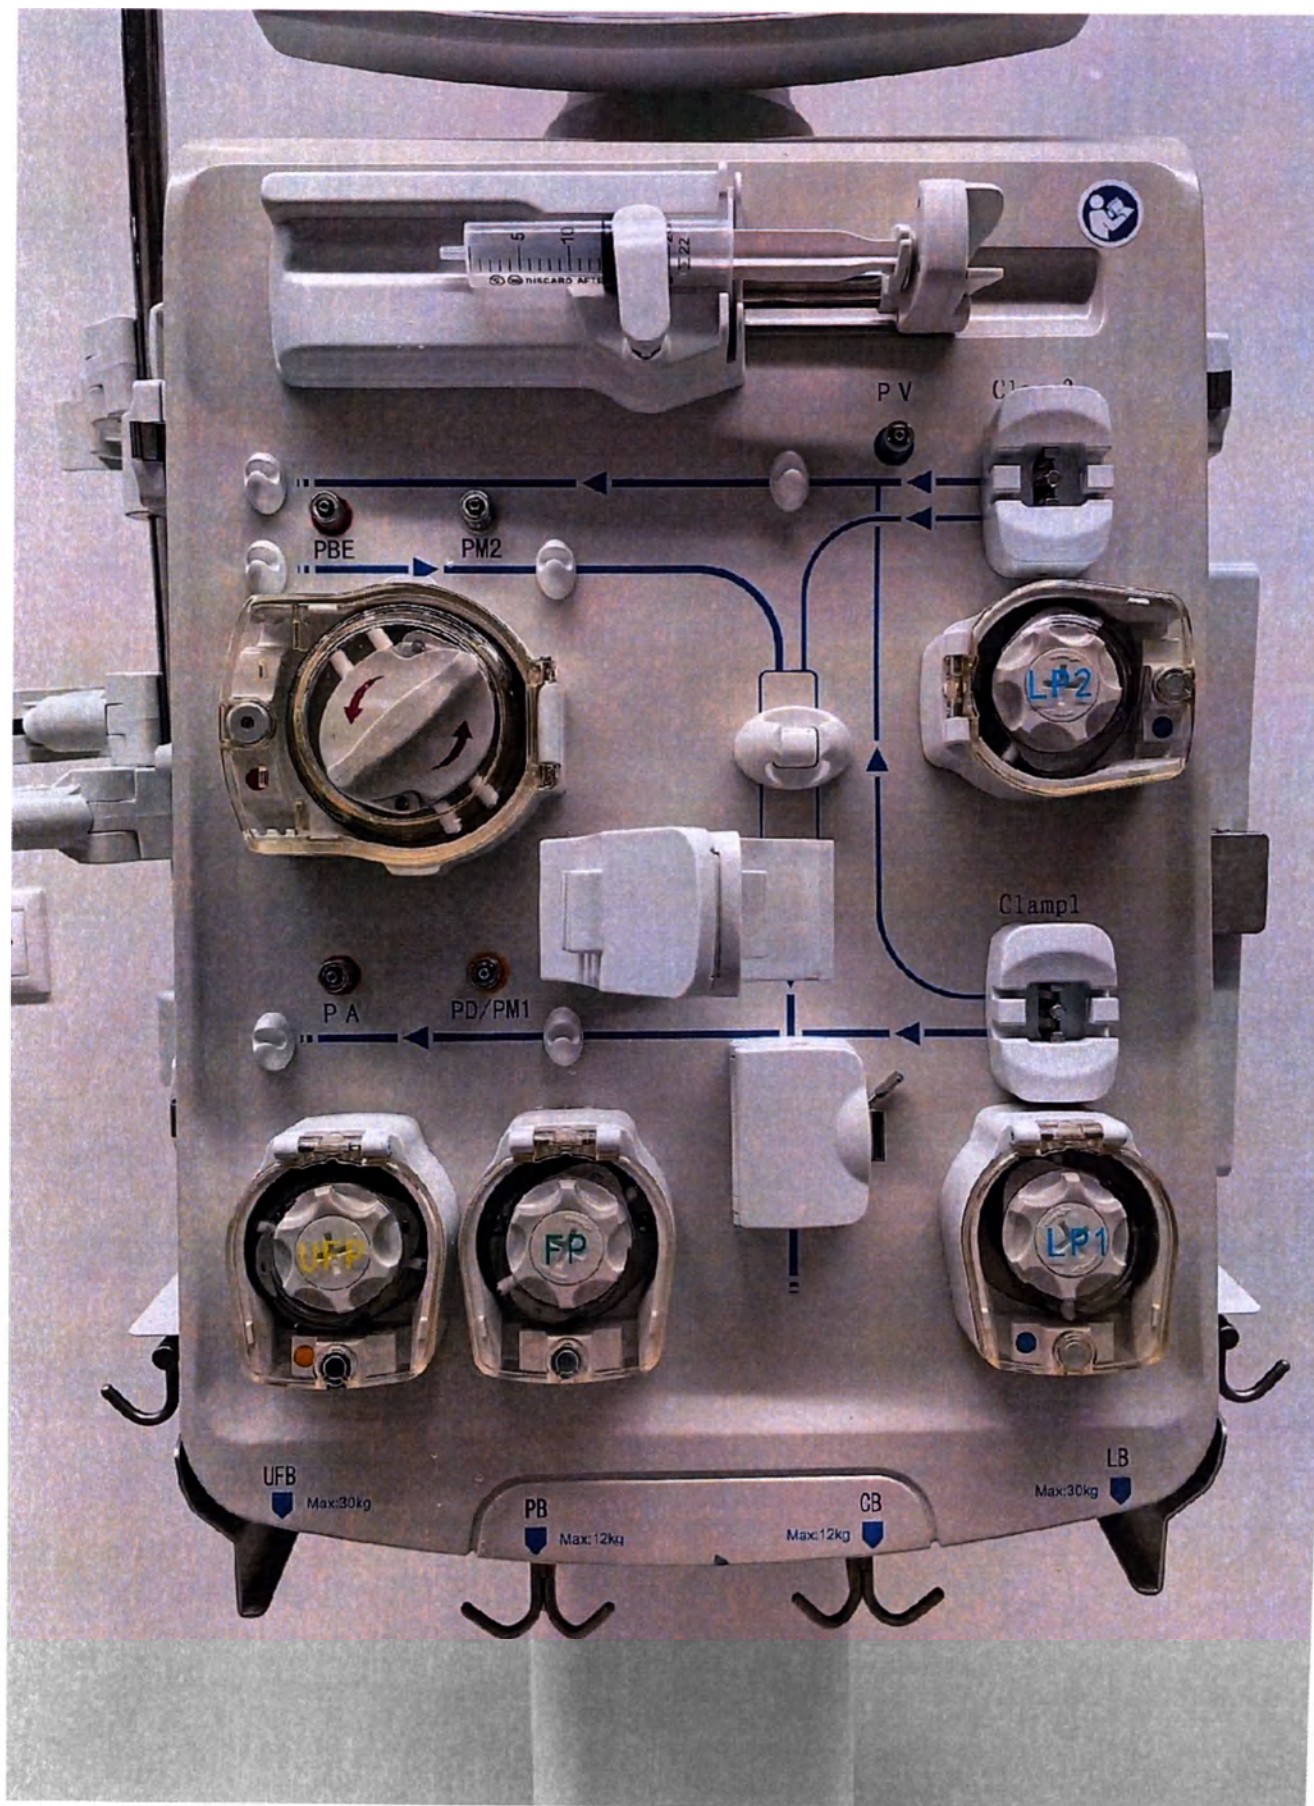


Рисунок 2 – Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции NOVADIAL, модель 5000, (надписи на корпусе аппарата)

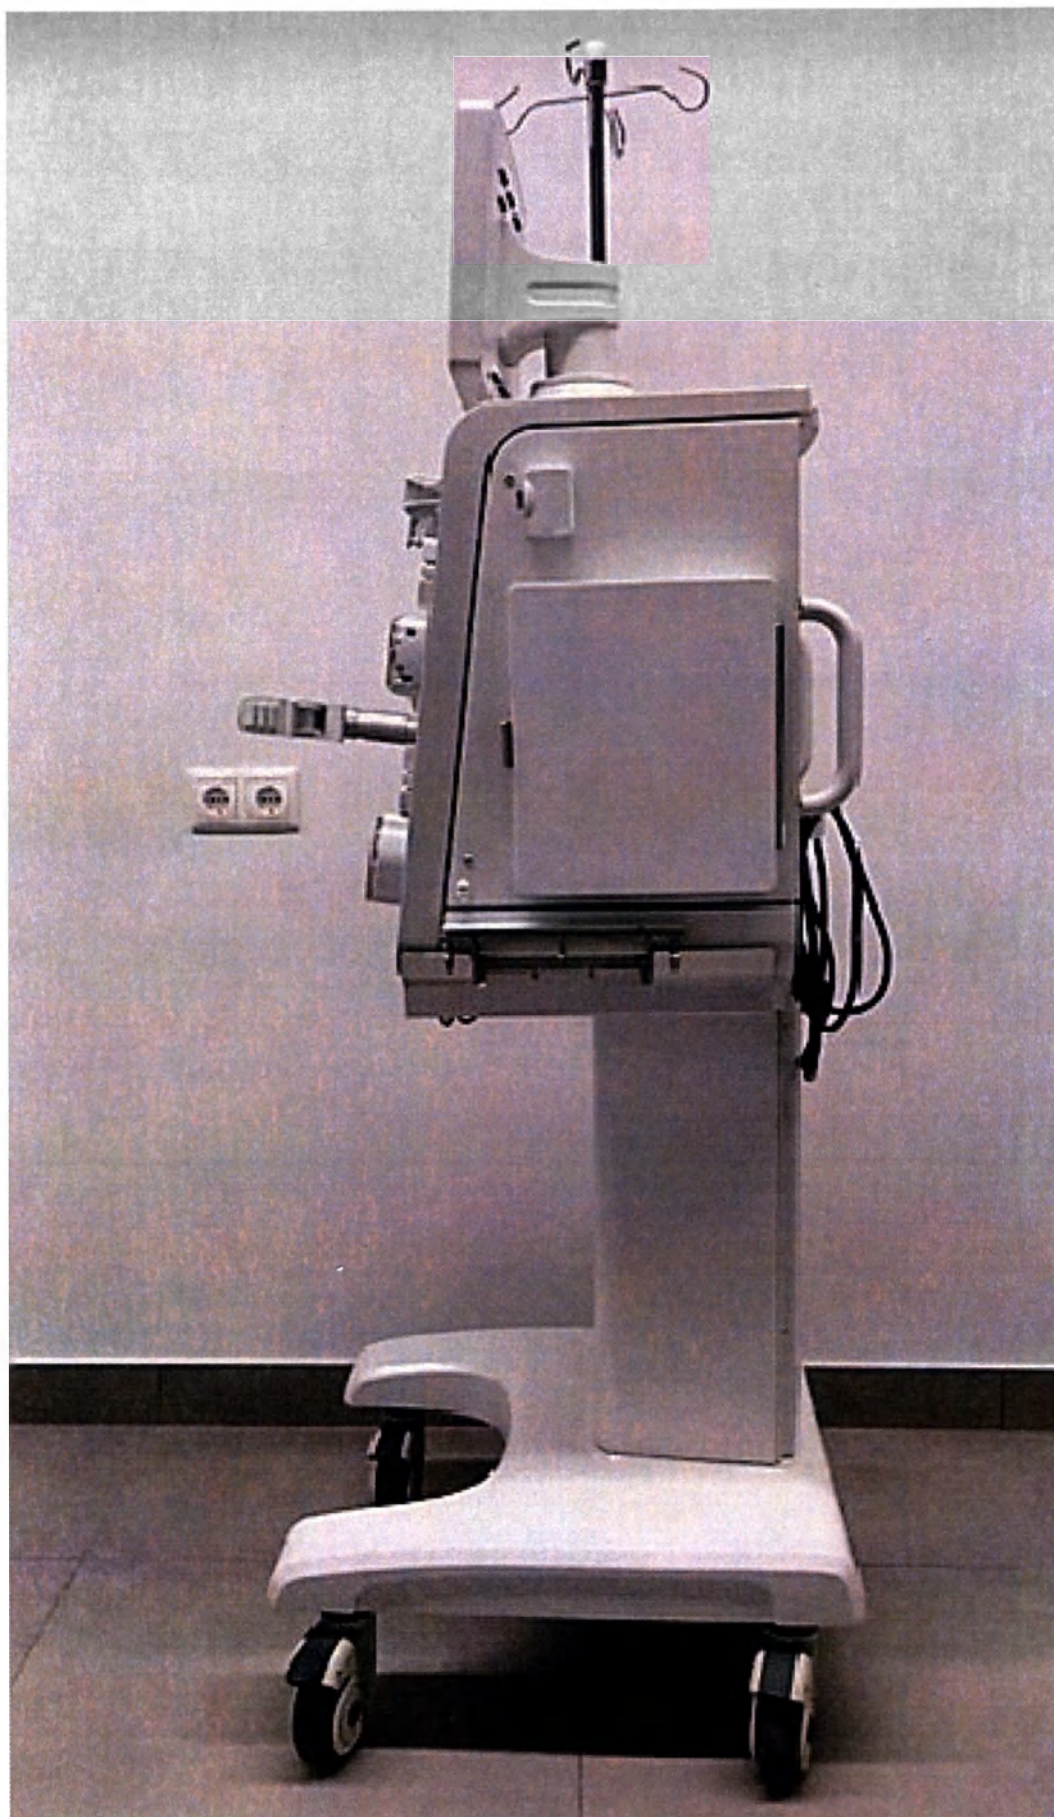


Рисунок 3 - Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции NOVADIAL, модель 5000, общий вид сбоку (справа)

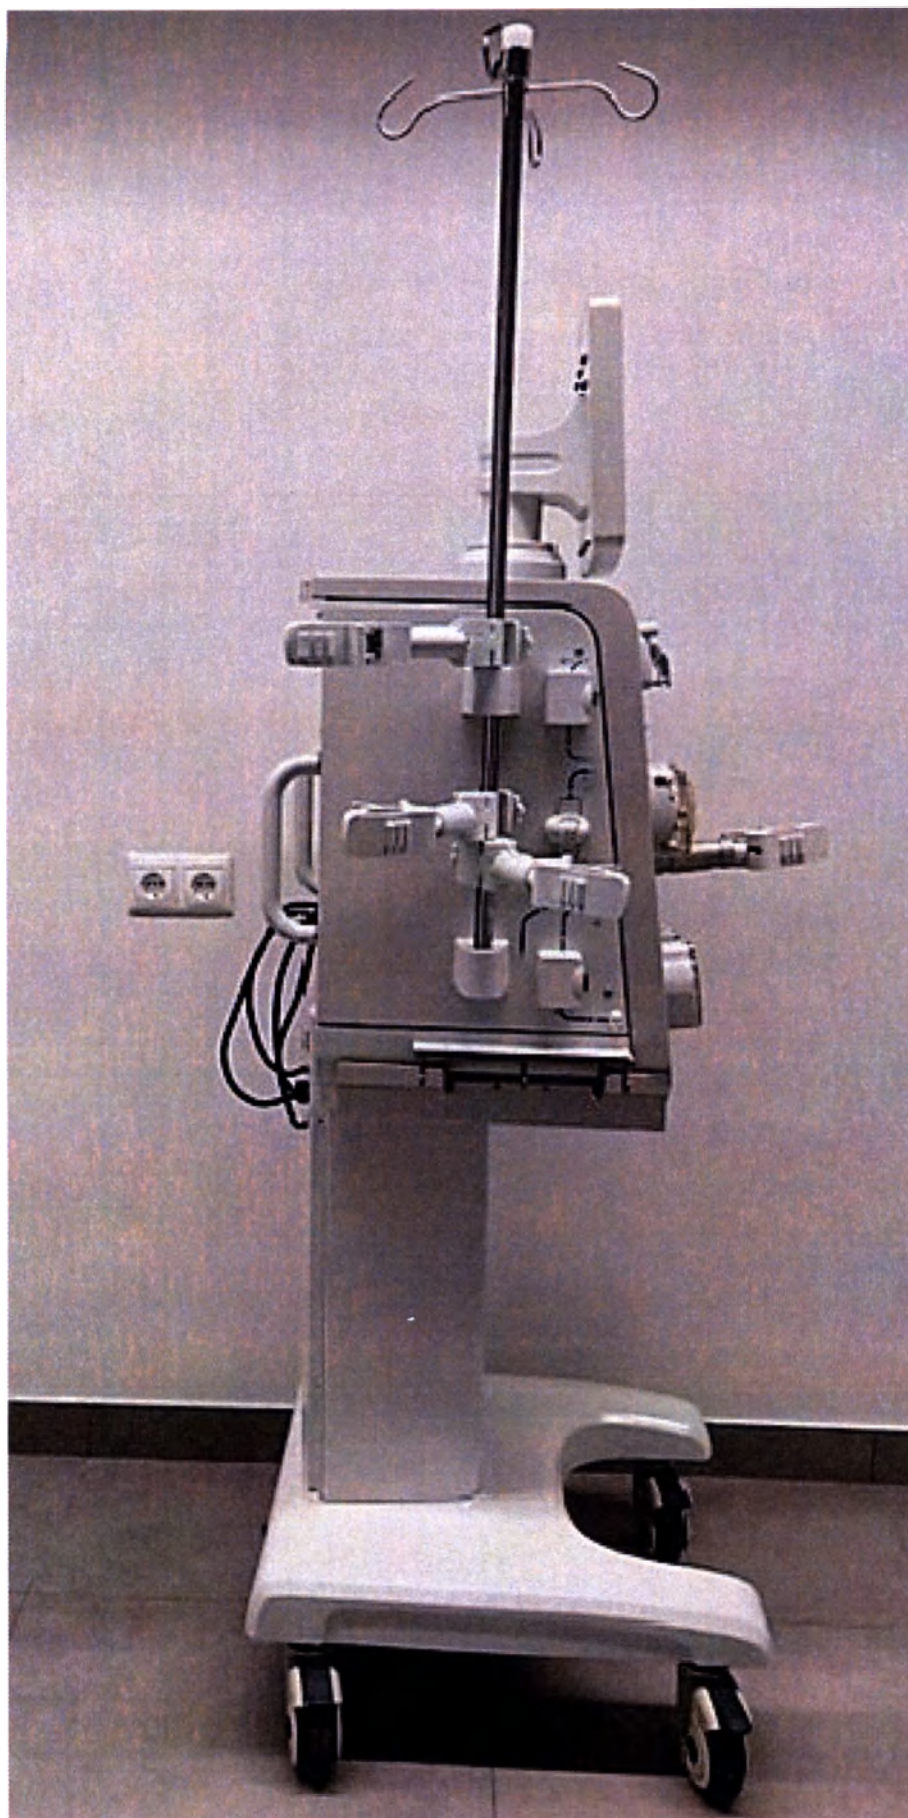


Рисунок 4 - Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции NOVADIAL, модель 5000, общий вид сбоку (слева)


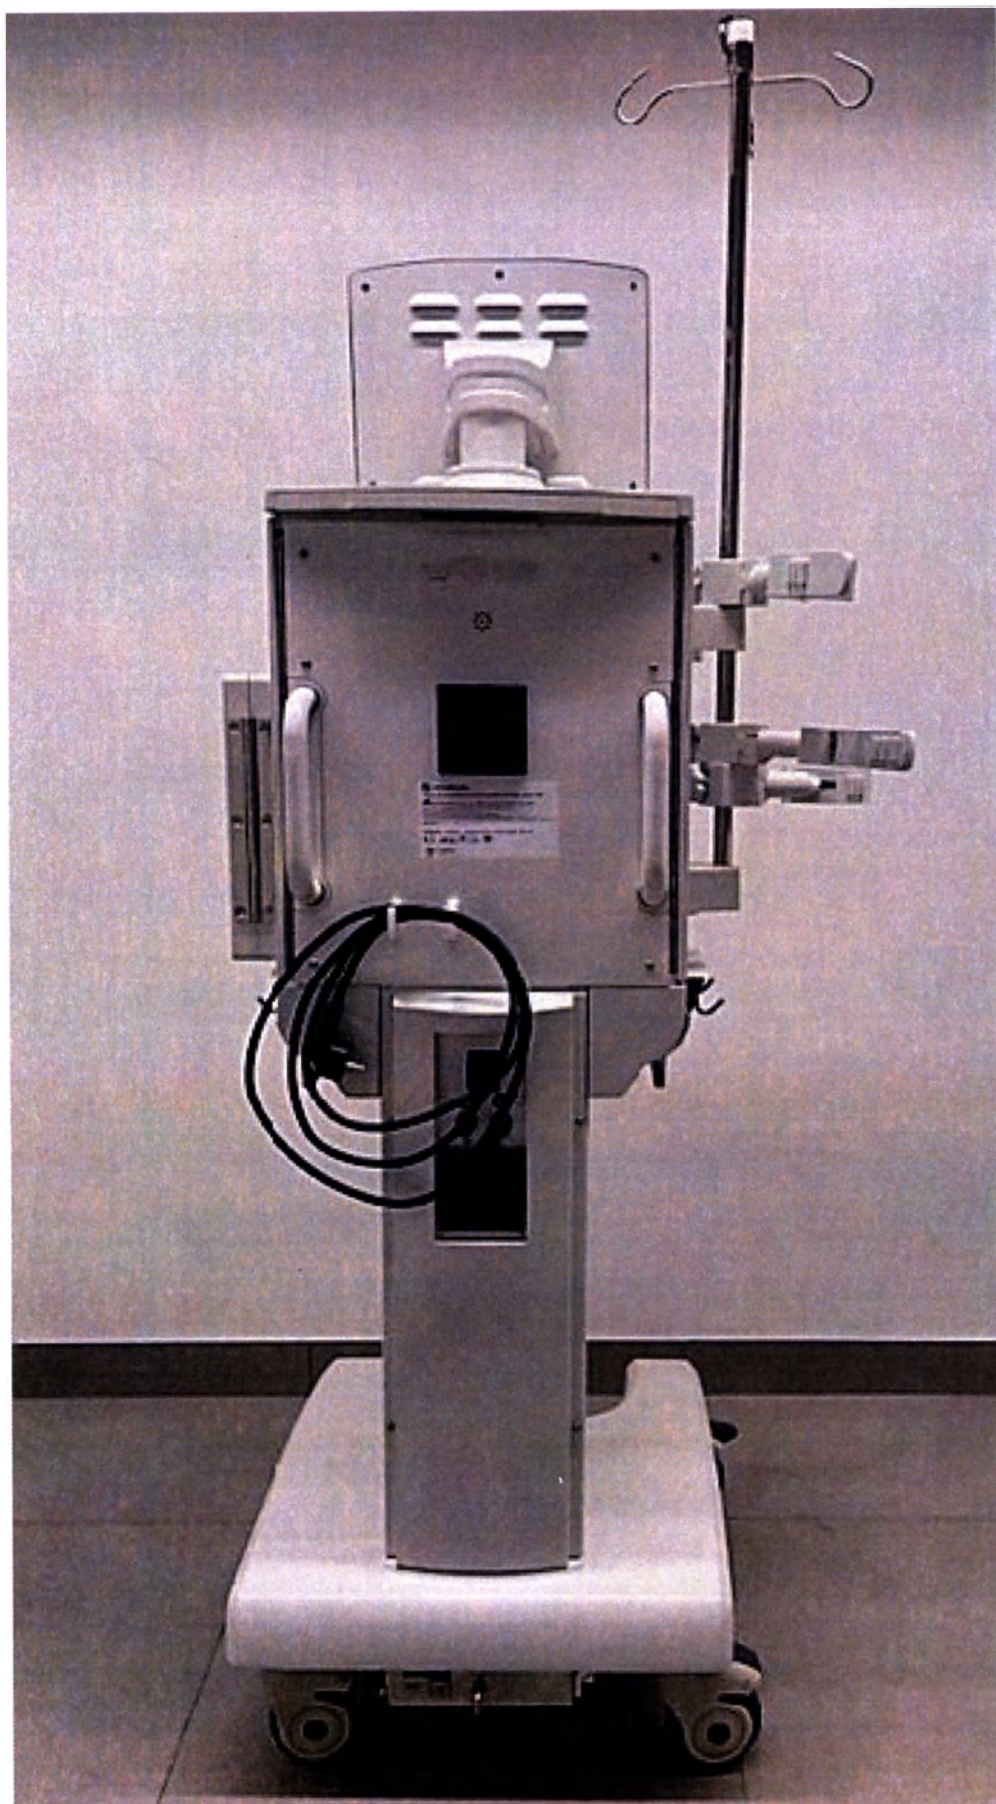


Рисунок 5 - Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции NOVADIAL, модель 5000, общий вид сзади

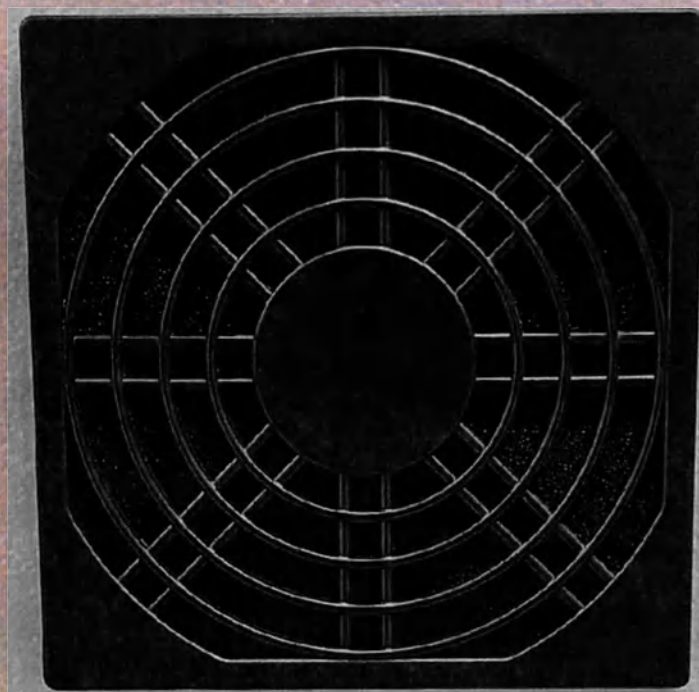

Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции NOVADIAL, модель 5000

 SW5 Hemodialysis Care Co., Ltd. (СВС Хемодиализис Кэар Ко., Лтд.), Китай

Адрес: No. 1, Ciji Road, Liangjiang New District, Chongqing, China

Страна происхождения: Китай (China)

Представитель производителя в РФ: ООО «Новадиял»

125171, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 3

РУ № РЗН _____ от _____ г.

Напряжение ~ 110/220 Вт Мощность: 500 ВА Частота: 50/60 Гц



SN 5230303136

 202403

Рисунок 6 - Маркировка на корпусе аппарата

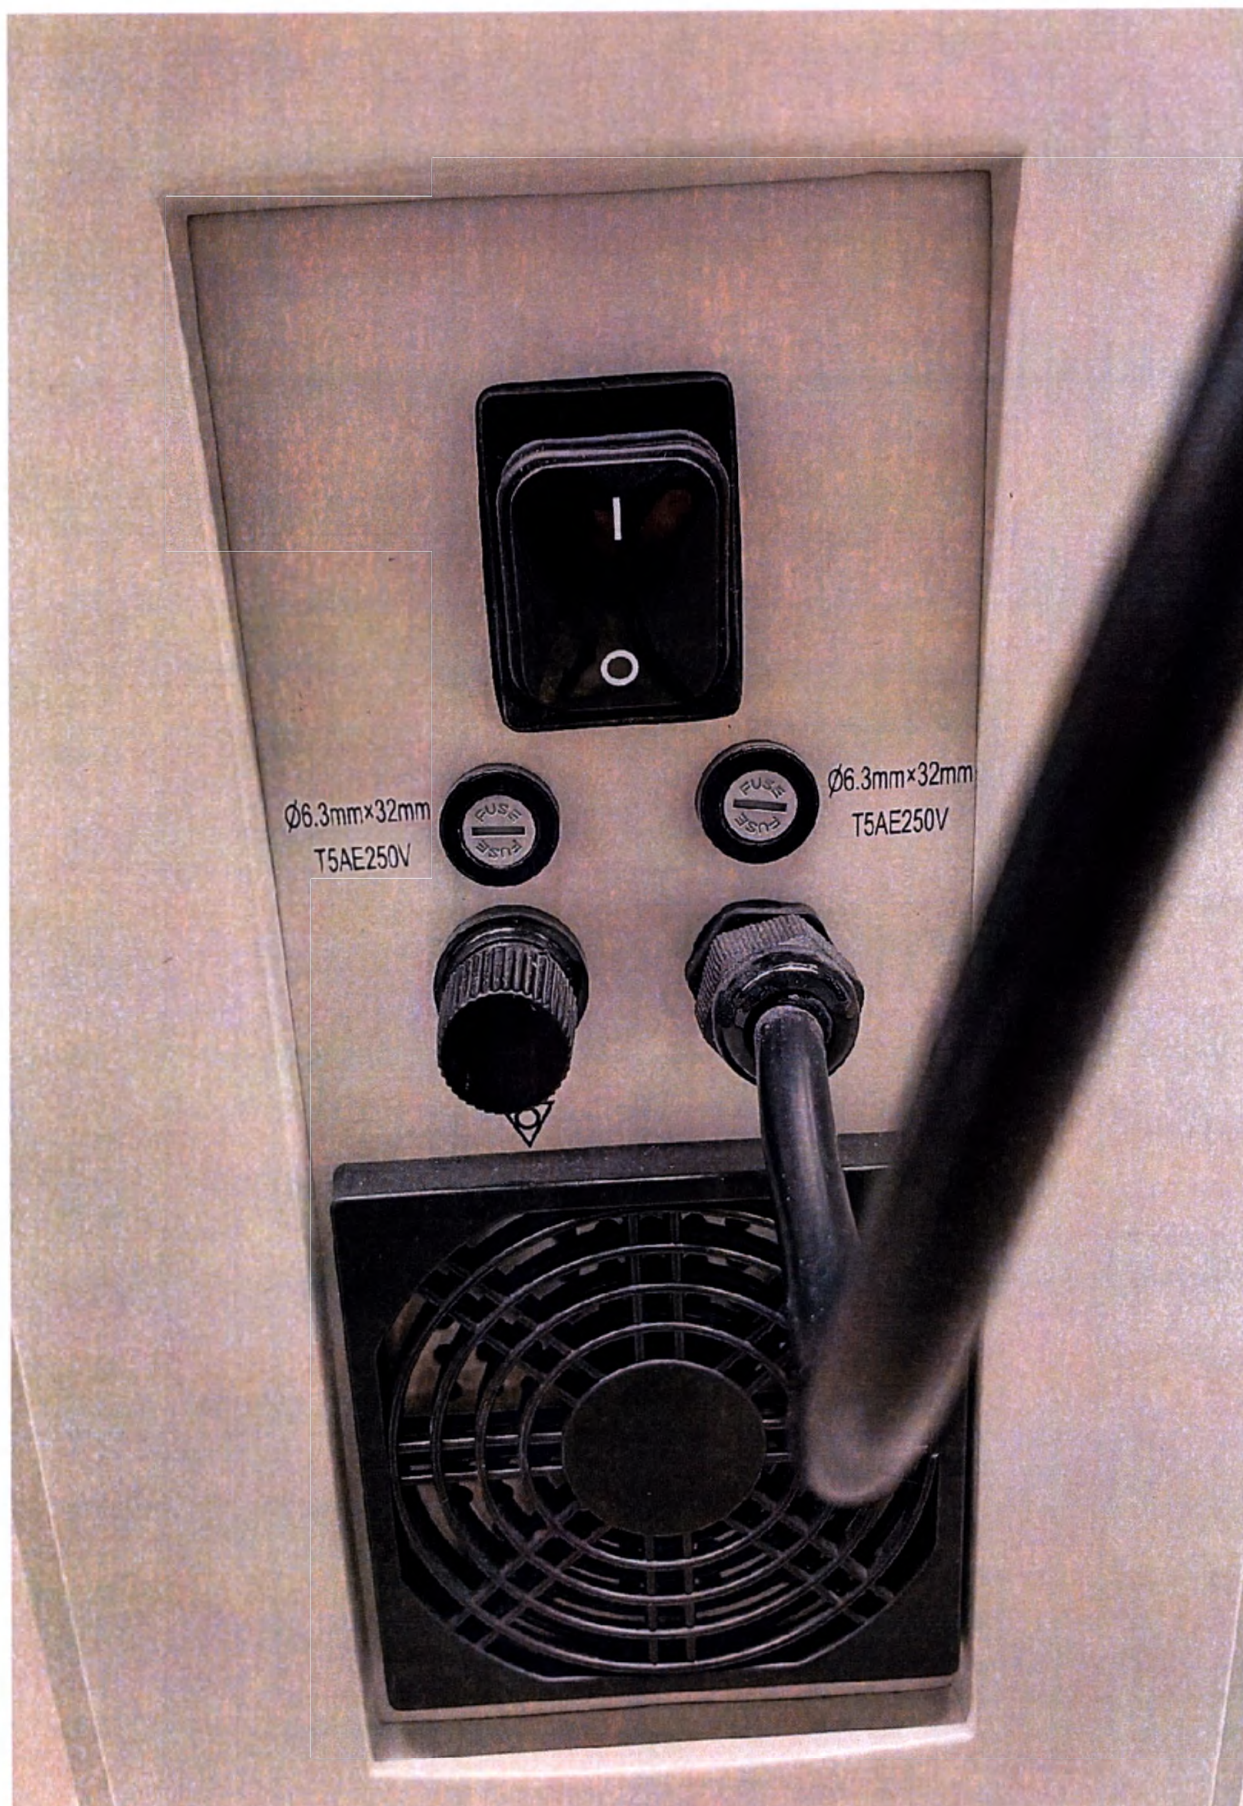


Рисунок 7 - Общий вид разъемов сзади аппарата

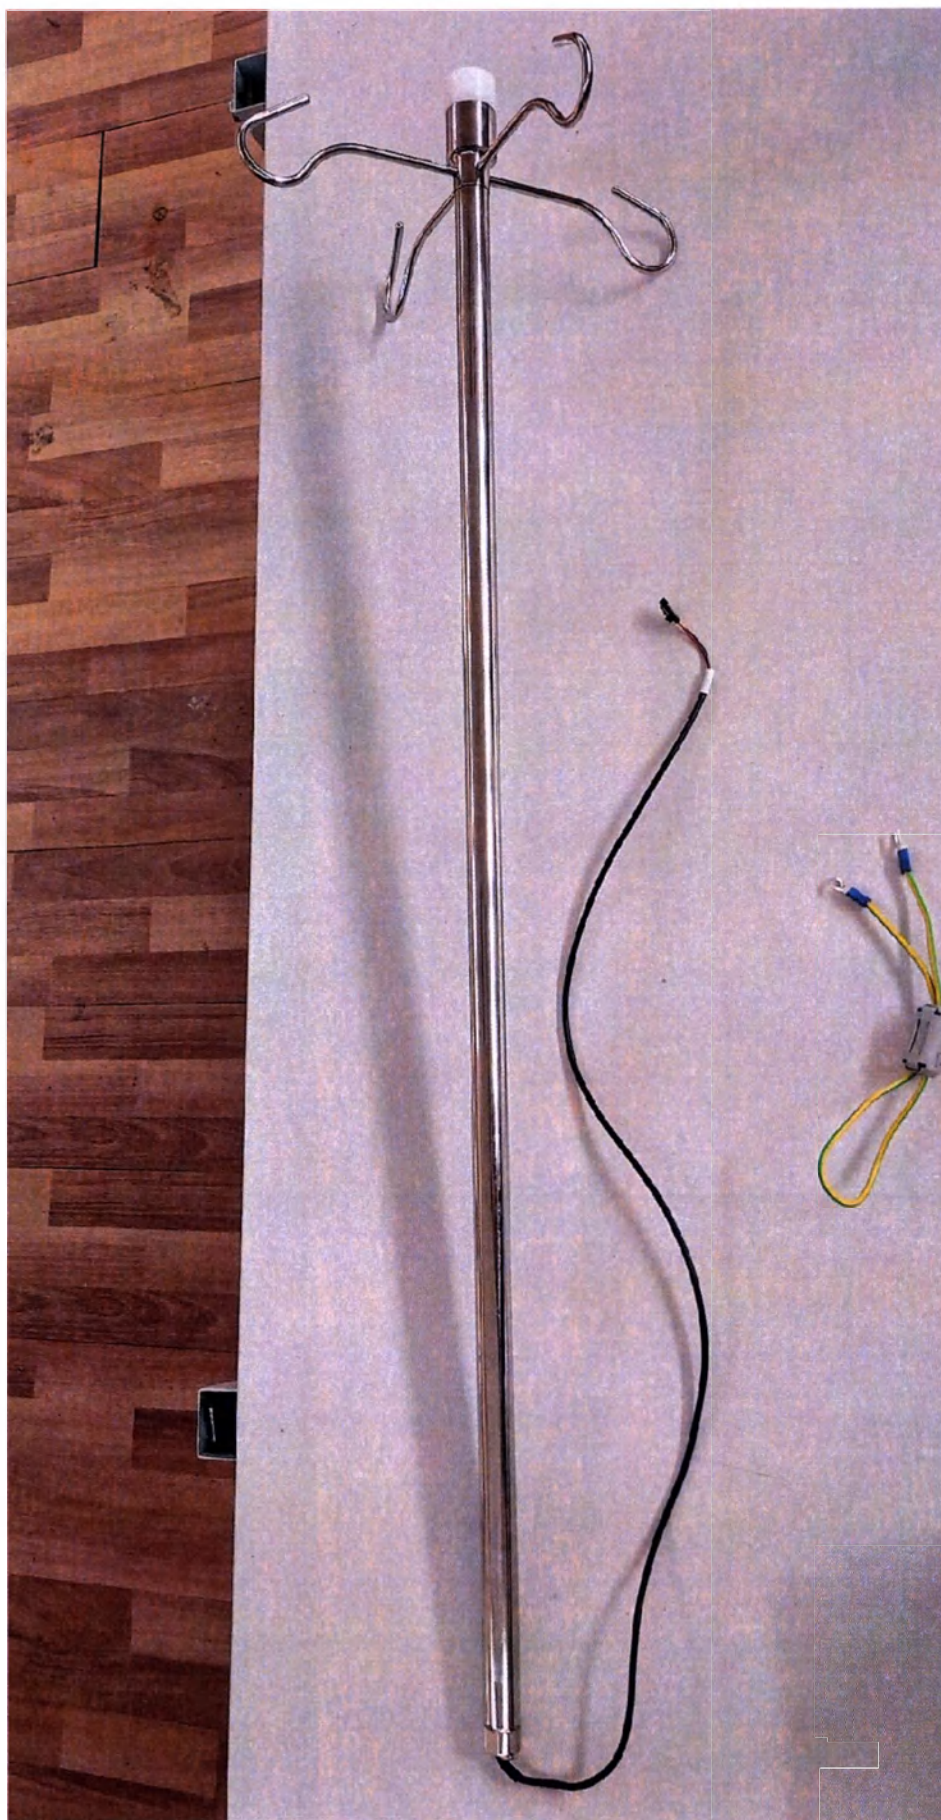


Рисунок 8 - Стойка для внутривенных вливаний в сборе



Рисунок 9 – Держатель диализатора на стойке, в сборе



Рисунок 10 – Держатель диализатора на аппарате, в сборе

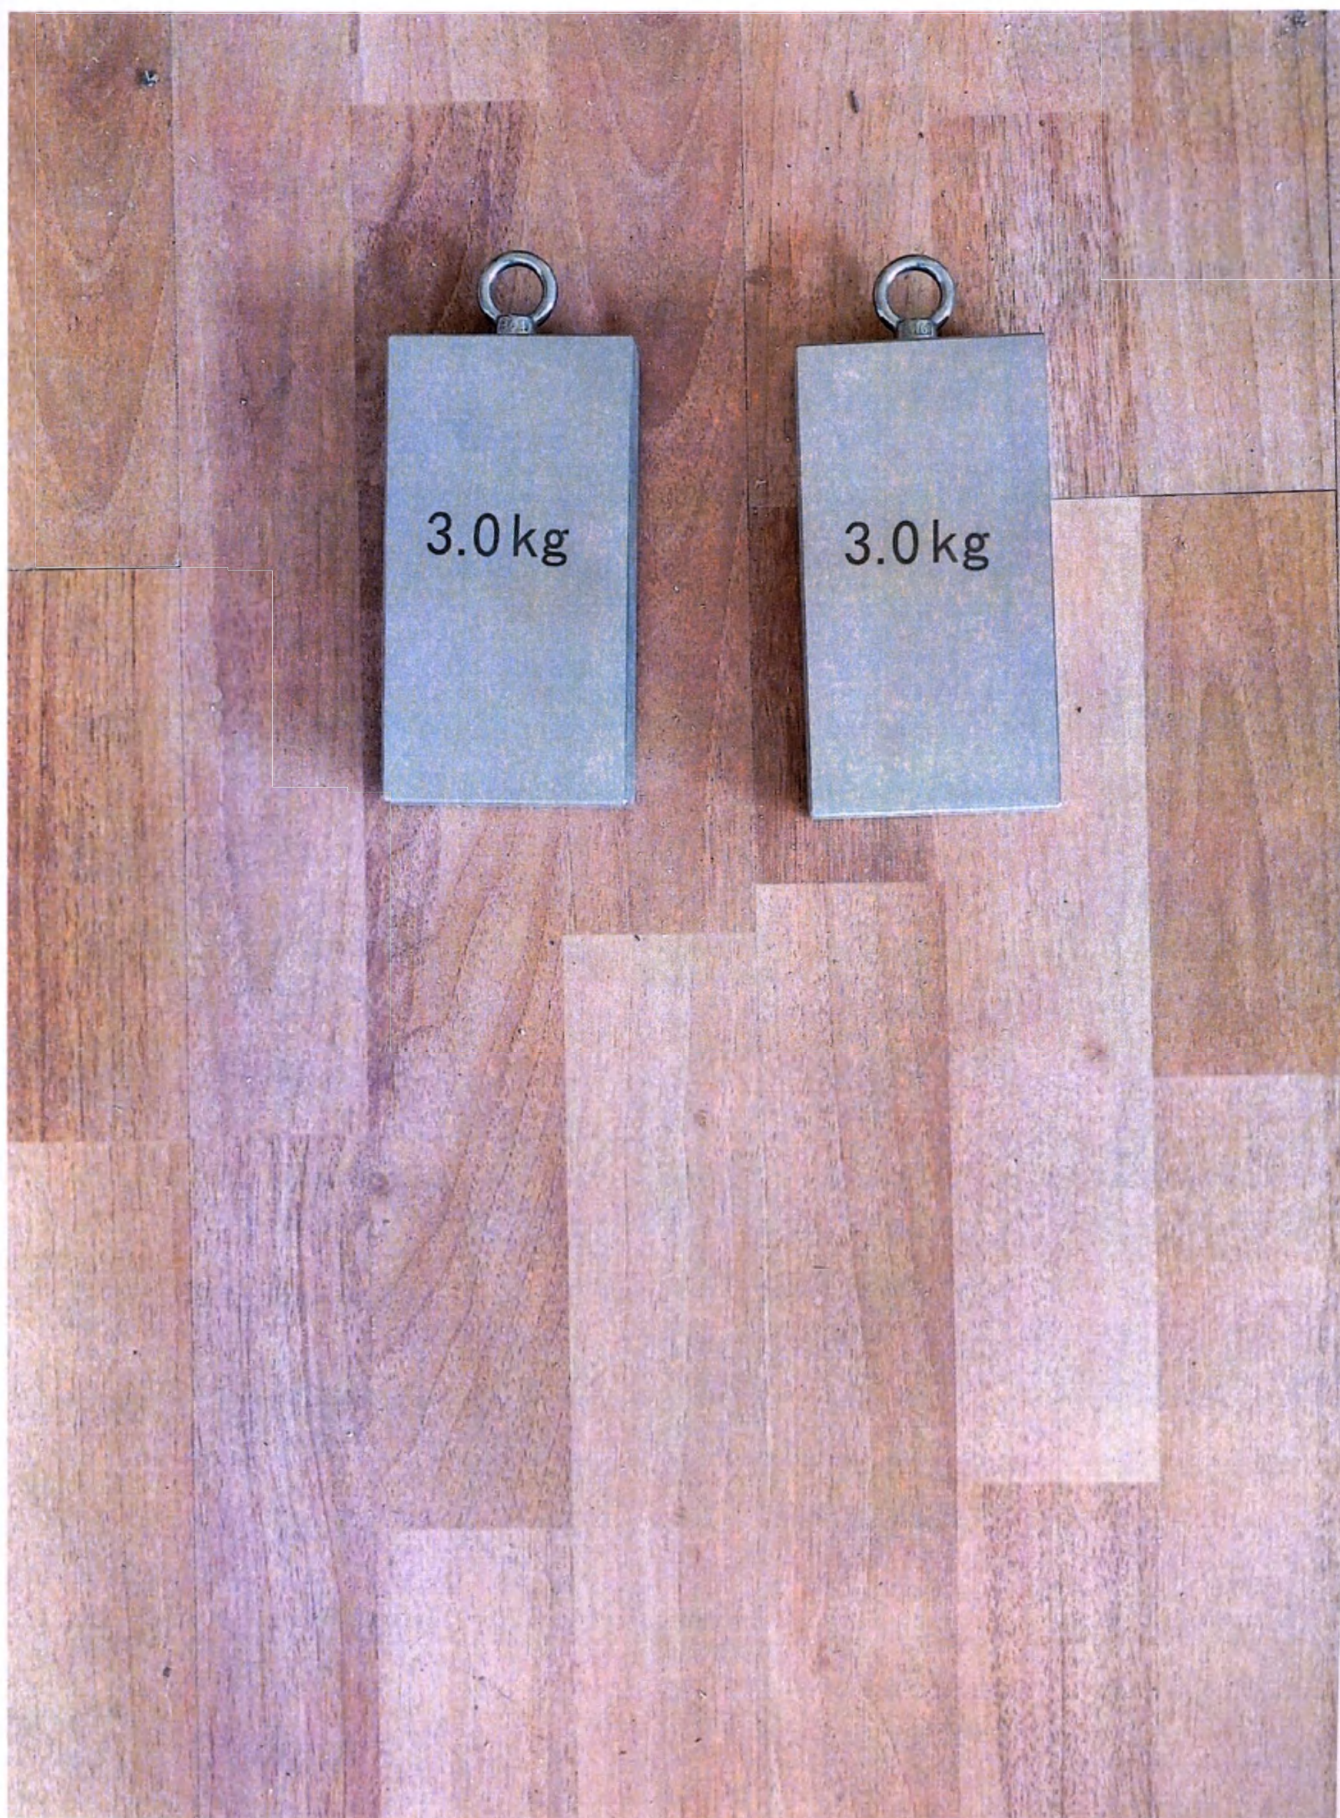


Рисунок 11 - Калибровочные веса (3 кг) – 2 шт.

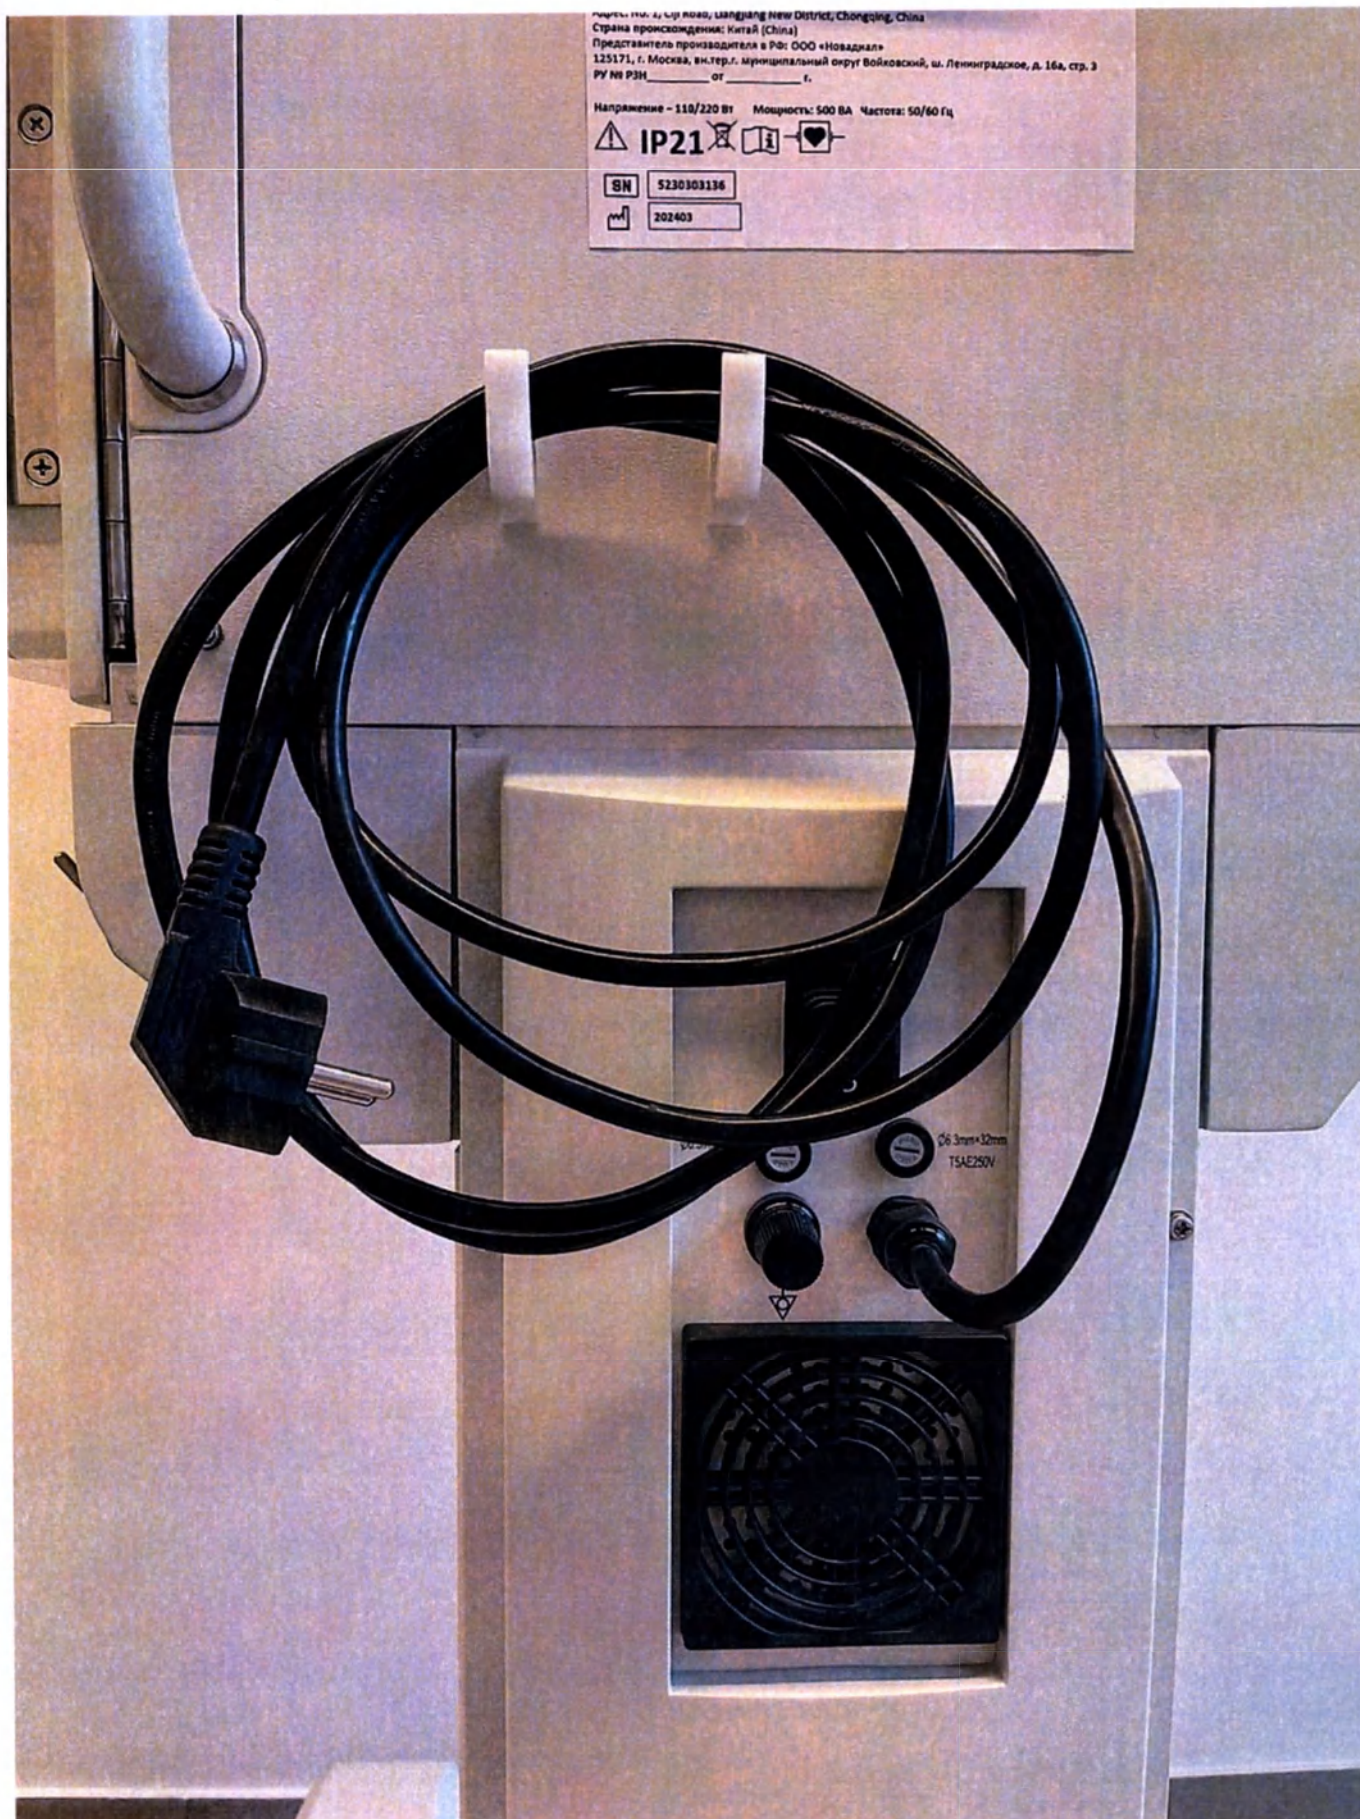


Рисунок 12 - Кабель питания – 1 шт.

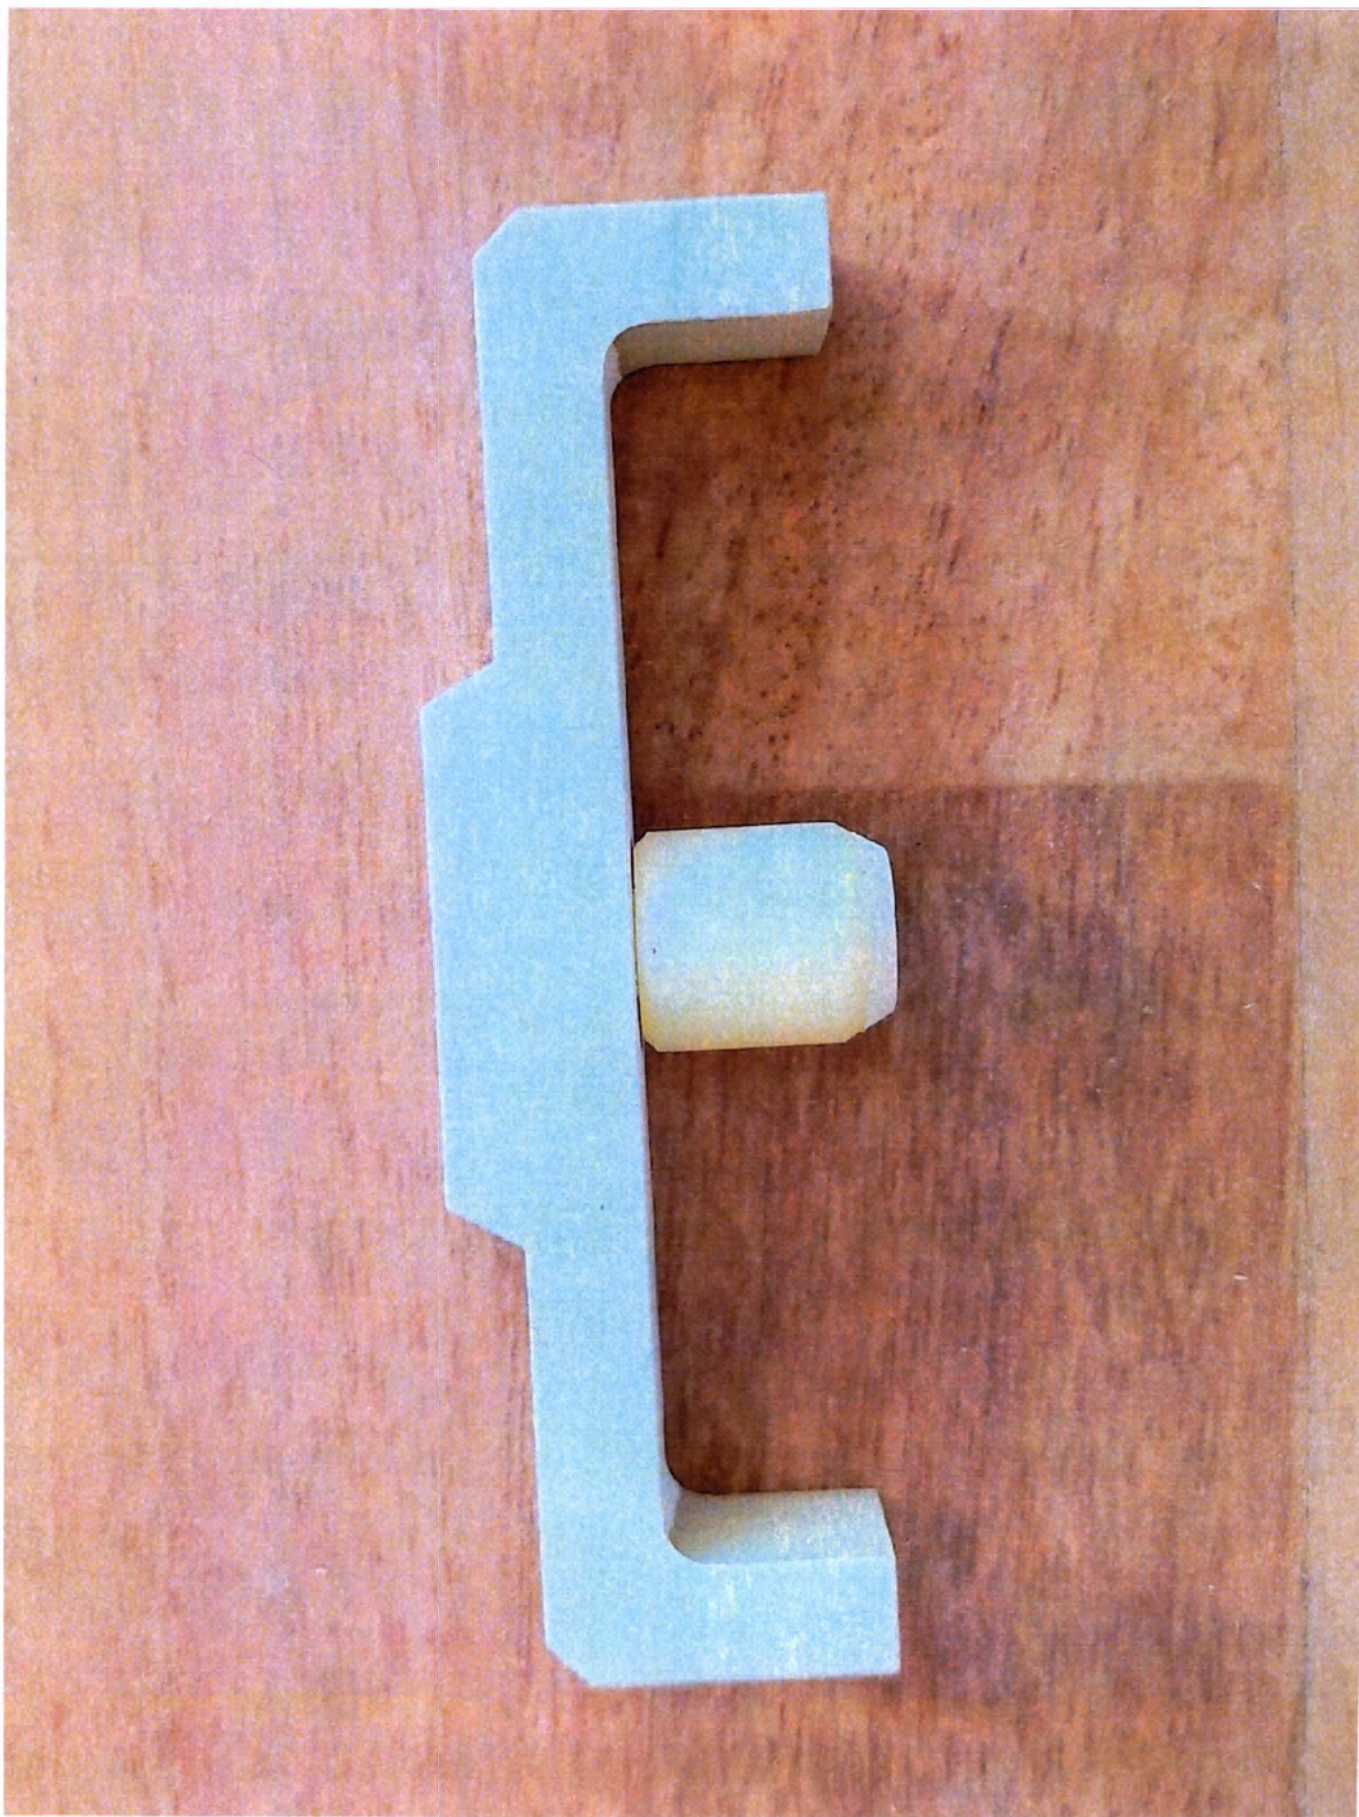


Рисунок 13 - Калибратор насосных роликов – 1 шт.

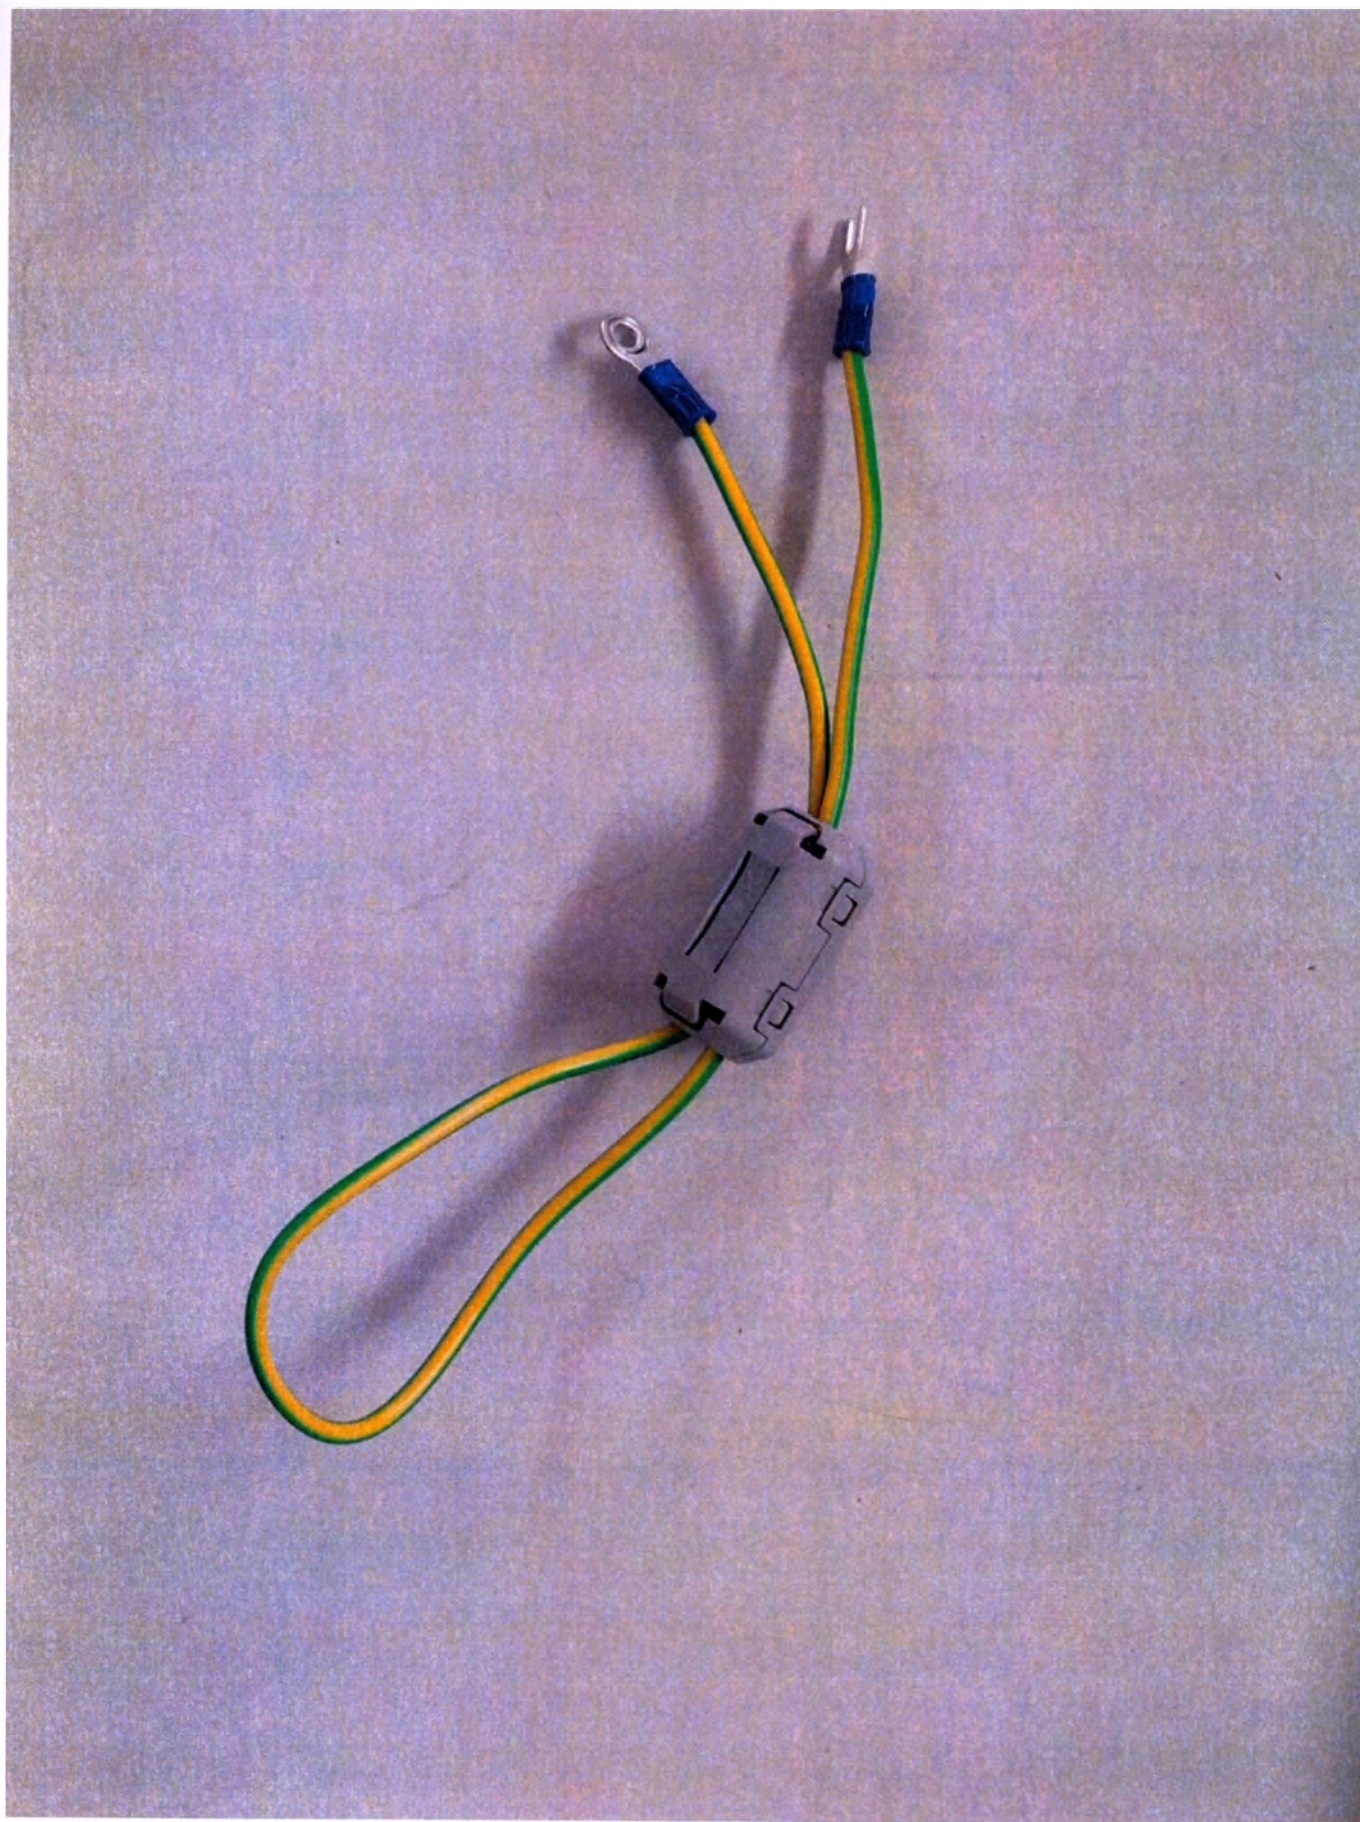


Рисунок 14 – Ферритовый фильтр – 1 шт.



Рисунок 15 – Предохранитель – 2 шт.



Рисунок 16 - Защитный чехол – 1 шт.

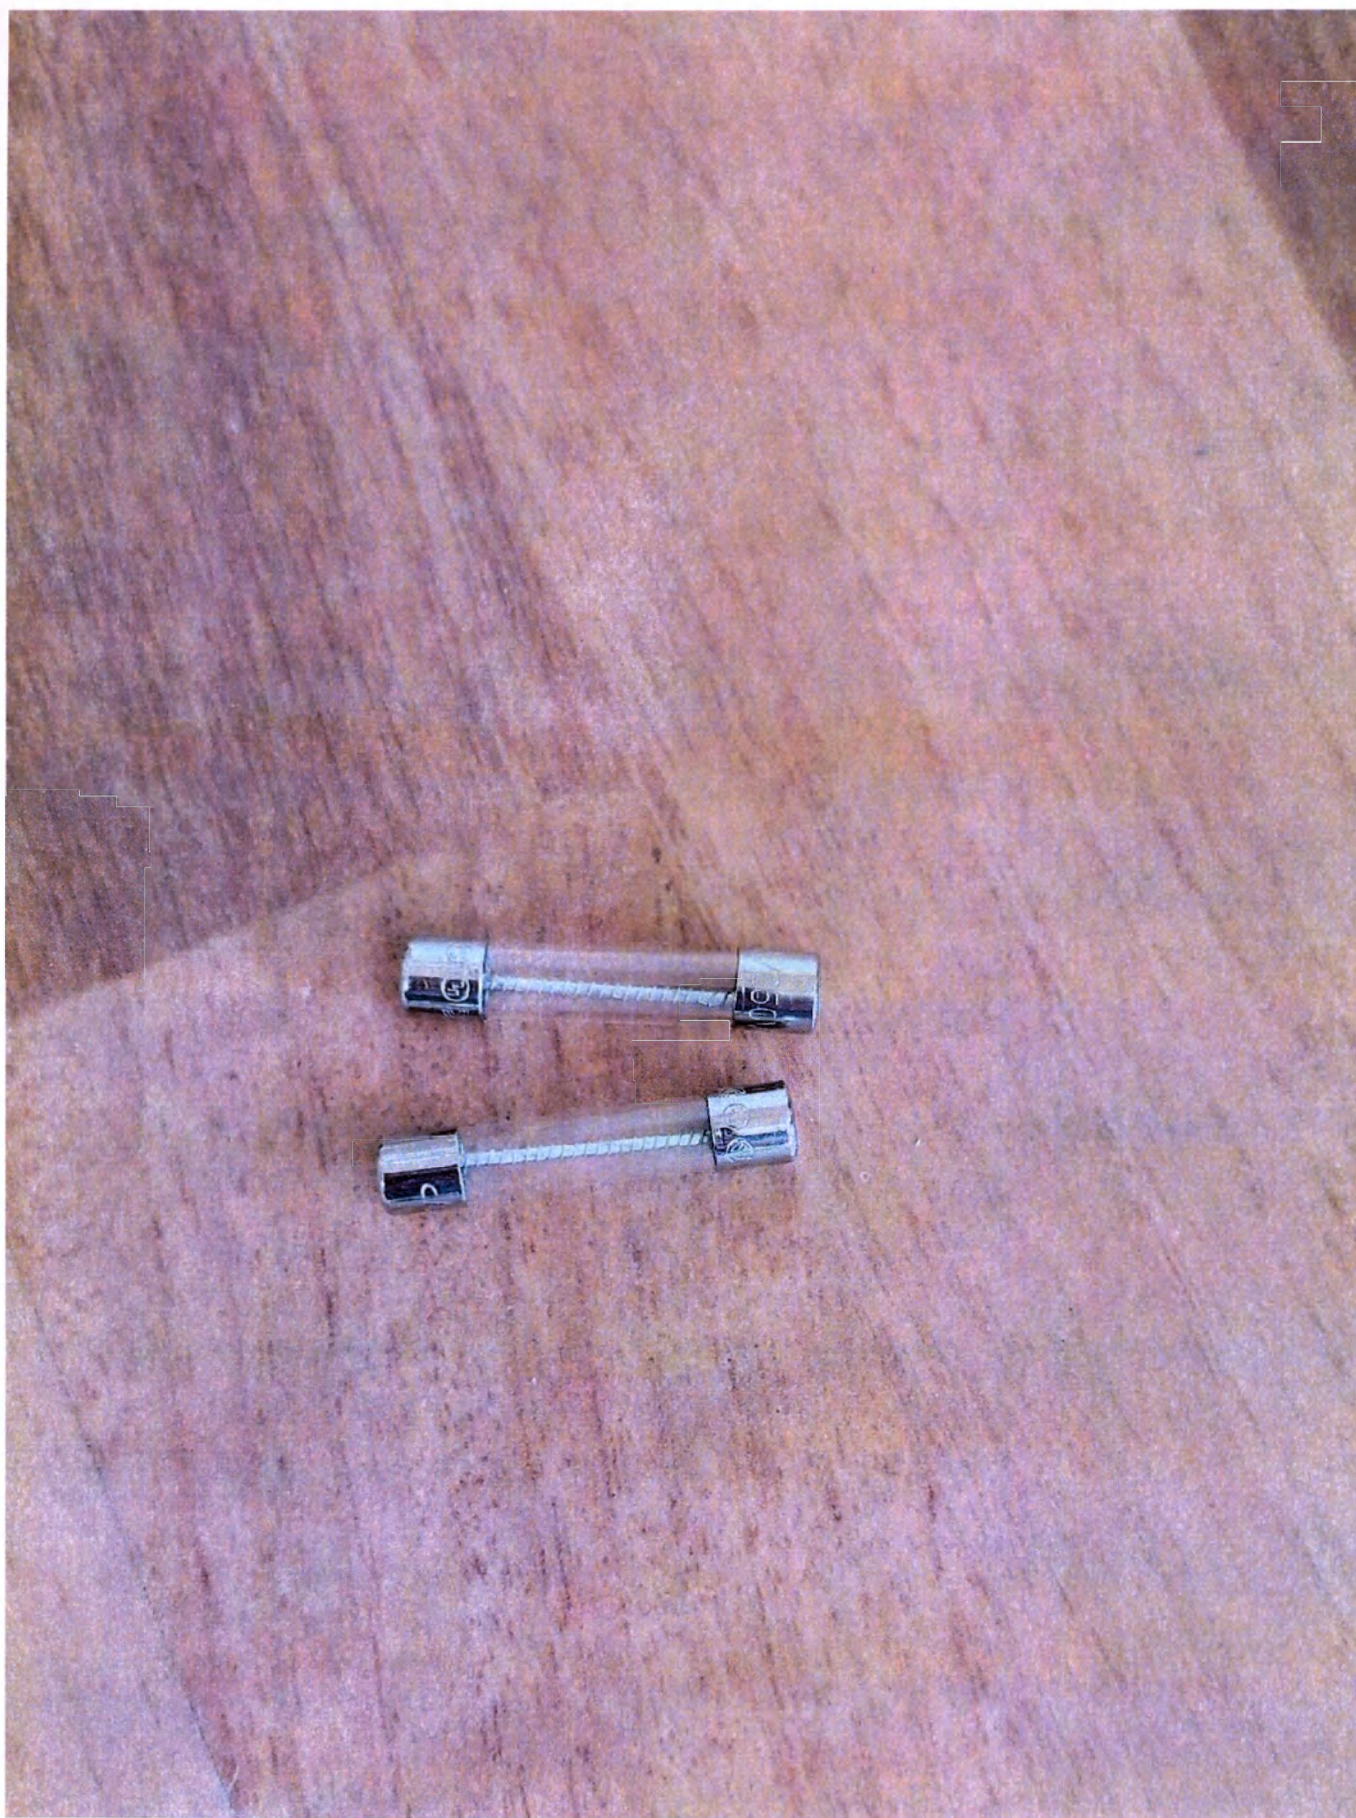


Рисунок 17 – Принадлежности: предохранитель запасной

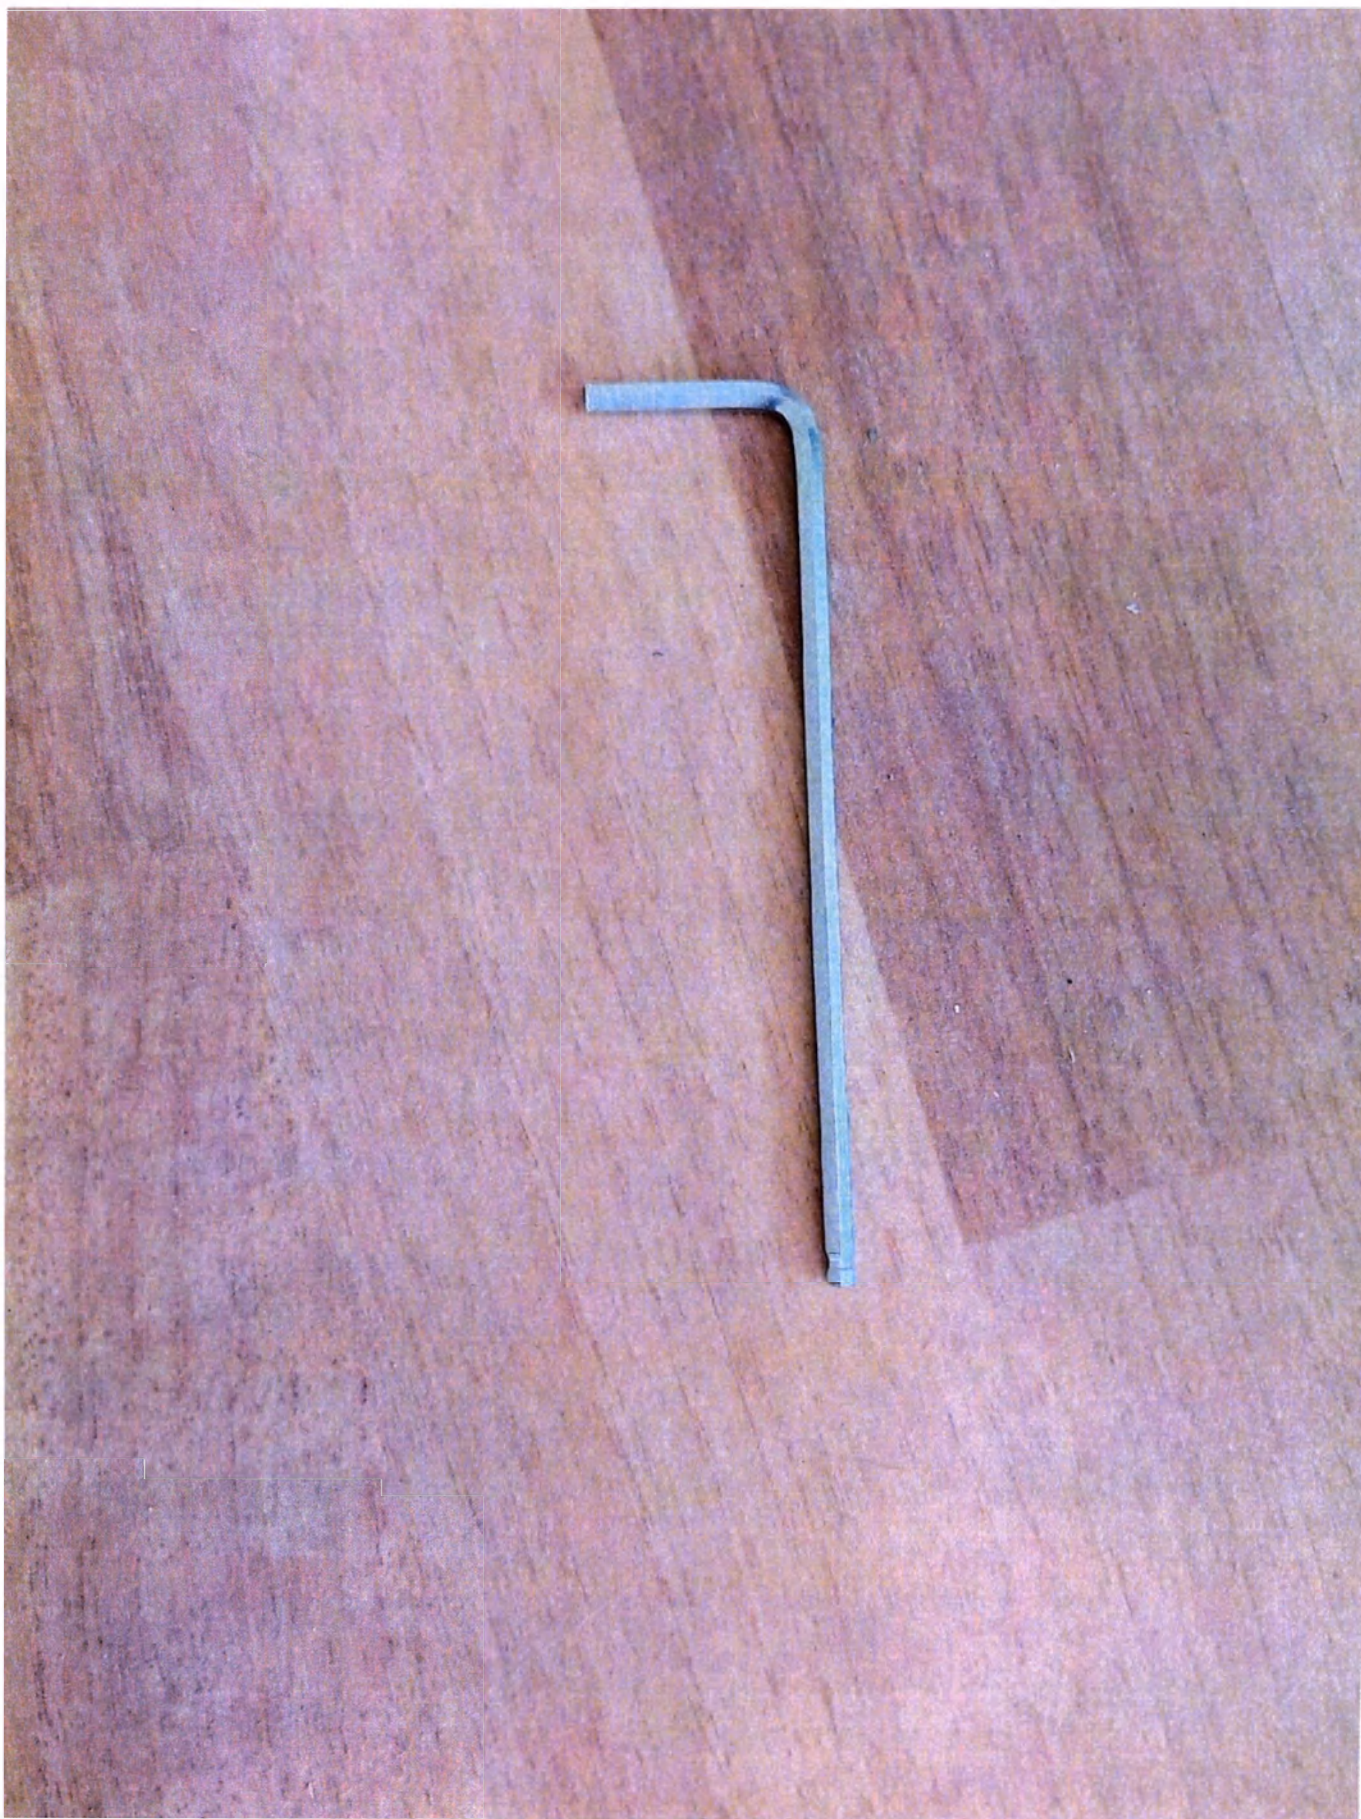


Рисунок 18 – Принадлежности: шестигранный ключ – 1 шт.



Рисунок 19 – Принадлежности: держатель диализатора на стойке, в сборе

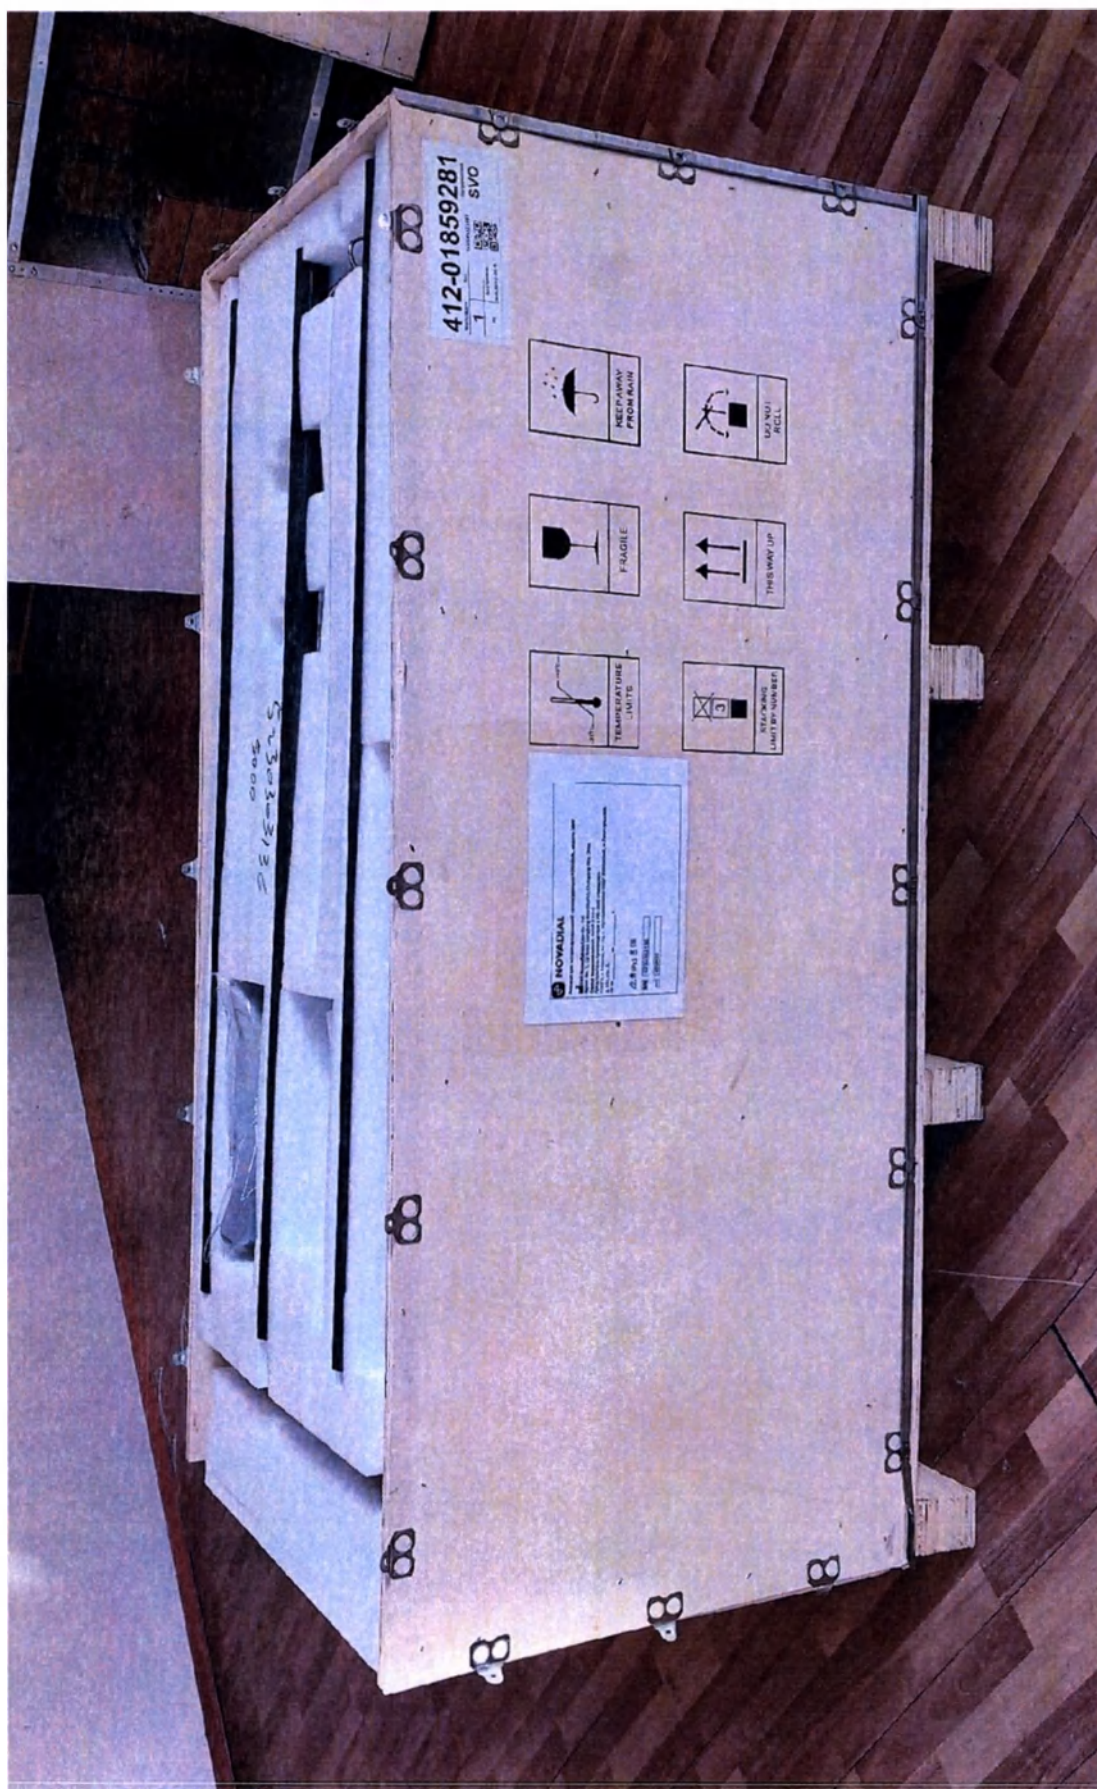


Рисунок 20 - Аппарат, упакованный в пластиковый мембранный материал

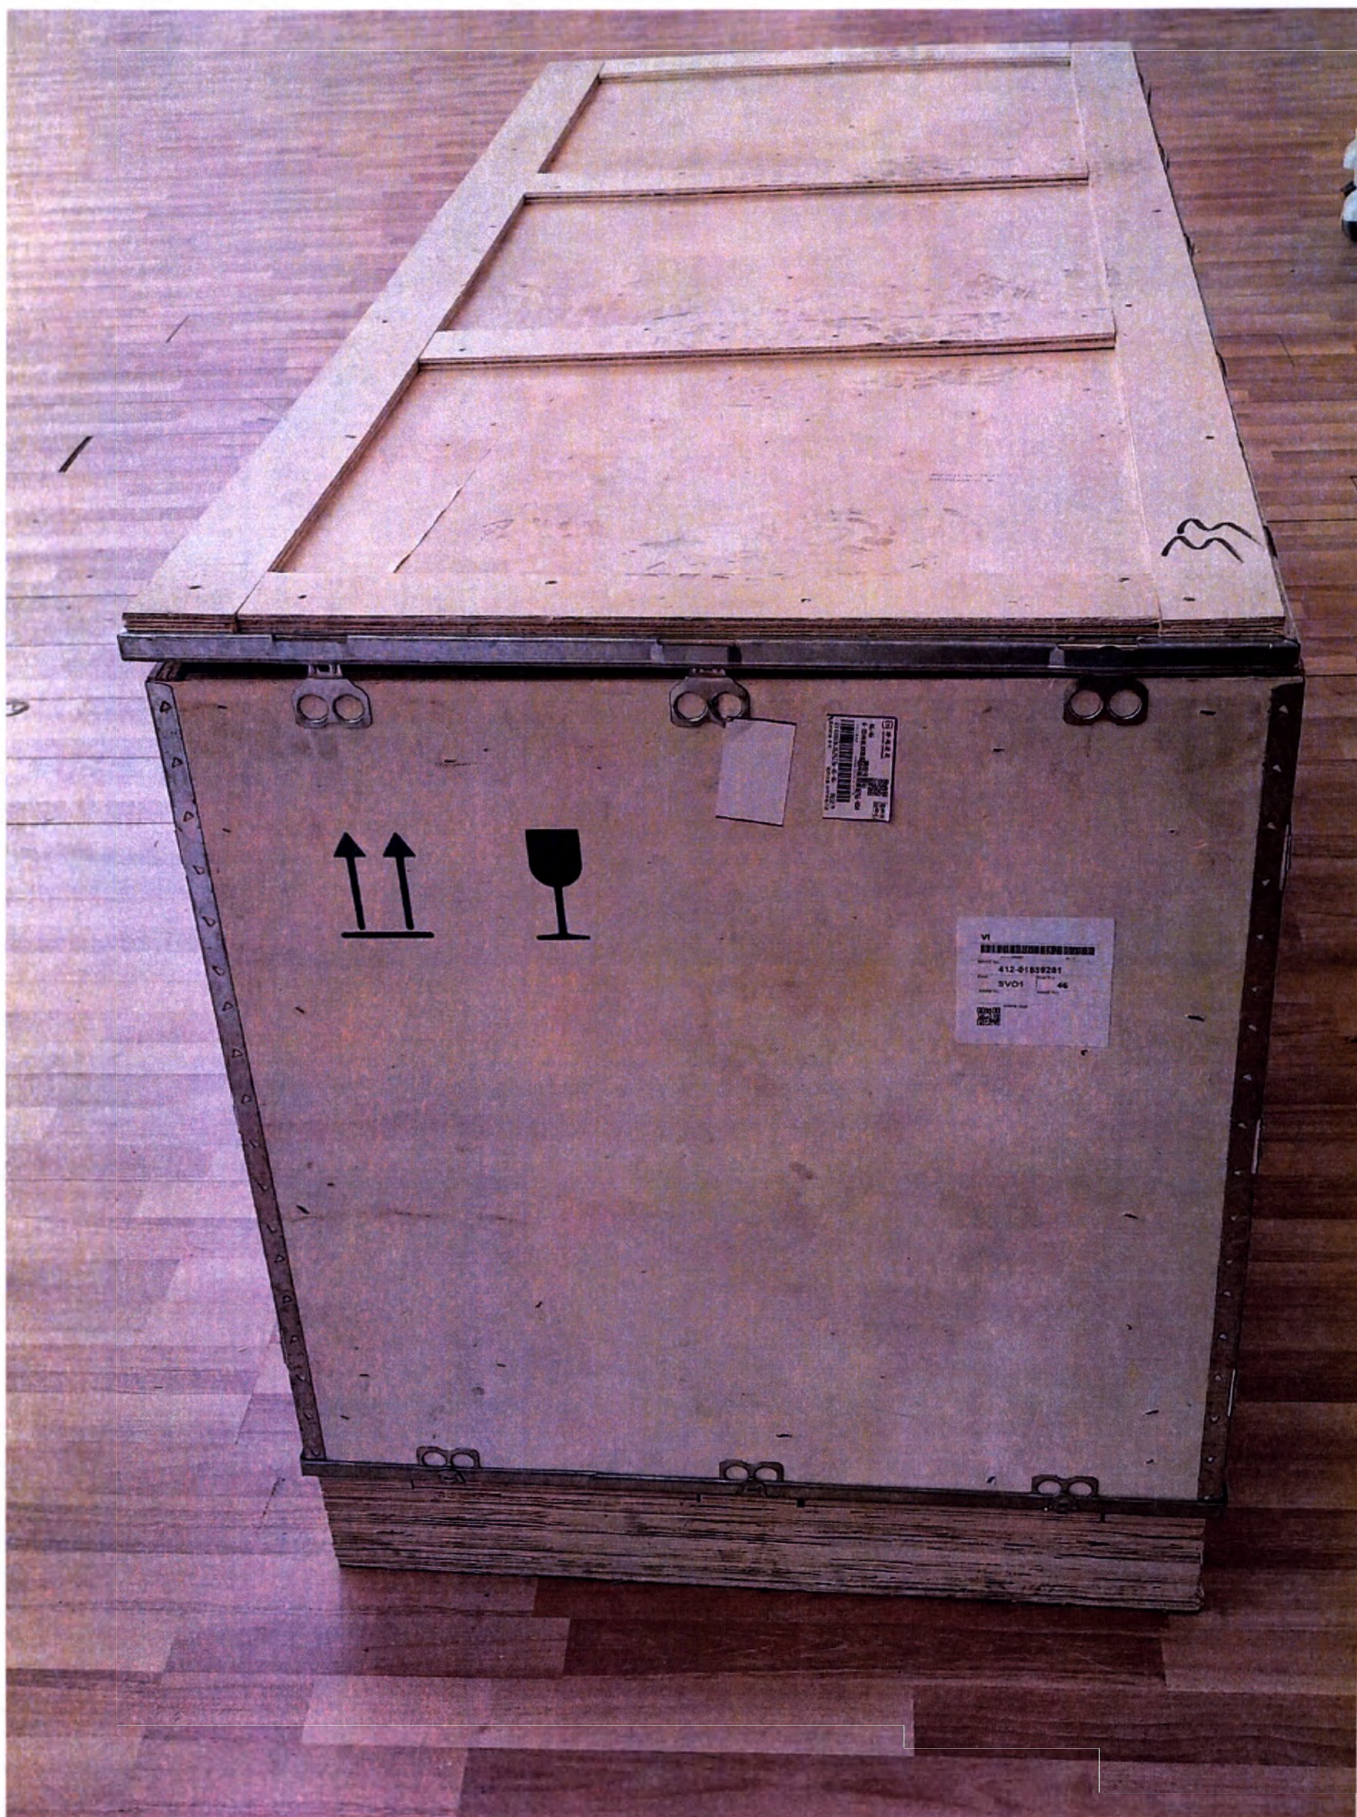


Рисунок 21 – Транспортная упаковка



Рисунок 22 - Транспортная упаковка



Рисунок 23 - Маркировка транспортной упаковки



Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции NOVADIAL, модель 5000

SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. (СВС Хемодиализис Кэар Ко., Лтд.), Китай

Адрес: No. 1, Ciji Road, Liangjiang New District, Chongqing, China

Страна происхождения: Китай (China)

Представитель производителя в РФ: ООО «Новадиял»

125171, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 3

РУ № РЗН _____ от _____ г.

Напряжение ~ 110/220 Вт Мощность: 500 ВА Частота: 50/60 Гц




Рисунок 24 – Макет маркировки изделия



Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции NOVADIAL, модель 5000

SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. (СВС Хемодиализис Кэар Ко., Лтд.), Китай

Адрес: No. 1, Ciji Road, Liangjiang New District, Chongqing, China

Страна происхождения: Китай (China)

Представитель производителя в РФ: ООО «Новадиял»

125171, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 3

РУ № РЗН _____ от _____ г.

Напряжение ~ 110/220 Вт Мощность: 500 ВА Частота: 50/60 Гц

Условия транспортировки/хранения:

Температура: от - 20°C до +55°C

Относительная влажность: от 10% до 93%;




Рисунок 25 – Макет маркировки транспортной упаковки

НЕПОМНЯШАЯ Е.В.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 03/НД

01 06.07.2024 г.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 25 листов
Генеральный директор ООО «Новадиял»

А.Н. Катаев

Катаев А.Н.

Дата 26.12.2024

