

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
_____ 10 _____ листах



Фотографические изображения медицинского изделия

Эндомотор медицинский стоматологический АСРЕТЕС по ТУ 32.50.11-001- 55817550-2022, в вариантах исполнения с принадлежностями

Генеральный директор
ООО "ТорМедТех"

Д.А. Трегубов

« 15 » ноября 2022 г.



Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC по ТУ 32.50.11-001- 55817550-2022, в варианте исполнения с принадлежностями:

Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC Prime / **Общий вид потребительской упаковки.**

Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC
по ТУ 32.50.11-001- 55817550-2022,
в варианте исполнения с принадлежностями:



**Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC
Prime**

Срок службы – 4 года.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

РУ № XXXX от XX.XX.XXXX

 SN DEM220920001

 20.09.2022




ООО "ТорМедТех",
129329, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово,
ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1
Телефон: +7 495-790-24-30
Эл.почта: acretec@tormt.ru
Сайт: www.tormt.ru



Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC по ТУ 32.50.11-001- 55817550-2022, в варианте исполнения с принадлежностями:

Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC Prime / **Общий вид потребительской упаковки.**

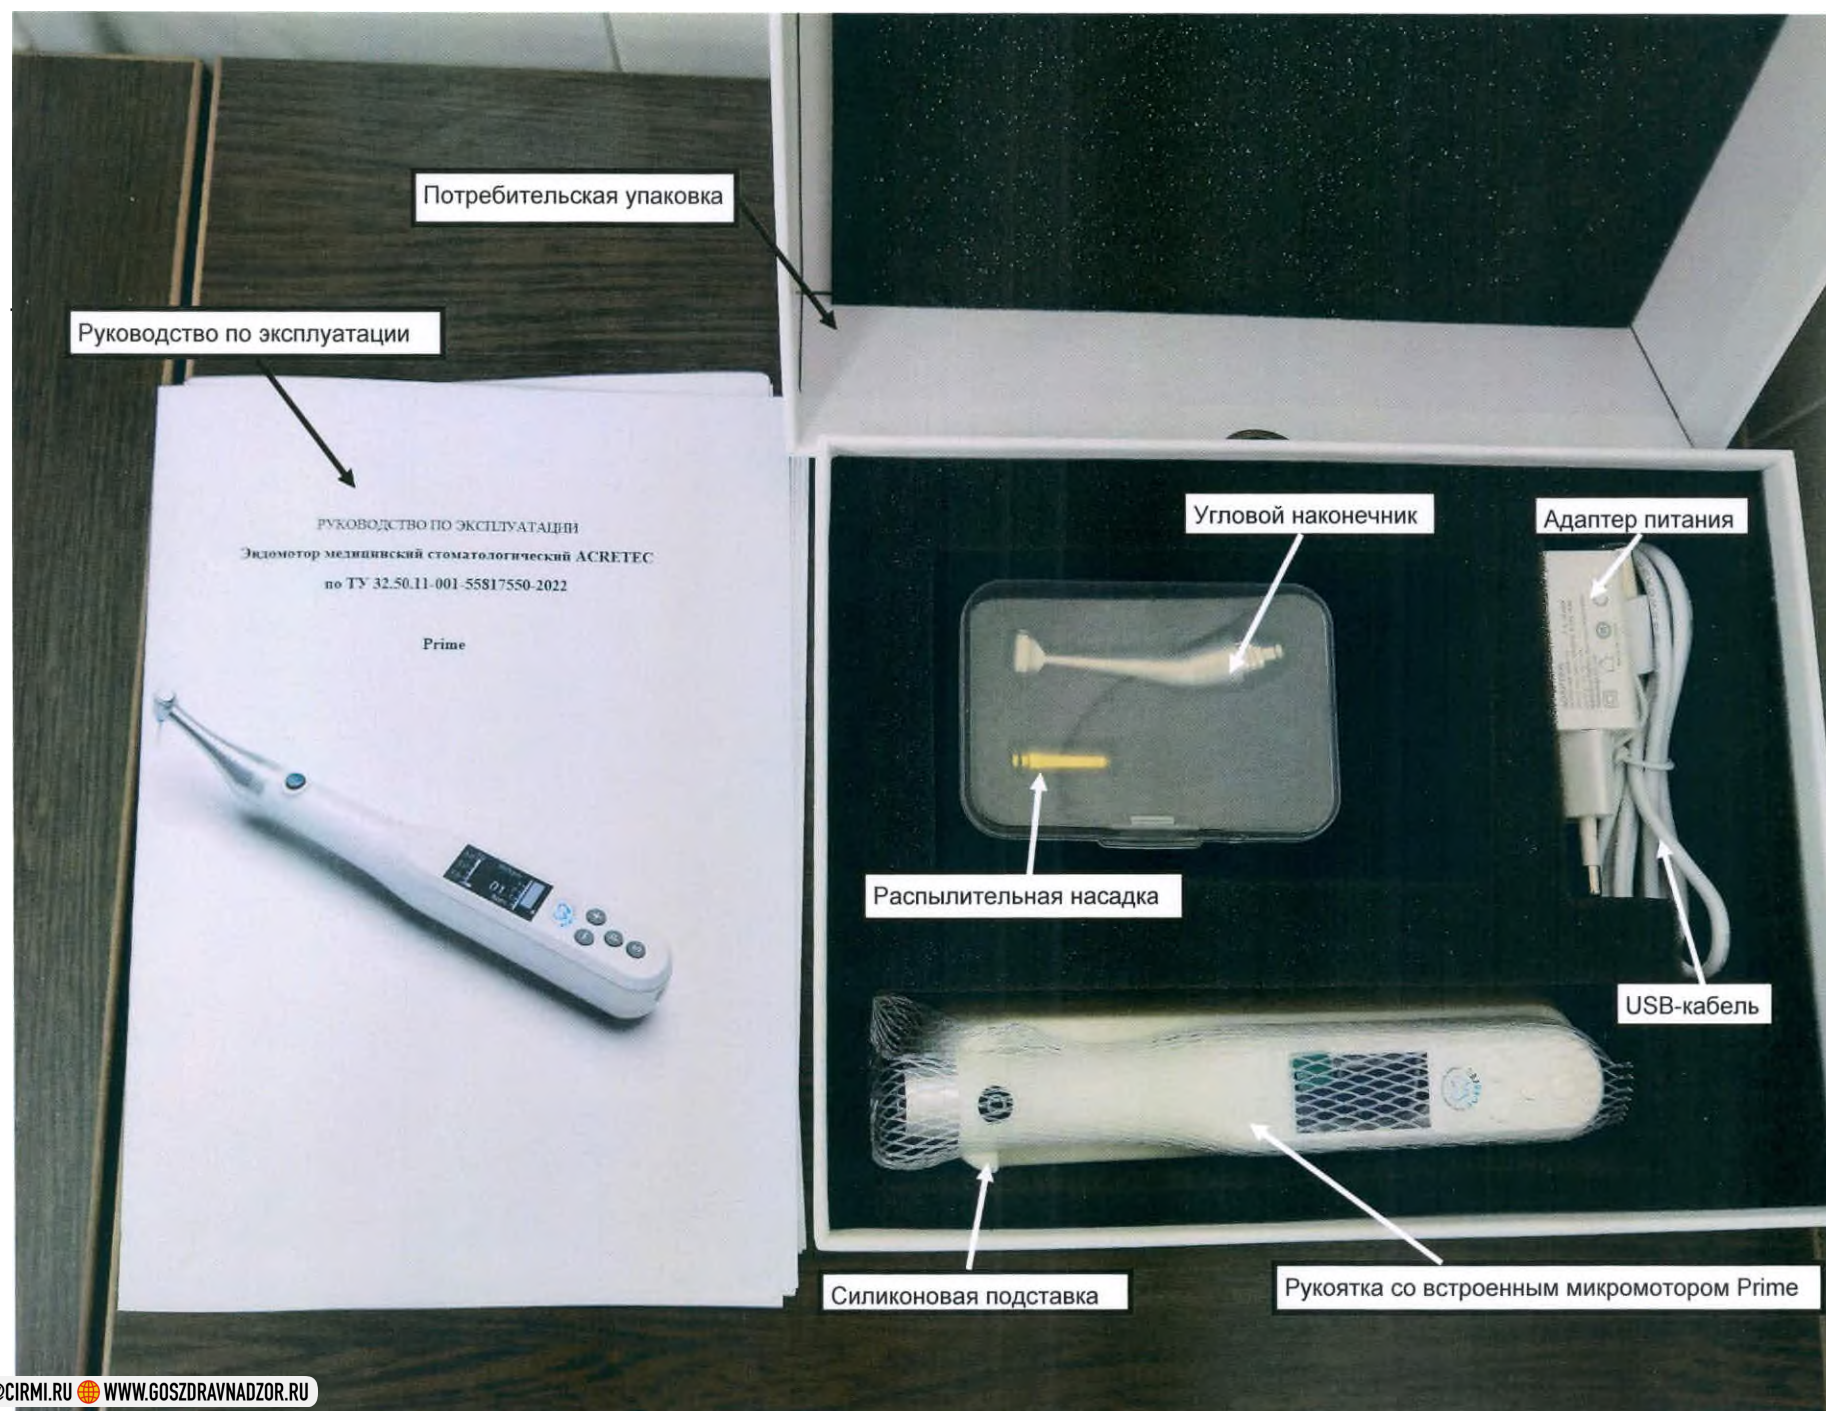

Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC по ТУ 32.50.11-001- 55817550-2022, в варианте исполнения с принадлежностями:

Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC Prime-1 / Общий вид потребительской упаковки.

Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC
по ТУ 32.50.11-001- 55817550-2022,
в варианте исполнения с принадлежностями:



**Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC
Prime-1**

Срок службы – 4 года.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

РУ № XXXX от XX.XX.XXXX

SN DEMP220920001

 20.09.2022




ООО "ТорМедТех",
129329, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово,
ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1
Телефон: +7 495-790-24-30
Эл.почта: acretec@tormt.ru
Сайт: www.tormt.ru




-10°C  +55°C

Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC по ТУ 32.50.11-001- 55817550-2022, в варианте исполнения с принадлежностями:

Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC Prime-1 / **Общий вид**

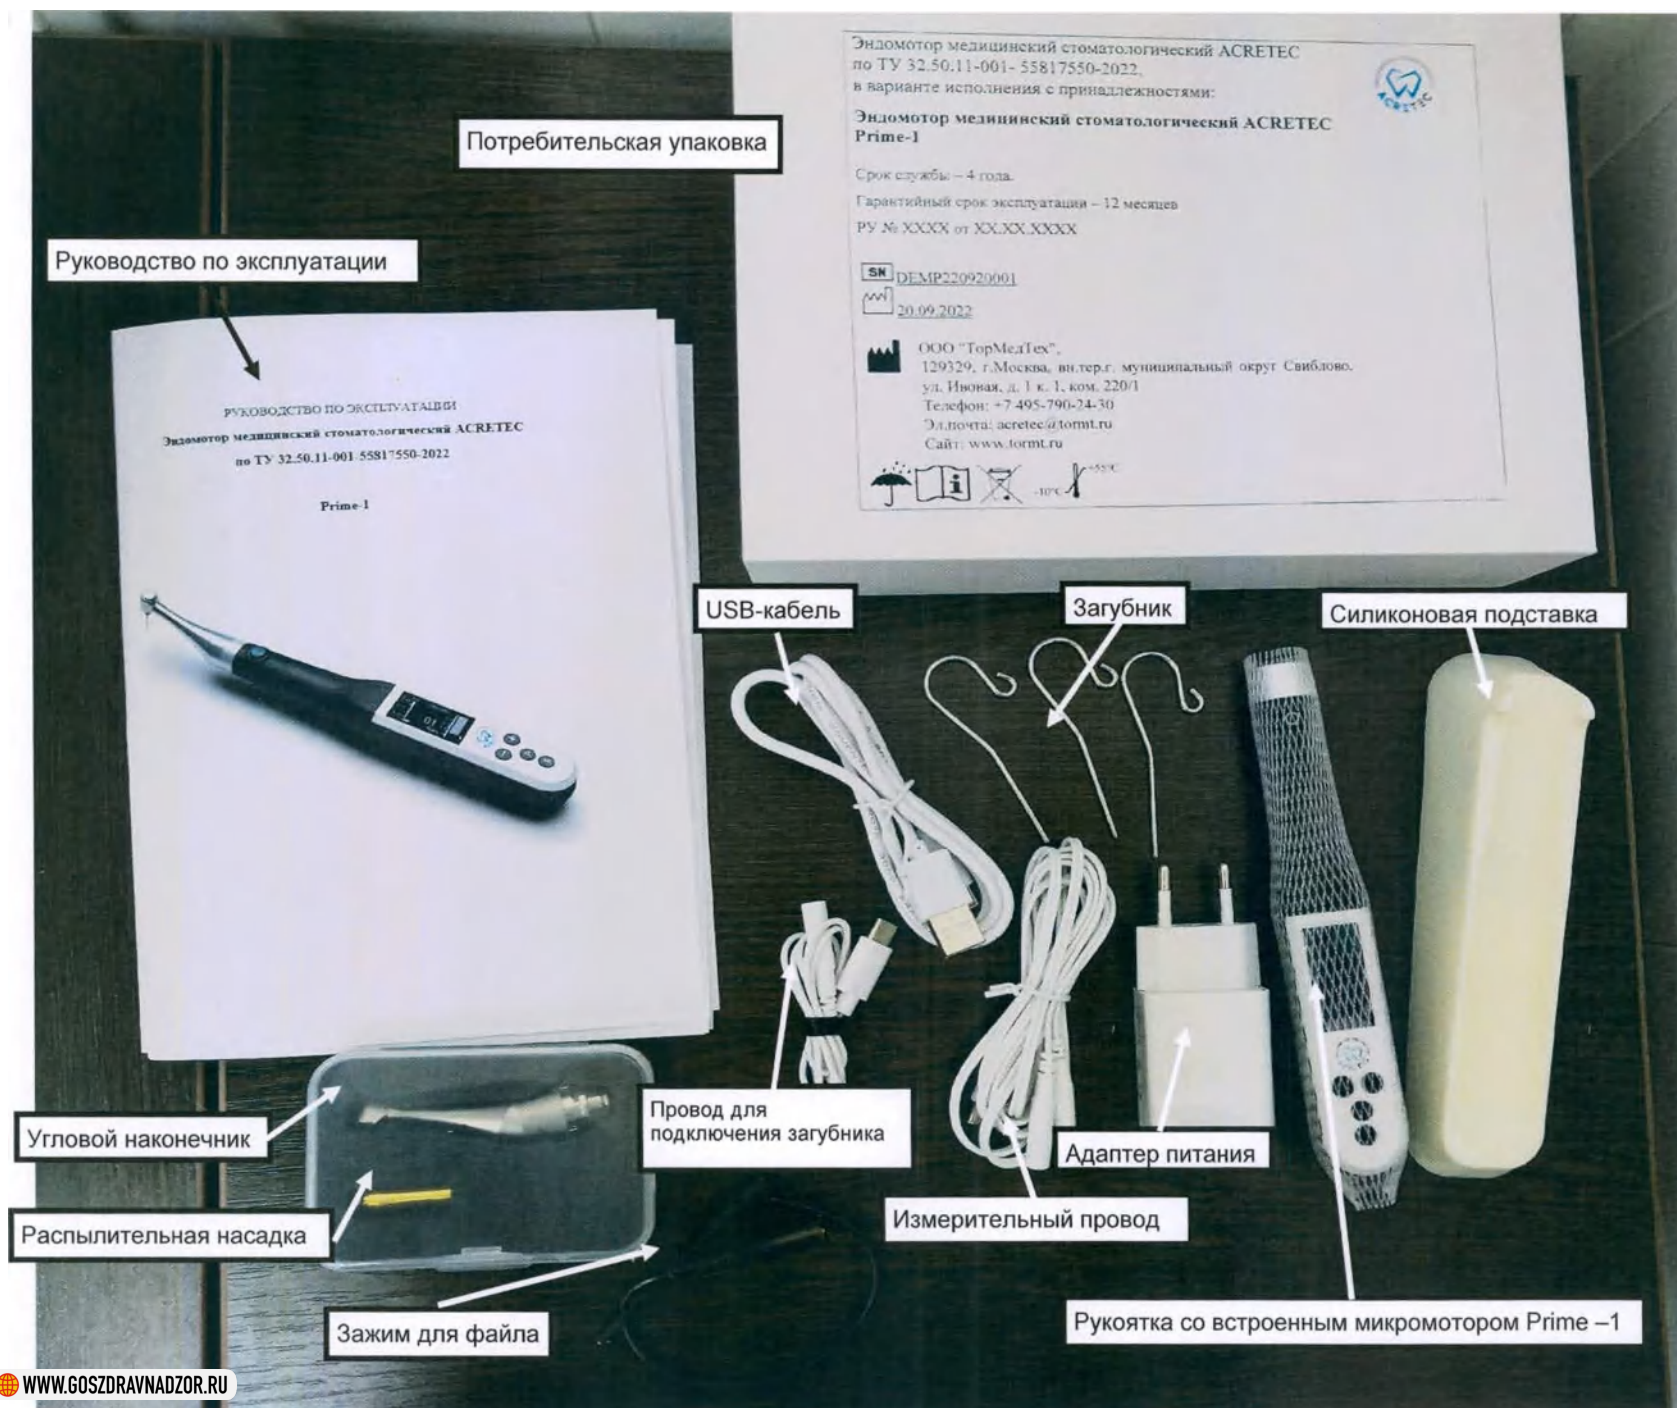

Рукоятка со встроенным микромотором Prime / Вид спереди

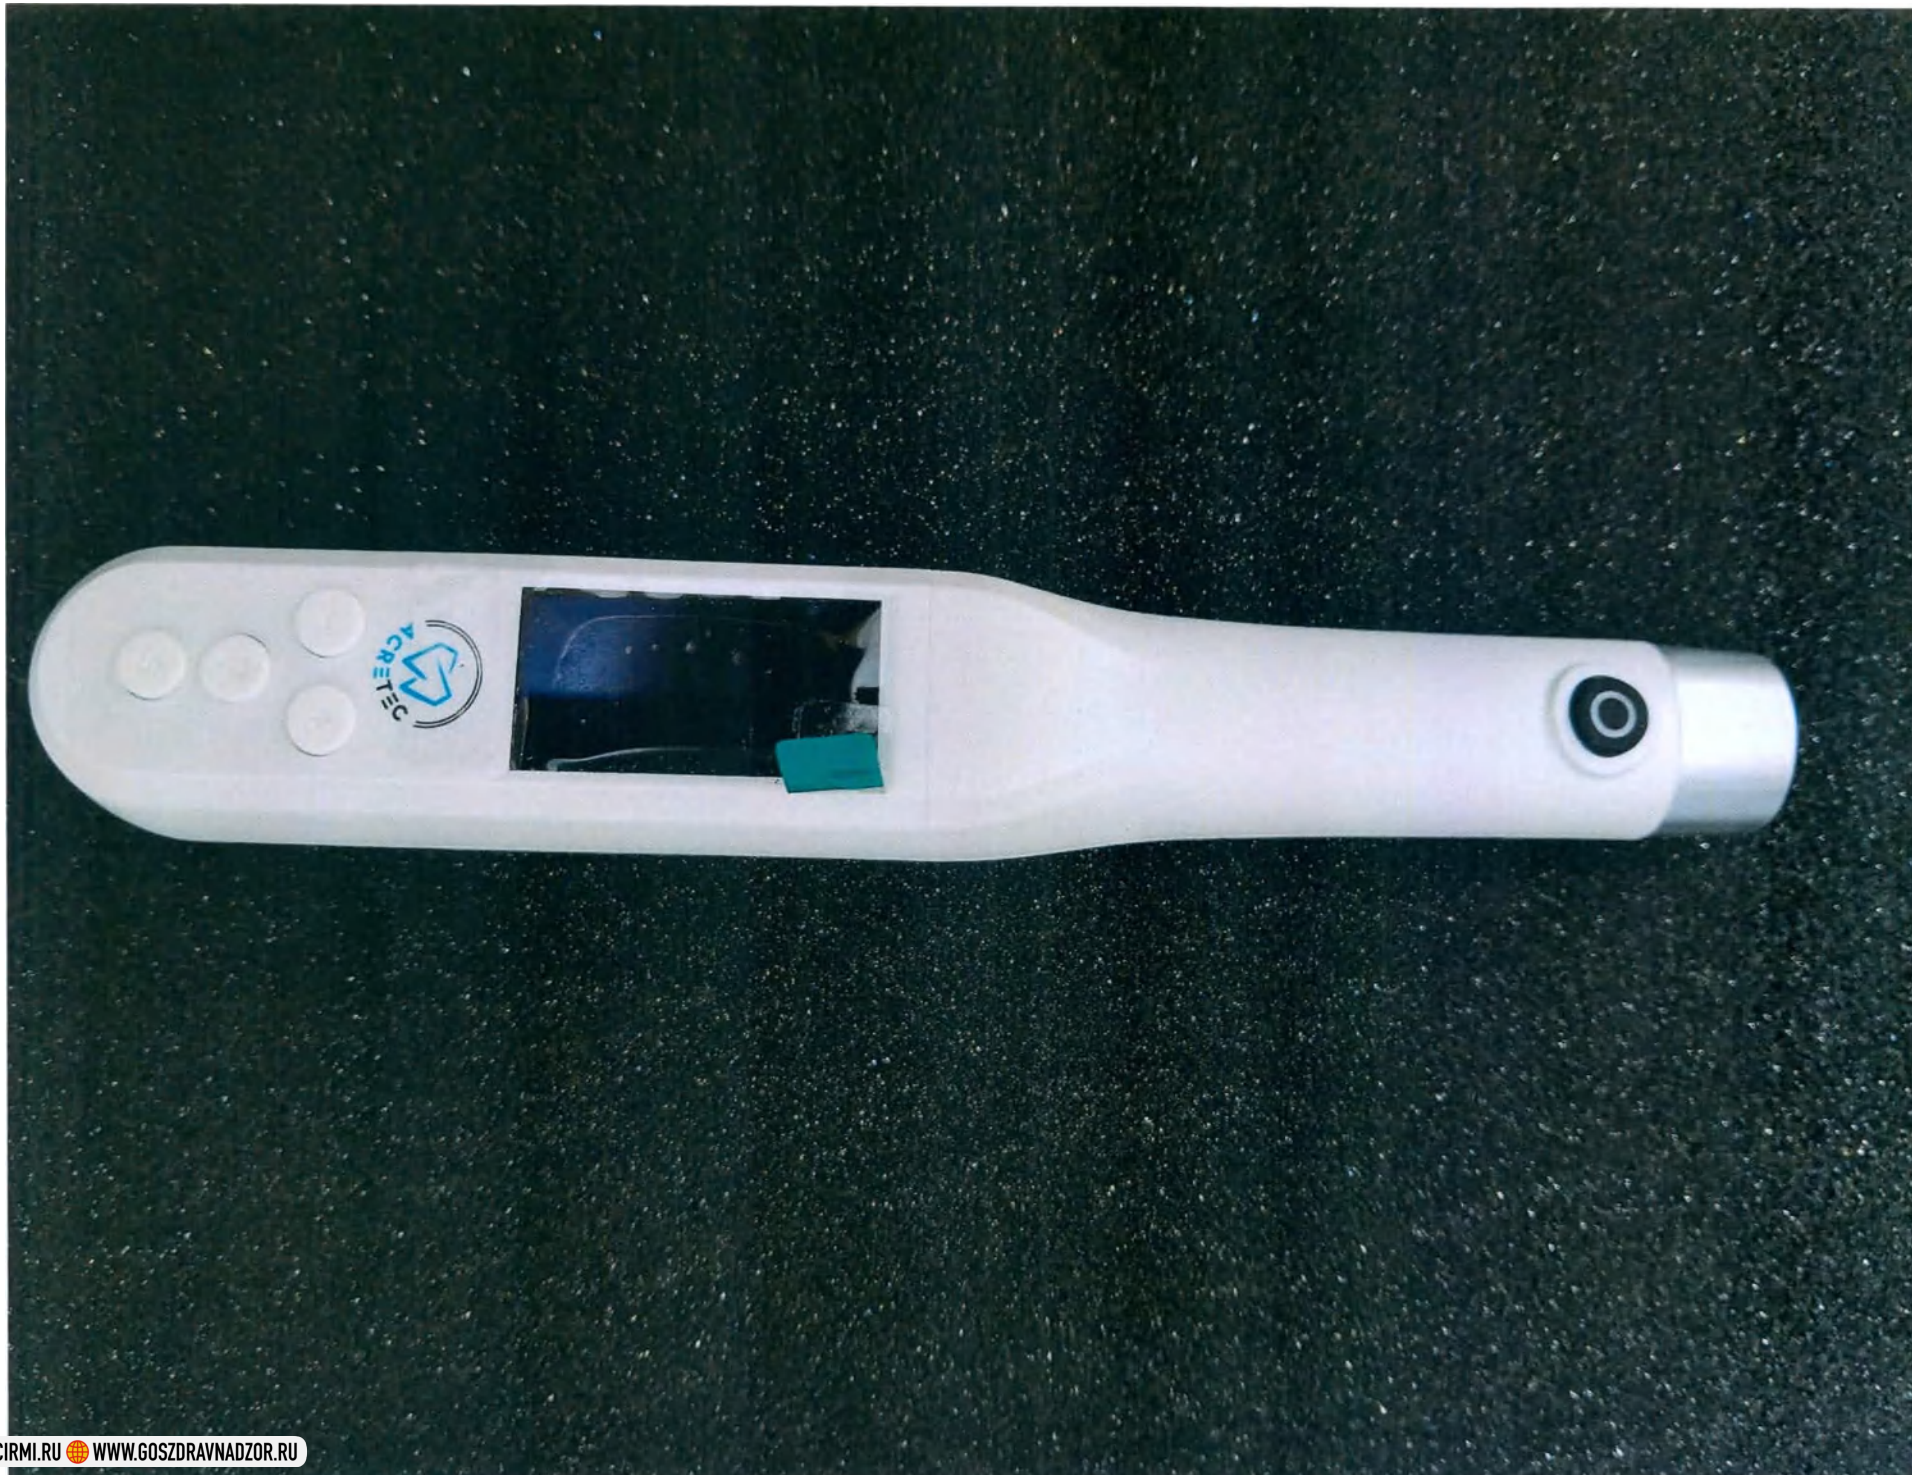

Рукоятка со встроенным микромотором Prime / Вид сзади



Рукоятка со встроенным микро мотором Prime-1 / Вид спереди










Рукоятка со встроенным микромотором Prime и угловой наконечник в сборе

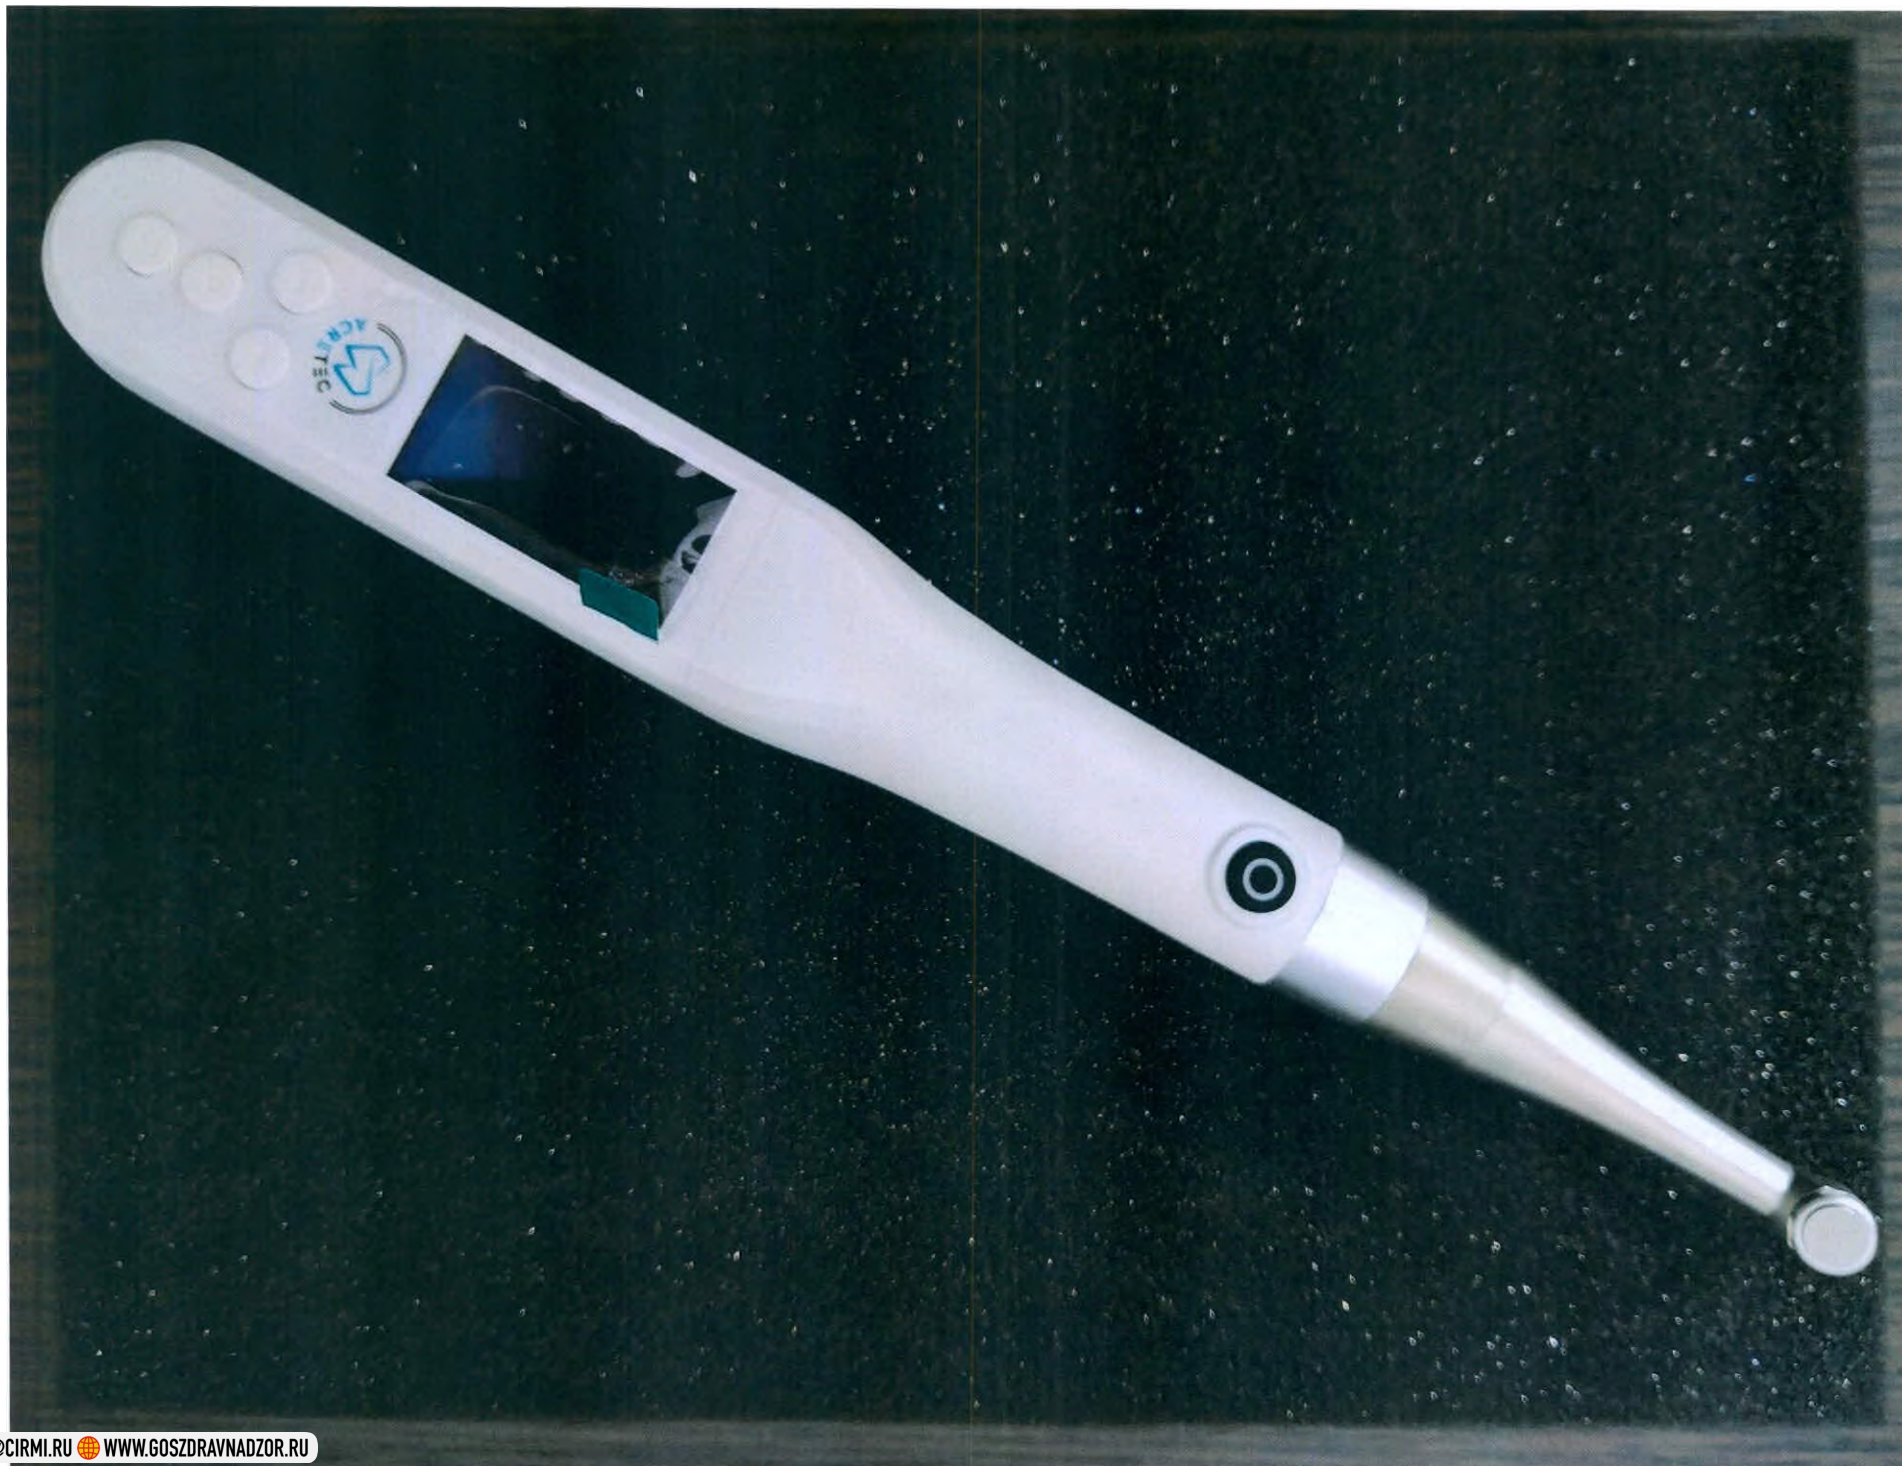

Рукоятка со встроенным микромотором Prime-1 и угловой наконечник в сборе





Измерительный провод





Измерительный провод
для Эндомотора медицинского стоматологического
ACRETEC Prime-1
по ТУ 32.50.11-001-55817550-2022
ПУ № XXXX от XX.XX.XXXX
 R20220920017  ООО "ТорМедТех", 129329,
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1
 20.09.2022



Провод для подключения загубника



Провод для подключения загубника/ Индивидуальная упаковка

Провод для подключения загубника
для Эндомотора медицинского стоматологического
ACRETEC Prime-1
по ТУ 32.50.11-001-55817550-2022
ПУ № XXXX от XX.XX.XXXX



R20220920018



20.09.2022





ООО "ТорМедТех".129329,
г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1


Зажим для файла




Зажим для файла

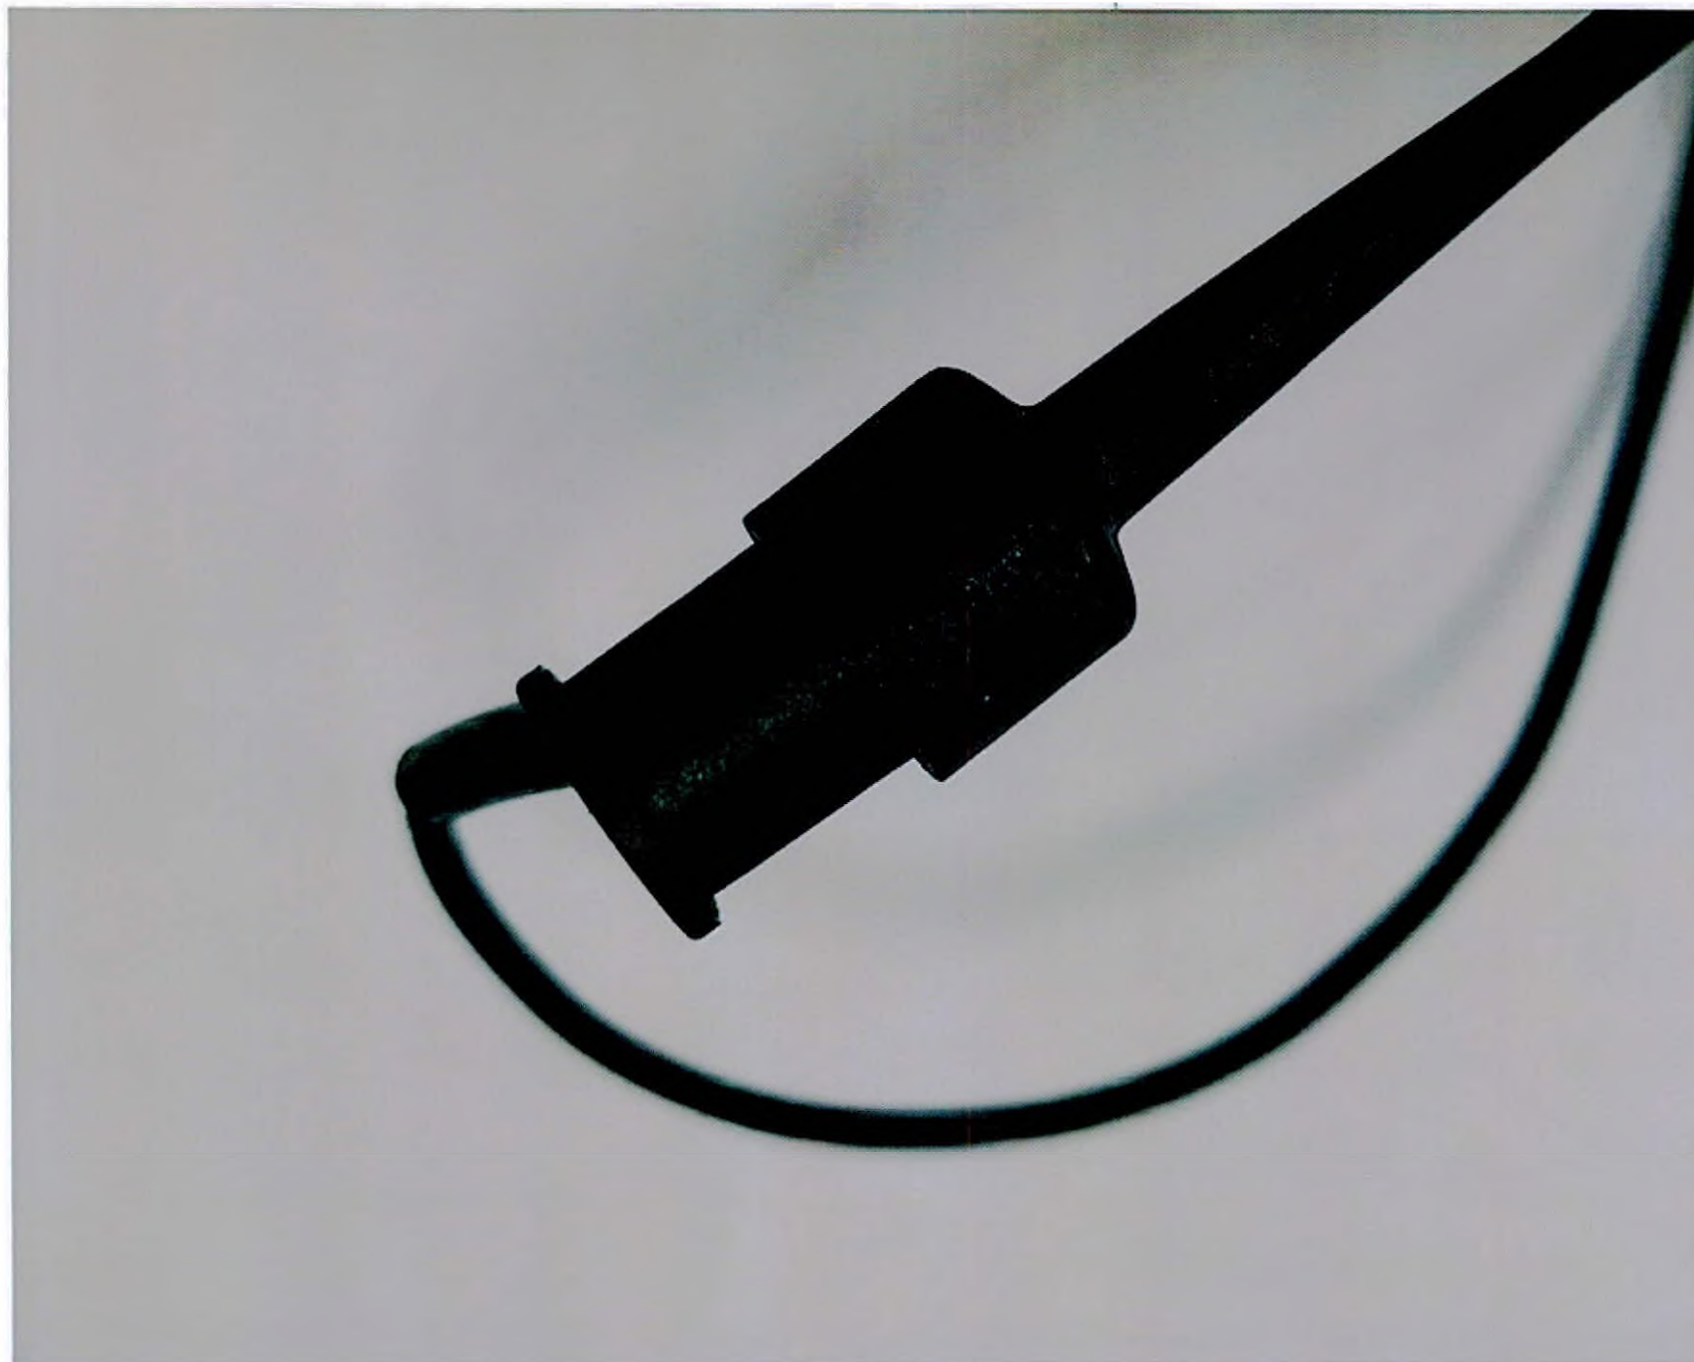


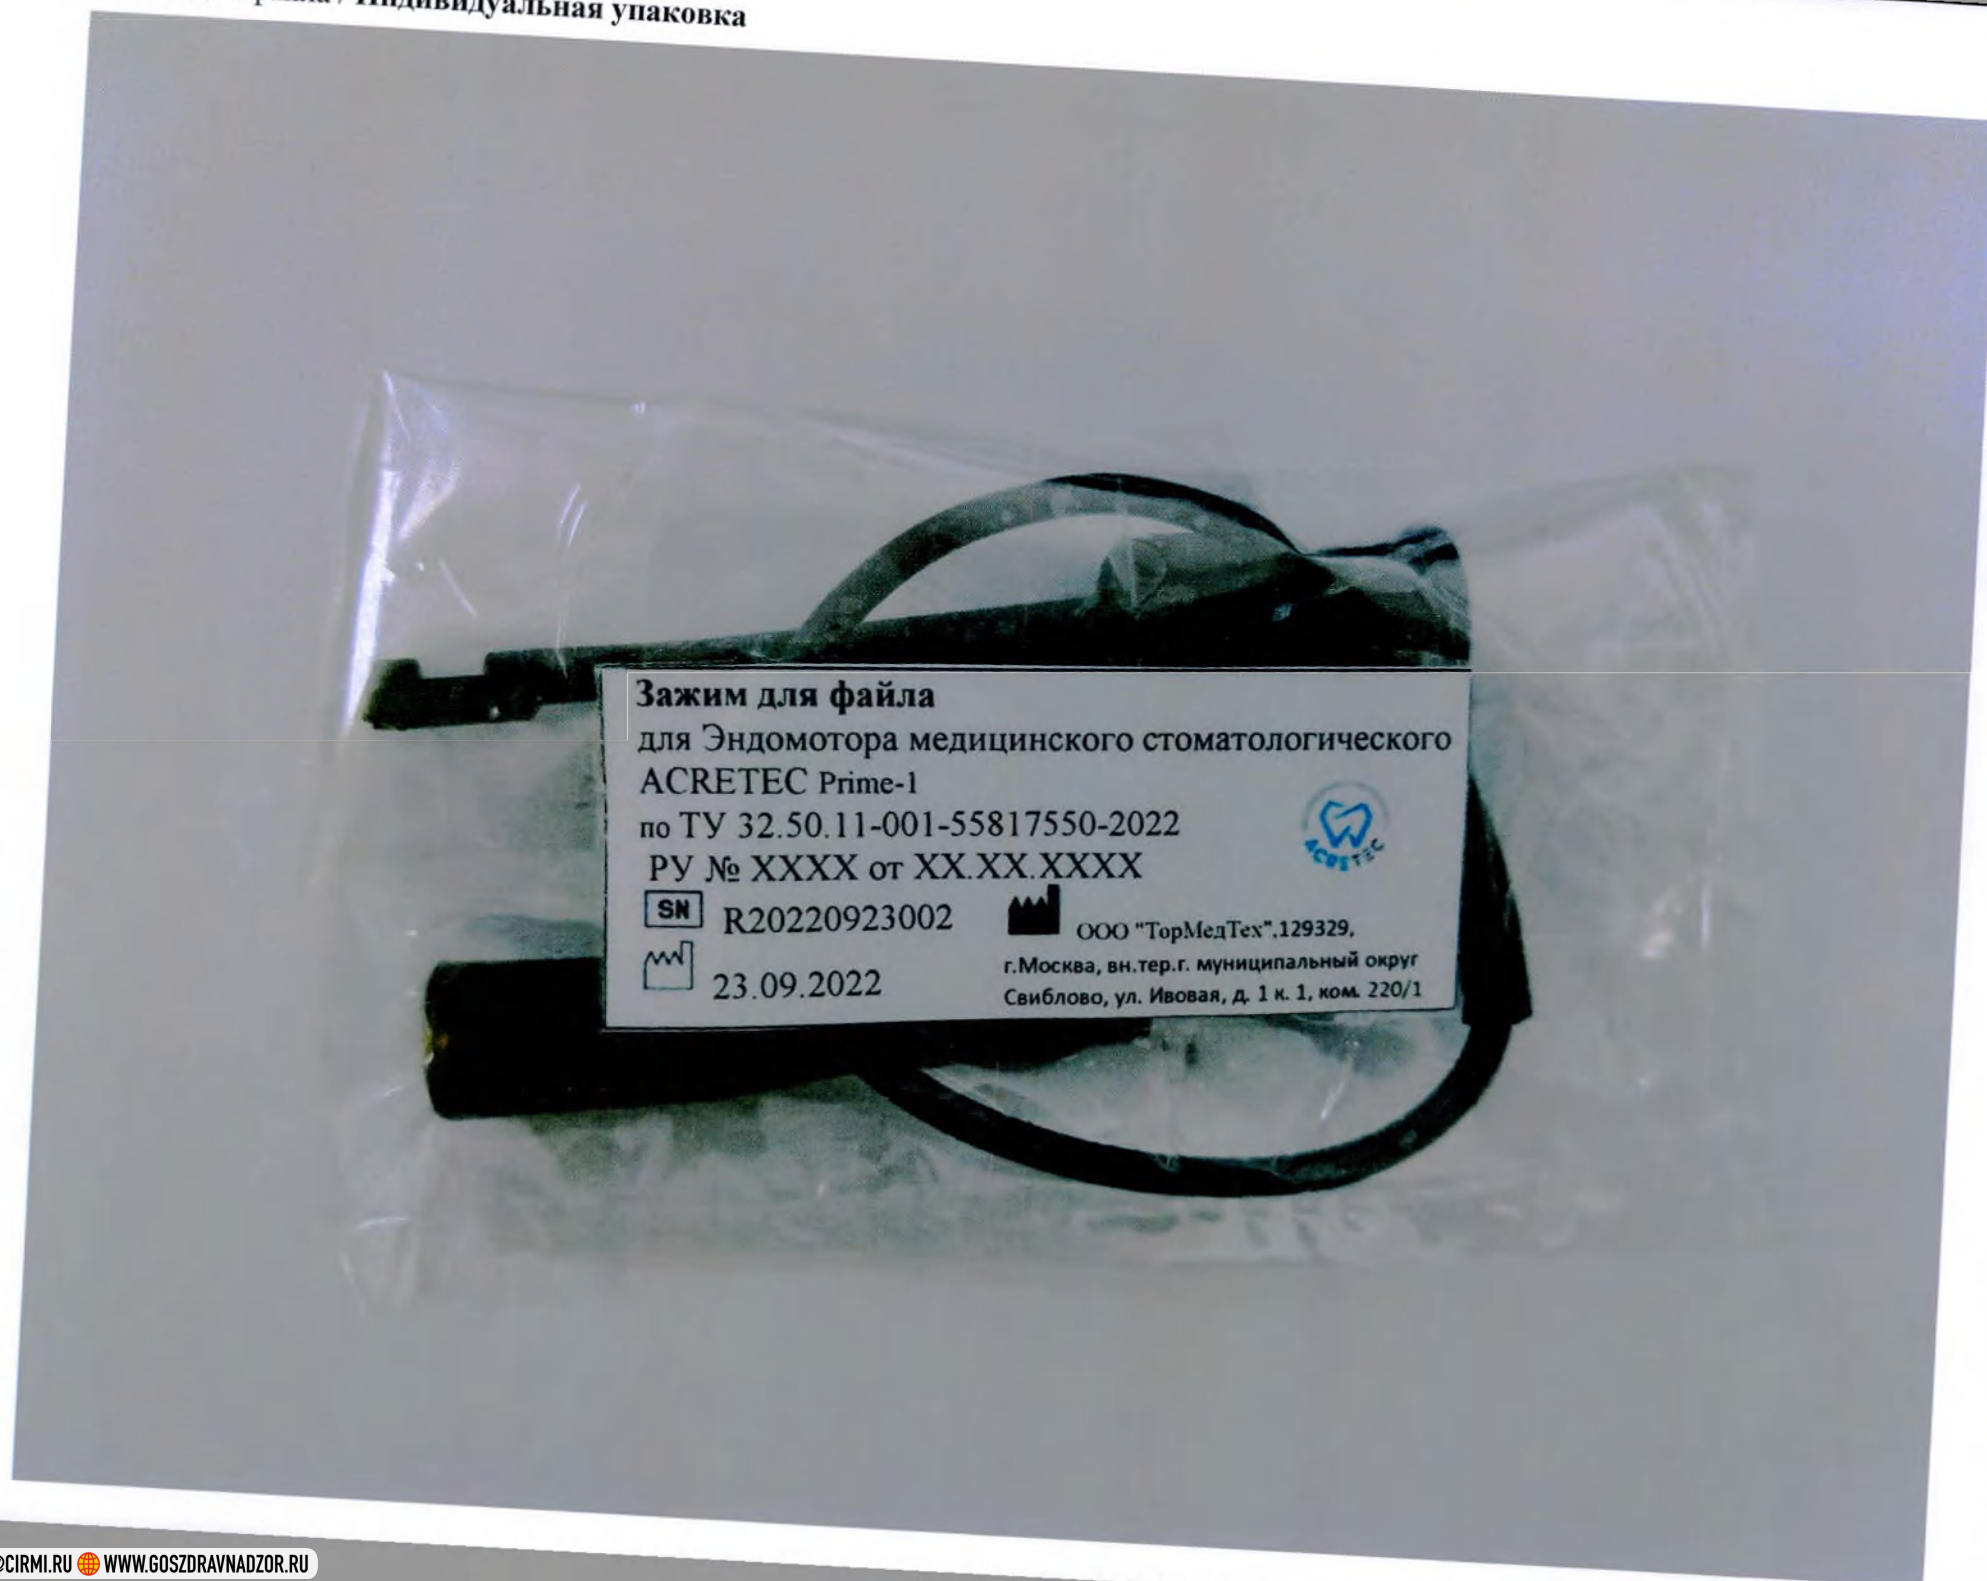

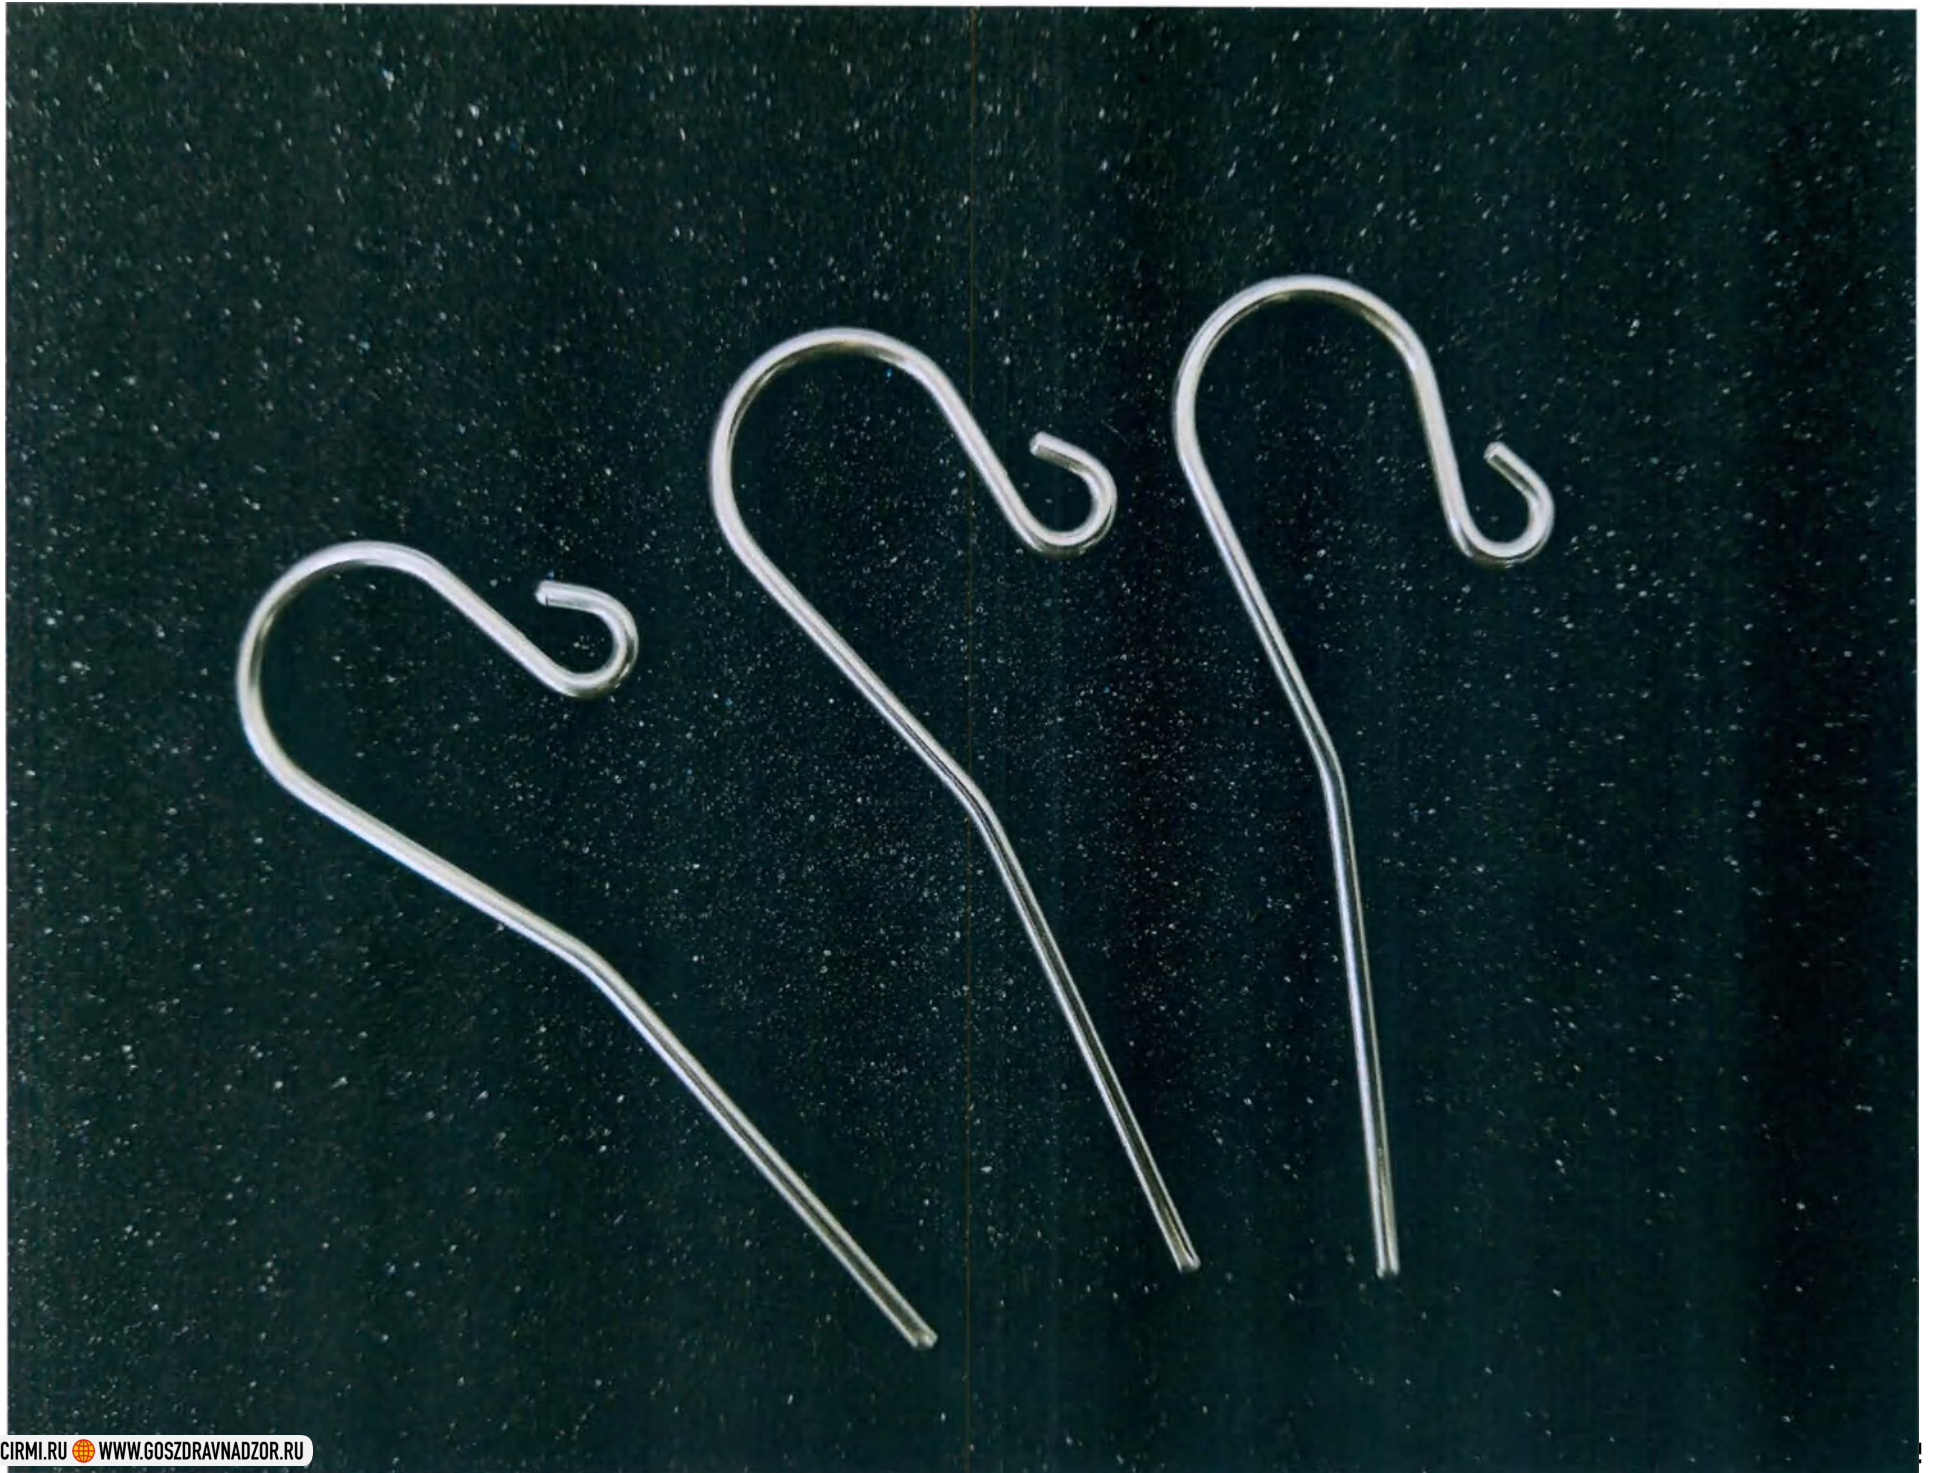

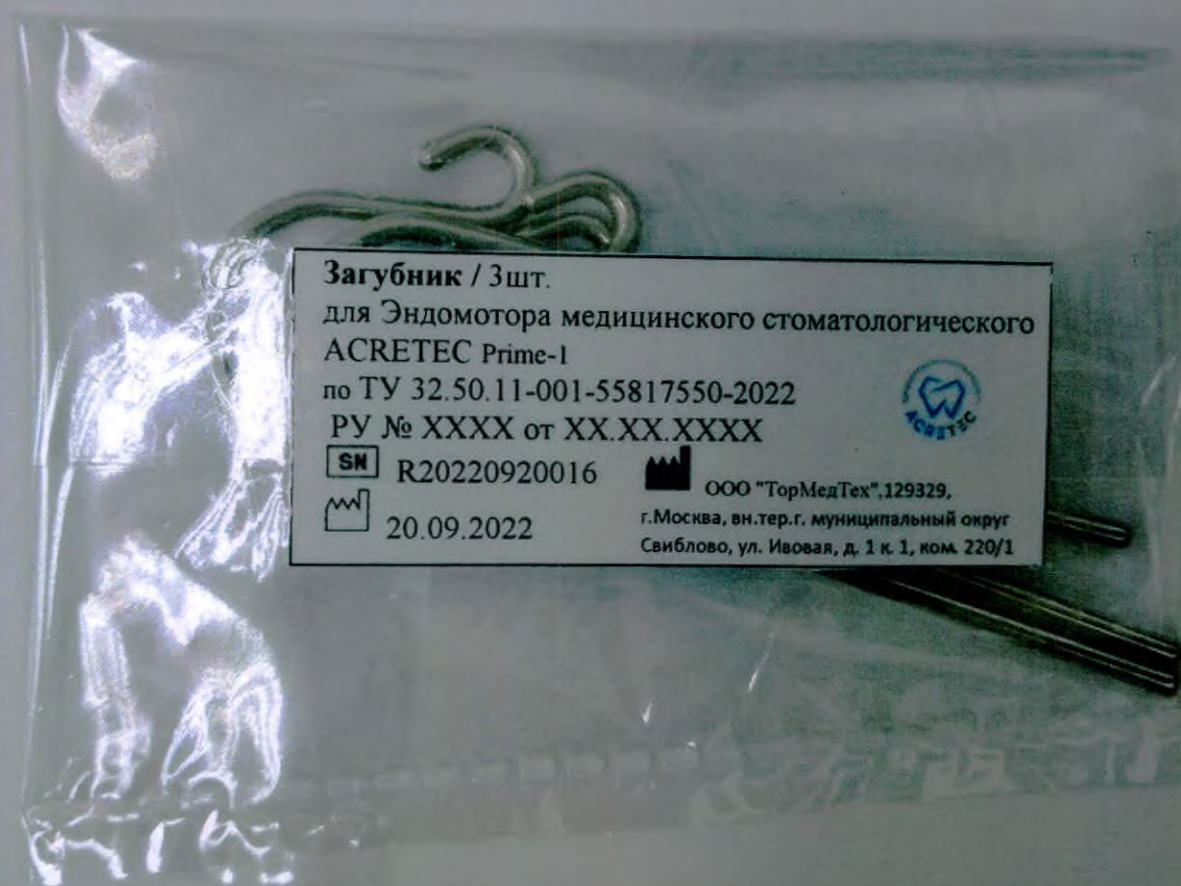


Принадлежности: Распылительная насадка

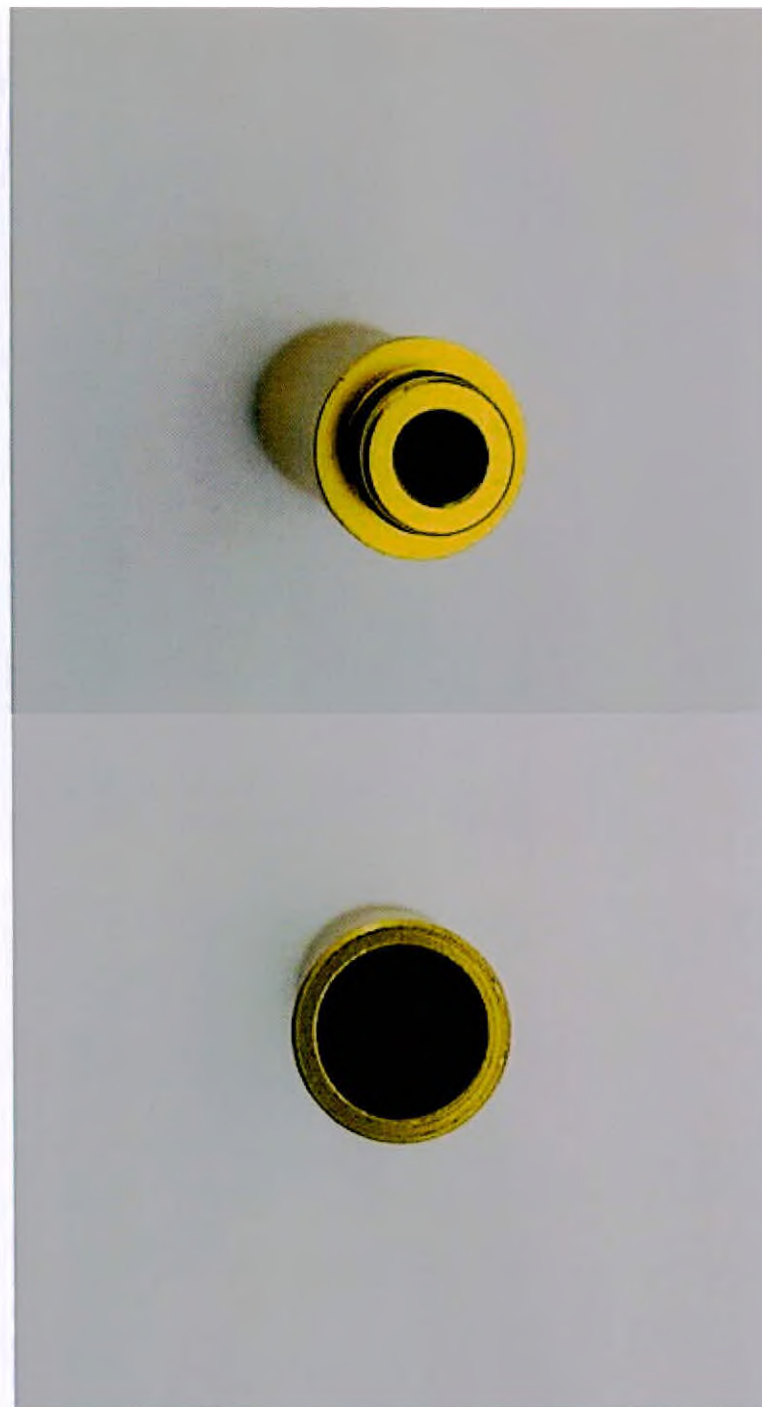

Принадлежности: Распылительная насадка / Индивидуальная упаковка




Принадлежности: Силиконовая подставка

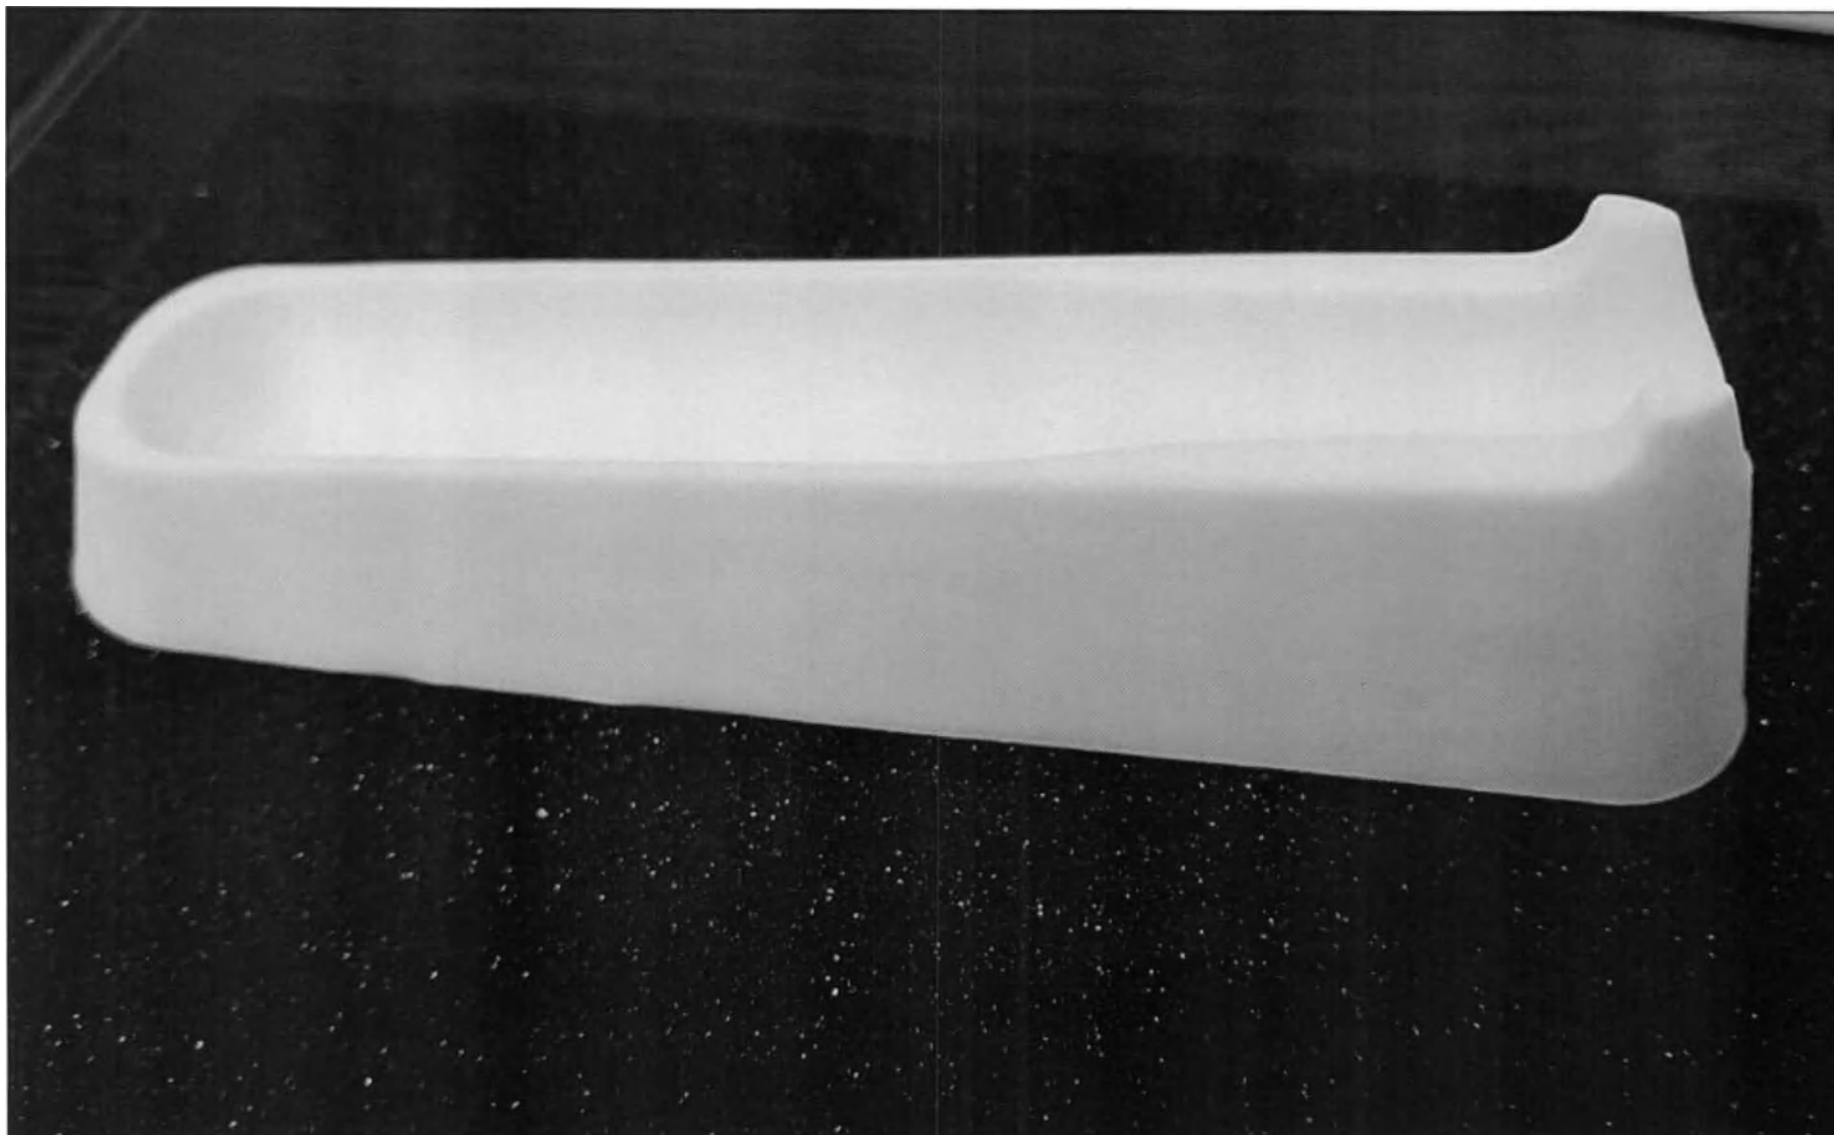

Принадлежности: Силиконовая подставка



Силиконовая подставка
для Эндомотора медицинского стоматологического
ACRETEC Prime/Prime-I
по ТУ 32.50.11-001-55817550-2022
РУ № XXXX от XX.XX.XXXX
SN R20220920011
20.09.2022
ООО "ТорМедТех", 129329,
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Савболово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1

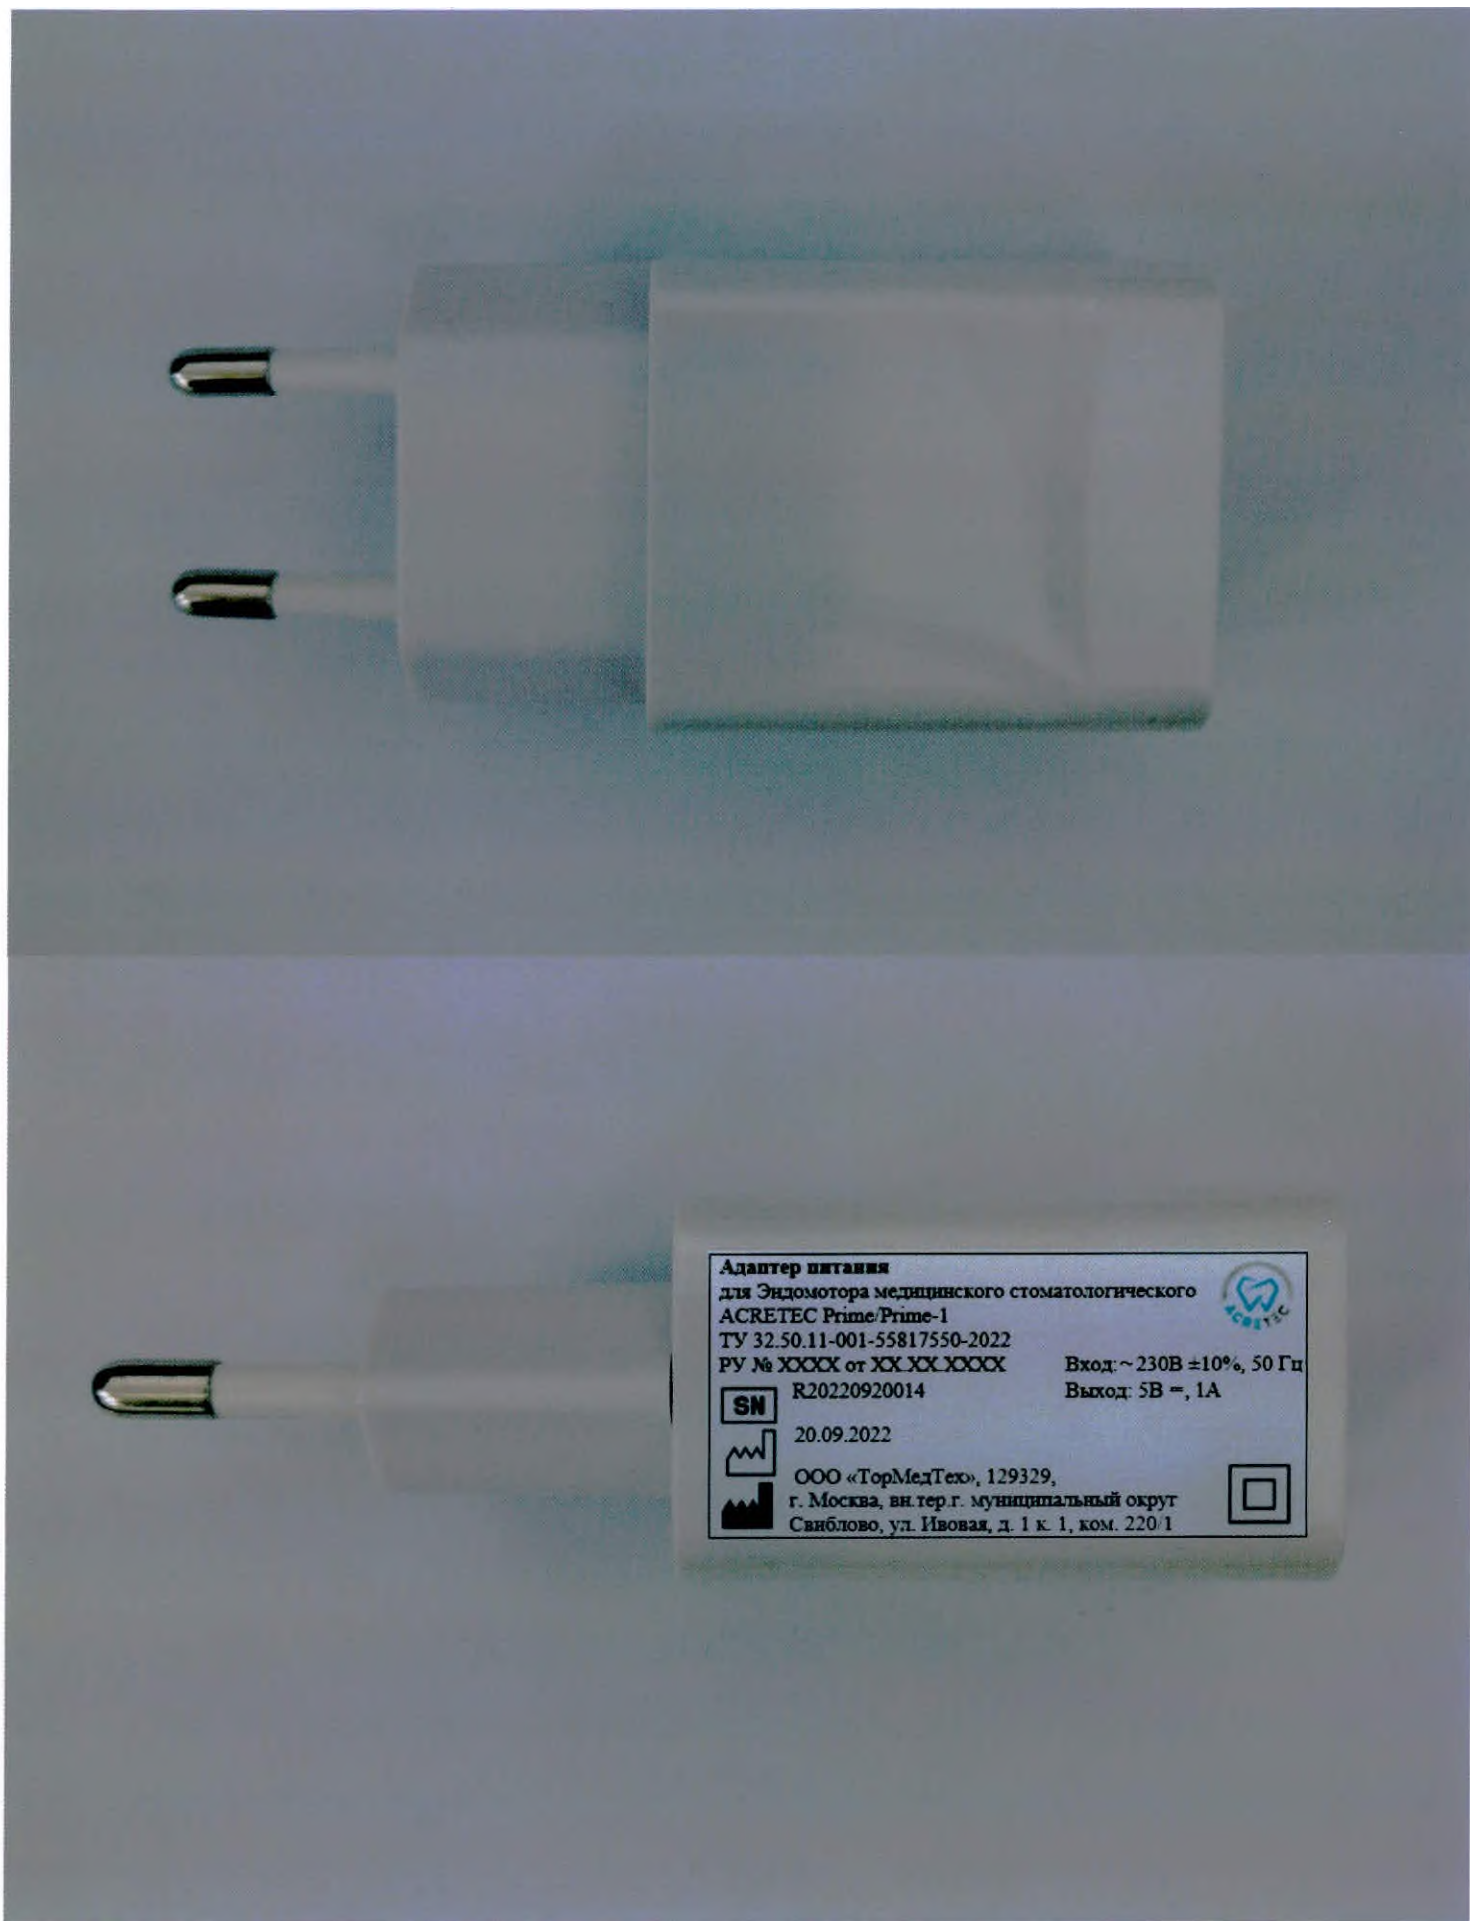



Адаптер питания
для Эндомотора медицинского стоматологического
ACRETEC Prime/Prime-1
по ТУ 32.50.11-001-55817550-2022
ПУ № XXXX от XX.XX.XXXX



R20220920014



20.09.2022



ООО "ТорМедТех". 129329.
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1. ком. 220/1




Принадлежности: USB-кабель





USB-кабель
для Эндомотора медицинского стоматологического
ACRETEC Prime/Prime-1
по ТУ 32.50.11-001-55817550-2022
ПУ № XXXX от XX.XX.XXXX
 R20220920015  ООО "ТорМедТех".129329,
г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Самболово, ул. Ивская, д. 1 к. 1, пом. 220/1
 20.09.2022

Транспортная упаковка.

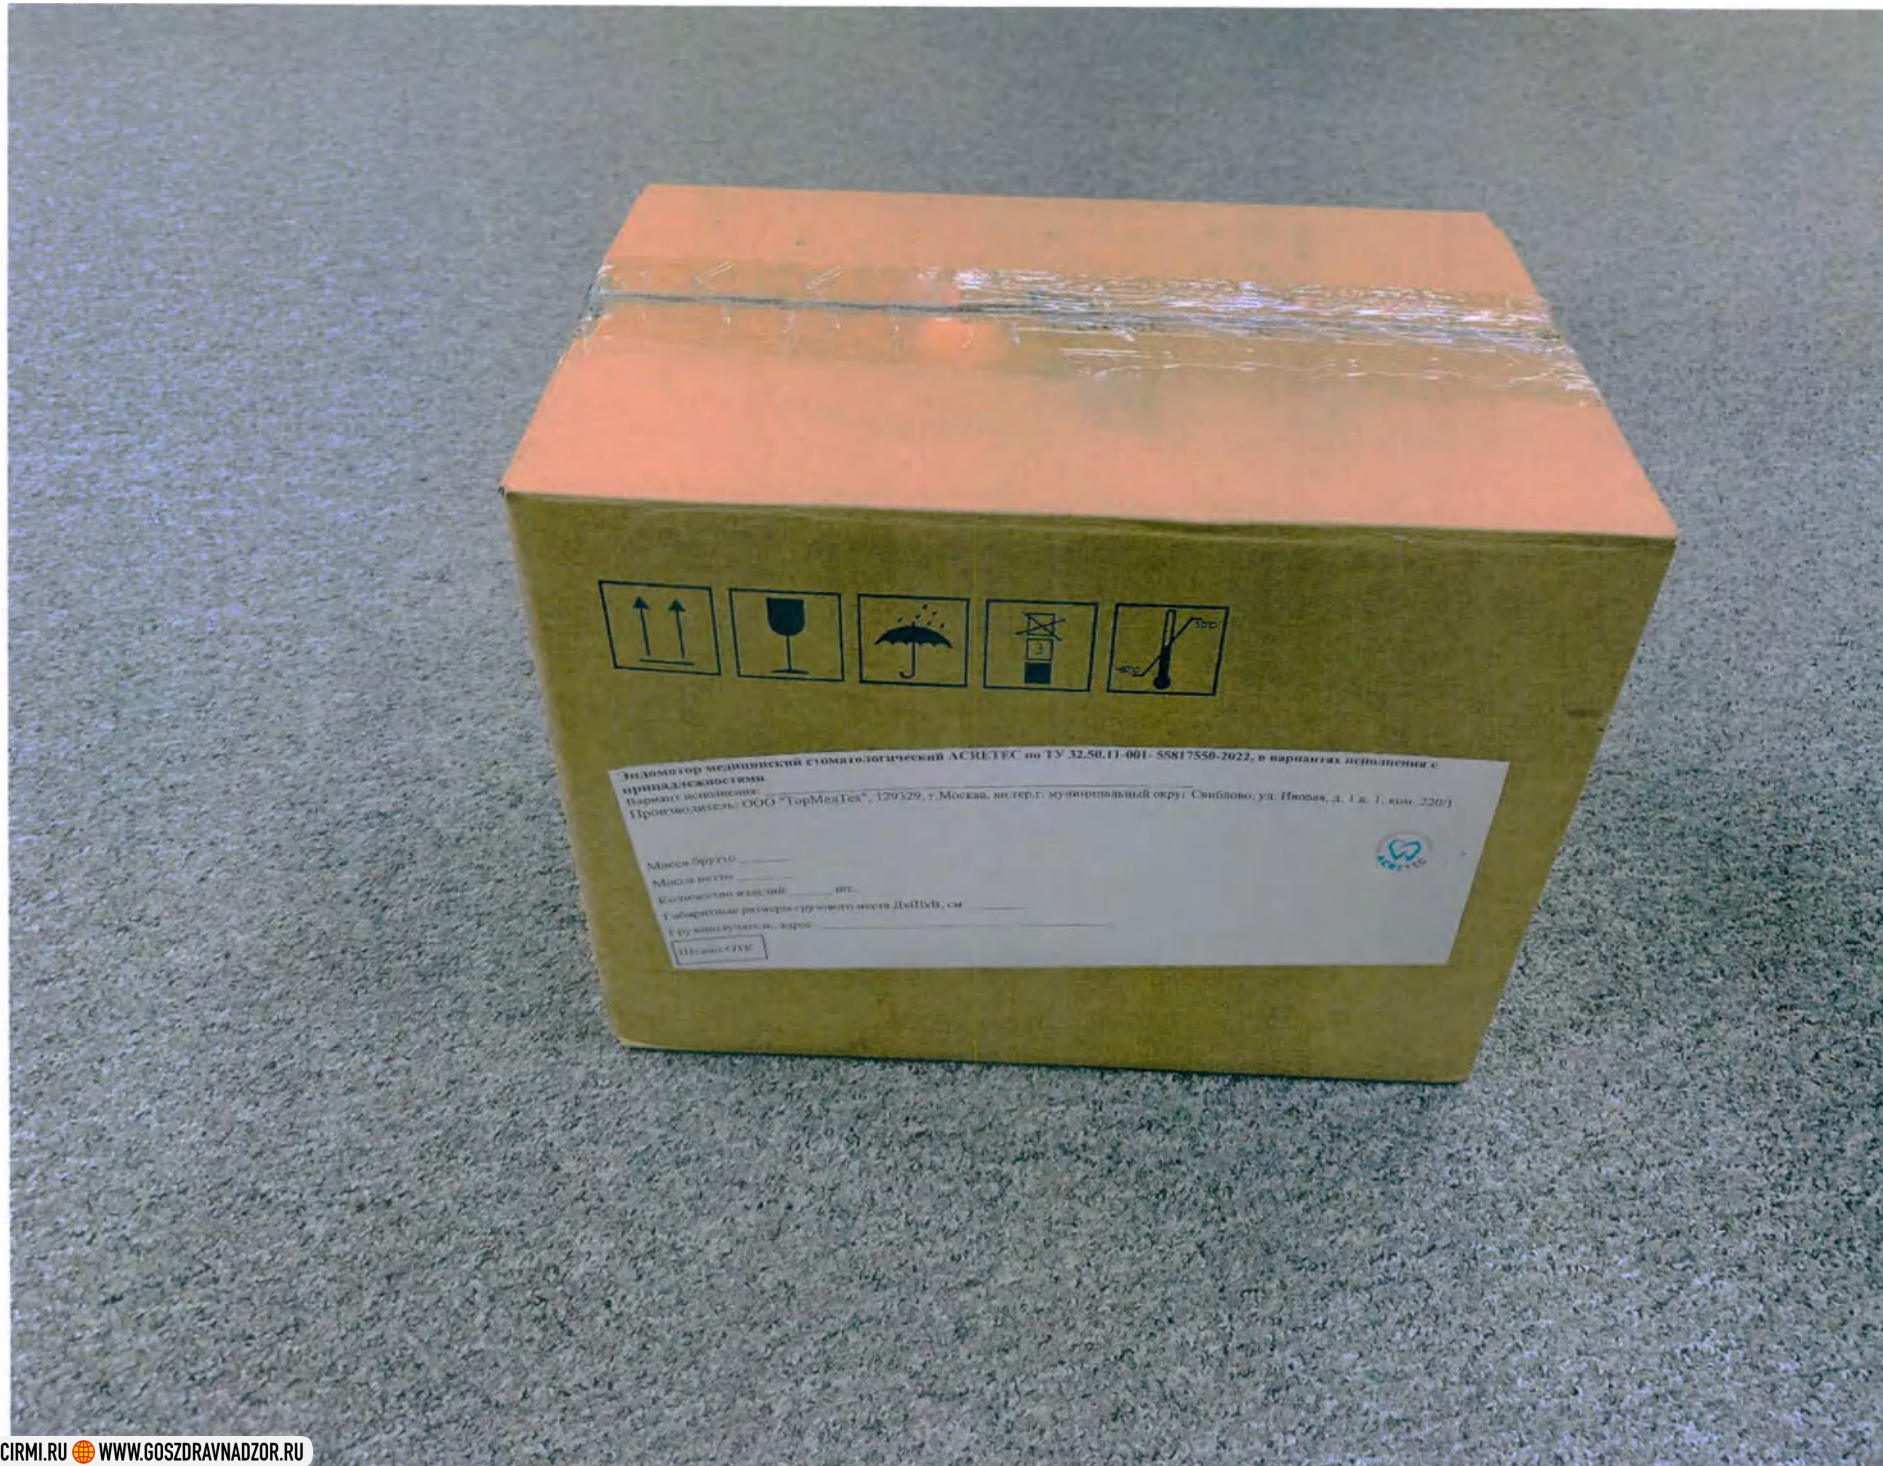

Транспортная упаковка.



Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC по ТУ 32.50.11-001- 55817550-2022, в вариантах исполнения с принадлежностями
Вариант исполнения: _____
Производитель: ООО "ТорМедТех", 129329, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1

Масса брутто _____

Масса нетто _____

Количество изделий _____ шт.

Габаритные размеры грузового места ДхШхВ, см _____

Грузополучатель, адрес: _____

Штамп ОТК



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
33 листах



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "ТорМедТех"

Д.А. Трегубов

16 » мая 2022 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ



Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC

по ТУ 32.50.11-001- 55817550-2022,

в вариантах исполнения с принадлежностями


Маркировка изделия

Рукоятка со встроенным микромотором Prime/Prime-1

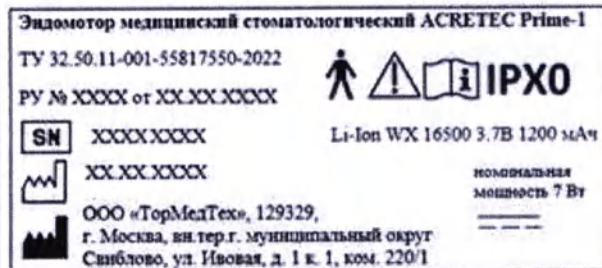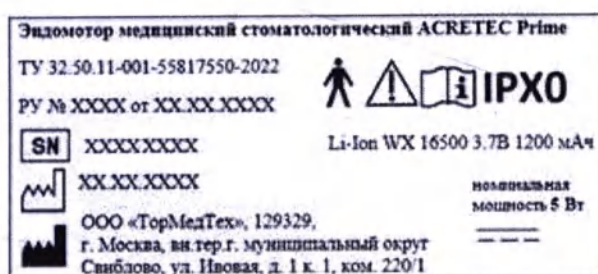


Угловой наконечник


1:1
/серийный номер/



Угловой наконечник (Индивидуальная упаковка)

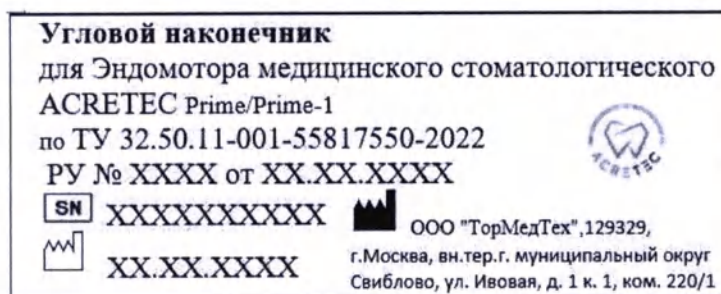

Загубник (Индивидуальная упаковка)

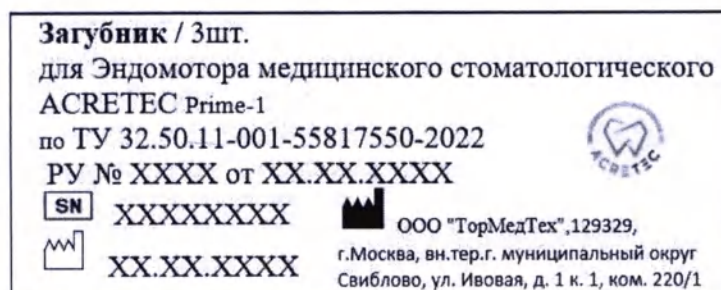

Провод для подключения загубника (Индивидуальная упаковка)

Провод для подключения загубника для Эндомотора медицинского стоматологического ACRETEC Prime-1 по ТУ 32.50.11-001-55817550-2022 РУ № XXXX от XX.XX.XXXX			
 SN	XXXX		 ООО "ТорМедТех", 129329, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1
	XX.XX.XXXX		

Зажим для файла



Зажим для файла (Индивидуальная упаковка)

Зажим для файла для Эндомотора медицинского стоматологического ACRETEC Prime-1 по ТУ 32.50.11-001-55817550-2022 РУ № XXXX от XX.XX.XXXX			
 SN	XXXXXXXX		 ООО "ТорМедТех", 129329, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1
	XX.XX.XXXX		

Измерительный провод (Индивидуальная упаковка)

Измерительный провод для Эндомотора медицинского стоматологического ACRETEC Prime-1 по ТУ 32.50.11-001-55817550-2022 РУ № XXXX от XX.XX.XXXX			
 SN	XXXXXXXX		 ООО "ТорМедТех", 129329, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1
	XX.XX.XXXX		

Маркировка принадлежностей

Распылительная насадка (Индивидуальная упаковка)

Распылительная насадка
для Эндомотора медицинского стоматологического
ACRETEC Prime/Prime-1
по ТУ 32.50.11-001-55817550-2022
РУ № XXXX от XX.XX.XXXX

 XXXX
 XX.XX.XXXX

 ООО "ТорМедТех", 129329,
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1



Адаптер питания

Адаптер питания
для Эндомотора медицинского стоматологического
ACRETEC Prime/Prime-1
ТУ 32.50.11-001-55817550-2022
РУ № XXXX от XX.XX.XXXX

 XXXXXXXX
 XXXXXXXX

 ООО «ТорМедТех», 129329,
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1

Вход: ~230В ±10%, 50 Гц
Выход: 5В ~, 1А



Адаптер питания (Индивидуальная упаковка)

Адаптер питания
для Эндомотора медицинского стоматологического
ACRETEC Prime/Prime-1
по ТУ 32.50.11-001-55817550-2022
РУ № XXXX от XX.XX.XXXX

 XXXX
 XX.XX.XXXX

 ООО "ТорМедТех", 129329,
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1



USB-кабель (Индивидуальная упаковка)

USB-кабель
для Эндомотора медицинского стоматологического
ACRETEC Prime/Prime-1
по ТУ 32.50.11-001-55817550-2022
РУ № XXXX от XX.XX.XXXX

 XXXX
 XX.XX.XXXX

 ООО "ТорМедТех", 129329,
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1



Силиконовая подставка

Силиконовая подставка
для Эндомотора медицинского стоматологического
ACRETEC Prime/Prime-1
по ТУ 32.50.11-001-55817550-2022
РУ № XXXX от XX.XX.XXXX

 XXXX
 XX.XX.XXXX

 ООО "ТорМедТех", 129329,
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1



Маркировка потребительской упаковки

Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC
по ТУ 32.50.11-001- 55817550-2022,
в варианте исполнения с принадлежностями:



Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC Prime

Срок службы – 4 года.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

РУ № XXXX от XX.XX.XXXX

SN XXXXXXXXXX

 XX.XX.XXXX




ООО "ТорМедТех",

129329, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово,
ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1

Телефон: +7 495-790-24-30

Эл. почта: acretec@tormt.ru

Сайт: www.tormt.ru



-10 °C



+55 °C

Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC
по ТУ 32.50.11-001- 55817550-2022,
в варианте исполнения с принадлежностями:



**Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC
Prime-1**

Срок службы – 4 года.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

РУ № XXXX от XX.XX.XXXX

 XXXXXXXXXX

 XX.XX.XXXX



ООО "ТорМедТех",

129329, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово,
ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1

Телефон: +7 495-790-24-30

Эл. почта: acretec@tormt.ru

Сайт: www.tormt.ru



Маркировка транспортной упаковки

Эндомотор медицинский стоматологический ACRETEC по ТУ 32.50.11-001- 55817550-2022, в вариантах исполнения с принадлежностями

Вариант исполнения: _____

Производитель: ООО "ТорМедТех", 129329, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово, ул. Ивовая, д. 1 к. 1, ком. 220/1

Масса брутто _____

Масса нетто _____

Количество изделий _____ шт.

Габаритные размеры грузового места ДхШхВ, см _____

Грузополучатель, адрес: _____

Штамп ОТК



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
_____ 7 _____ листах

