

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

декабрь 2022 г.



Фотографические изображения изделия:

Калибратор гематологический (Hematology Calibrator) для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro

**Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.»), Китай**

HEMATOLOGY CALIBRATION

DM-CAL PLUS

LOT N0072208

2022-06-01


2022-06-01



Attention:

1. POTENTIAL
2. Protect
3. This product but still can't should be

EC REP

100 Floor

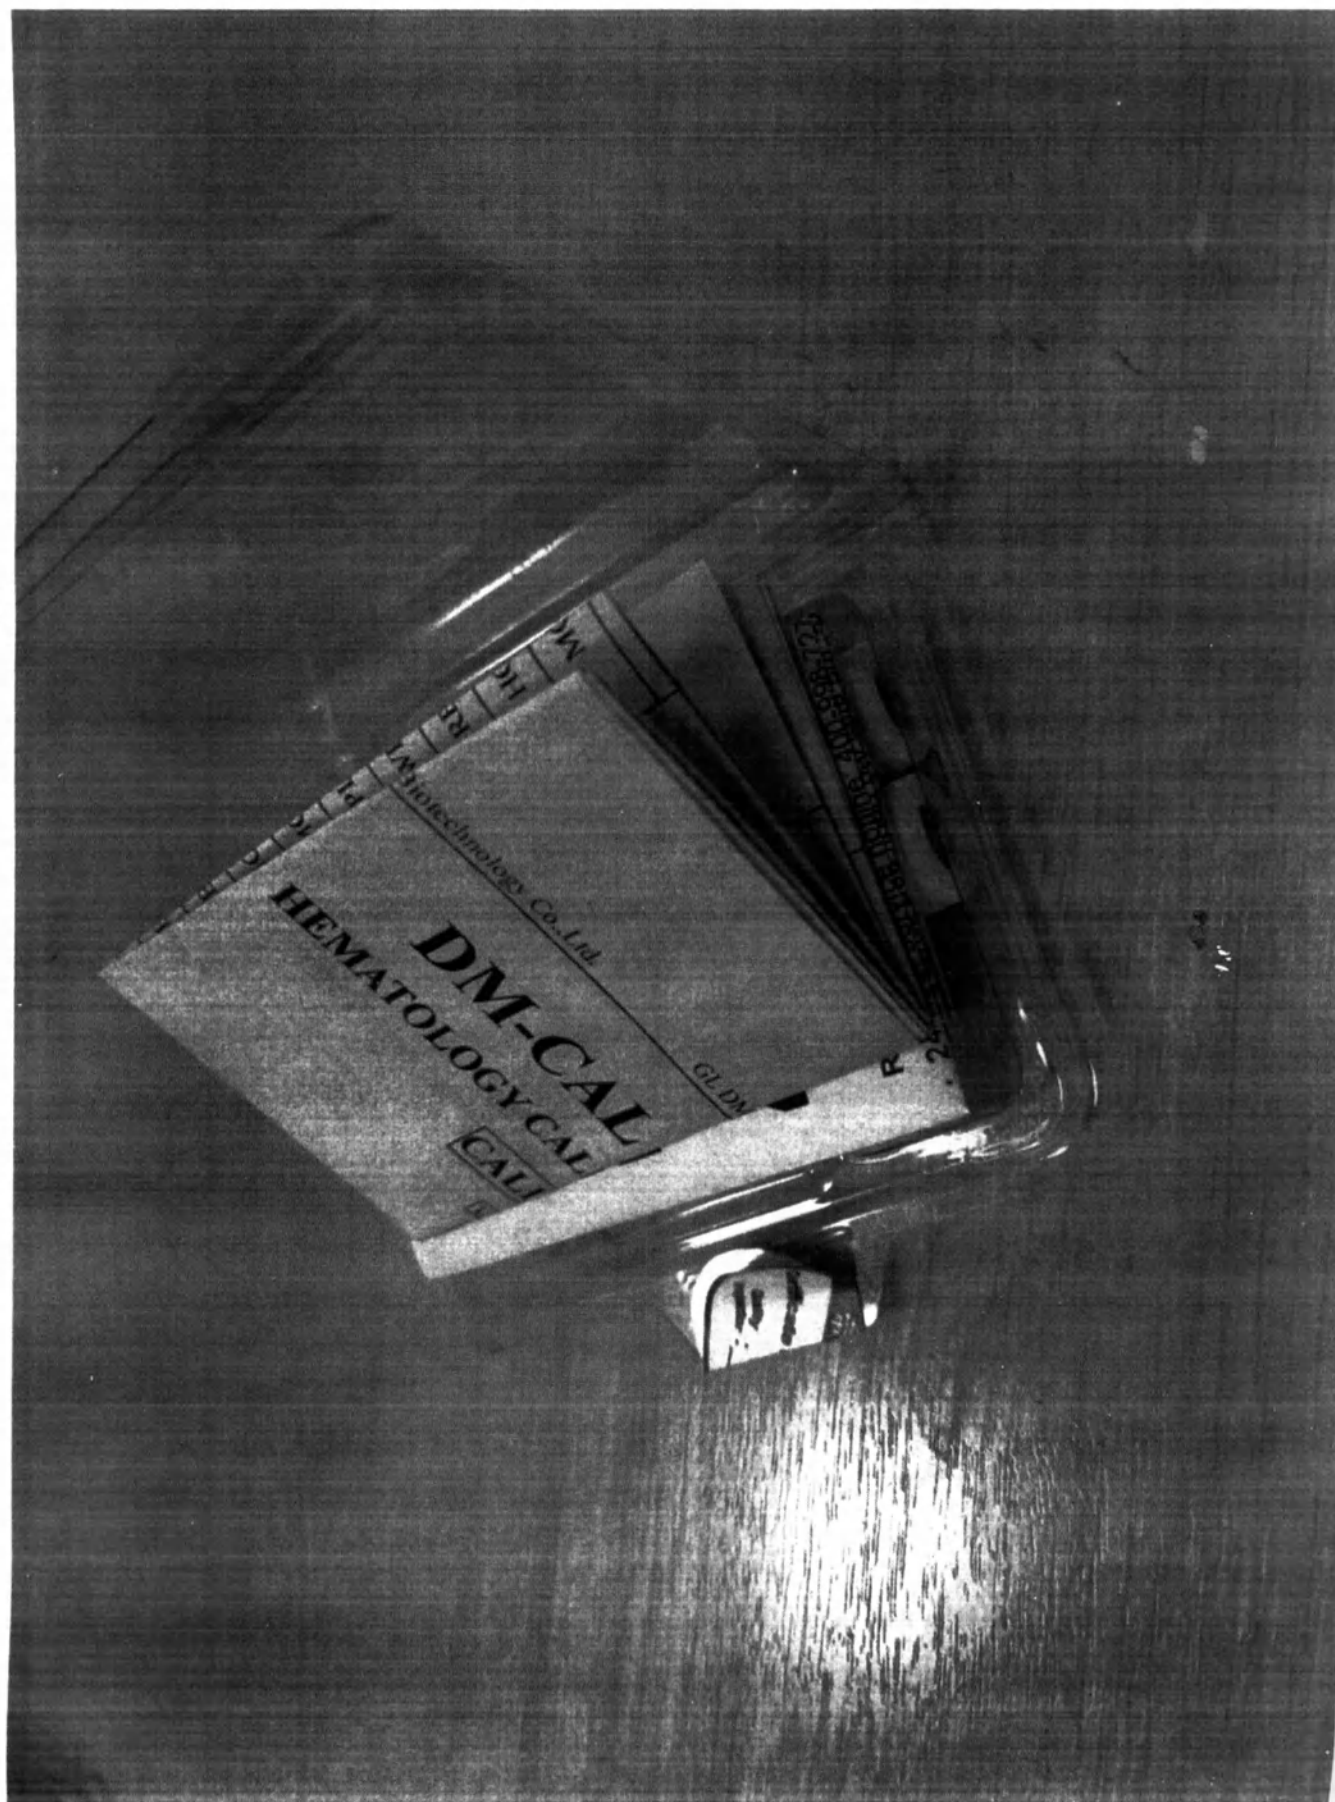

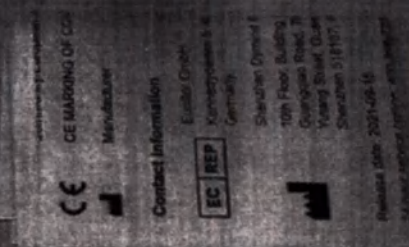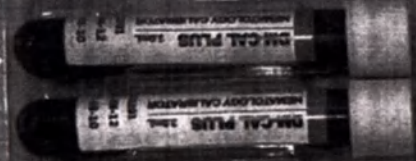

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

CE 1114-05-02 on VK2.0

DM-CAL PLUS

HEMATOLOGY CALIBRATOR

CALIBRATOR

Reference Values provided by DYMIND


UNKNK082201

2022-07-12

2022-09-09

Applicable Instruments	Parameter	Unit	Reference Value
UN71, UN73, UN76, D173 (Technical File Version A1.3 or higher)	WBC	$10^9/L$	9.91
	RBC	$10^{12}/L$	4.61
	HGB	g/L	136
	HCT	$%$	35.2
	PLT	$10^9/L$	259
D150, D151, D152 D153, D155, D156 (Technical File Version A1.3 or higher)	WBC	$10^9/L$	9.45
	RBC	$10^{12}/L$	4.61
	HGB	g/L	132
	HCT	$%$	33.1

Общий вид медицинского изделия (Калибратор гематологический (Hematology Calibrator) для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения 2×3,0 мл)

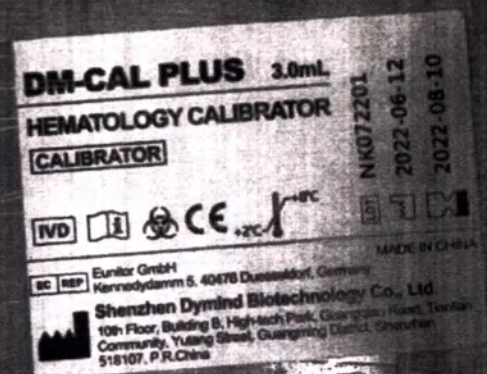

Калибратор (Калибратор гематологический (Hematology Calibrator) для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических

гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения 2×3,0 мл)
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 5 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

