

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

28 февраля 2023 г.




ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 1754197
КУСАЙЛО Р.В.


Фотографические изображения изделия:

**Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для
диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2))**

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd., («Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.»),
Китай



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYD-2, 200 мл

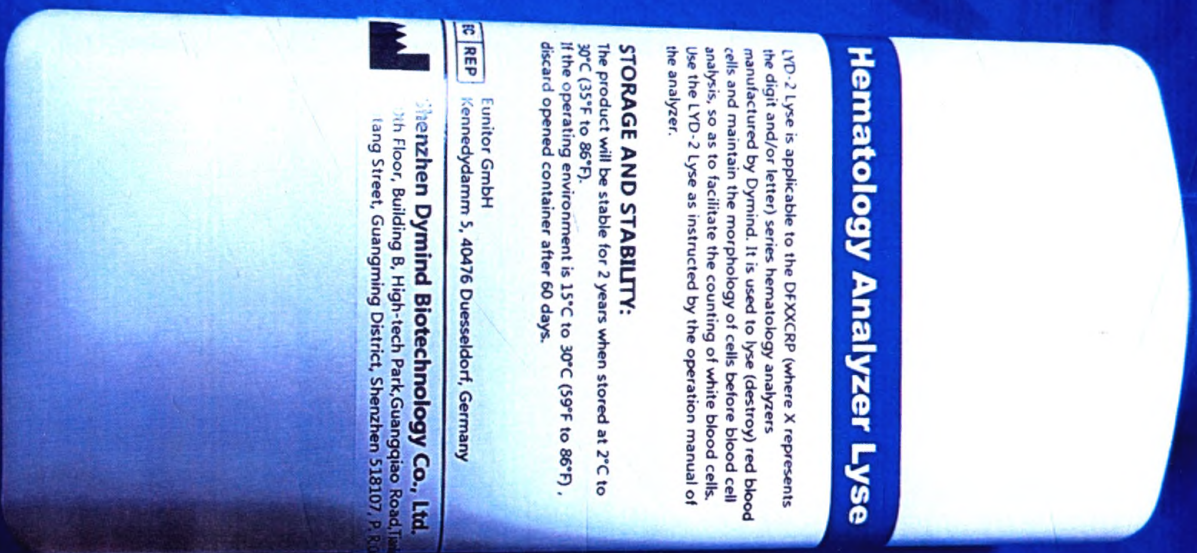

Hematology Analyzer Lyse

LYD-2 Lyse is applicable to the DEXXCRP (where X represents the digit and/or letter) series hematology analyzers manufactured by Dymind. It is used to lyse (destroy) red blood cells and maintain the morphology of cells before blood cell analysis, so as to facilitate the counting of white blood cells. Use the LYD-2 Lyse as instructed by the operation manual of the analyzer.

STORAGE AND STABILITY:

The product will be stable for 2 years when stored at 2°C to 30°C (35°F to 86°F).
If the operating environment is 15°C to 30°C (59°F to 86°F), discard opened container after 60 days.



REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476 Dueseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
3th Floor, Building B, High-tech Park, Guangdong Road, Jia
Lang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China


Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYD-2, 200 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYD-2, 200 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYD-2, 200 мл

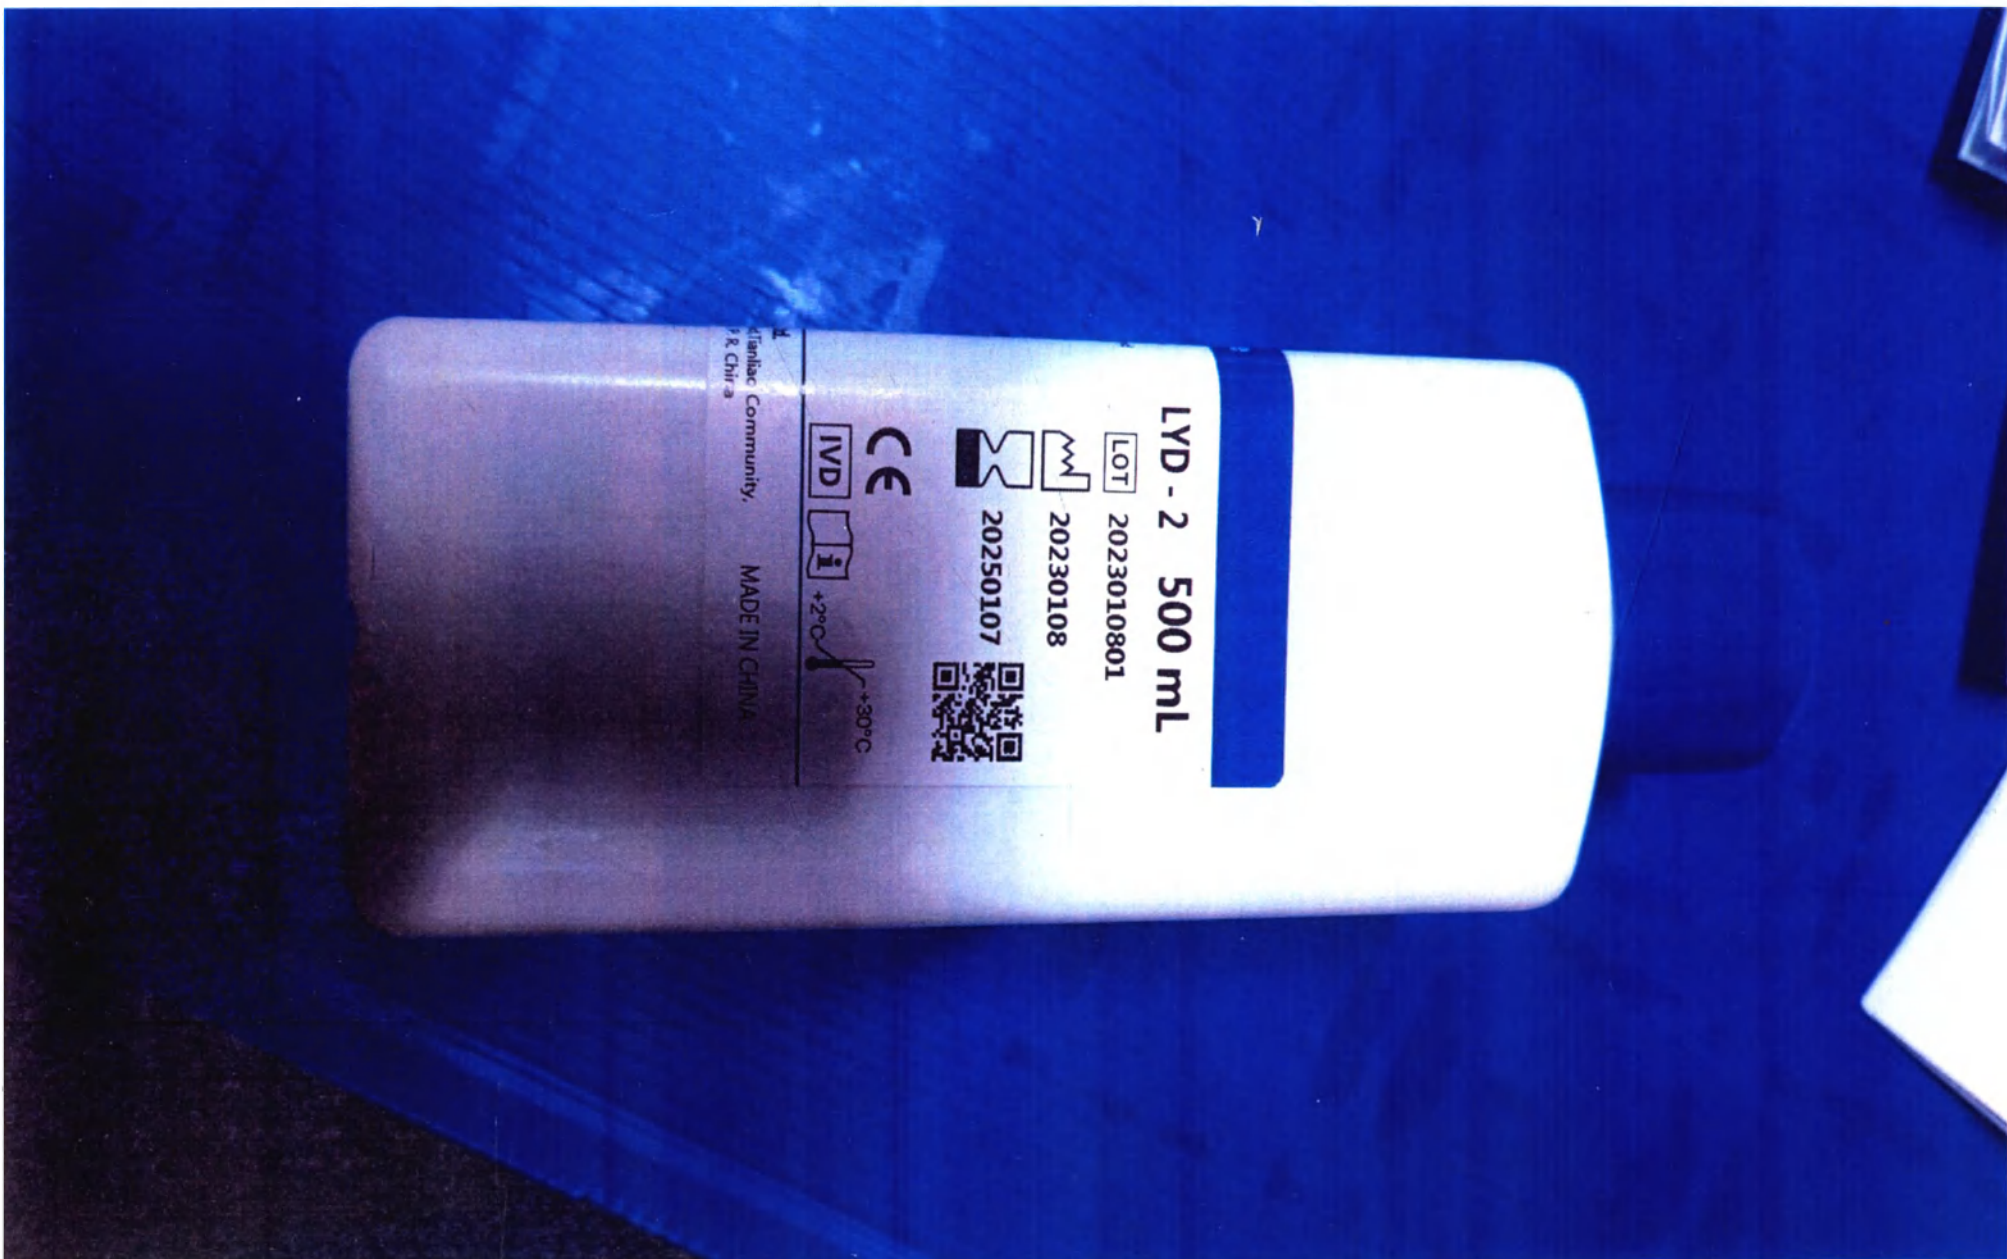

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYD-2, 500 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYD-2, 500 мл



WARNINGS:

1. Avoid skin or eye contact. In case of skin or eye contact, flush the affected area with plenty of water immediately and go see a doctor. In case of inhaling, immediately go see a doctor.
2. Finish product before the expiration date. Once it is opened, it should be finished within 60 days.
3. If product is frozen (either partially or completely), thaw completely, warm to room temperature and mix thoroughly by gentle inversion. Verify background results before analyzing patient samples.
4. Dispose of waste product in accordance with governmental requirements.

ACTIVE INGREDIENTS:

Surface active agent; Buffering agent; Antifungal and antibacterial Agents.

EC

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYD-2, 500 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYD-2, 500 мл



DYMIND

WARNINGS:

1. Avoid skin or eye contact. In case of skin or eye contact, flush the affected area with plenty of water immediately and go see a doctor. In case of inhaling, immediately go see a doctor.
2. Finish product before the expiration date. Once it is opened, it should be finished within 60 days.
3. If product is frozen (either partially or completely), thaw completely, warm to room temperature and mix thoroughly by gentle inversion. Verify background results before analyzing patient samples.
4. Dispose of waste product in accordance with governmental requirements.

ACTIVE INGREDIENTS:

Surface active agent; Buffering agent;
Antifungal and antibacterial Agents.

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYC-2, 500 мл



Hematology Analyzer Lyse

LYC-2 Lyse is applicable to the DFSX (where X represents the digit and/or letter) series hematology analyzers manufactured by Dymind. It is used to lyse (destroy) red blood cells and maintain the morphology of cells before blood cell analysis, so as to facilitate the counting of white blood cells. Use the LYC-2 Lyse as instructed by the operation manual of the analyzer.

STORAGE AND STABILITY:

The product will be stable for 2 years when stored at 2°C to 30°C (35°F to 86°F).
If the operating environment is 15°C to 30°C (59°F to 86°F), discard opened container after 60 days.



Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476 Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road,
Yutang Street, Gangning District, Shenzhen 518107, P.R.

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYC-2, 500 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYC-2, 500 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYC-2, 500 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYC-2, 200 мл

Hematology Analyzer Lyse

LYC-2 Lyse is applicable to the DF5X (where X represents the digit and/or letter) series hematology analyzers manufactured by Dymind. It is used to lyse (destroy) red blood cells and maintain the morphology of cells before blood cell analysis, so as to facilitate the counting of white blood cells. Use the LYC-2 Lyse as instructed by the operation manual of the analyzer.

STORAGE AND STABILITY:

The product will be stable for 2 years when stored at 2°C to 30°C (35°F to 86°F).

If the operating environment is 15°C to 30°C (59°F to 86°F), discard opened container after 60 days.

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476 Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianshan
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P. R. C.

Реагент лизирующий для анализатора гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYC-2, 200 мл



WARNINGS:

1. Avoid skin or eye contact. In case of skin or eye contact, flush the affected area with plenty of water immediately and go see a doctor. In case of inhaling, immediately go see a doctor.
2. Finish product before the expiration date. Once it is opened, it should be finished within 60 days.
3. If product is frozen (either partially or completely), thaw completely, warm to room temperature and mix thoroughly by gentle inversion. Verify background results before analyzing patient samples.
4. Dispose of waste product in accordance with governmental requirements.

ACTIVE INGREDIENTS:

Surface active agent; Buffering agent;
Antifungal and antibacterial Agents.

EC

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYC-2, 200 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYC-2, 200 мл




Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2)) (вид сверху)



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2))
(Транспортная упаковка (вид сверху))



Hematology Analyzer Lyse



List	Model	Specification	LOT	Production date	Expiry date	PCS
	LYD-2	200mL	2022061101	11.06.2022	10.06.2024	4
	LYD-2	200mL	2022061102	11.06.2022	10.06.2024	8
	LYC-2	200mL	2022061101	11.06.2022	10.06.2024	4
	LYC-2	200mL	2022061102	11.06.2022	10.06.2024	8



Made in China



Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476 Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street,
Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China

Country : Russia-Company BW, LLC

No. : DM220606023-1

C/N : 78-2

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYC-2/LYD-2))
(Транспортная упаковка)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 20 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 1754197
КУСАЙЛО Р.В.

