

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2023 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 1754197
КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

**Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для
диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1))**

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd., («Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.»),
Китай

**WARNINGS:**

1. Avoid skin or eye contact. In case of skin or eye contact, flush the affected area with plenty of water immediately and go see a doctor. In case of inhaling, immediately go see a doctor.
2. Finish product before the expiration date. Once it is opened, it should be finished within 60 days.
3. If product is frozen (either partially or completely), thaw completely, warm to room temperature and mix thoroughly by gentle inversion. Verify background results before analyzing patient samples.
4. Dispose of waste product in accordance with governmental requirements.

ACTIVE INGREDIENTS:

Surface active agent; Buffering agent;
Antifungal and antibacterial Agents.

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYA-1, 200 мл

Hematology Analyzer Lyse

LYA-1 Lyse is applicable to the DH5X series, DH7X series, HS-5, HS-5CRP, HS-7 and DX-CRP series and DHXXCRP series hematology analyzers manufactured by Dymind. Among which, X represents the digit and/or letter. It is used to break down red blood cell membrane and convert hemoglobin to a hemoglobin complex to determine the HGB. It 2-differentiates WBCs to BASO and other WBCs, and determines WBCs amount. Use the LYA-1 Lyse as instructed by the operation manual of the analyzer.

STORAGE AND STABILITY:

The product will be stable for 2 years when stored at 2°C to 30°C (35°F to 86°F).

If the operating environment is 15°C to 30°C (59°F to 86°F), discard opened container after 60 days.




Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476 Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tian
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.C

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYA-1, 200 мл

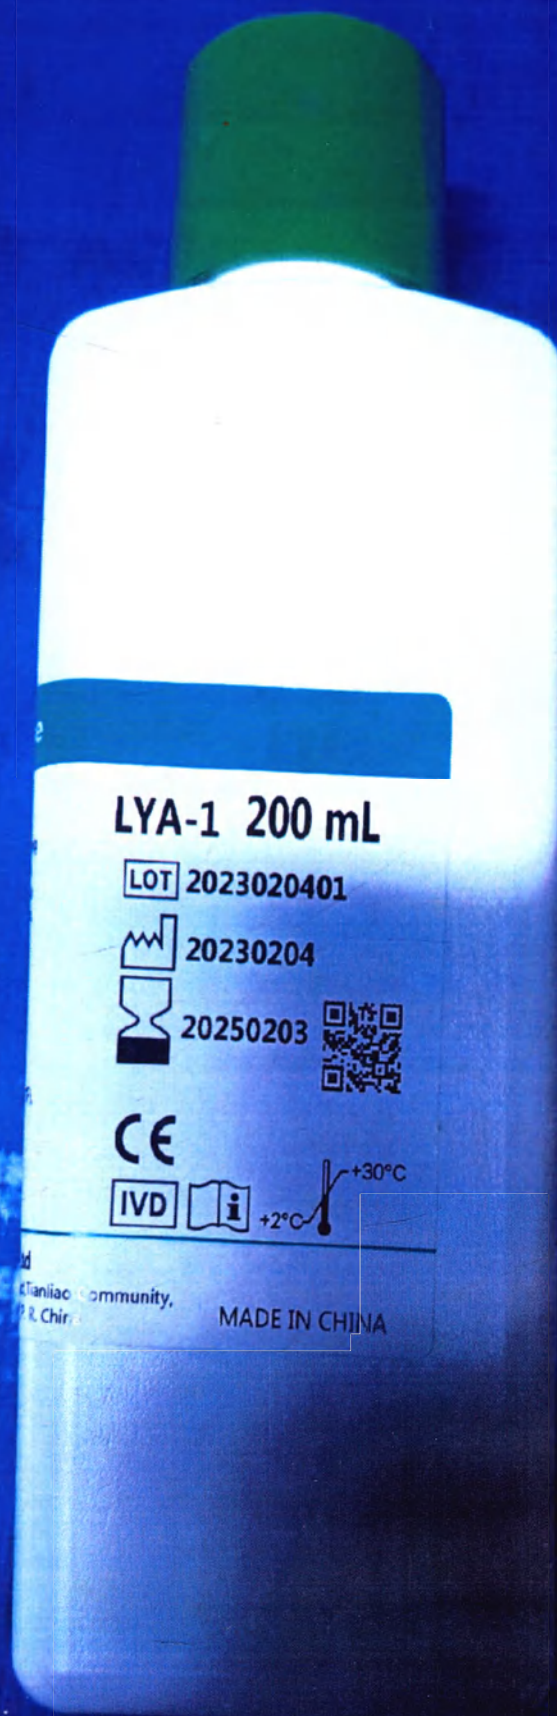

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYA-1, 200 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYA-1, 200 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYA-1, 200 мл

**WARNINGS:**


1. Avoid skin or eye contact. In case of skin or eye contact, flush the affected area with plenty of water immediately and go see a doctor. In case of inhaling, immediately go see a doctor.
2. Finish product before the expiration date. Once it is opened, it should be finished within 60 days.
3. If product is frozen (either partially or completely), thaw completely, warm to room temperature and mix thoroughly by gentle inversion. Verify background results before analyzing patient samples.
4. Dispose of waste product in accordance with governmental requirements.

ACTIVE INGREDIENTS:

Surface active agent; Buffering agent;
Antifungal and antibacterial Agents.

EC

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYA-1, 500 мл

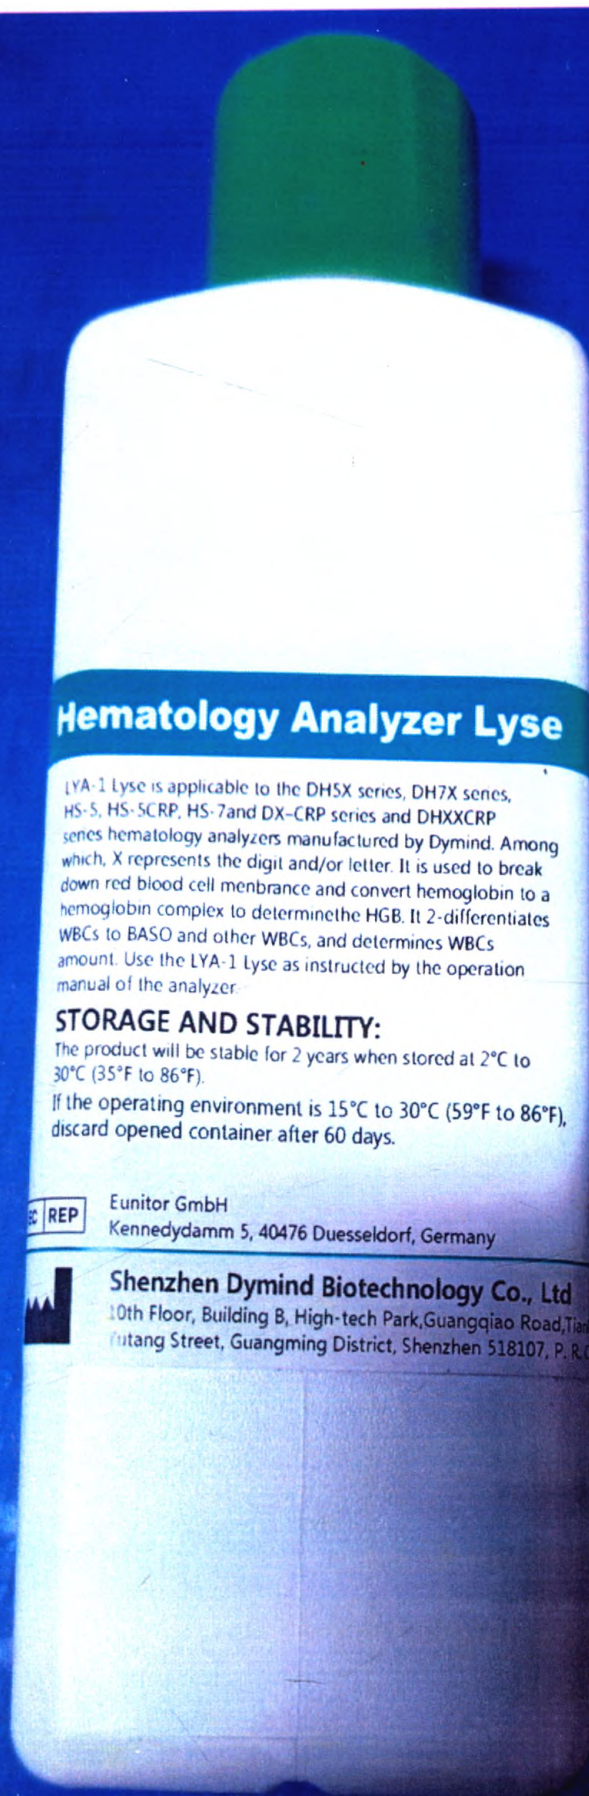

Hematology Analyzer Lyse

LYA-1 Lyse is applicable to the DH5X series, DH7X series, HS-5, HS-5CRP, HS-7 and DX-CRP series and DHXXCRP series hematology analyzers manufactured by Dymind. Among which, X represents the digit and/or letter. It is used to break down red blood cell membrane and convert hemoglobin to a hemoglobin complex to determine the HGB. It 2-differentiates WBCs to BASO and other WBCs, and determines WBCs amount. Use the LYA-1 Lyse as instructed by the operation manual of the analyzer.

STORAGE AND STABILITY:

The product will be stable for 2 years when stored at 2°C to 30°C (35°F to 86°F).

If the operating environment is 15°C to 30°C (59°F to 86°F), discard opened container after 60 days.



Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476 Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tian
Tutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P. R. C.

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYA-1, 500 мл

LYA-1 500 mL

LOT 2023020401

 20230204

 20250203



CE

IVD



+2°C  +30°C

Tianliao Community,
P.R. China

MADE IN CHINA

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYA-1, 500 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики *in vitro* (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYA-1, 500 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYA-1, 500 мл



DYMIND

WARNINGS:

1. Avoid skin or eye contact. In case of skin or eye contact, flush the affected area with plenty of water immediately and go see a doctor. In case of inhaling, immediately go see a doctor.
2. Finish product before the expiration date. Once it is opened, it should be finished within 60 days.
3. If product is frozen (either partially or completely), thaw completely, warm to room temperature and mix thoroughly by gentle inversion. Verify background results before analyzing patient samples.
4. Dispose of waste product in accordance with governmental requirements.

ACTIVE INGREDIENTS:

Quaternary ammonium surfactants and NaCl.

EC

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYR-1, 200 мл

Hematology Analyzer Lyse

LYR-1 Lyse is applicable to the DM79, DM78, DM72, DM71, DM79X, DM78X, DM72X, DM71X hematology analyzers manufactured by Dymind. It is used to break down red blood cell membrane and convert hemoglobin to a hemoglobin complex to determine the HGB. It 2-differentiates WBCs to BASO and other WBCs, and determines WBCs amount. Use the LYR-1 Lyse as instructed by the operation manual of the analyzer.

STORAGE AND STABILITY:

The product will be stable for 2 years when stored at 2°C to 30°C (35°F to 86°F).

If the operating environment is 15°C to 30°C (59°F to 86°F), discard opened container after 60 days.



Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476 Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Te
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P. R.

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYR-1, 200 мл

LYR-1 200 mL

LOT 2023020401

20230204

20250203



CE

IVD

i

+2°C — +30°C

Tianjin Community,
P.R. China

MADE IN CHINA

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYR-1, 200 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYR-1, 200 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYR-1, 200 мл



DYMIND

WARNINGS:

1. Avoid skin or eye contact. In case of skin or eye contact, flush the affected area with plenty of water immediately and go see a doctor. In case of inhaling, immediately go see a doctor.
2. Finish product before the expiration date. Once it is opened, it should be finished within 60 days.
3. If product is frozen (either partially or completely), thaw completely, warm to room temperature and mix thoroughly by gentle inversion. Verify background results before analyzing patient samples.
4. Dispose of waste product in accordance with governmental requirements.

ACTIVE INGREDIENTS:

Quaternary ammonium surfactants and NaCl.

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYR-1, 500 мл

Hematology Analyzer Lyse

LYR-1 Lyse is applicable to the DM79, DM78, DM72, DM71, DM79X, DM78X, DM72X, DM71X hematology analyzers manufactured by Dymind. It is used to break down red blood cell membrane and convert hemoglobin to a hemoglobin complex to determine the HGB. It 2-differentiates WBCs to BASO and other WBCs, and determines WBCs amount. Use the LYR-1 Lyse as instructed by the operation manual of the analyzer.

STORAGE AND STABILITY:

The product will be stable for 2 years when stored at 2°C to 30°C (35°F to 86°F).

If the operating environment is 15°C to 30°C (59°F to 86°F), discard opened container after 60 days.



Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476 Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYR-1, 500 мл

LYR-1 500 mL

LOT 2023020401

20230204

20250203



IVD



+2°C

+30°C

Shandong Tianliao Community,
P.R. China

MADE IN CHINA

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYR-1, 500 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики *in vitro* (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYR-1, 500 мл



Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)), вариант исполнения: Реагент лизирующий LYR-1, 500 мл



Общий вид МИ Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1)) в транспортной упаковке с инструкцией по применению


Hematology Analyzer Lyse



List	Model	Specification	LOT	Production date	Expiry date	PCS
	LYR-1	200mL	2022051801	18.05.2022	17.05.2024	3
	LYR-1	200mL	2022040601	06.04.2022	05.04.2024	7
	LYA-1	200mL	2022051801	18.05.2022	17.05.2024	3
	LYA-1	200mL	2022040601	06.04.2022	05.04.2024	7



Made in China



Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476 Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street,
Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China

Country : Russia-Company BW, LLC

Маркировка транспортной упаковки МИ Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического 5-Diff для диагностики in vitro (Hematology analyzer lyse (LYA-1/ LYR-1))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 23 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 1754/97
КУСАНОВ Р.А.

