

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«11» мая 2023 г.


по доверенности
№ АБ 1754197

КУСАНДОР В.


Фотографические изображения изделия:

Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro


Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд.»), Китай

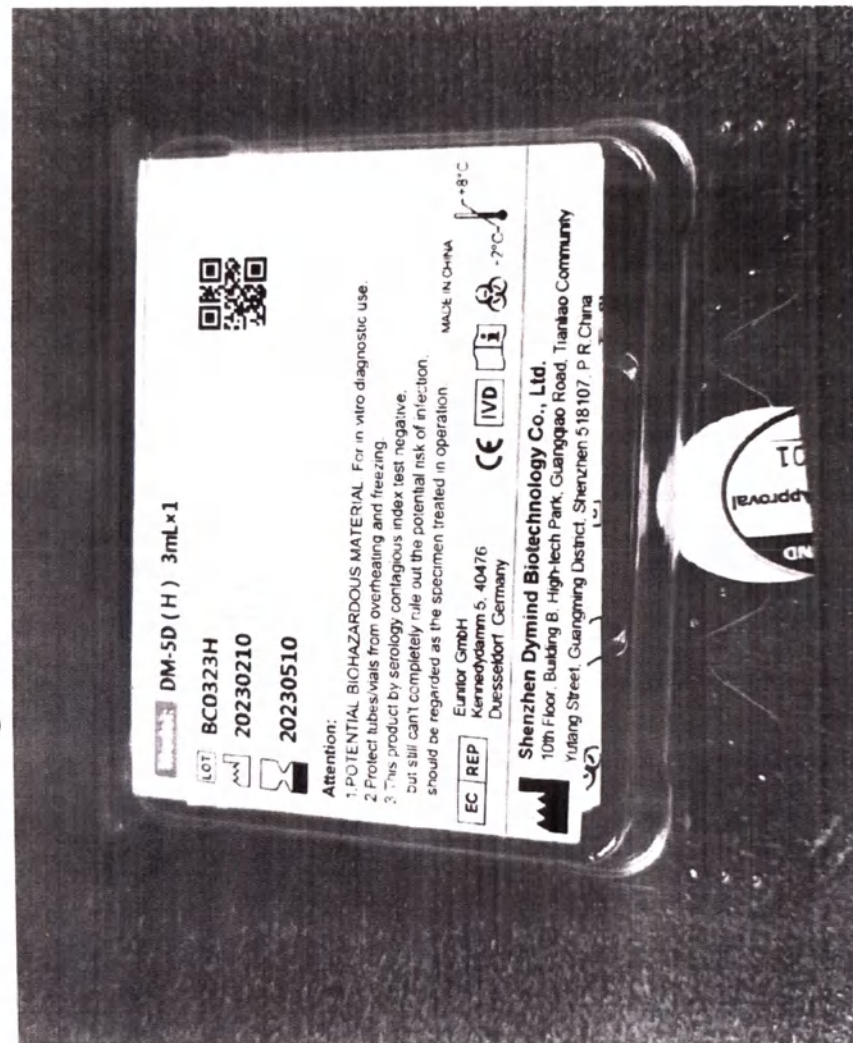

Клинический образец (Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения H (1x3,0 мл))

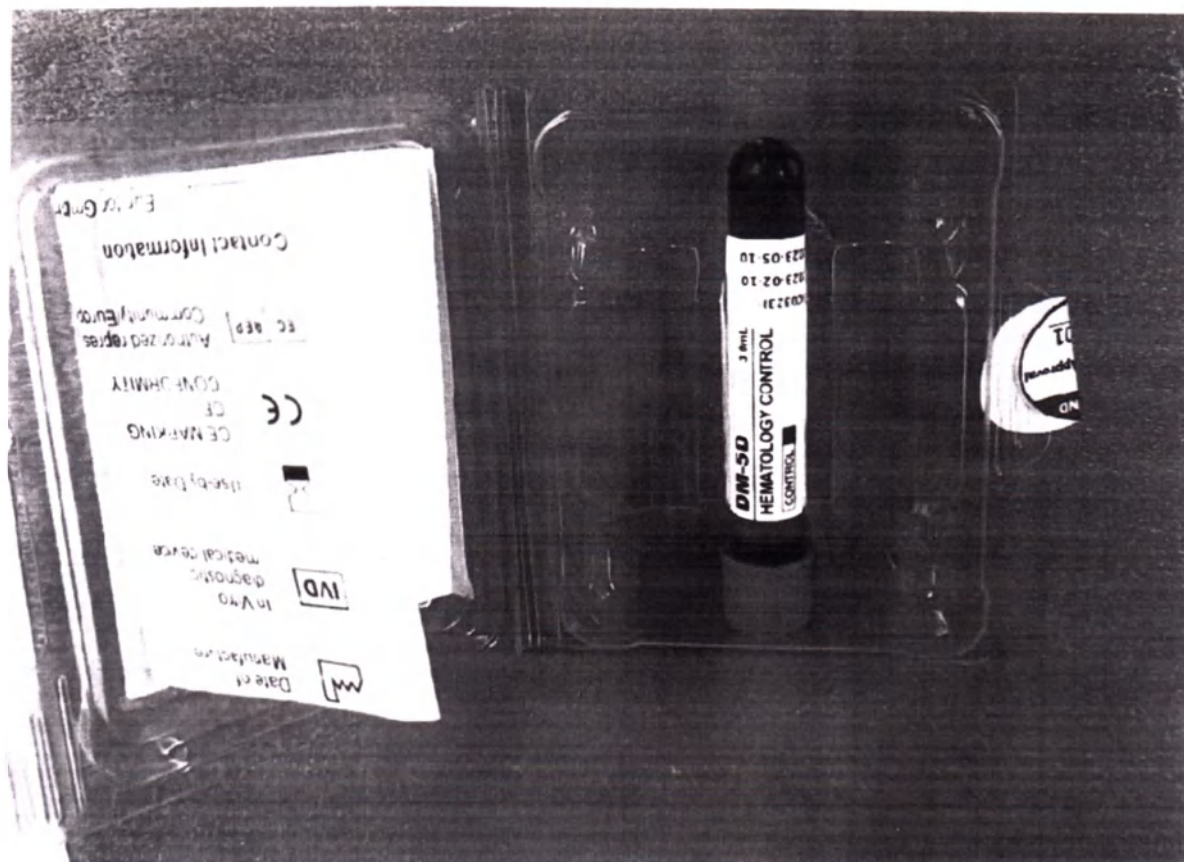


Общий вид внешнего изделия (Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (1-3,0 мл))

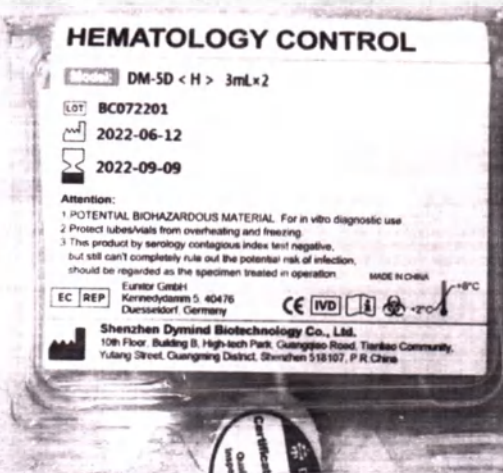


Общий вид внешнего изделия (Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (2-3,0 мл))




Скорость гематологического теста (Контроль гематологический (Hematology Control)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови и клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-DiH для диагностики in vitro, в варианте исполнения H (3×3,0 мл)

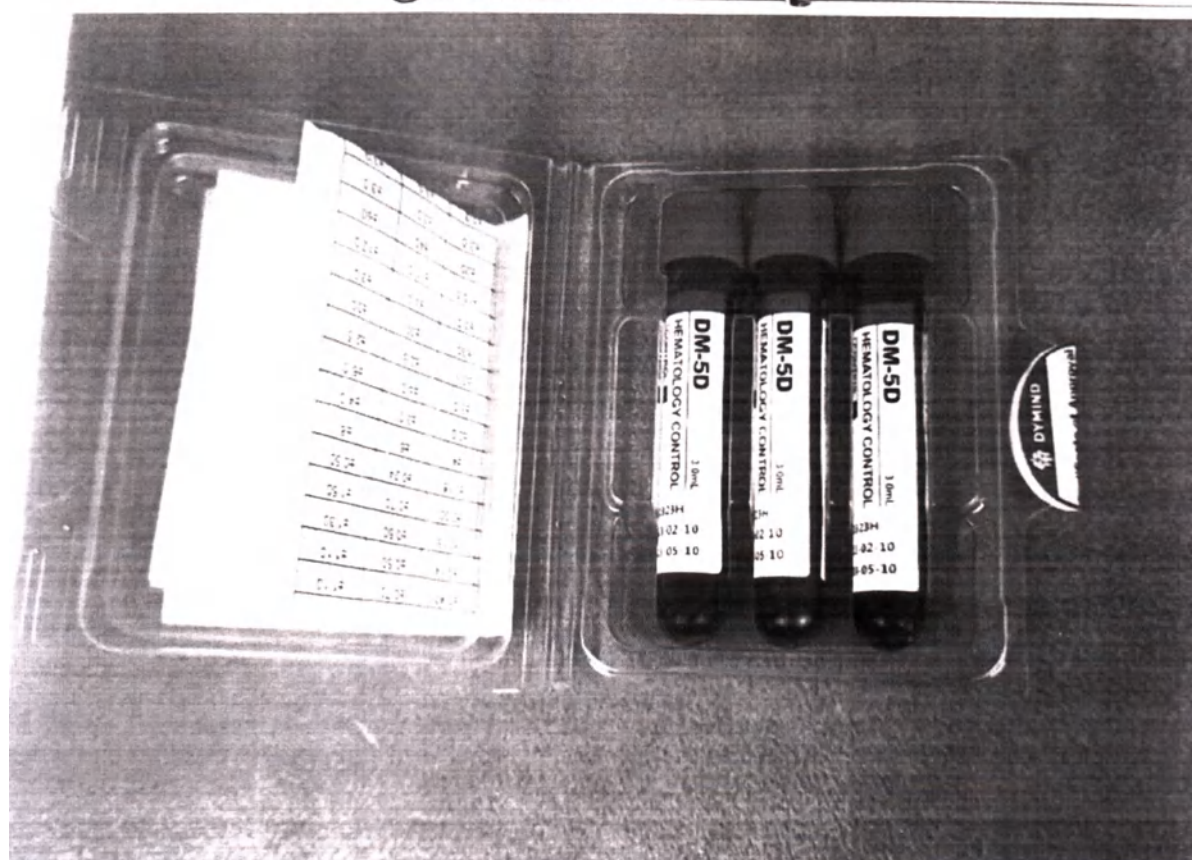

Скорость гематологического теста (Контроль гематологический (Hematology Control)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови и клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-DiH для диагностики in vitro, в варианте исполнения H (3×3,0 мл)

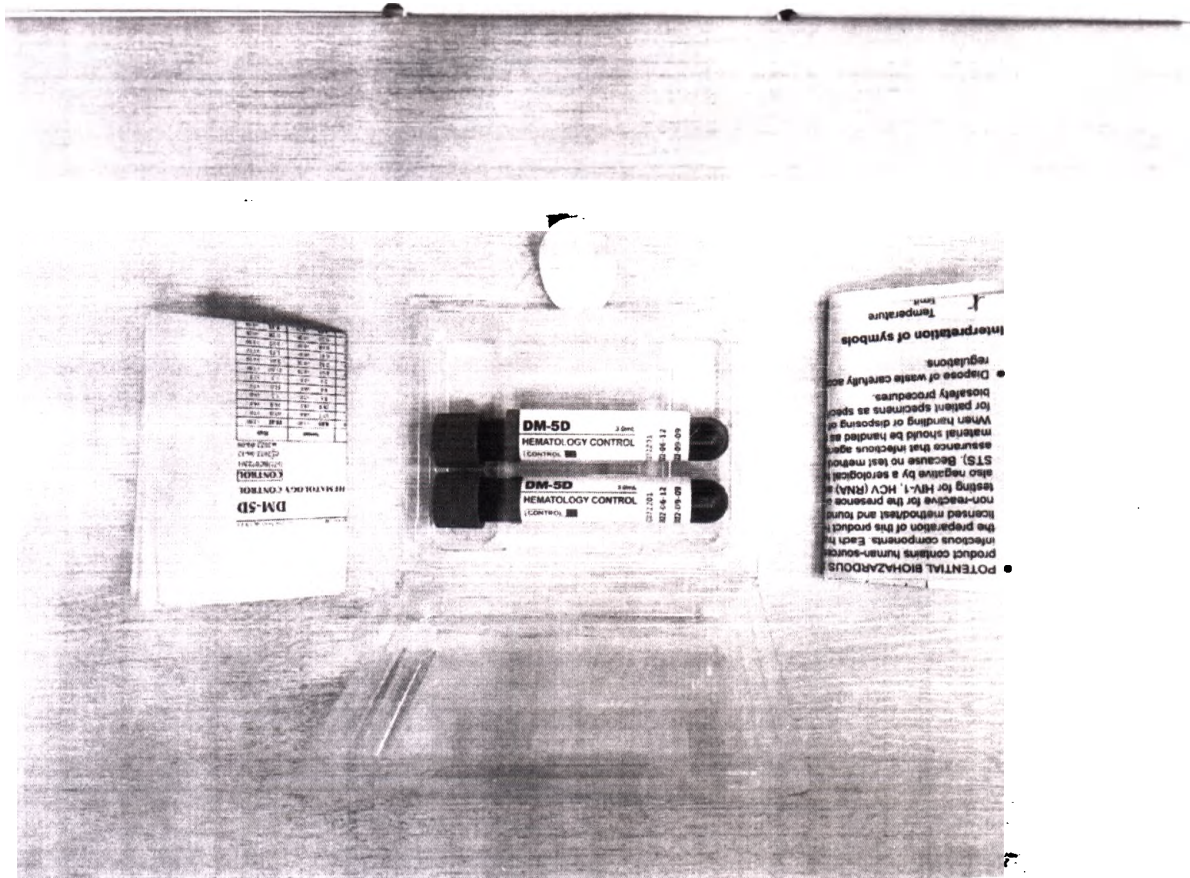

Содержимое мини-набора (Контроль гематологический (Hematology Control)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (2×3,0 мл)

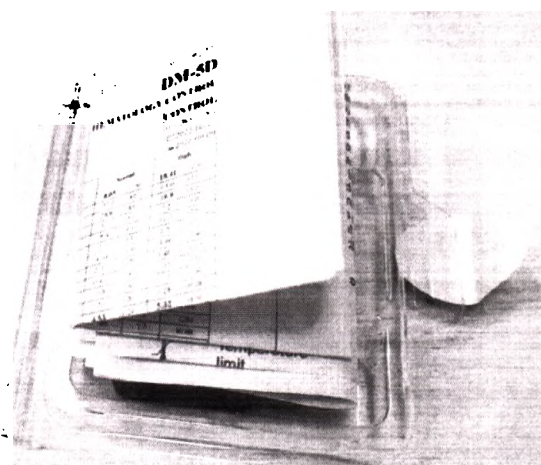

Содержимое мини-набора (Контроль гематологический (Hematology Control)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (2×3,0 мл)

HEMATOLOGY CONTROL

Model: DM-5D < N > 3mLx2

LOT: BC072201

2022-06-12

2022-09-09

Attention:

- 1 POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
- 2 Protect tubes/vials from overheating and freezing.
- 3 This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

EC REP Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany

CE

IVD

i

BIO

2°C

+8°C

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China

Объект вне медицинского изделия (Контроль гематологический (Hematology Control)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (2x3,0 мл)

HEMATOLOGY CONTROL

Model: DM-5D (N) 3mLx3

LOT: BC0323N

2023-02-10

2023-05-10

Attention:

- 1 POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use
- 2 Protect tubes/vials from overheating and freezing
- 3 This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

EC REP Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany

CE

IVD

i


BIO

2°C

+8°C

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China


Объект вне медицинского изделия (Контроль гематологический (Hematology Control)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (3x3,0 мл)

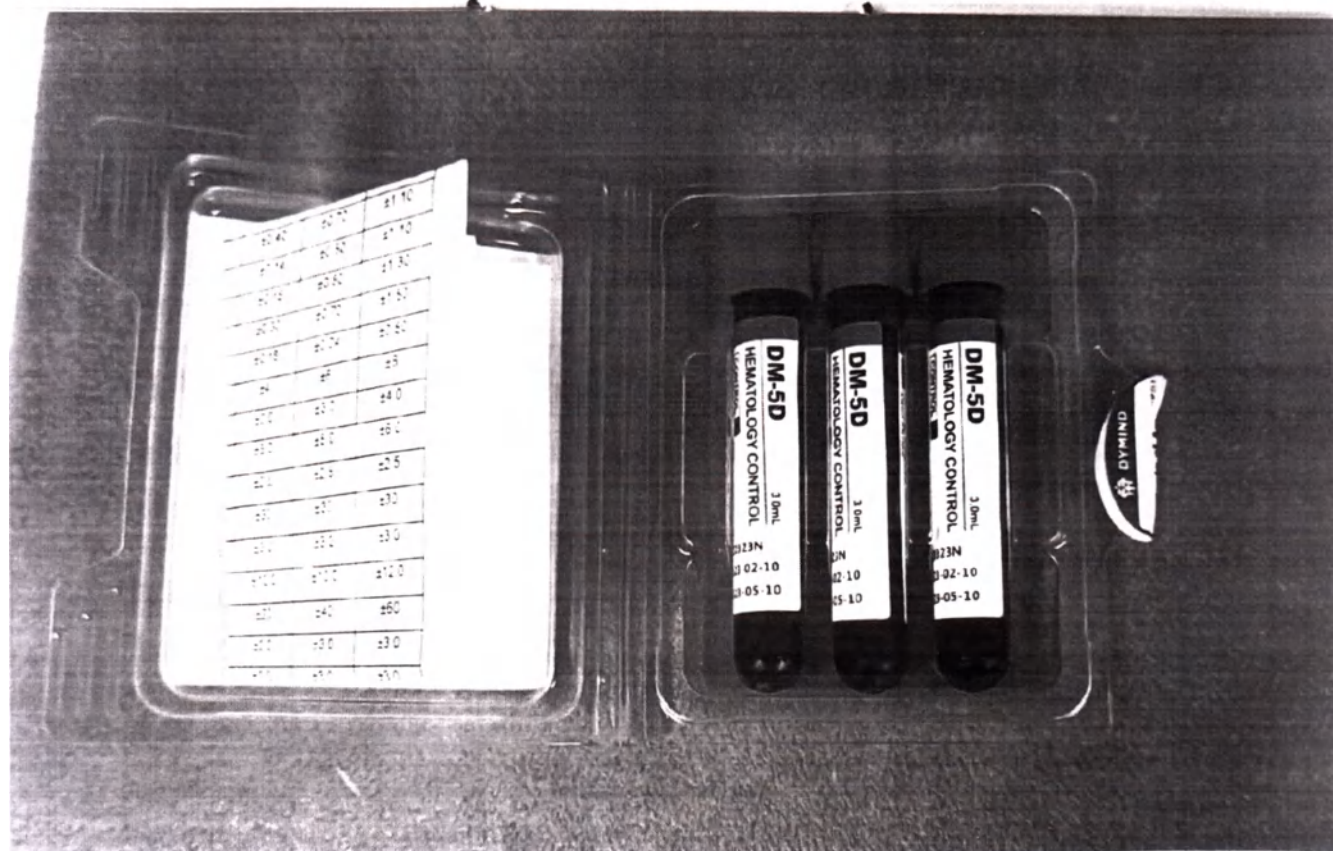


1. Картинка на упаковке изделия (Контроль гематологический (Hematology Control)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови и в клиническом обращении на автоматических гематологических анализаторах 5-12шт для диагностики in vitro, в варианте исполнения № (3.0 мл)




1. Картинка на упаковке изделия (Контроль гематологический (Hematology Control)) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови и в клиническом обращении на автоматических гематологических анализаторах 5-12шт для диагностики in vitro, в варианте исполнения № (1.0 мл)

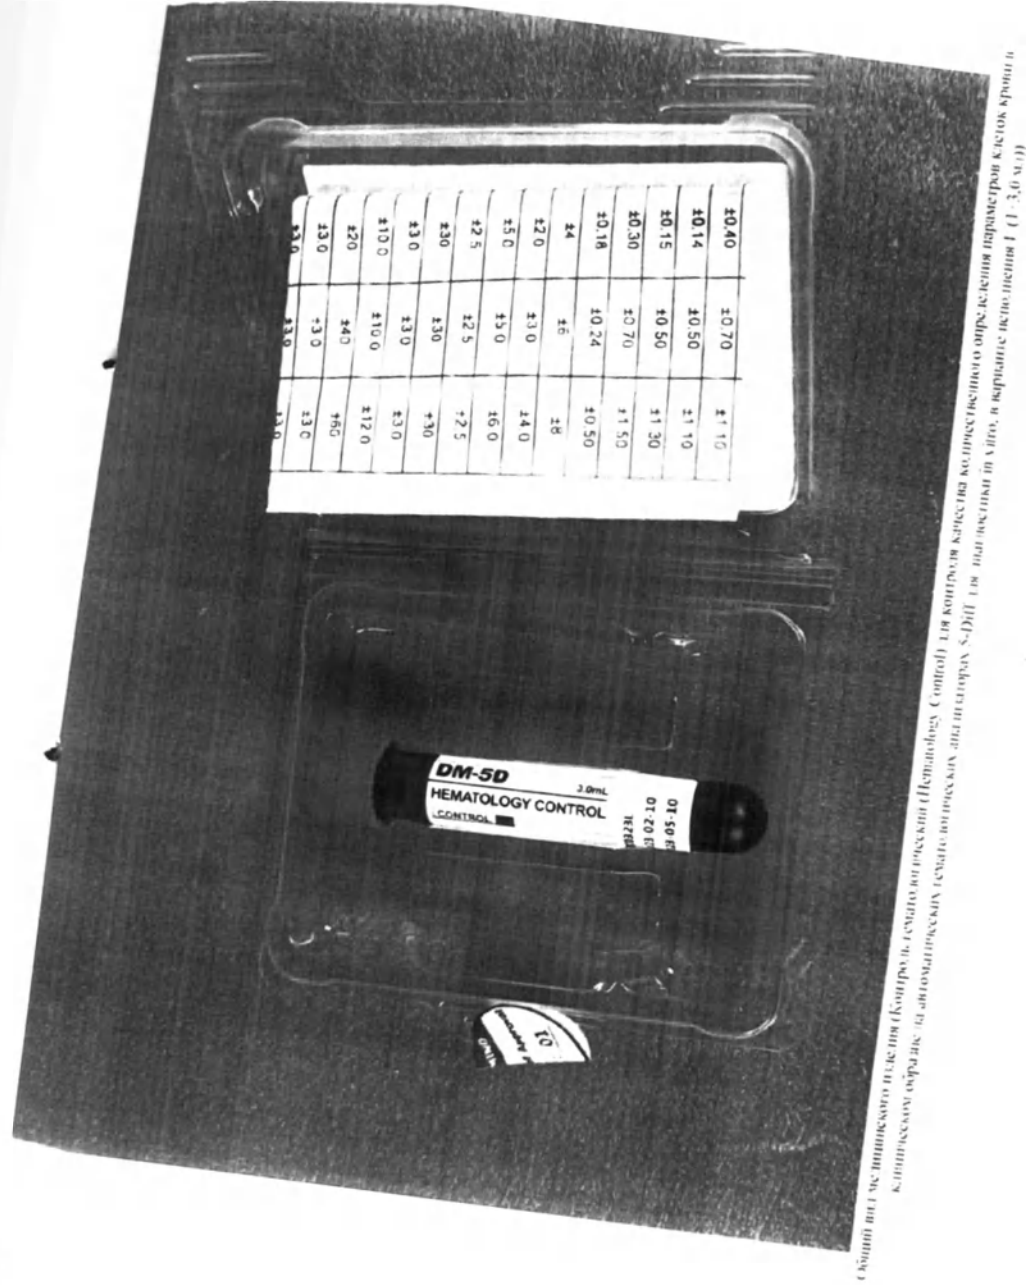


Смешивать не рекомендуется (Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматическом гематологическом анализаторе 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (2×3.0 мл))

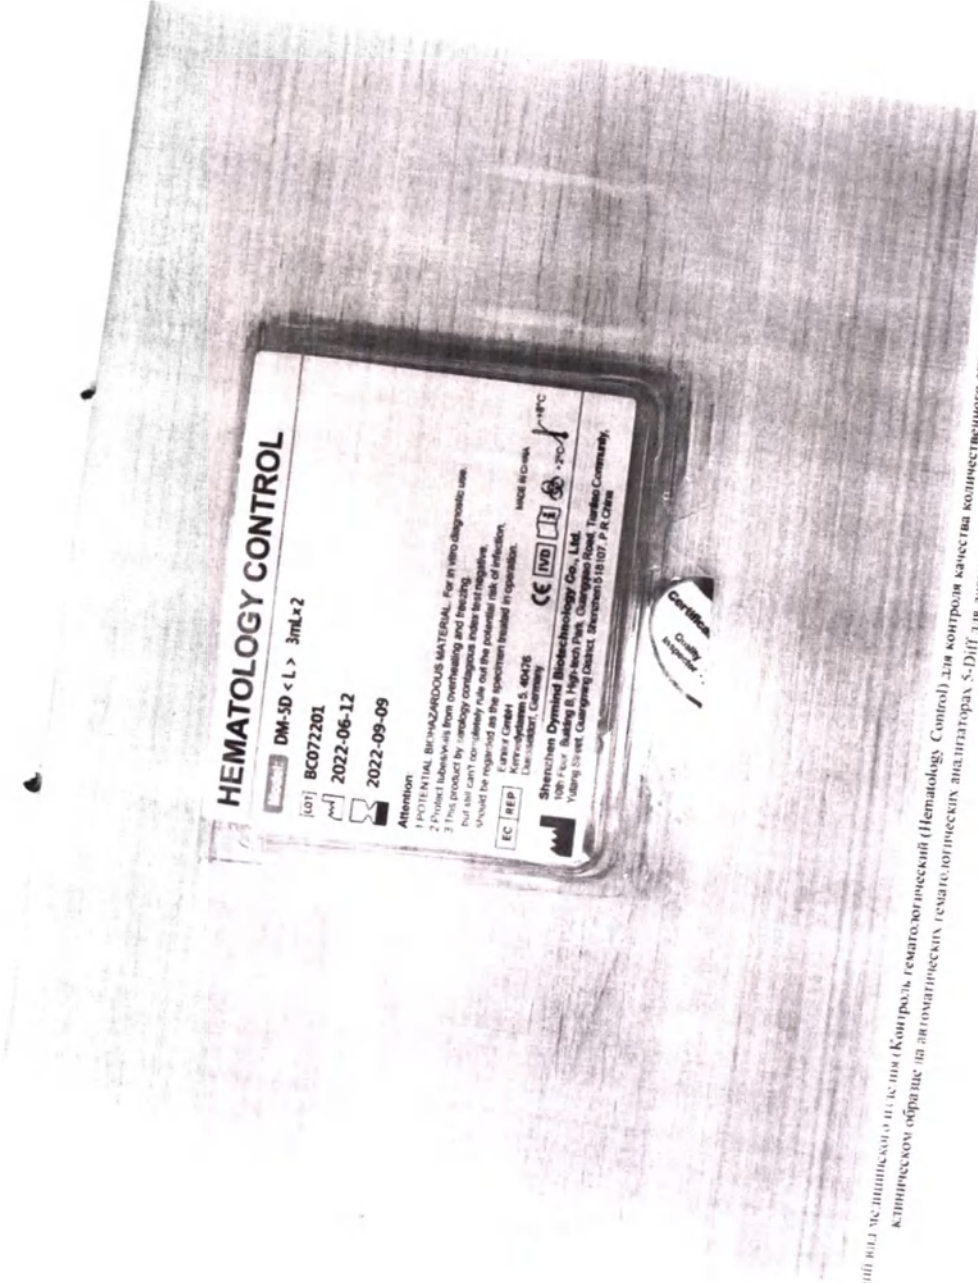

Смешивать не рекомендуется (Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматическом гематологическом анализаторе 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (2×3.0 мл))

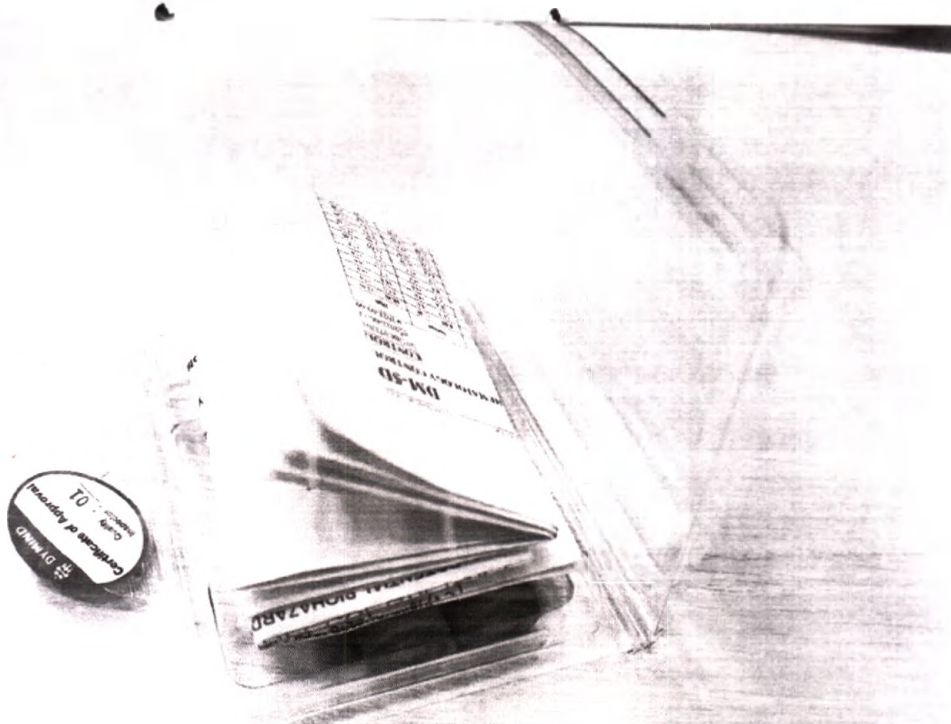

Общий вид индивидуального изделия (Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-DiIT для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (2×3,0 мл))

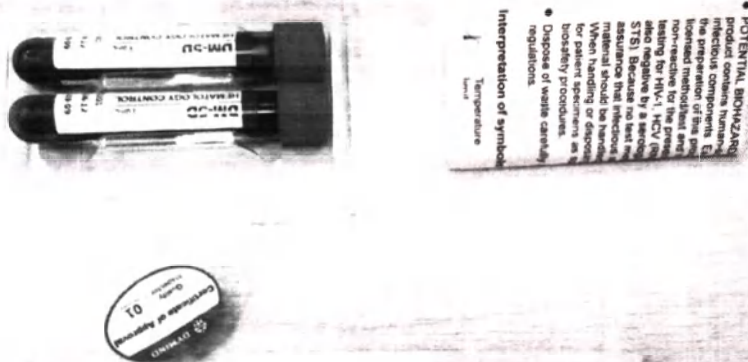


DM-5D
HEMATOLOGY CONTROL
CONTROL
REF: BKV2201
C2403-000-02
© 2010-08-09

Reference Values provided by OYMINO

Applicable Parameters	Reference	Unit	Value	Range	Units
WBC	4.0-11.0	10 ⁹ /L	4.00	1.0-11.0	10 ⁹ /L
Neu	50-70	%	50.0	40-70	%
Lym	20-40	%	20.0	10-40	%
Mon	2-10	%	2.0	1-10	%
Eos	1-5	%	1.0	0-5	%
Bas	0-1	%	0.1	0-1	%
PLT	150-400	10 ⁹ /L	150.0	100-400	10 ⁹ /L
Hgb	120-160	g/L	120.0	100-160	g/L
Hct	37-47	%	37.0	30-47	%
MCV	80-100	fL	80.0	70-100	fL
MCH	27-32	pg	27.0	20-32	pg
MCHC	32-36	g/dL	32.0	25-36	g/dL
RDW	11.5-14.0	%	11.5	10-14	%
RDW-CV	11.5-14.0	%	11.5	10-14	%
RDW-SD	40-50	fL	40.0	30-50	fL
MPV	8-12	fL	8.0	5-12	fL
PCT	0.1-0.3	%	0.1	0-0.3	%
MPV	8-12	fL	8.0	5-12	fL
PCT	0.1-0.3	%	0.1	0-0.3	%



Общий вид индивидуального изделия (Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-DiIT для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (2×3,0 мл))

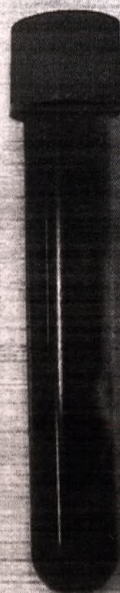


Контроль H (высокий) (Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro)




Контроль N (средний) (Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro)

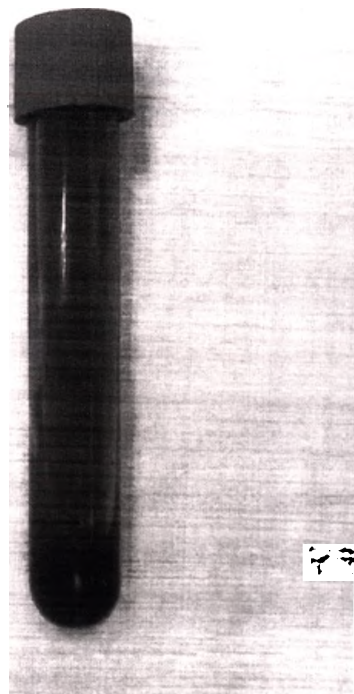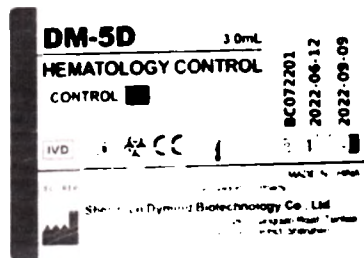


1. Описание. Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro.

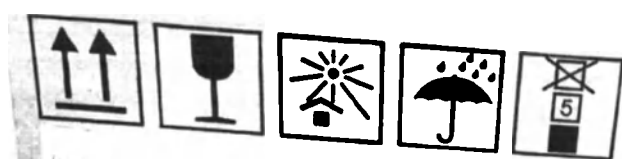

Expiry: 2022-09-09
Lot: 2022060001
CN: 2022-06-12

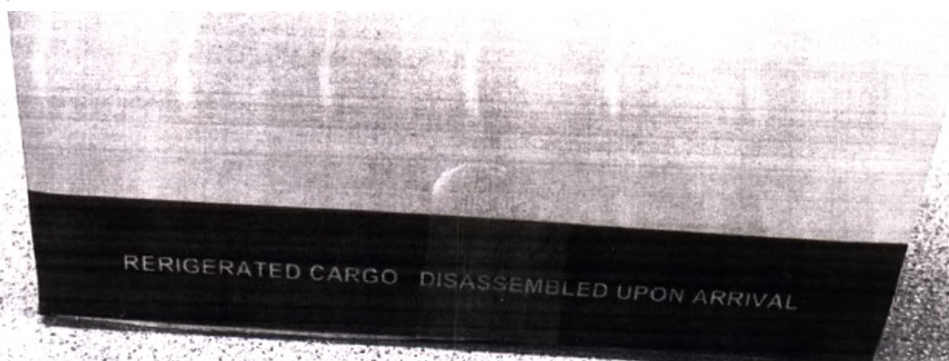

1. Описание. Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 5-Diff для диагностики in vitro.

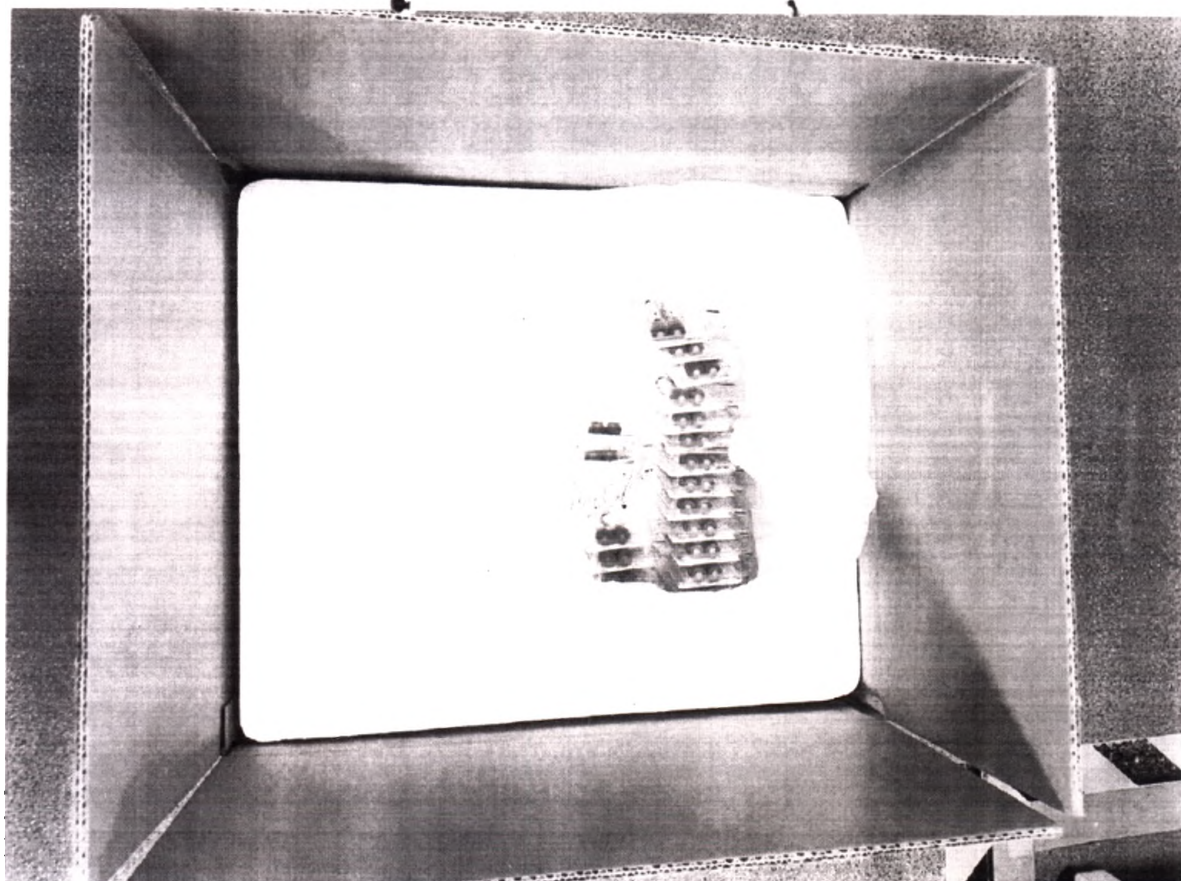

Грантируемая установка для измерения и контроля «Контроль гематологический (Hematology Control)» для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в химическом образце на оптических гематологических анализаторах 5-6IV для диагностики in vitro

Всего принято, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 27 шт.

Генеральный директор
М.П.

Получено
№ 508/0000000000
17.04.2015
18.04.2015