

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

_____ Т.А. Носова

« 22 » _____ декабря 2023 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 3555614

КУСАЙЛО Р. В.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.»), Китай

HEMATOLOGY CONTROL

Model: DM-3D (H) 3mLx1

LOT B1123H

2023-10-10

2024-02-10



Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

EC REP


Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany

CE IVD



+2°C

MADE IN CHINA



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China

DM-3D

3.0mL


HEMATOLOGY CONTROL

CONTROL

B1123H

23-10-10

24-02-10



Product Name

Hematology Control

Model

DM-3D

Packaging

Type

Specimen



Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (1×3,0 мл)

HEMATOLOGY CONTROL

Model: DM-3D (H) 3mLx2

LOT B1123H

2023-10-10

2024-02-10



Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

MADE IN CHINA

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany

CE IVD




+2°C +8°C



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China



Product Name

Hematology Control


Model


DM-3D

Packaging

Type

Speci

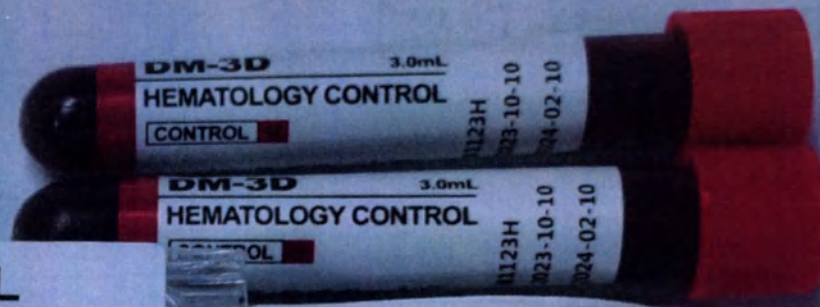

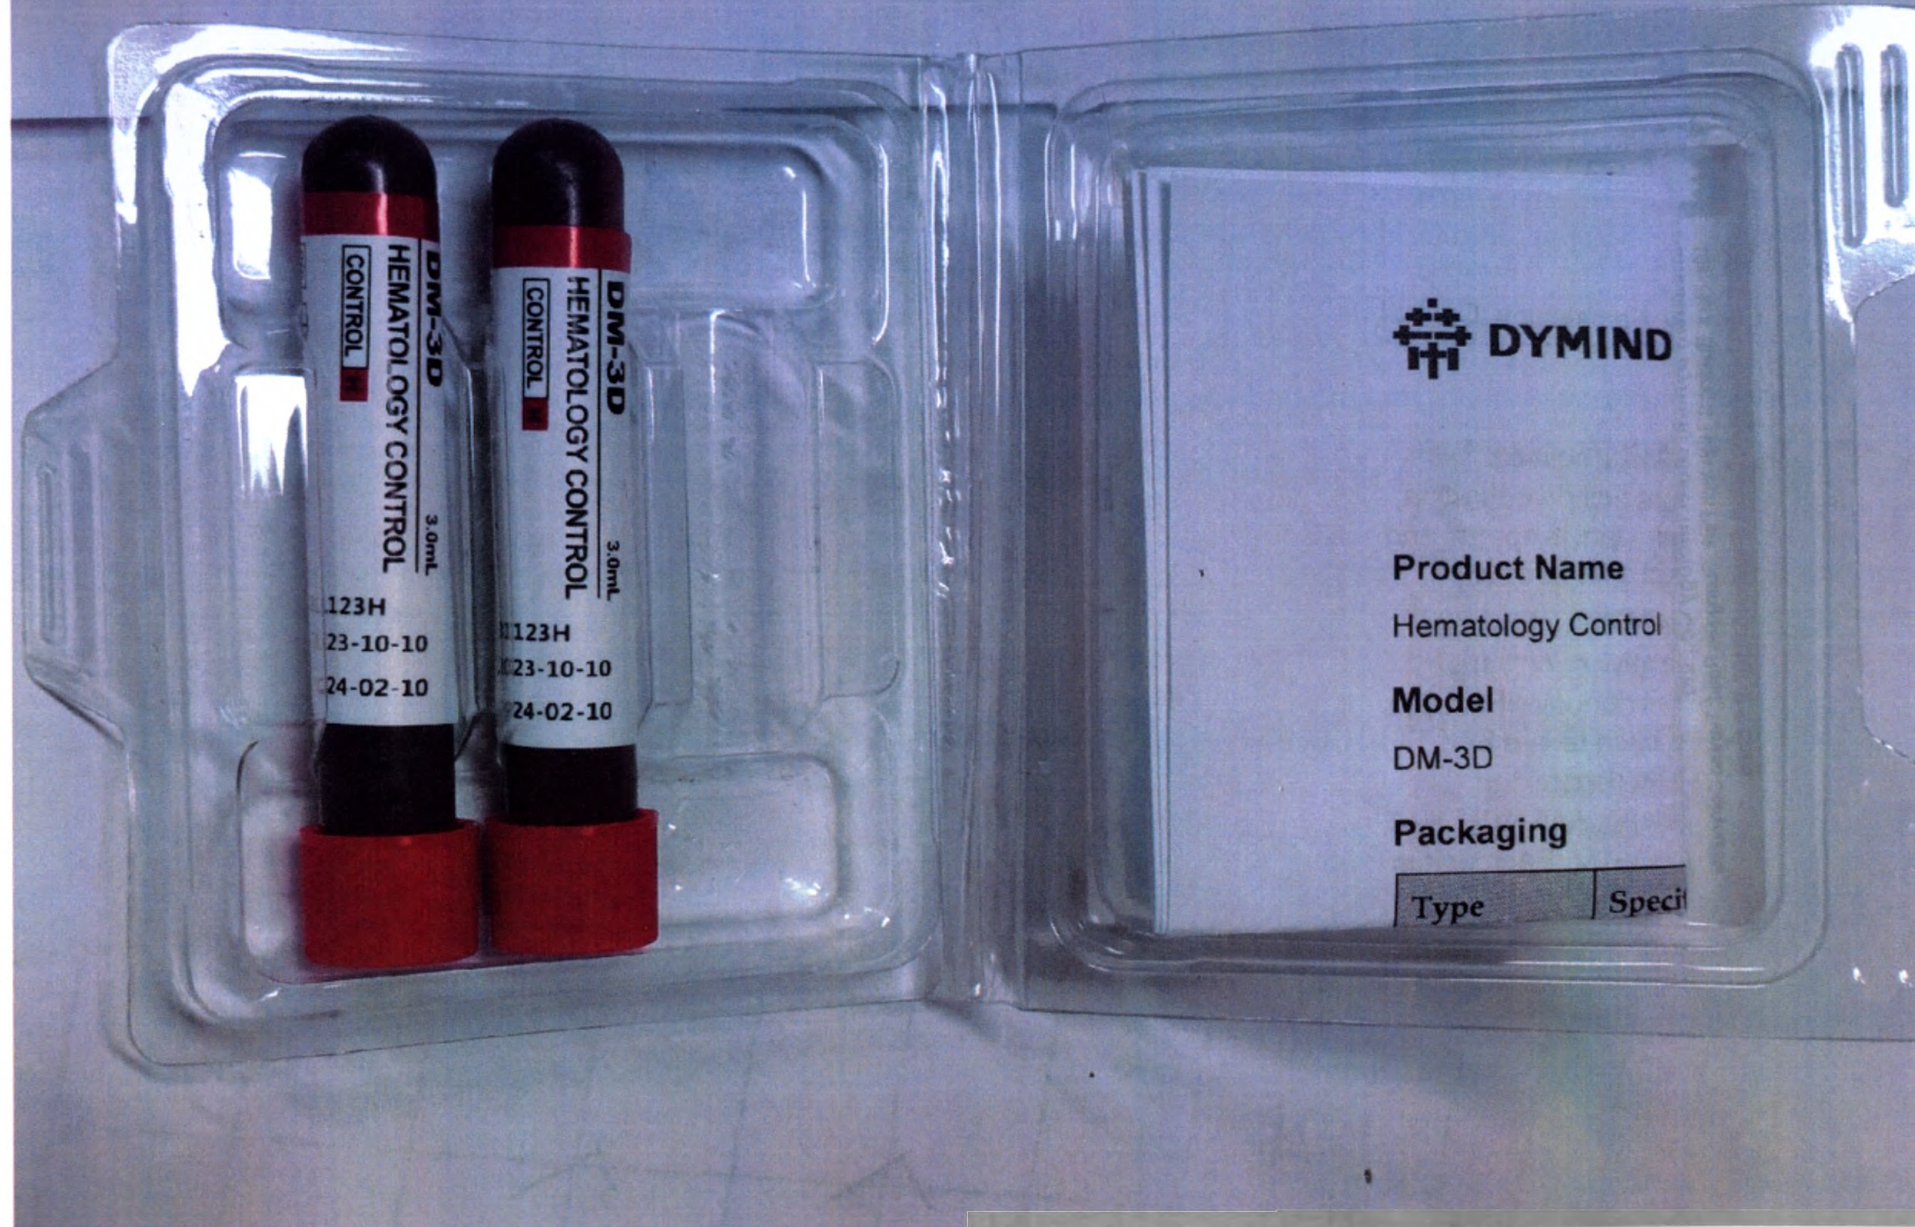

Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (2×3,0 мл)

Стр. 5 из 21

HEMATOLOGY CONTROL

Model: DM-3D (H) 3mL×3

LOT B1123H01

2023-10-10

2024-02-10



Attention:


1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

MADE IN CHINA

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany

CE IVD



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China



DYMIND

Product Name

Hematology Control

Model

DM-3D

Packaging


Type

Specit





Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (3×3,0 мл)

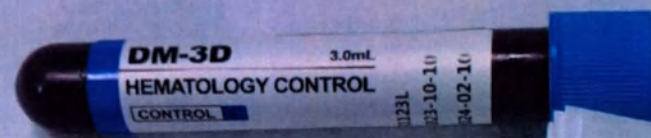

HEMATOLOGY CONTROL

Model: DM-3D (L) 3mL×1

LOT B1123L

2023-10-10

2024-02-10



Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

MADE IN CHINA

EC REP

Euntor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany

CE IVD



+2°C

+8°C

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China

 DYMIND

Product Name
Hematology Control

Model
DM-3D

Packaging

Type

Speci



Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (1×3,0 мл)

HEMATOLOGY CONTROL

Model: DM-3D (L) 3mLx2

LOT B1123L

2023-10-10

2024-02-10



Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

MADE IN CHINA

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany

CE IVD



+2°C



+8°C

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China

DM-3D

3.0mL

HEMATOLOGY CONTROL

CONTROL

B1123L

2023-10-10

2024-02-10

DM-3D

3.0mL

HEMATOLOGY CONTROL

CONTROL

B1123L

2023-10-10

2024-02-10



DYMIND

Product Name

Hematology Control

Model

DM-3D

Packaging

Type

Speci



Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (2×3,0 мл)



HEMATOLOGY CONTROL

Model: DM-3D (L) 3mLx3

LOT B1123101

2023-10-10

2024-02-10



Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

MADE IN CHINA

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany

CE IVD



+2°C




+8°C



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China



Product Name

Hematology Control

Model

DM-3D

Packaging

Type

Speci



Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения L (3×3,0 мл)



HEMATOLOGY CONTROL

Model: DM-3D (N) 3mL×1

LOT B1123N

2023-10-10

2024-02-10



Attention:

- 1.POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
- 2.Protect tubes/vials from overheating and freezing.
- 3.This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

MADE IN CHINA

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany




+8°C
+2°C



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China



Product Name


Hematology Control

Model


DM-3D

Packaging

Type	Speci
------	-------

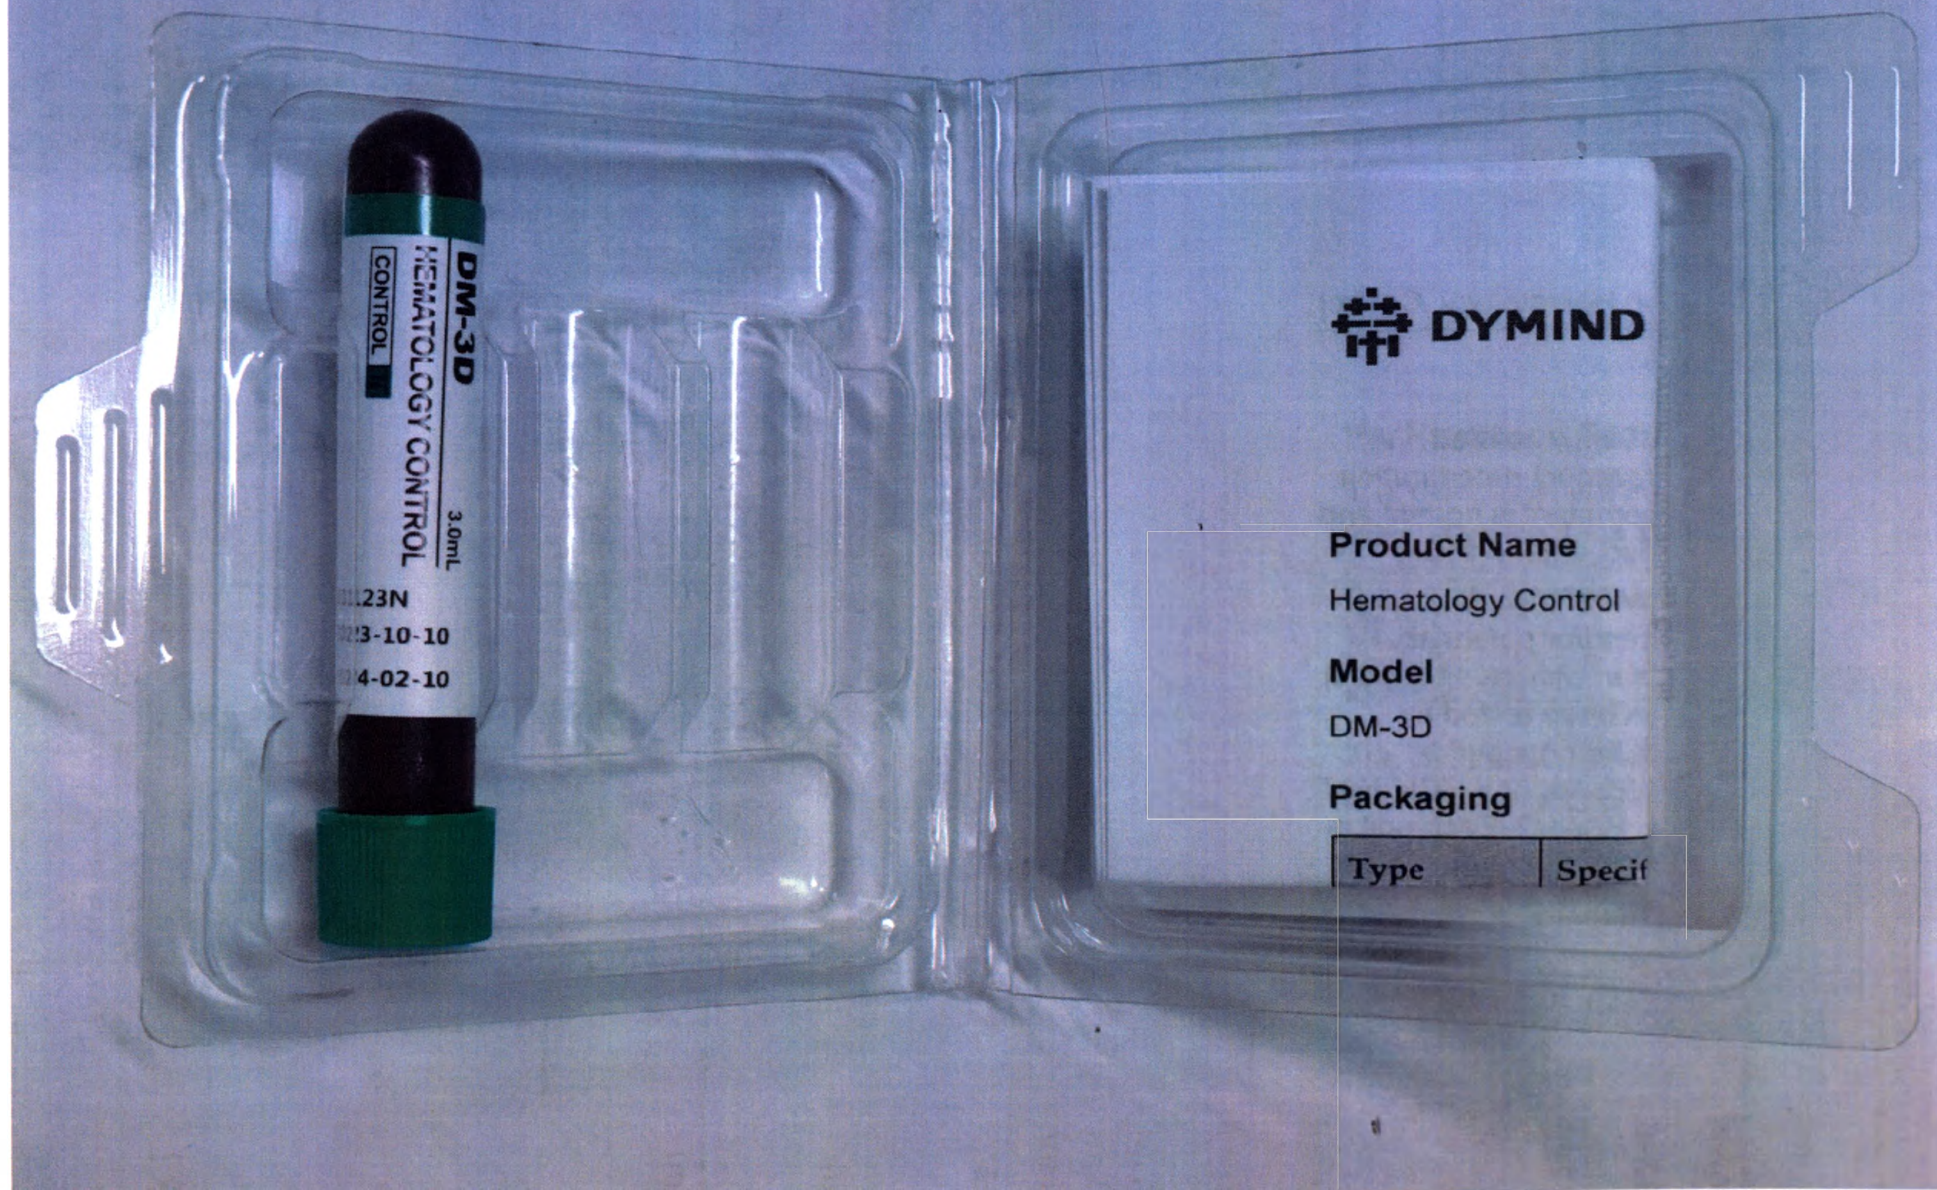

Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (1×3,0 мл)

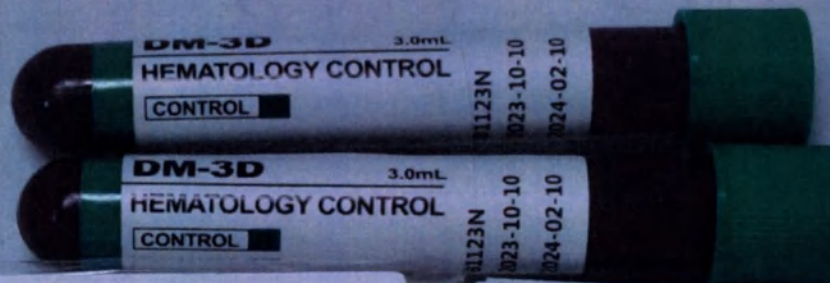

HEMATOLOGY CONTROL

Model: DM-3D (N) 3mLx2

LOT B1123N

2023-10-10

2024-02-10



Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

MADE IN CHINA

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany




+2°C



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China



Product Name

Hematology Control


Model

DM-3D

Packaging

Type

Speci

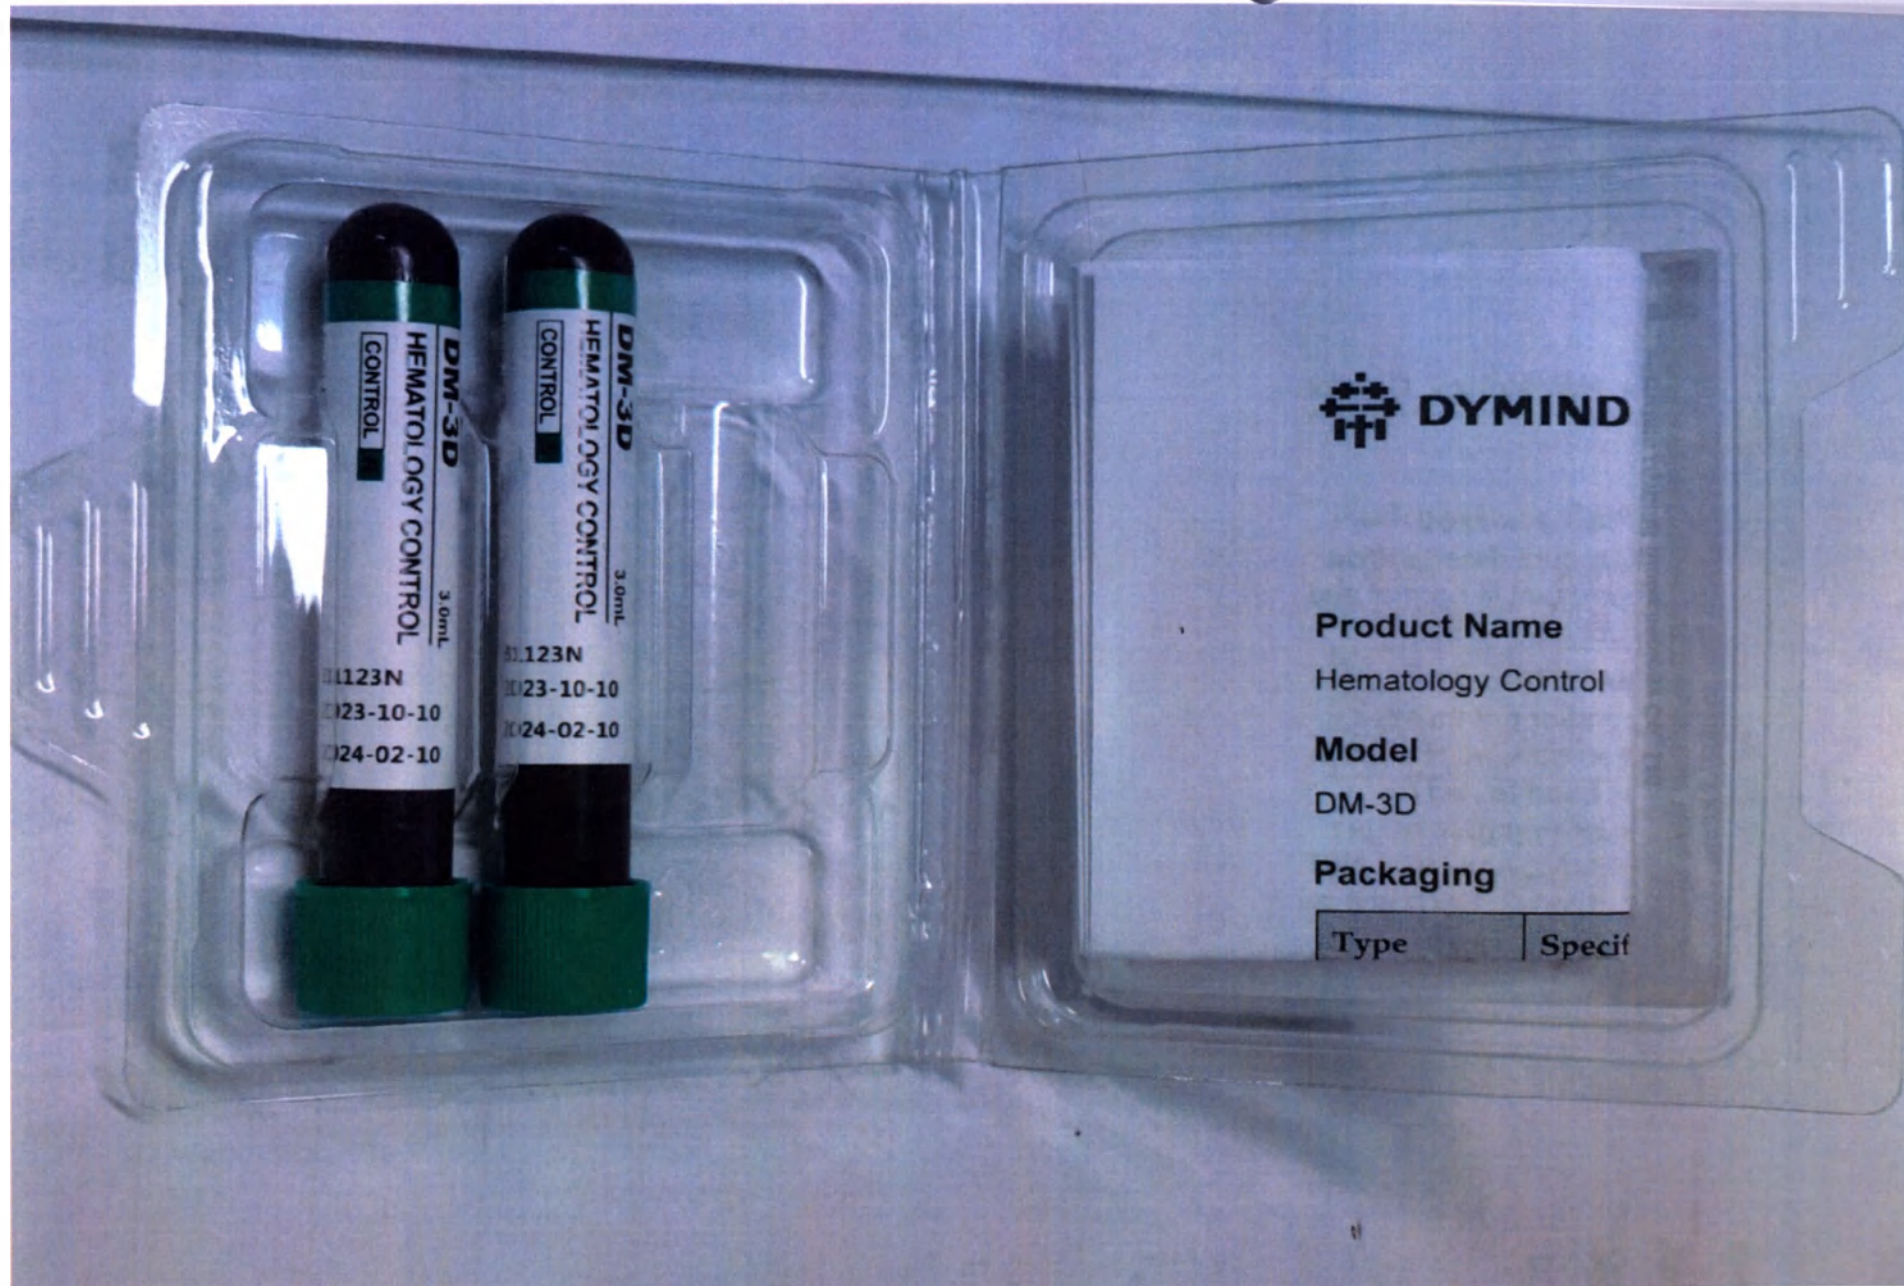

Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (2×3,0 мл)



HEMATOLOGY CONTROL

Model: DM-3D (N) 3mL×3

LOT B1123N01

2023-10-10

2024-02-10



Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL. For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

MADE IN CHINA

EC REP

Eurotor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany

CE IVD




+2°C



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliu Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China



Product Name

Hematology Control

Model

DM-3D

Packaging

Type	Speci
------	-------



Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения N (3×3,0 мл)

Информацию на стикере считать приоритетной

Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (1×3,0 мл):

- Контроль Н (высокий) – 1×3,0 мл;
- Таблицы значений и диапазонов анализа компании Dymind – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

(«Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.»), Китай

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen, China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр 1, пом 17.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Стикер на потребительской упаковке изделия

Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Контроль гематологический (Hematology Control) для контроля качества количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения Н (1×3,0 мл)

LOT




масса нетто _____
масса брутто _____
масса нетто потребительской упаковки _____
количество _____ шт.
габаритные размеры (ДхШхВ): _____



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

(«Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.»), Китай

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen, China



IVD



Макет маркировки транспортной упаковки

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 21 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 3555674
ХУСАИНОВ Р.А.

