



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgM)»


Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д. 24 МАЙ 2020 г.





ВЕКТОР

БЕСТ

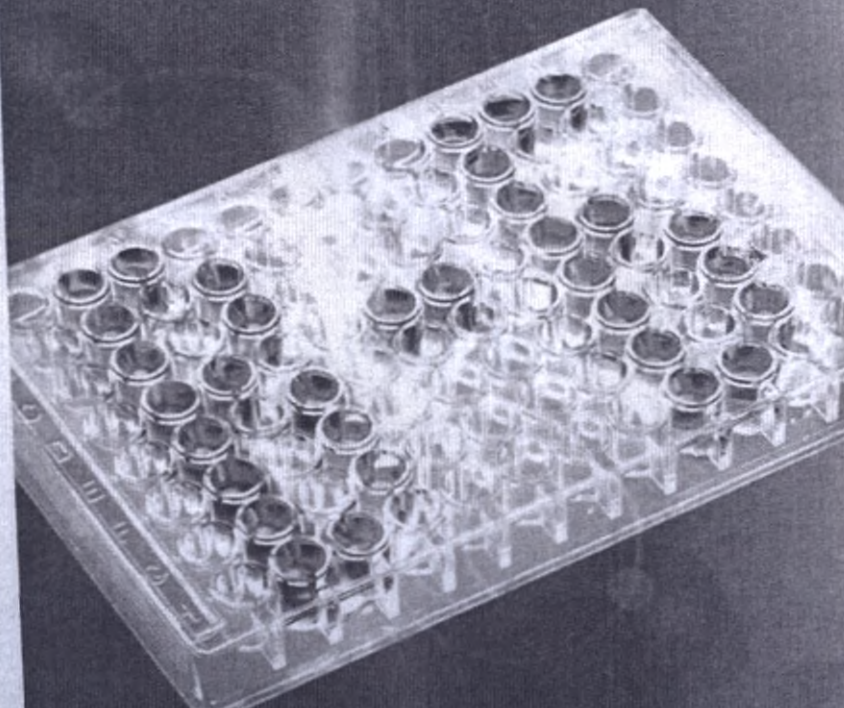

REF

D-2554

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к вирусу краснухи
в сыворотке (плазме) крови

ВектоРубелла-IgM

LOT 217

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса краснухи	1 шт.	216
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	217
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 3,0 мл	217
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	217
5. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	854
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	217
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2810
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл	407
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1302

Принадлежности:

Пленка для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночка для реагента	2 шт.
Наконечники для пипетки	16 шт.
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgM)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
24 МАЙ 2020 г.




BEKTOP

БЕСТ

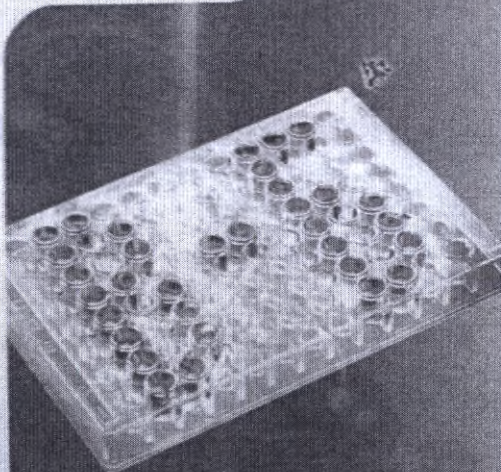

REF **D-2554**



ТУ 9398-401-23548172-2012

ПУ № РЗН 2013/1347 от 17.03.2017

LOT

217



2019-07-05



2020-07-05

ВектоРубелла-IgM

IVD



25540507200021700420

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgM)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2020 г.



АО «Вектор-Бест»



ВектоРубелла-IgM
Планшет разборный
с иммобилизованным
антигеном вируса
краснухи



LOT 216

2021-11

фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgM)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«24 мая» 2020 г.





фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgM)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
24 МАИ 2020 г.



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgM)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
« 24 МАИ » _____ 2020 г.

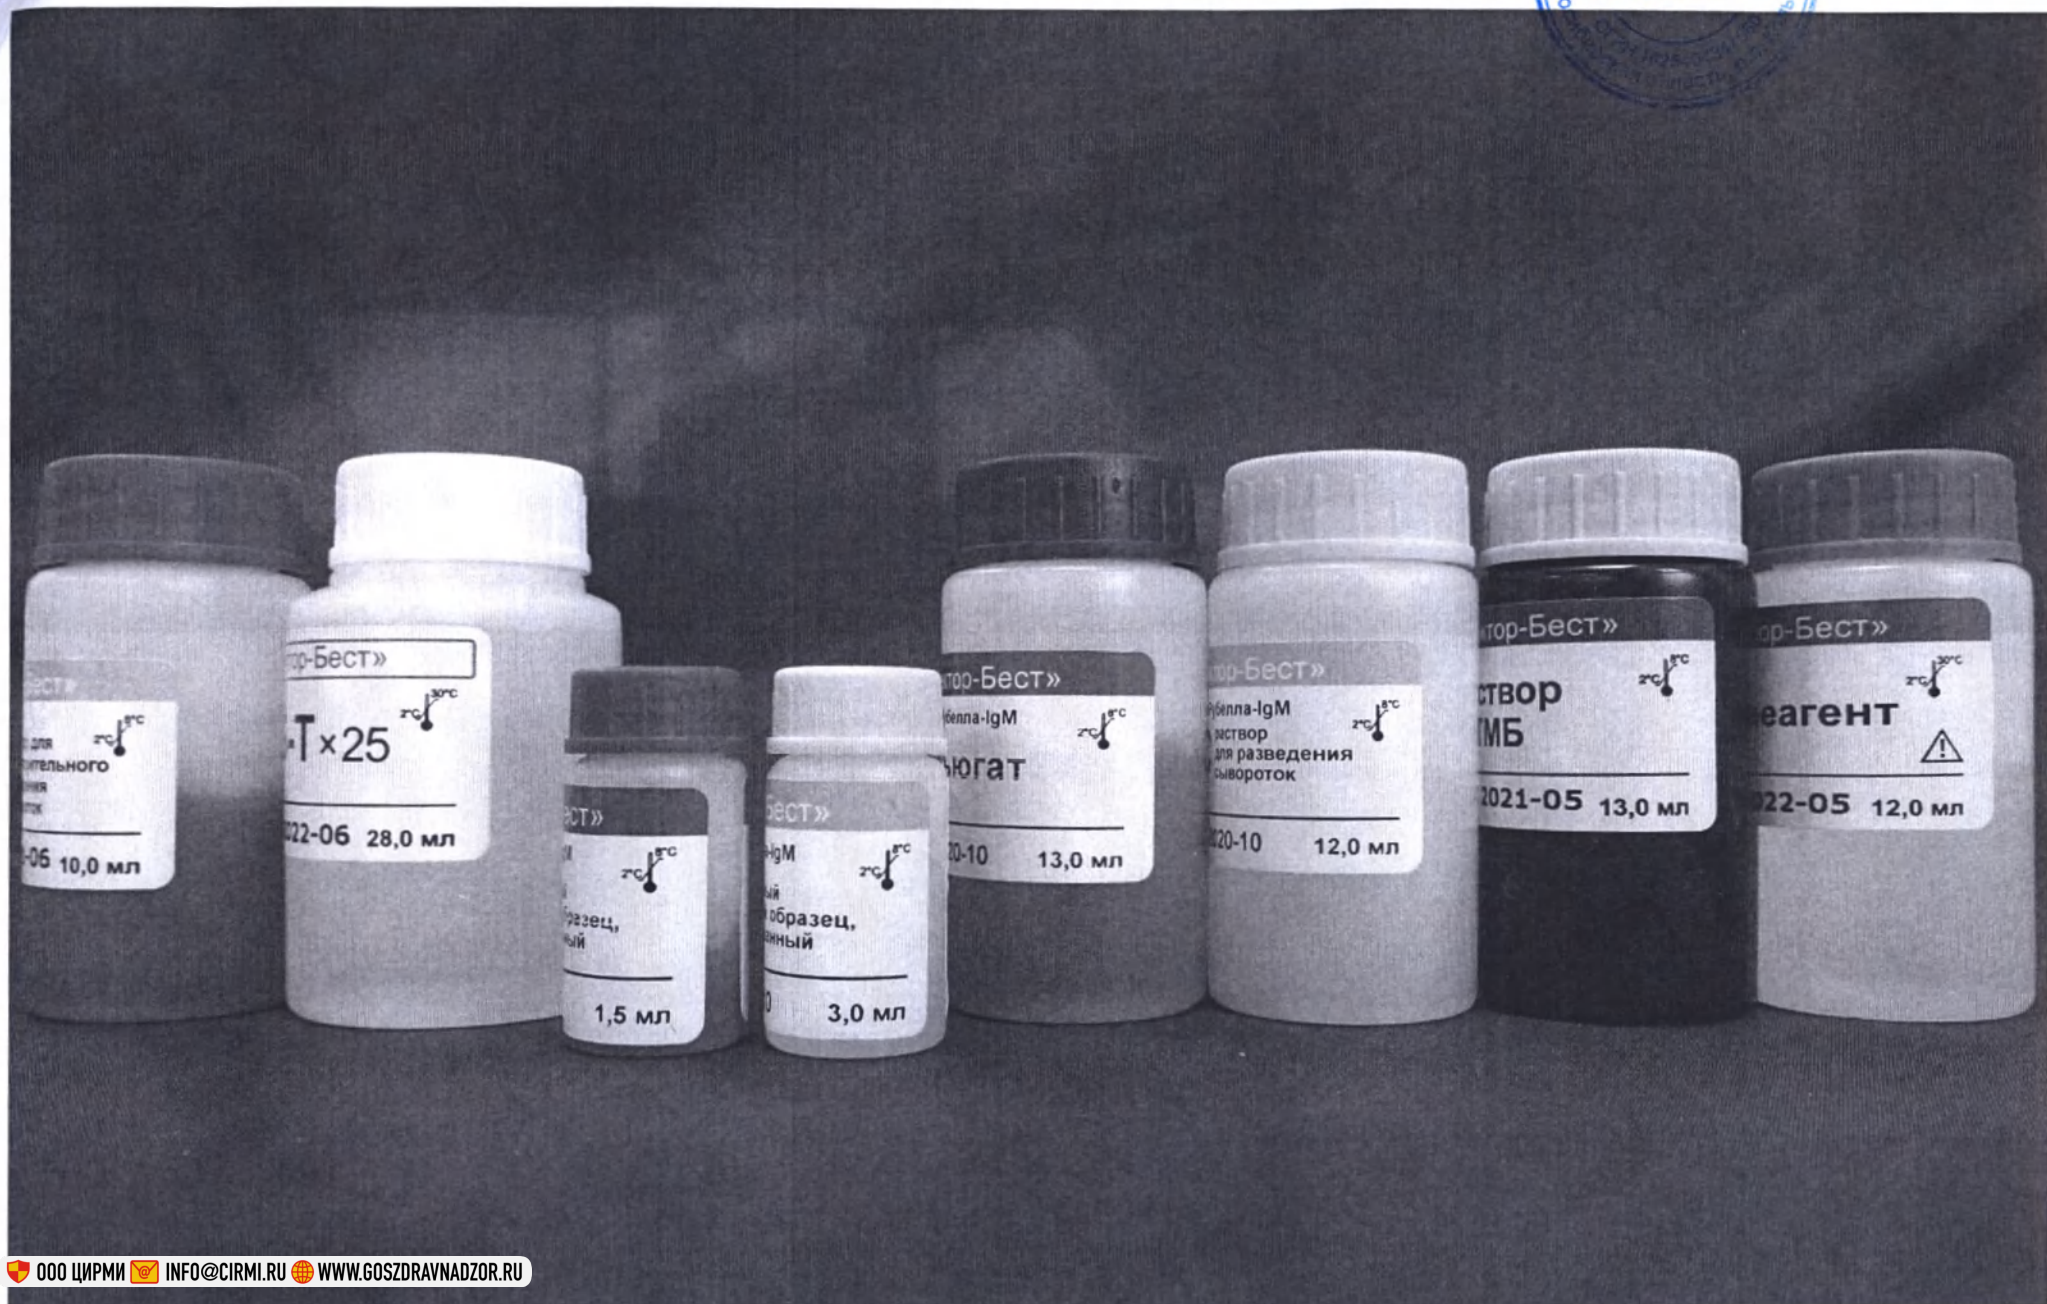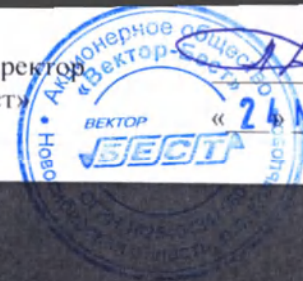

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 07 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

2 " Вектор-Бест " 2020 г. А.В. Масыго

