





ООО фирма "Технология-Стандарт"
ул.я 1351 г. Барнаул, Алтайский край, 656037
тел.факс: (385-2) 27-13-00, 27-11-01, 22-99-37
ПАСПОРТ № 010
с патологическим диапазоном значений (Техноклот П)
ТУ 9398-066-42349142-2016
Годен до 11.2017

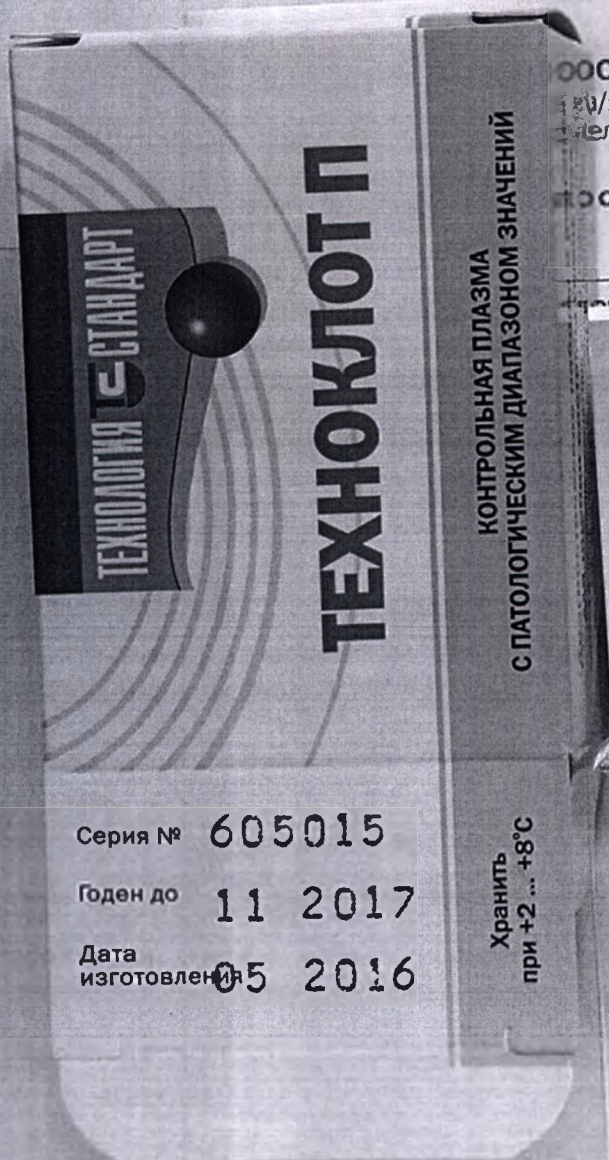

Техноклот П

ИНСТРУКЦИЯ
по применению контрольной плазмы
с патологическим диапазоном значений

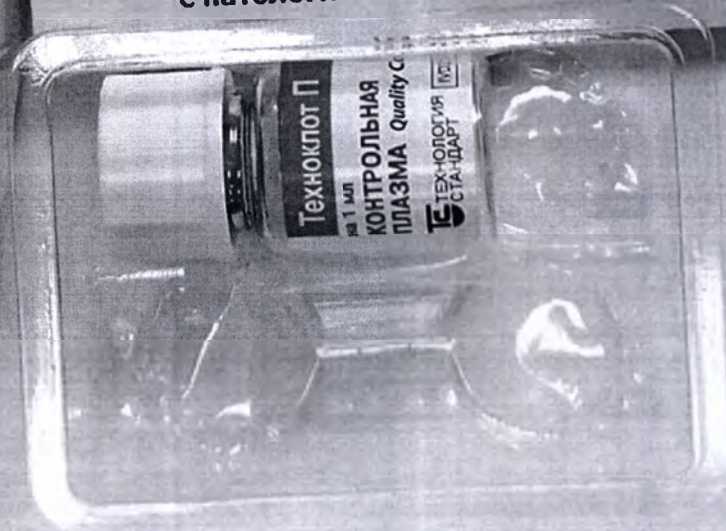

Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»
А.П. Момот

Макет этикеток медицинского изделия «Контрольная плазма с патологическим диапазоном значений (Техноклот П) по ТУ 9398-066-42349142-2016».

Макет этикетки реагента «Техноклот П»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот

Макет упаковки медицинского изделия «Контрольная плазма с патологическим диапазоном значений»
(Техноклот П) по ТУ 9398-066-42349142-2016»



Директор ООО «Фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

