

Внешний вид медицинского изделия «Набор реагентов для определения антитромбина на автоматических коагулометрах (ХромоТех-Антитромбин) по ТУ 9398-059-42349142-2015».

Серия № 503011  
Годен до 09 2016  
Дата изготовления 03 2015

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

## ХРОМОТЕХ-АНТИТРОМБИН

Хранить при +2 ... +8°C

250

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТРОМБИНА НА АВТОМАТИЧЕСКИХ КОАГУЛОМЕТРАХ



ХромоТех-Антитромбин

ИНСТРУКЦИЯ

к набору реагентов для определения антитромбина

ПАСПОРТ № 220


Фирма «Технология-Стандарт»  
51, г. Барнаул, Алтайский край, 656017  
КЗ (385-2) 27-13-00, 27-11-01, 22-99-37




Директор ООО фирмы «Технология-Стандарт» *А.П. Момот* А.П. Момот

Макет этикеток медицинского изделия «Набор реагентов для определения антитромбина на автоматических коагулометрах (ХромоТех-Антитромбин) по ТУ 9398-059-42349142-2015».

Макет этикетки реагента «Хромогенный субстрат»

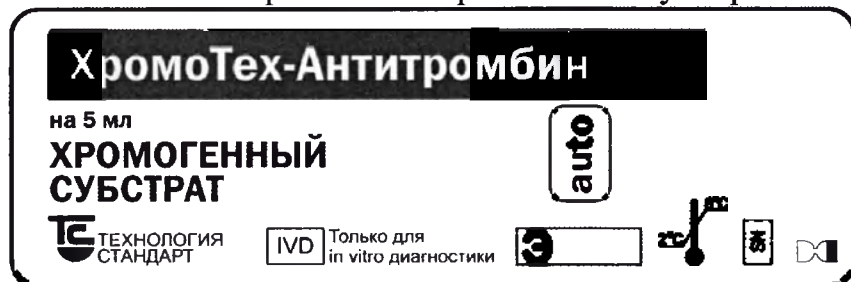

Макет этикетки реагента «Тромбин»

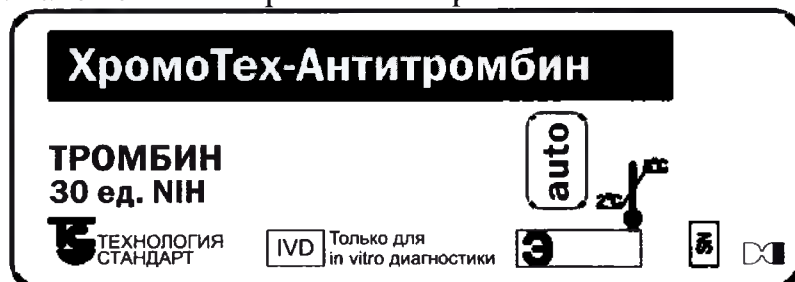

Макет этикетки реагента «Растворитель для тромбина»



Макет этикетки реагента «Плазма-калибратор»



Директор ООО фирма  
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот