


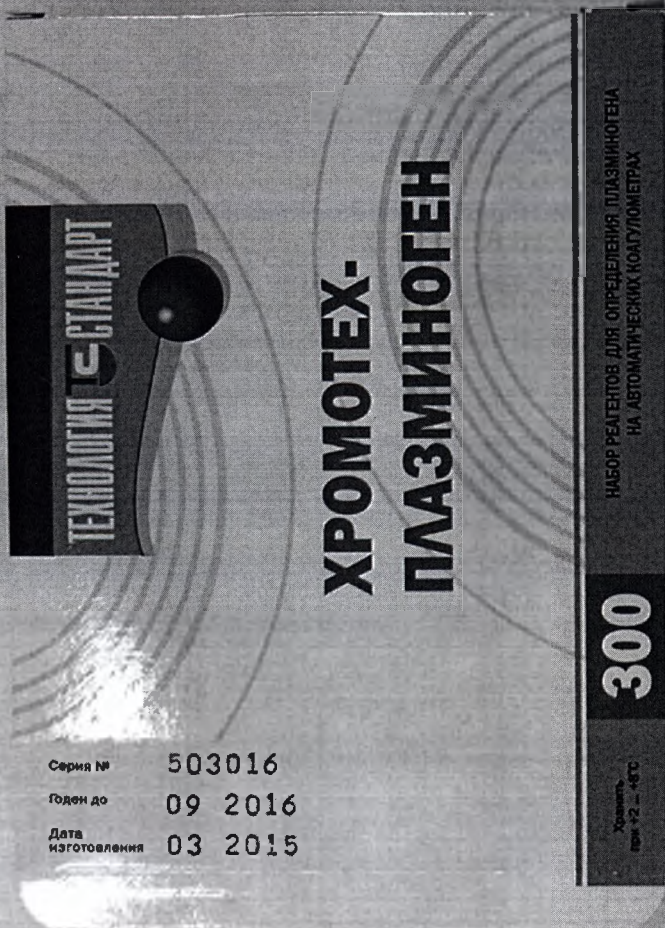

ООО фирма "Технология-Стандарт"
а/я 1351 г. Барнаул, Алтайский край
Тел./факс: (385-2) 27-13-00, 27-11-44

ПАСПОРТ № 891

реагентов для определения плазминогена на автоматических коагулометрах

ТУ 9398-058-42349142-2015




ХромоТех-Плазминоген

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения плазминогена на автоматических коагулометрах

Хранить при +2...+8°C

ИЗДАНИЕ 01

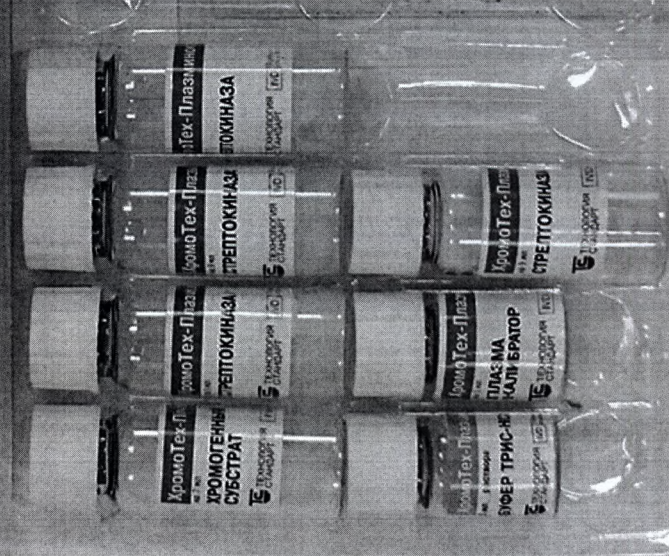

Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот