


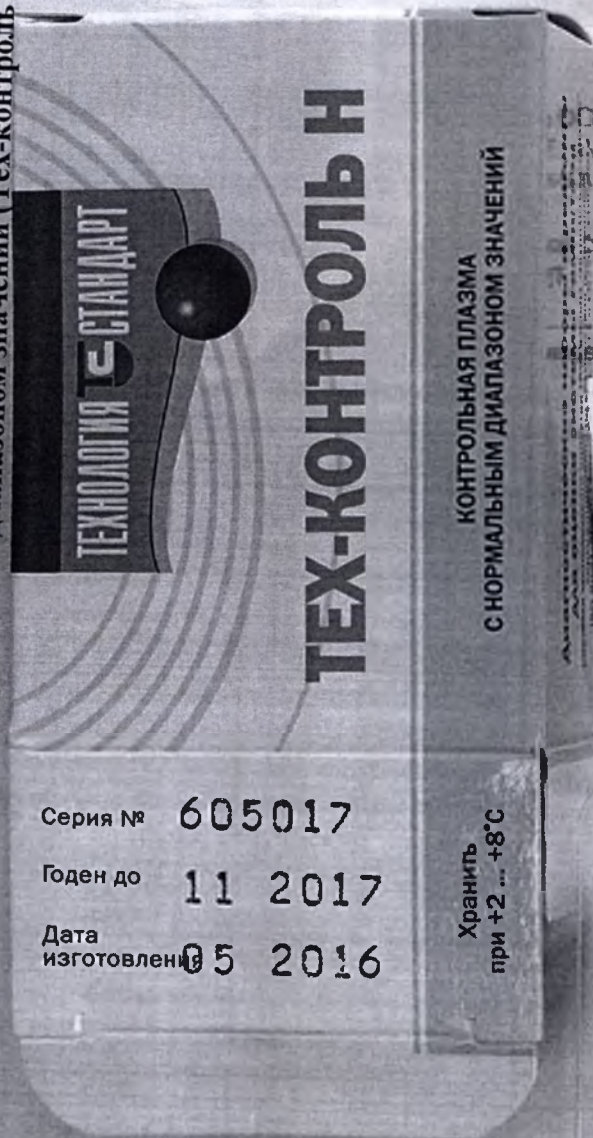

Серия № 605017
Годен до 11 2017
Дата изготовления 05 2016

КОНТРОЛЬНАЯ ПЛАЗМА
С НОРМАЛЬНЫМ ДИАПАЗОНОМ ЗНАЧЕНИЙ

Хранить
при +2 ... +8°C

ООО фирма "Технология-Стандарт"
а/я 1351 г. Барнаул, Алтайский край, 656037
тел.факс: (385-2) 27-13-00, 27-11-01, 22-99-37
ПАСПОРТ № 014
с нормальным диапазоном значений (Тех-контроль Н)
ТУ 9398-067-42349142-2016

Годен до 11.2017

описание показателя

Должное

Фактическое



Директор ООО фирма "Технология-Стандарт" А.П. Момот

Макет этикеток медицинского изделия «Контрольная плазма с нормальным диапазоном значений (Тех-контроль Н) по ТУ 9398-067-42349142-2016».

Макет этикетки реагента «Тех-контроль Н»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



Макет упаковки медицинского изделия «Контрольная плазма с нормальным диапазоном значений (Тех-контроль Н) по ТУ 9398-067-42349142-2016»



Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

