



Устройства MIRA-i CS для проведения операций на работающем сердце с минимально инвазивным доступом с принадлежностями с прикрепленным стабилизатором ACROBAT – i (продается отдельно)

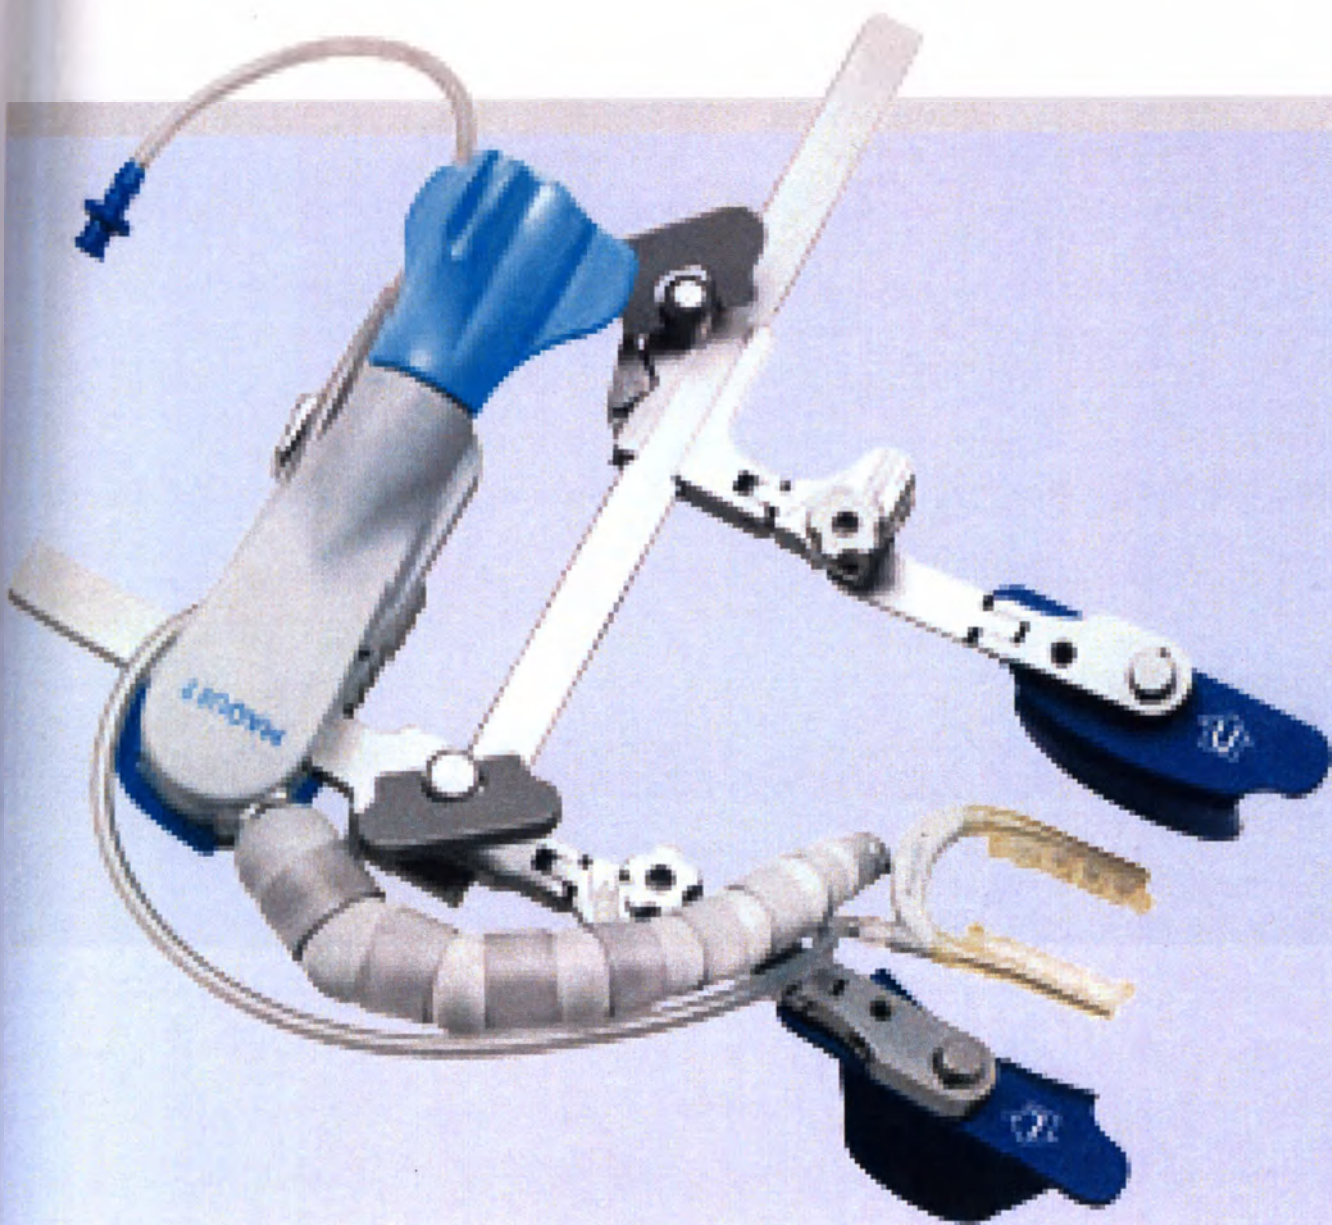

Устройство Mira-i CS для разведения краев операционной раны.

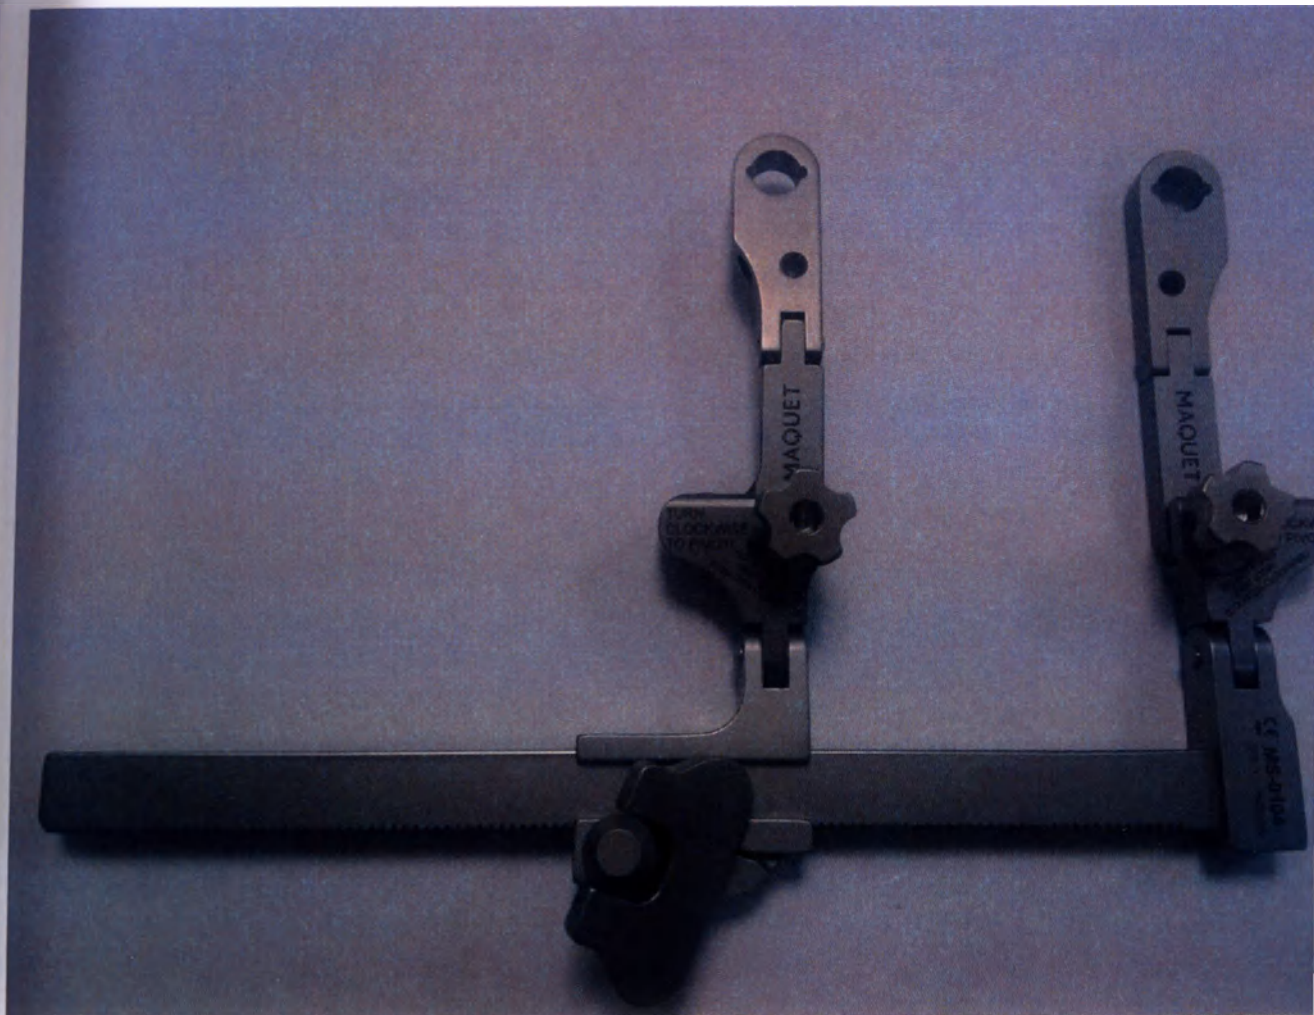

Устройство Mira-i CS для позиционирования краёв операционной раны изогнутое микро



**Устройство Miga-i CS для позиционирования верхнего ребра (обратный изгиб)
микро**




Устройство Mira-i CS для позиционирования краёв операционной раны изогнутое
малое



**Устройство Mira-i CS для позиционирования верхнего ребра (обратный изгиб)
малое**



Устройство Mira-i CS для позиционирования краёв операционной раны изогнутое среднее

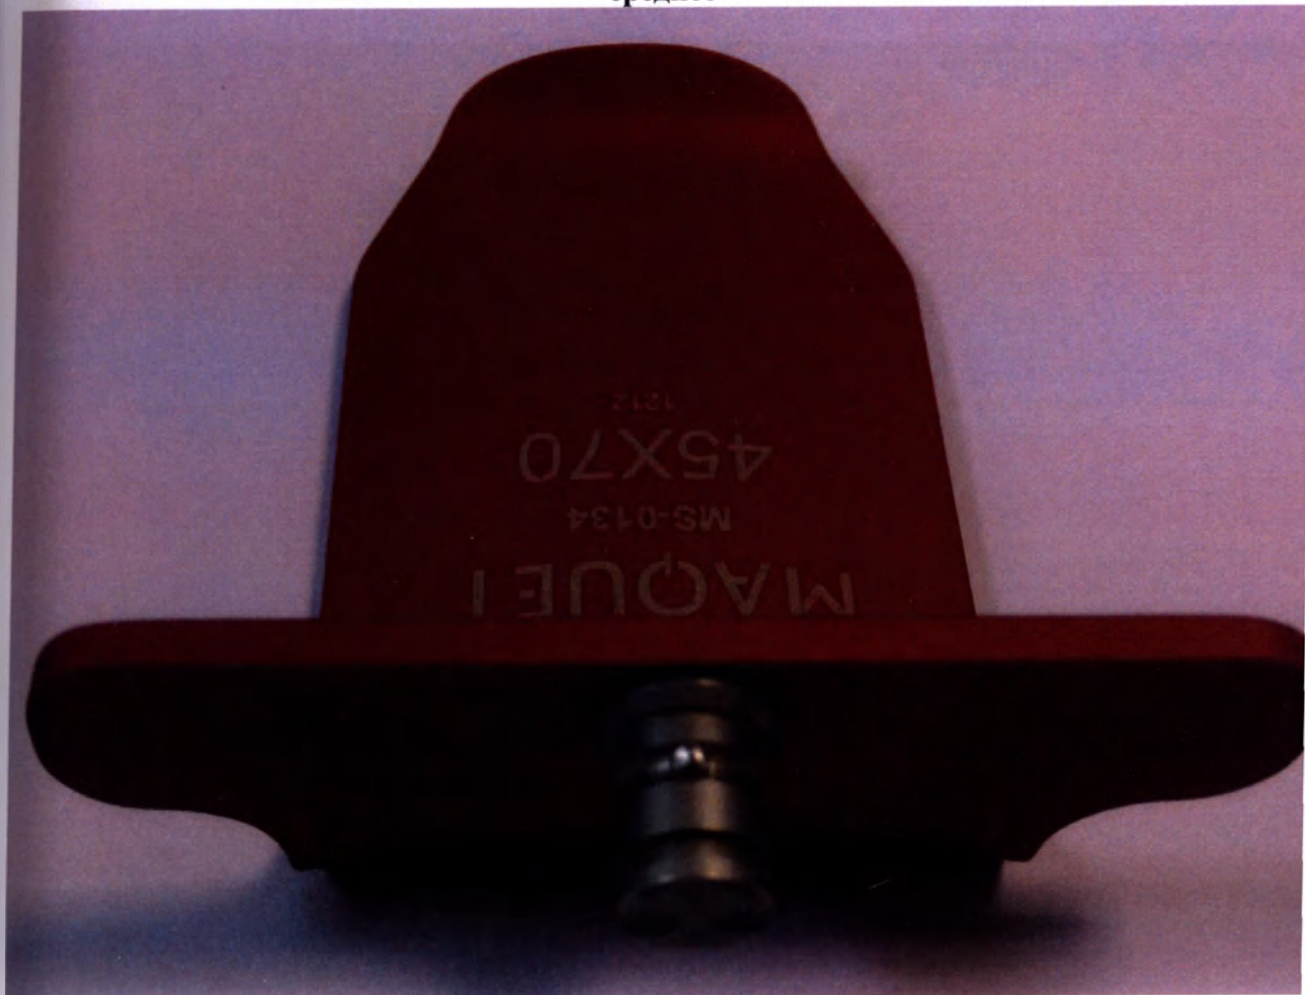

**Устройство Mira-i CS для позиционирования верхнего ребра (обратный изгиб)
среднее**



Устройство MIRA-i CS для позиционирования внутренней артерии широкое.



Устройство MIRA-i CS для позиционирования внутренней артерии узкое.





Инструмент для регулировки MIRA – i CS.




Устройство – адаптер MIRA-i CS для стабилизатора (для ACROBAT – i).



Зажим штатива MIRA – i CS.

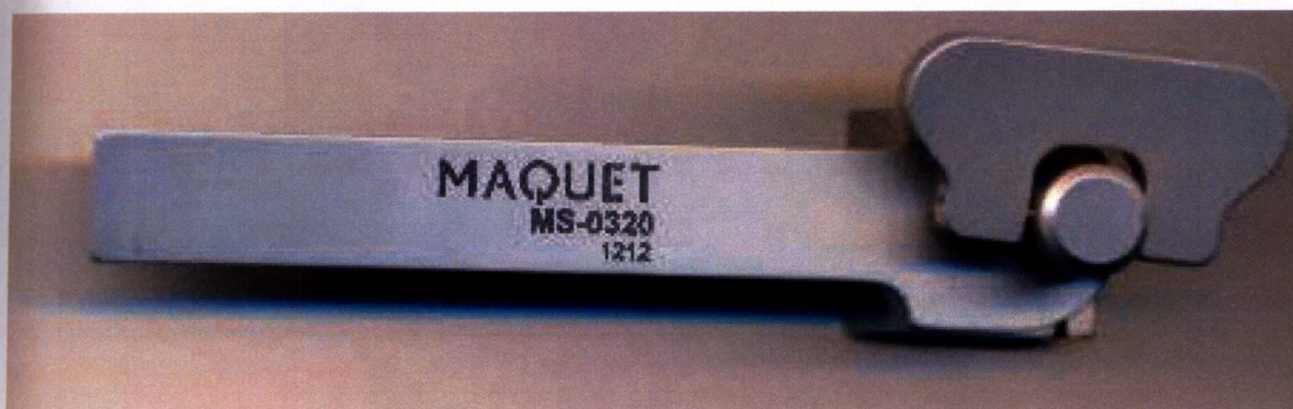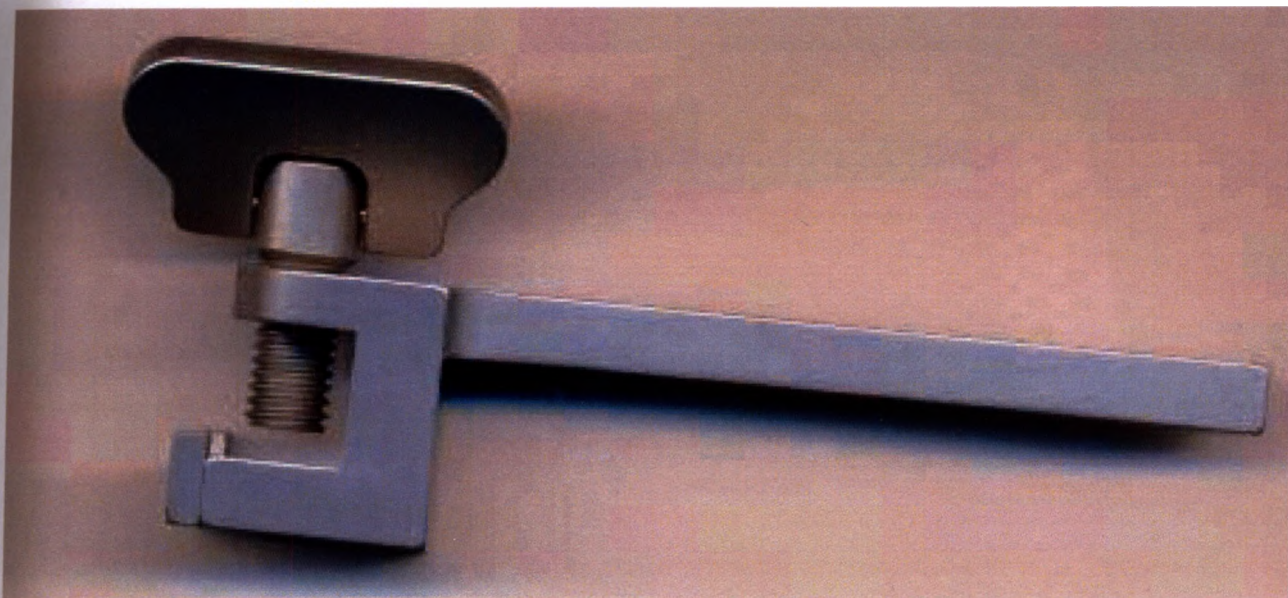

Лоток для стерилизации MIRA – i CS.

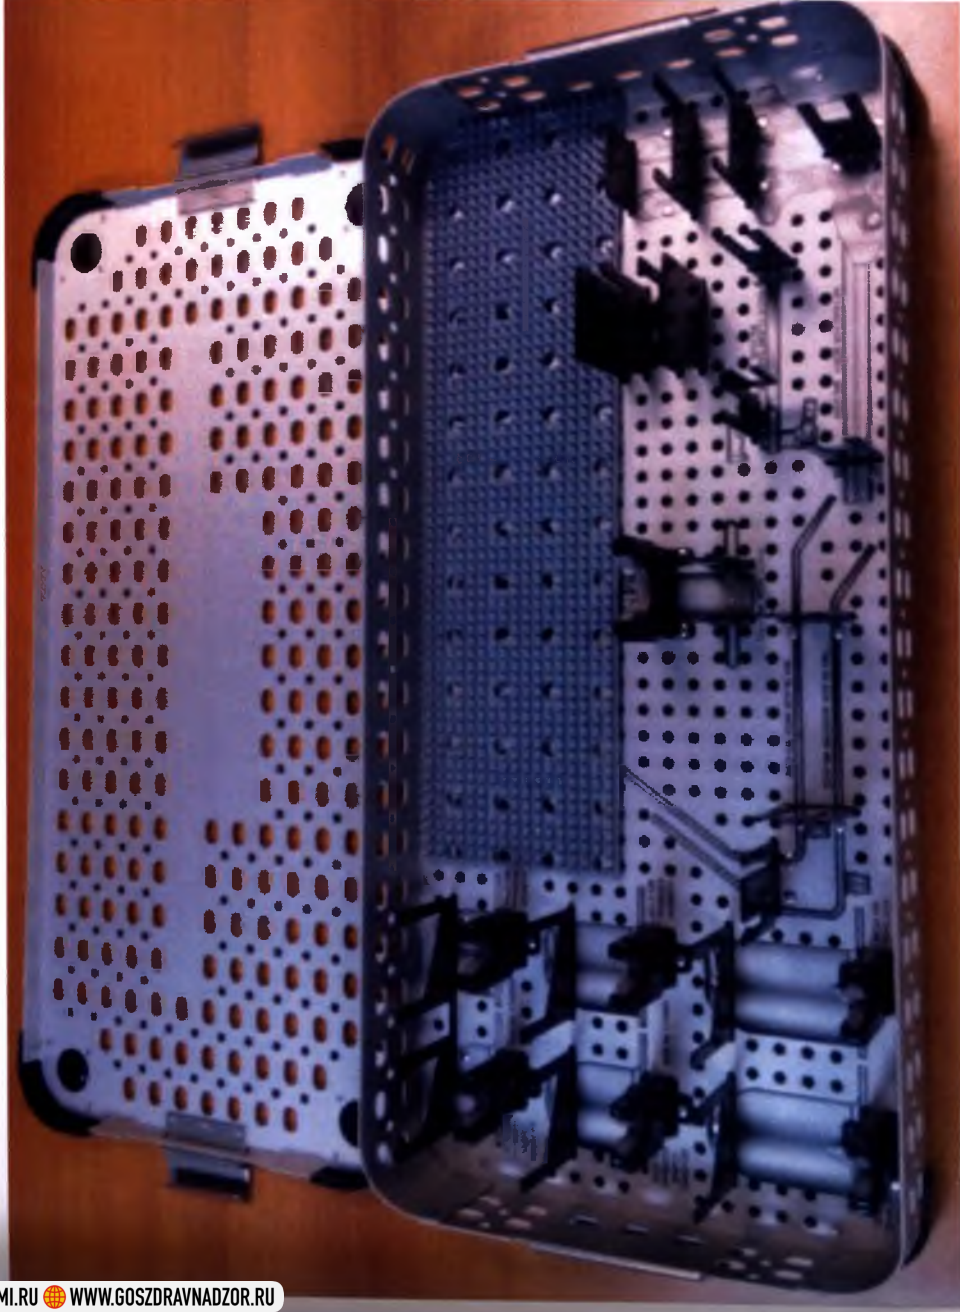

Исполнитель
Иванов Иван

