

3

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Интерторг»

Наумов М.С.

18.04.2024

**Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые
одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные, размеры XS, S,
M, L, XL. Цвета: голубой, фиолетовый, розовый, бирюзовый, синий, белый,
оранжевый, черный.**

**Фотографические изображения медицинского изделия,
маркировки и упаковки**

Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.
(Аньхой Интко Медикал Продактс Ко., Лтд.)

No. 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui
Province, China 235100
(235100 Китай, Провинция Аньхой, Хуайбэй Сити, Суйси Каунти, Суйси Вуху Модерн Индастриал
Парк, Хайтан Сауф Роуд, № 6)

Введены в действие: Апрель 2024г.

Примечание: изделия имеют одинаковый внешний вид; они отличаются только размером и цветом.

Рисунок 1. Внешний вид медицинского изделия: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные (вид 185830), размеры XS, S, M, L, XL. Цвета: голубой, фиолетовый, розовый, бирюзовый, синий, белый, оранжевый, черный.

По Вариантам исполнения:

- 1) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Light
- 2) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Esthetics
- 3) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Ultra
- 4) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Soft
- 5) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Flexible
- 6) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Sensitive
- 7) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Ideal
- 8) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Delicate
- 9) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Protect
- 10) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Durable
- 11) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Reliable
- 12) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Lasting
- 13) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Guard
- 14) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Secure
- 15) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Sturdy
- 16) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Hardy



Рис. 2: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 100 шт., общий вид.

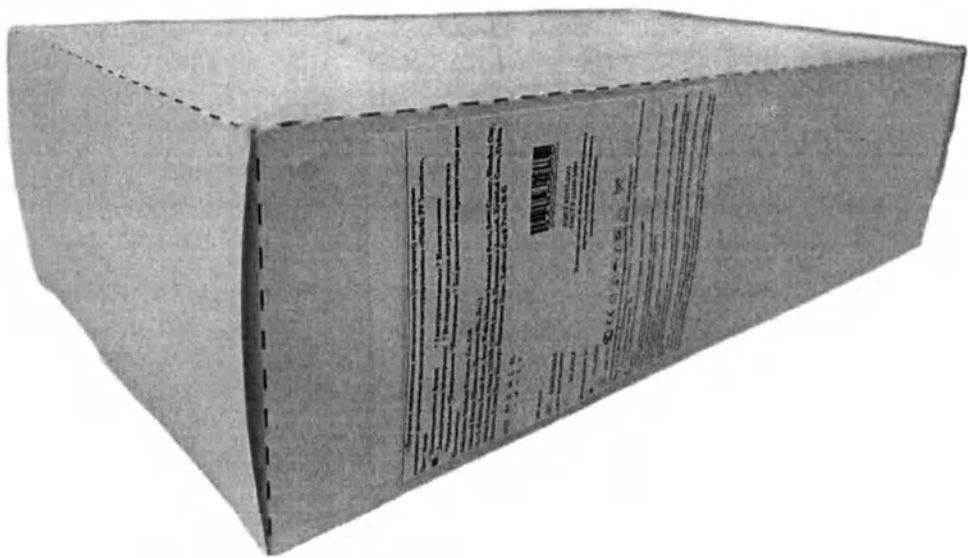


Рис. 3: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 100 шт., увеличенный вид.

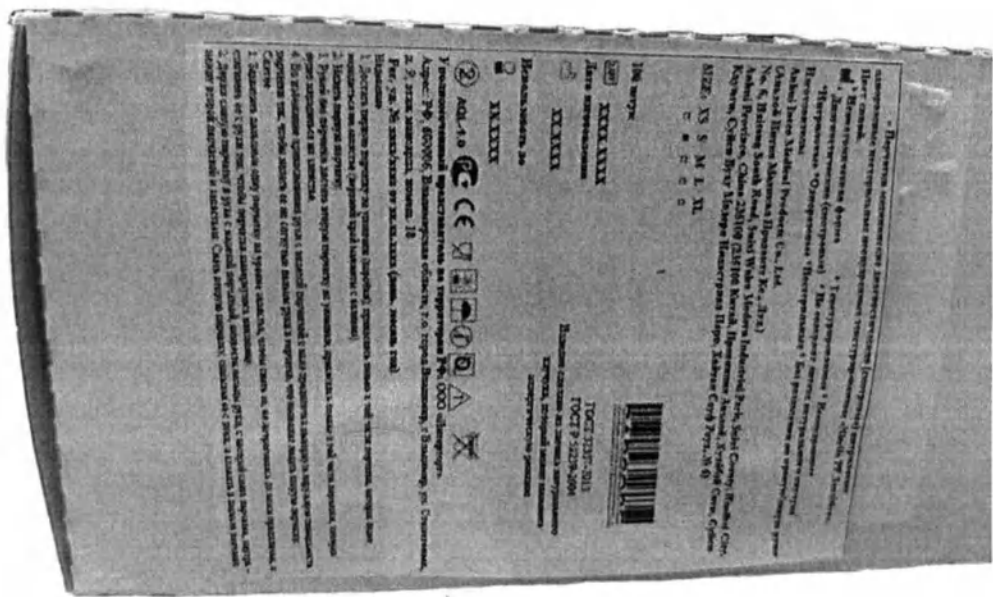


Рис. 4: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 100 шт., вид снизу и сбоку.

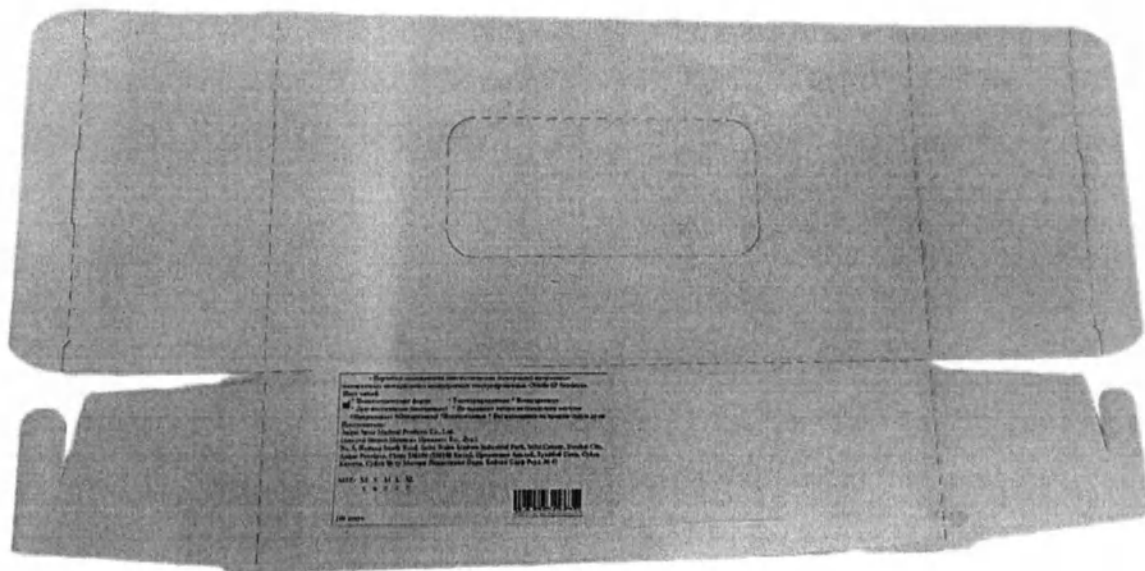


Рис. 5: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 100 шт., вид сверху и сбоку.

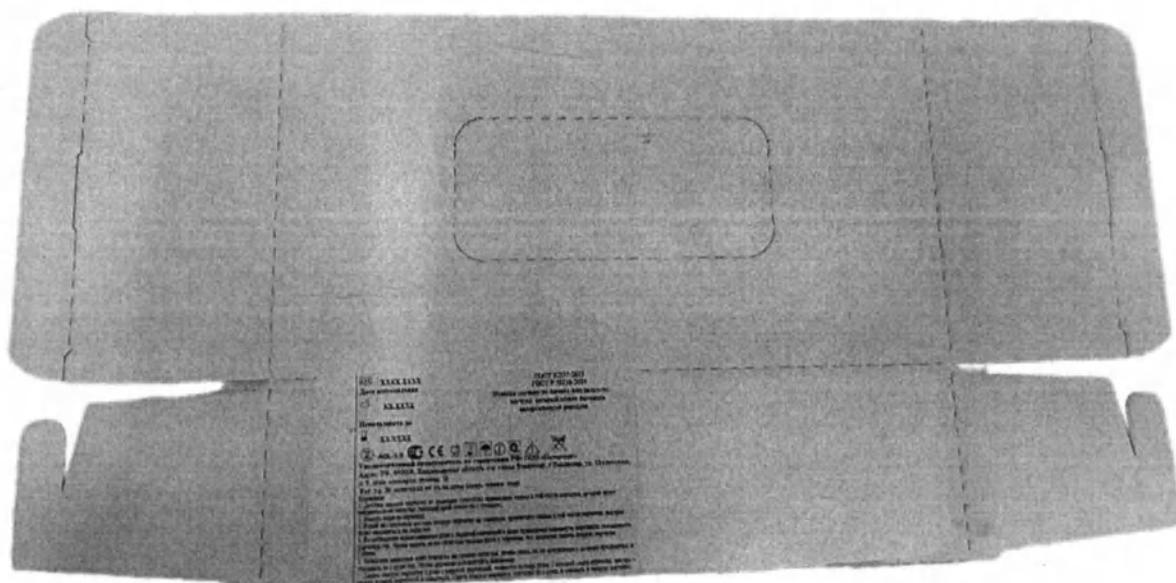


Рис. 6: Изображение маркировки транспортной упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 1000 шт., общий вид.



Рис. 7: Изображение маркировки транспортной упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 1000 шт., увеличенный вид.

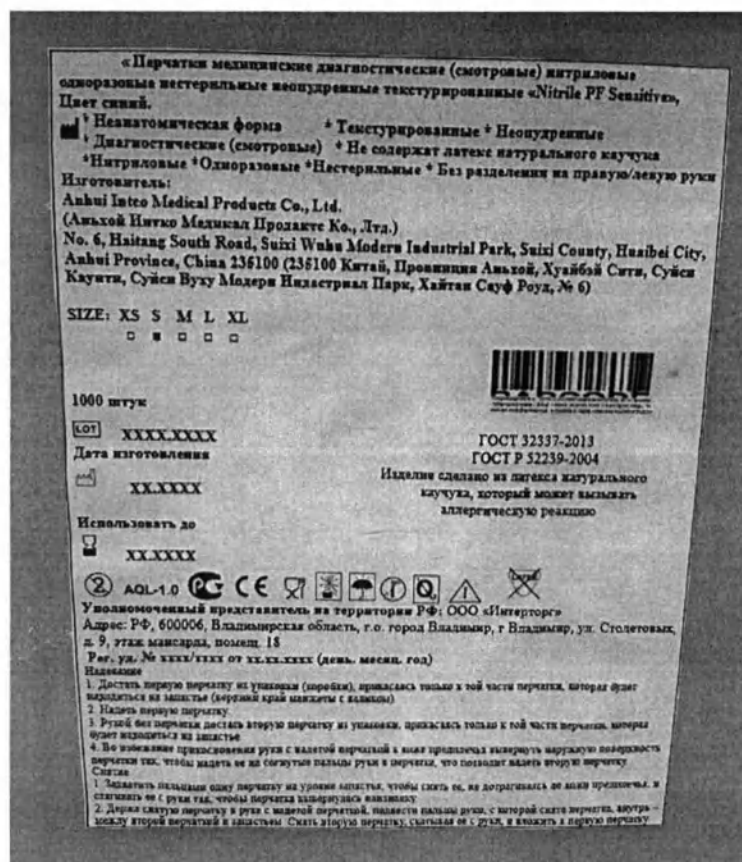


Рис. 8: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 10 штук, общий вид



Рис.9: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 20 штук, общий вид.



Рис. 10: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive», 40 штук, общий вид.



Рис. 11: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 50 штук, общий вид.



Рис. 12: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 70 штук, общий вид.




Рис. 13: Изображение маркировки потребительской упаковки (ПЭТ) на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 70 штук, общий вид.



Рис. 14: Изображение маркировки потребительской упаковки (ПЭТ) на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 70 штук, увеличенный вид.



Генеральный директор
ООО «Интерторг»



Наумов М.С.

СЕРТИФИКАТ

/Логотип/

Китайский комитет содействия развитию международной торговли (ССРПТ)

Китайский комитет содействия развитию международной торговли (ССРПТ)
Международная торговая палата Китая

Китайский комитет содействия развитию международной торговли (ССТПТ)
Международная торговая палата Китая

/голографическая
печать/

СЕРТИФИКАТ

/QR-код/
№ 241100B0/055009

Настоящим подтверждается, что печать компании Аньхой Интко Медикал Продактс Ко., Лтд. на приложенном документе является подлинной.

/Часть печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли, специальная печать для сертификатов/

Китайский комитет содействия развитию международной торговли (ССТПТ)

*/Печать: Китайский комитет содействия развитию международной торговли,
специальная печать для сертификатов/*

Уполномоченное лицо: */Подпись/*

Гао Личао

Дата: 29 октября 2024 г.

*/Печать: Китайский комитет
содействия развитию
международной торговли,
специальная печать для
сертификатов/*

Сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

16

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Интерторг»

Наумов М.С.
18.04.2024

**Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные
неопудренные текстурированные, размеры XS, S,
M, L, XL. Цвета: голубой, фиолетовый, розовый, бирюзовый, синий, белый, оранжевый, черный.**

Фотографические изображения медицинского изделия, маркировки и упаковки

Anhui Intco Medical Products Co., Ltd. (Аньхой Интко Медикал Продактс Ко., Лтд.)

No. 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui
Province, China 235100 (235100, КНР, провинция Аньхой, г. Хуайбэй, уезд Суйси, зона экономического
развития Суйю, ул. Южная Хайтан, д.6)

Введены в действие: Апрель 2024г.

*/Часть печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли, специальная печать
для сертификатов/*


Примечание: изделия имеют одинаковый внешний вид; они отличаются только размером и цветом.

Рисунок 1. Внешний вид медицинского изделия: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные (вид 185830), размеры XS, S, M, L, XL. Цвета: голубой, фиолетовый, розовый, бирюзовый, синий, белый, оранжевый, черный.

По Вариантам исполнения:

- 1) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Light
- 2) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Esthetics
- 3) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Ultra
- 4) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Soft
- 5) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Flexible
- 6) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Sensitive
- 7) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Ideal
- 8) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Delicate
- 9) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Protect
- 10) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Durable
- 11) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Reliable
- 12) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Lasting
- 13) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Guard
- 14) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Secure
- 15) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Sturdy
- 16) Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные Nitrile PF Hardy

/Часть печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли, специальная печать для сертификатов/

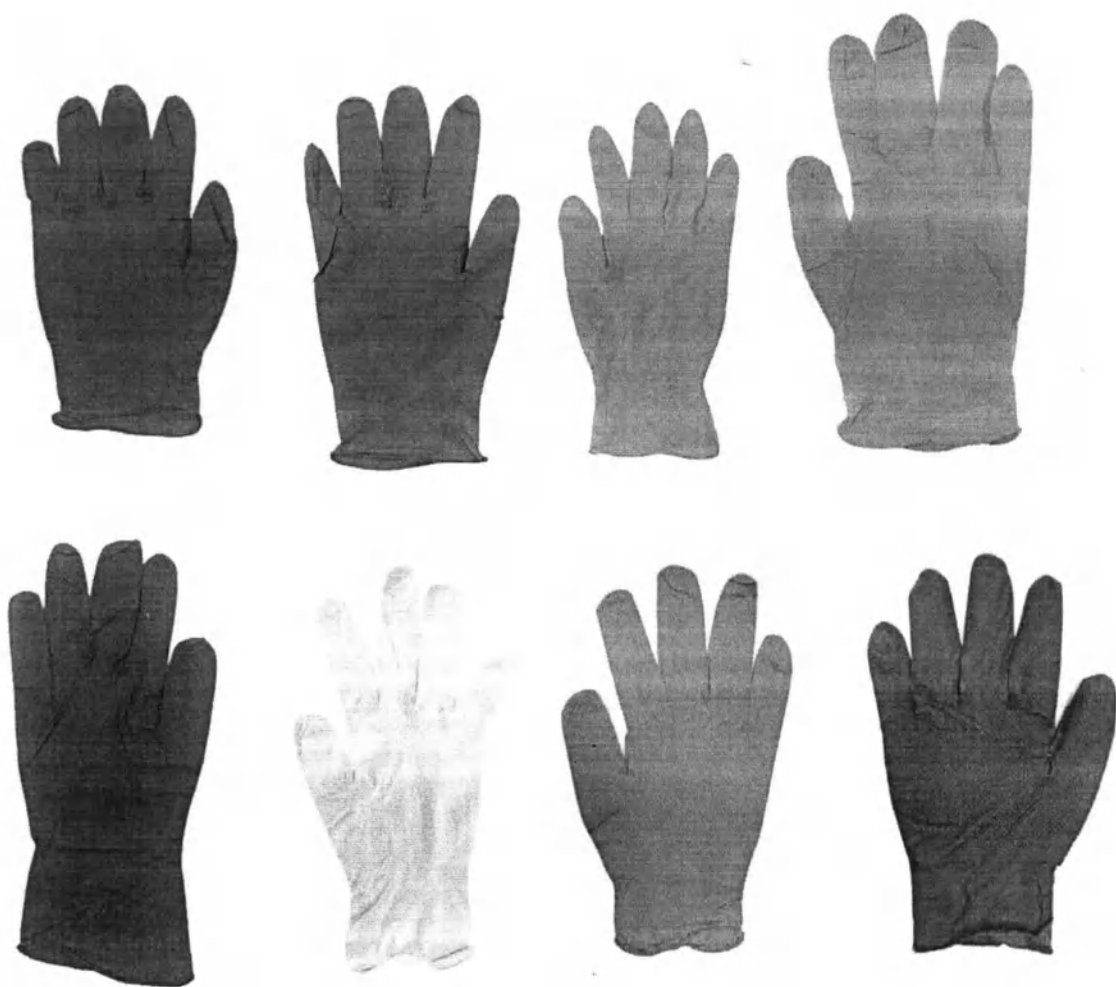

/Часть печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли, специальная печать для сертификатов/

Макет маркировки на индивидуальной упаковке (на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные «Nitrile PF Sensitive»:

«Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные «Nitrile PF Sensitive», Цвет синий.

 * Неанатомическая форма * Текстурированные * Неопудренные
* Диагностические (смотровые) * Не содержат латекс натурального каучука
* Нитриловые * Одноразовые * Нестерильные * Без разделения на правую/левую руки

Изготовитель:

Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.

(Аньхой Интко Медикал Продактс Ко., Лтд.)

No. 6, Haitang South Road, Suixi Wuhu Modern Industrial Park, Suixi County, Huaibei City, Anhui Province, China 235100 (235100 Китай, Провинция Аньхой, Хуайбэй Сити, Суйси Каунти, Суйси Вуху Модерн Индастриал Парк, Хайтан Сауф Роуд, № 6)

SIZE: XS S M L XL

☐ ☒ ☐ ☐ ☐



Маркировка, зарегистрированная в стране
обращении для этих изделий (параметры: в
виде цифровых кодов) при необходимости

100 штук

LOT

XXXX.XXXX

Дата изготовления



XX.XXXX

ГОСТ 32337-2013

ГОСТ Р 52239-2004

Изделие сделано из латекса натурального
каучука, который может вызывать
аллергическую реакцию

Использовать до



XX.XXXX



AQL-1.0



Надевание

1. Достать первую перчатку из упаковки (коробки), прикасаясь только к той части перчатки, которая будет находиться на запястье (верхний край манжеты с валиком).

2. Надеть первую перчатку.

3. Рукой без перчатки достать вторую перчатку из упаковки, прикасаясь только к той части перчатки, которая будет находиться на запястье.

4. Во избежание прикосновения руки с надетой перчаткой к коже предплечья вывернуть наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки в перчатке, что позволит надеть вторую перчатку.

Снятие

1. Захватить пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее, не дотрагиваясь до кожи предплечья, и стягивать ее с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку.

2. Держа снятую перчатку в руке с надетой перчаткой, подвести пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь – между второй перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложить в первую перчатку.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Интерторг»

Адрес: РФ, 600006, Владимирская область, г.о. город Владимир, г Владимир, ул. Столетовых, д. 9, этаж мансарда, помещ. 18

Рег. уд. № xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx (день. месяц. год)

/Часть печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли, специальная печать для сертификатов/

Рис. 2: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 100 шт., общий вид.


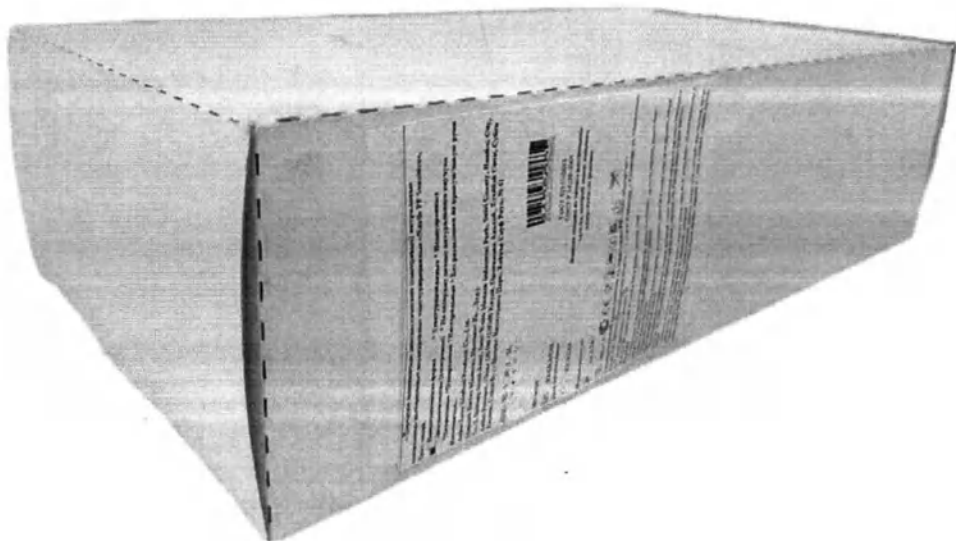


Рис. 3: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 100 шт., увеличенный вид.

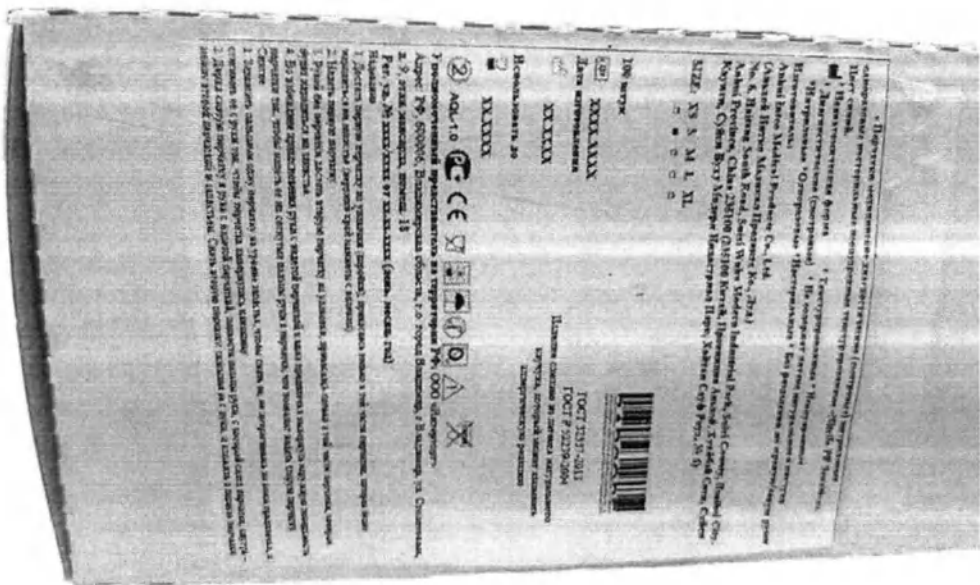

/Часть печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли, специальная печать для сертификатов/

Рис. 4: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 100 шт., вид снизу и сбоку.

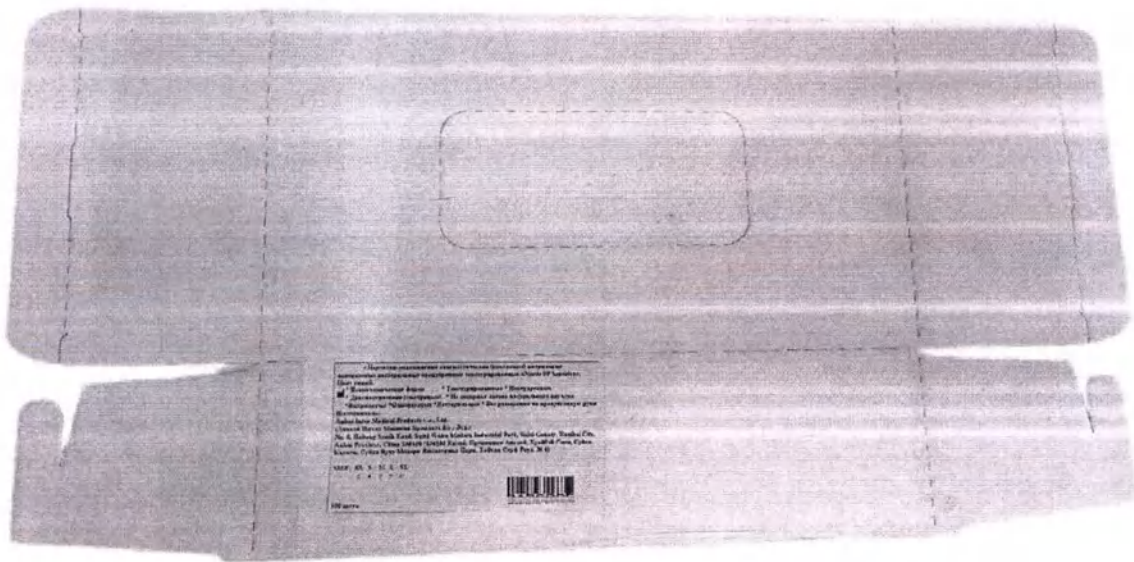


Рис. 5: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 100 шт., вид сверху и сбоку.

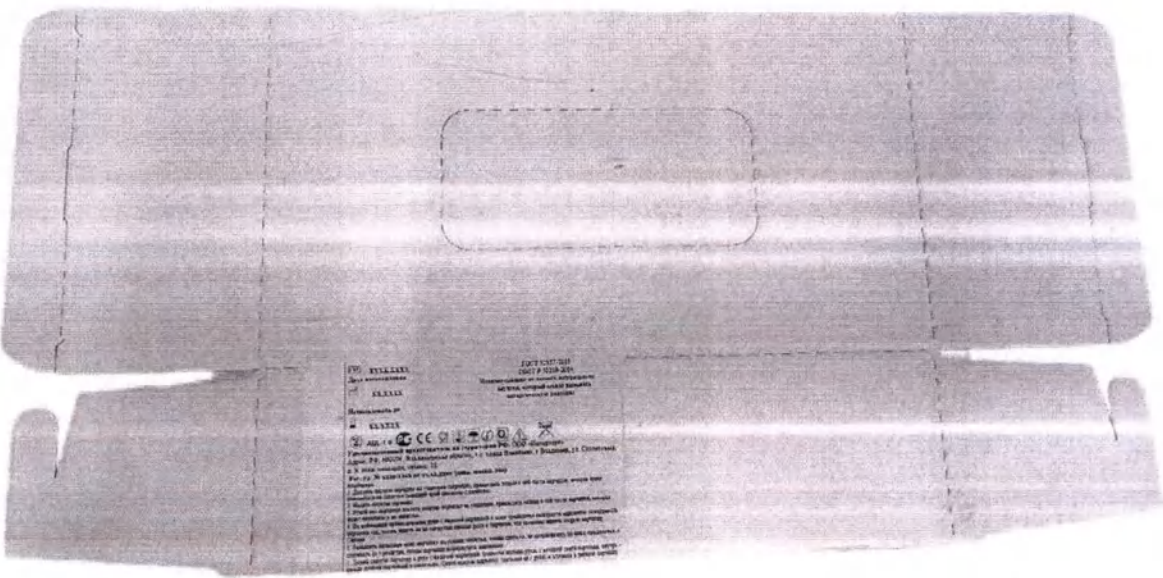


Рис. 6: Изображение маркировки транспортной упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 1000 шт., общий вид.



Рис. 7: Изображение маркировки транспортной упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 1000 шт., увеличенный вид.

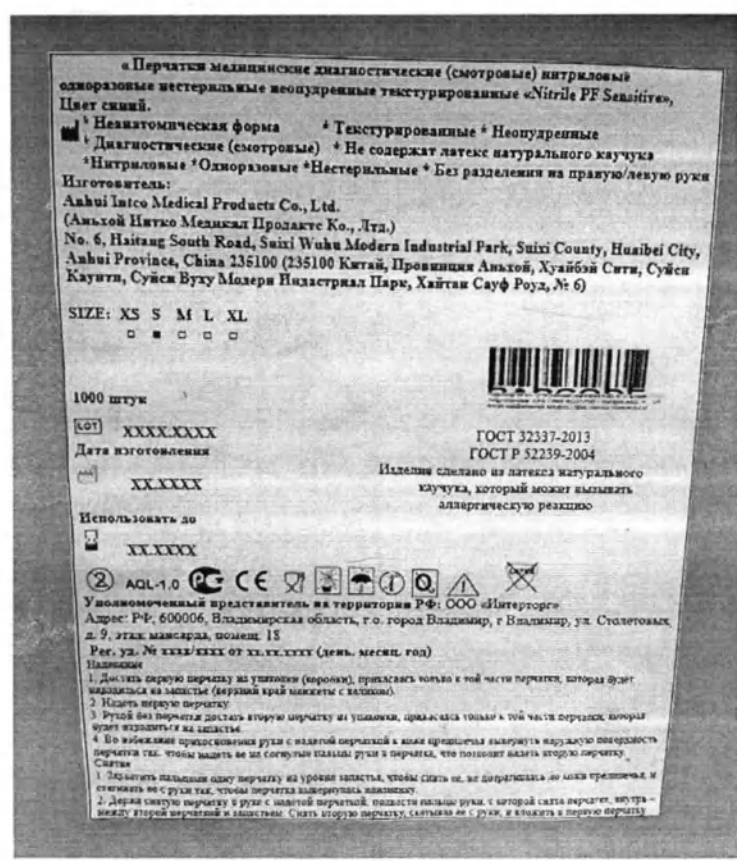


Рис. 8: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 10 штук, общий вид



Рис.9: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 20 штук, общий вид.



/Часть печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли, специальная печать для сертификатов/

Рис. 10: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive», 40 штук, общий вид.



Рис. 11: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 50 штук, общий вид.



/Часть печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли, специальная печать для сертификатов/

Рис. 12: Изображение маркировки потребительской упаковки на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 70 штук, общий вид.



Рис. 13: Изображение маркировки потребительской упаковки (ПЭТ) на примере варианта исполнения «Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нитриловые одноразовые нестерильные неопудренные текстурированные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 70 штук, общий вид.



/Часть печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли, специальная печать для сертификатов/

Изображение маркировки потребительской упаковки (ПЭТ) на примере варианта исполнения перчаток медицинские диагностические (смотровые) нитриловые Порозовые нестерильные неопудренные нестерилизованные неопудренные «Nitrile PF Sensitive» 70 штук, увеличенный вид.



Генеральный директор
ООО «Интерторг»

Наумов М.С.

/Печать: Медицинские принадлежности Интко (Аньхой), Лтд., 3408210109621/

/Часть печати: Китайский комитет содействия развитию международной торговли, специальная печать для сертификатов/

Конец перевода

Перевод с китайского и английского на русский язык выполнил переводчик
Сурков Борис Михайлович



Российская Федерация
Город Владимир Владимирской области

Двенадцатого декабря две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Атюскина Екатерина Викторовна, нотариус нотариального округа города Владимир, свидетельствую подлинность подписи переводчика Суркова Бориса Михайловича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 33/158-н/33-2024-8-874.

Уплачено за совершение нотариального действия: 800 руб. 00 коп.



Е.В.Атюскина

Прошито, пронумеровано
на двадцати листах
и скреплено печатью
нотариус Е.В. Атюскина

