

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО НТО «ИРЭ-Полус»

Н.Н. Евтихийев

2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (дополнение)

на медицинское изделие

Аппарат лазерный медицинский FiberLase CR по ТУ 32.50.50-061-18003536-2020

Варианты исполнения FiberLase CR, FiberLase CR S

2020

Аппарат лазерный медицинский FiberLase CR
по ТУ 32.50.50-061-18003536-2020, в варианте исполнения

FiberLase CR S

SN	FLCR190010		2019
----	------------	---	------

Хар-ки питания Аппарата 18 V --- 5.55 A max	Хар-ки Бл. к питания: 100—240V ~ 47-63 Hz 1.2-0.5A MODEL NO : HPU101-10*
--	--

IP20

Рабочий цикл: Непродолжительный

Вкл/Выкл 60/15 мин

I класс защиты от поражения
электрическим током





 ООО "НТО ИРЭ-Полус"
Пг. Академика Б.А. Важенского 1, стр. 3,
г. Фрязино, Московская обл., 141190, Россия

IRG
IRE-Polus

Внешний вид маркировки аппарата (пример)

**Маркировка
транспортной
упаковки (пример)**

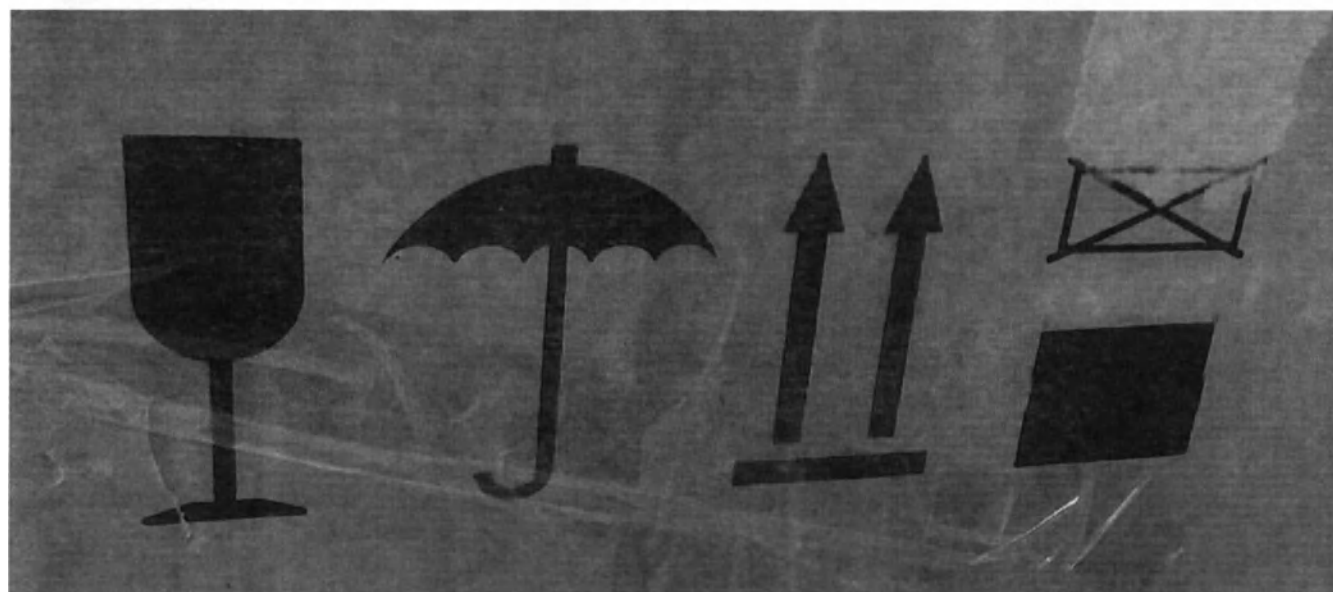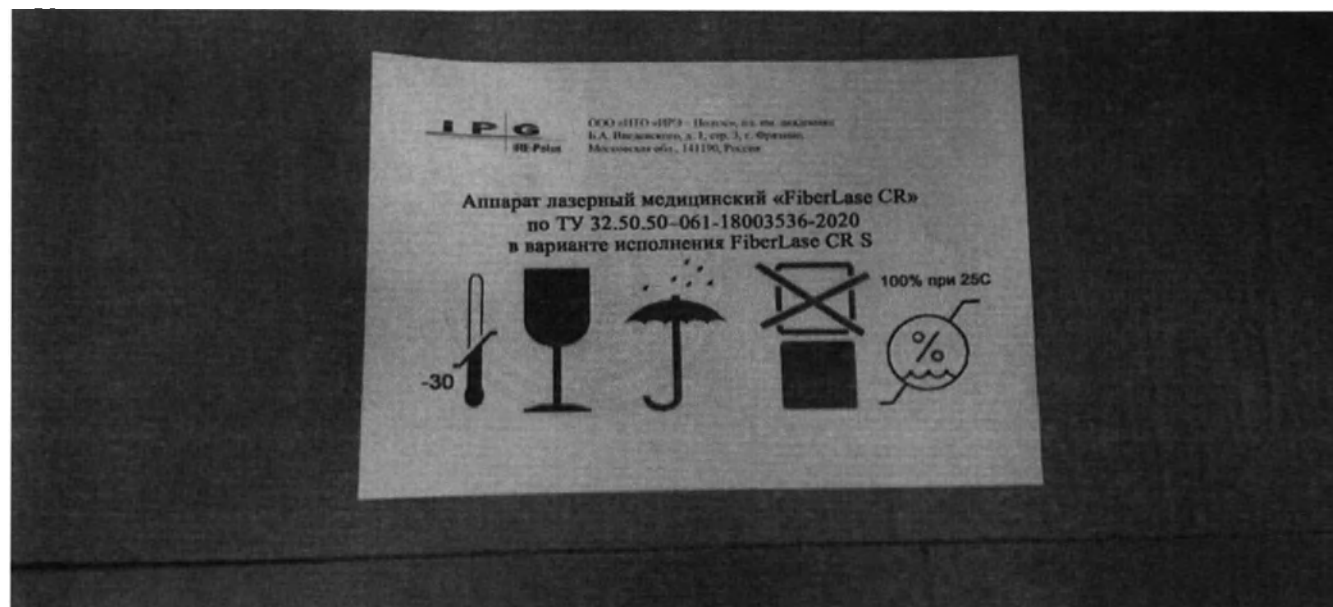



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

ООО ИТО «ИРЭ-ПОЛЮС»

лист

Печать, подпись

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО ИТО «ИРЭ-ПОЛЮС»

ЕВТИХИЕВ Н.Н.