

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕТ»



Филиппов С.В.



«28»  2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Матрас противопролежневый медицинский «МЕТ» по ТУ 32.50.50-013-11459109-2021
в вариантах исполнения с принадлежностями

Матрас противопролежневый медицинский «МЕТ» в вариантах исполнения:
MET AIR T-100



MET AIR T-200



MET AIR WC-100



MET AIR WC-200



MET AIR WC-300 XL



MET ROVACARE



MET AIR PRO-1000



MET AIR PRO-300



MET AIR PRO-400



MET AIR PRO-500



MET AIR PRO-600



MET AIR PRO-900



MET AIR PRO-800



Матрас медицинский «МЕТ» с активной противопротезной программой в вариантах исполнения:
MET AIR BASIC





MET AIR PRO-200


MET AIR BRIO



MET AIR PRO-1200




MET AIR BASIC XXL

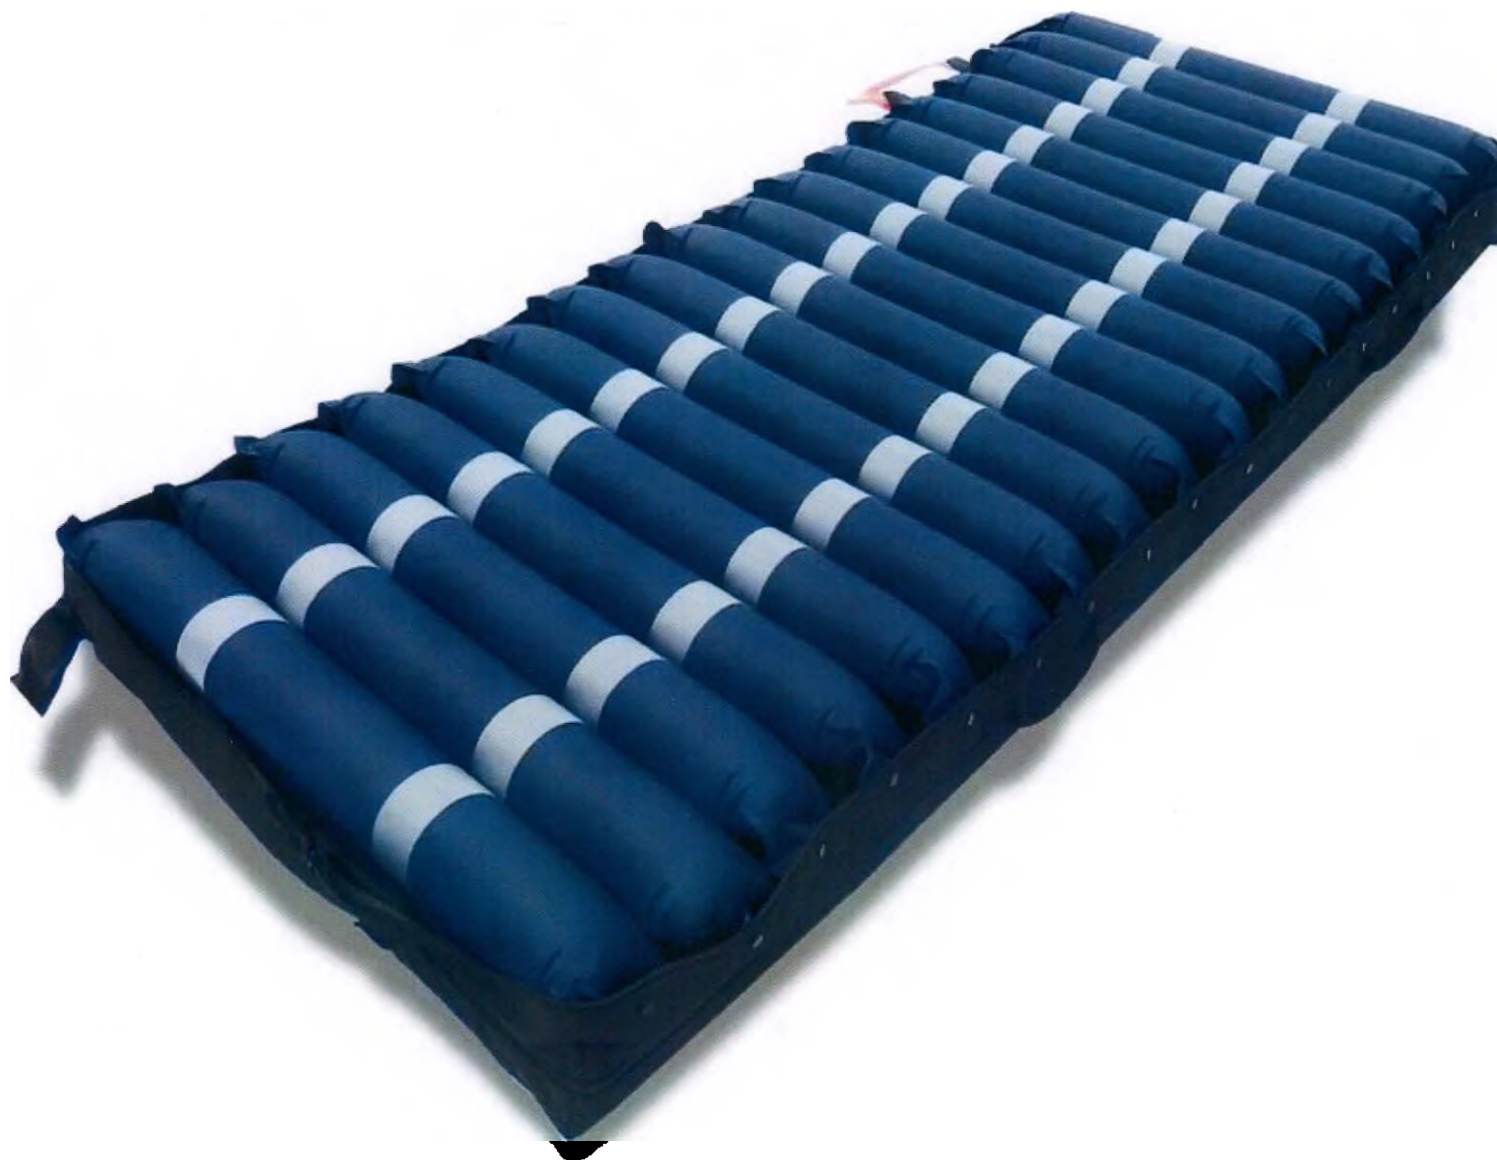

MET AIR PRO-1400



MET AIR PRO-1500

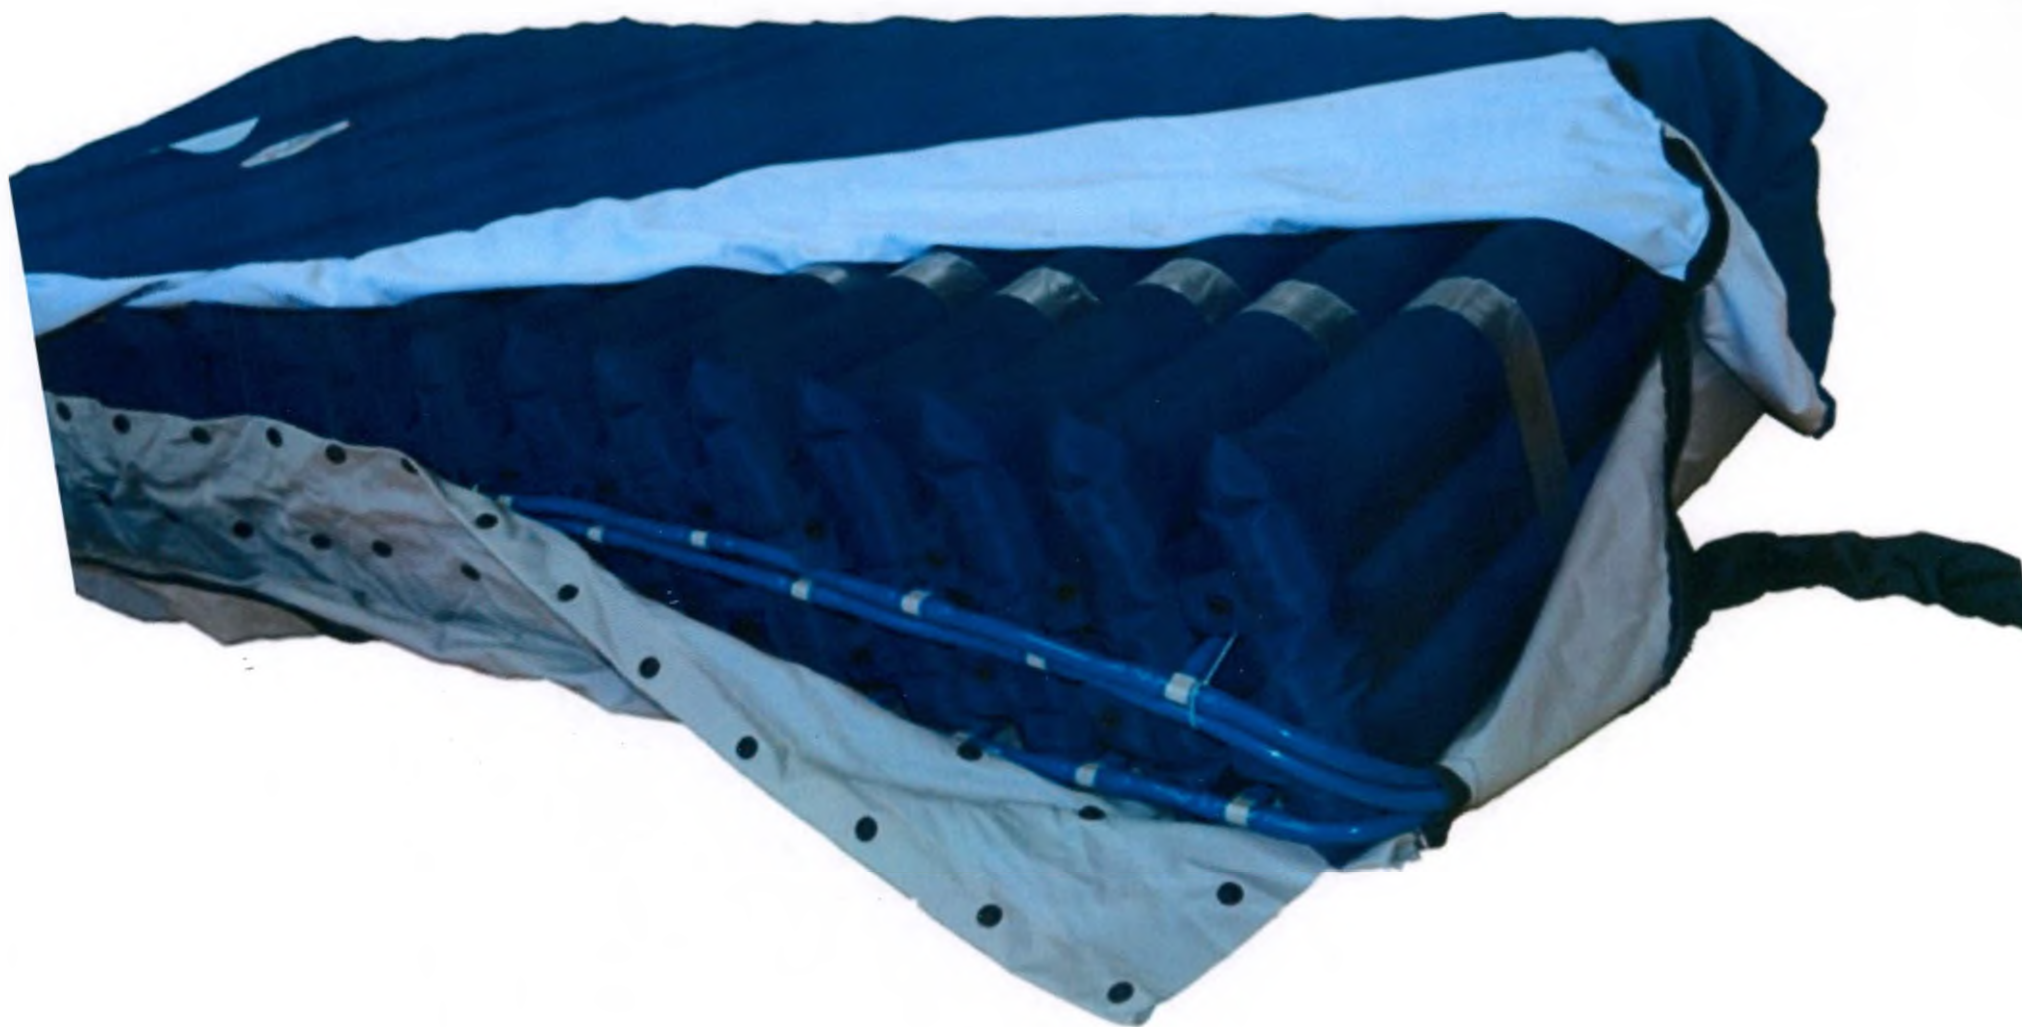

Матрас противопролежневый медицинский «МЕТ» с динамичным режимом в вариантах исполнения:
MET AIR B-100



MET AIR B-300



MET AIR B-400



MET AIR B-500



Компрессор МЕТ КР-100




Компрессор МЕТ КР-200



Компрессор MET KP-300



Шланг соединительный

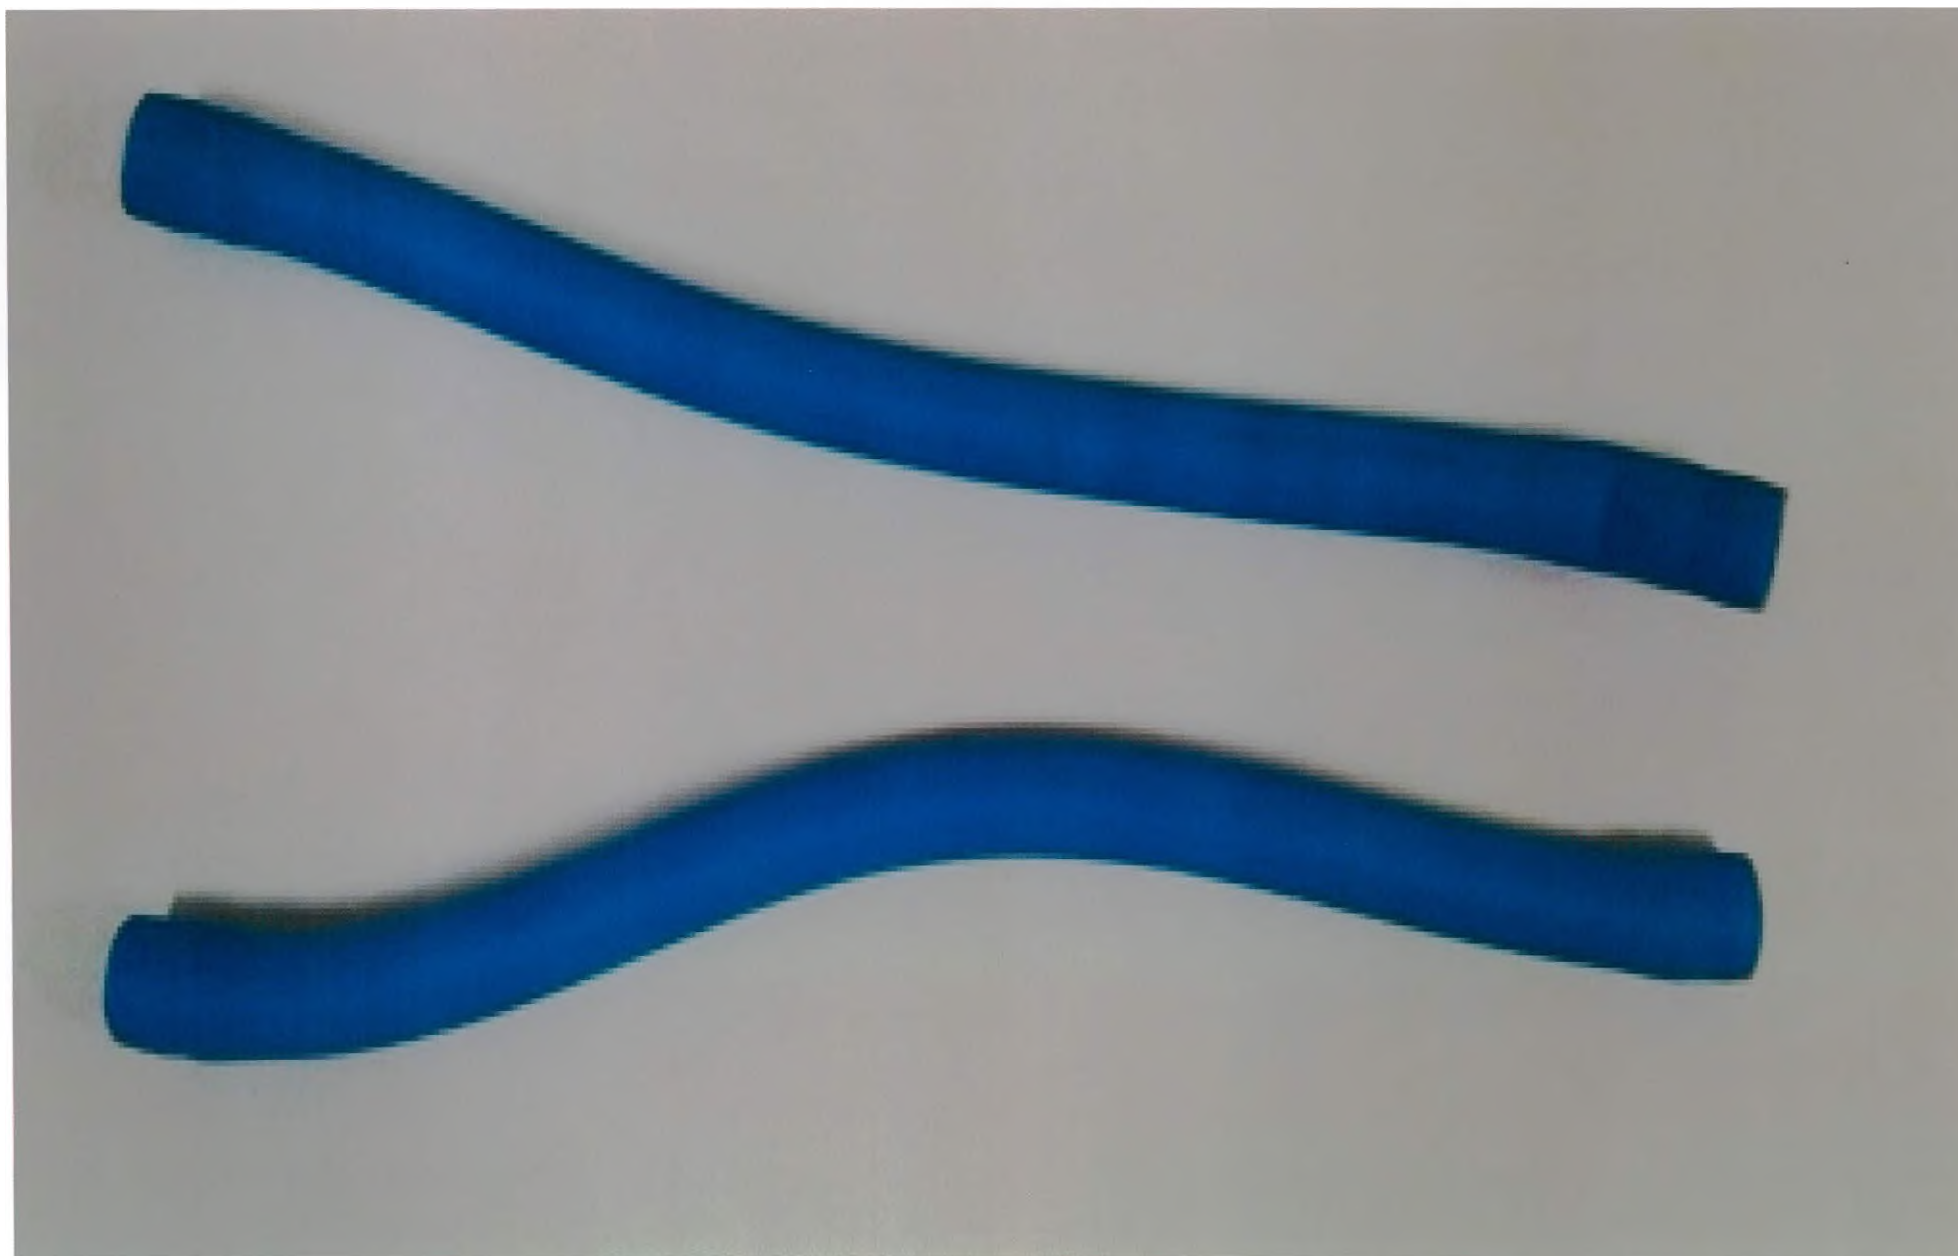

Матрасная вставка




Чехол




Сумка для хранения



Аккумуляторная батарея (встроена в компрессор)

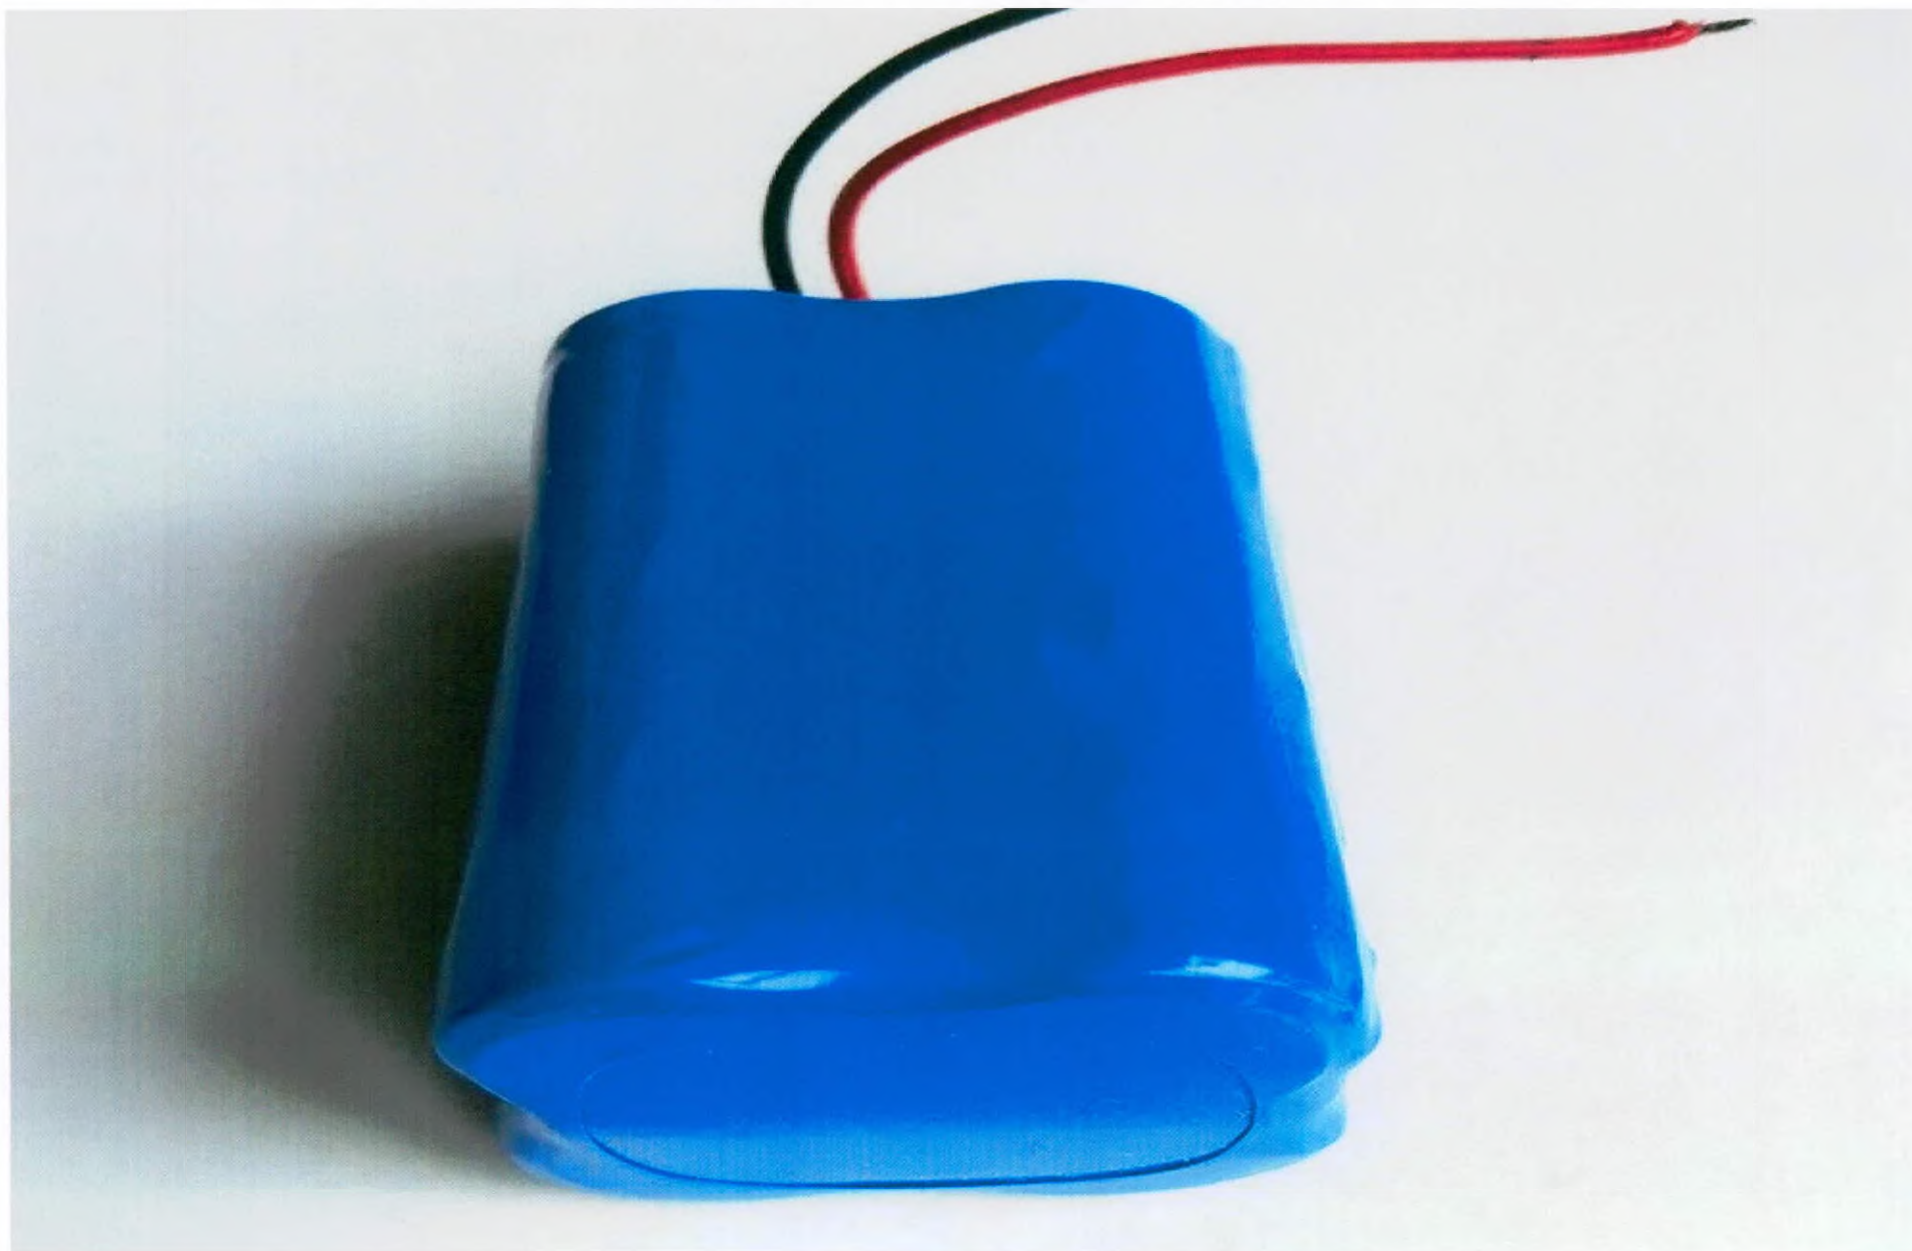


Зарядное устройство

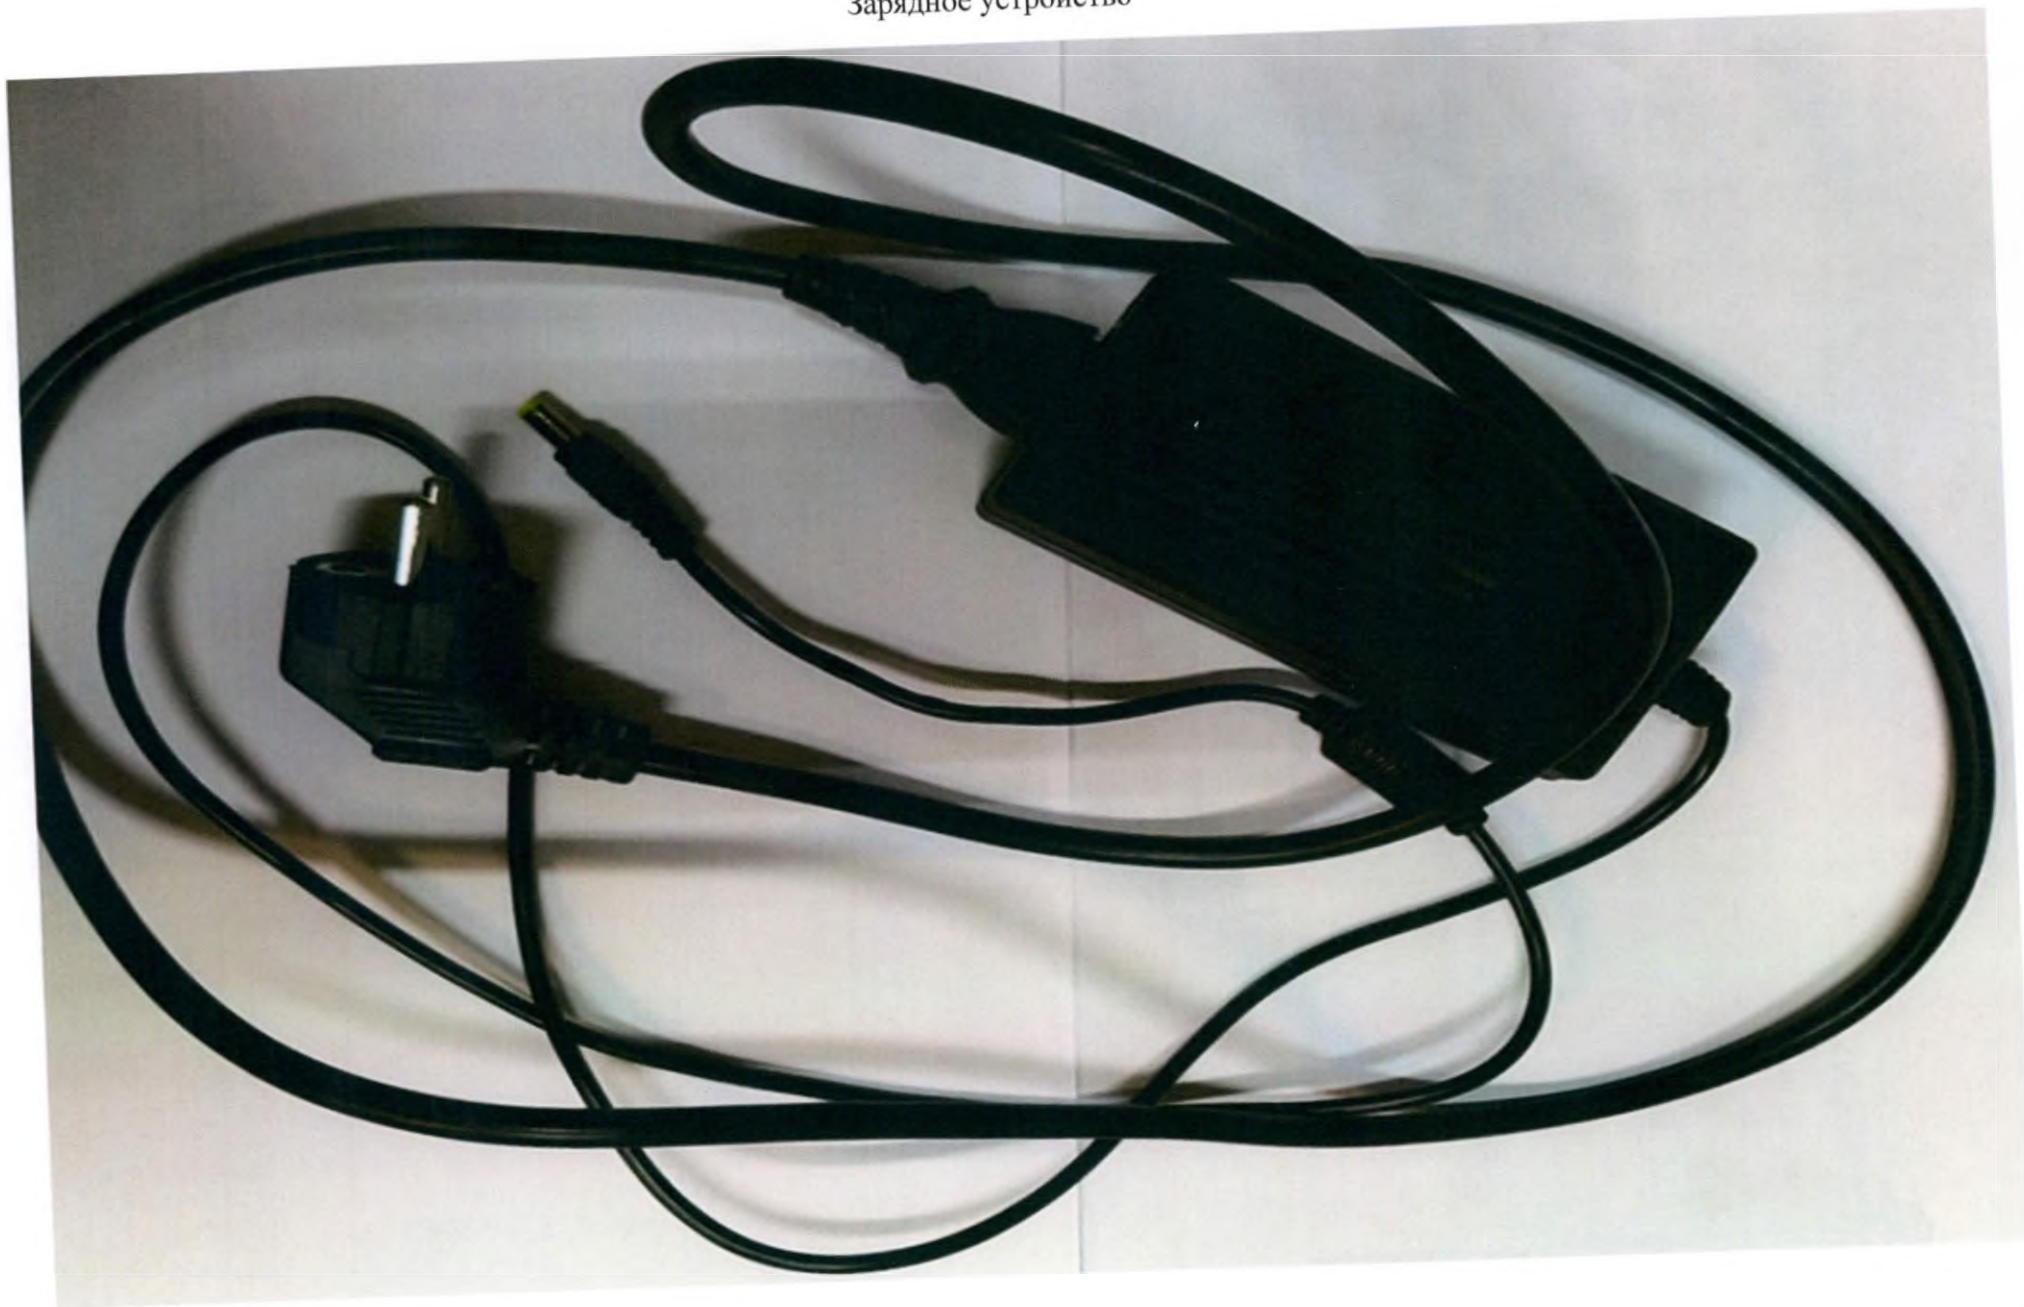

Датчик давления (встроен в компрессор)



Датчик температуры (встроен в компрессор)

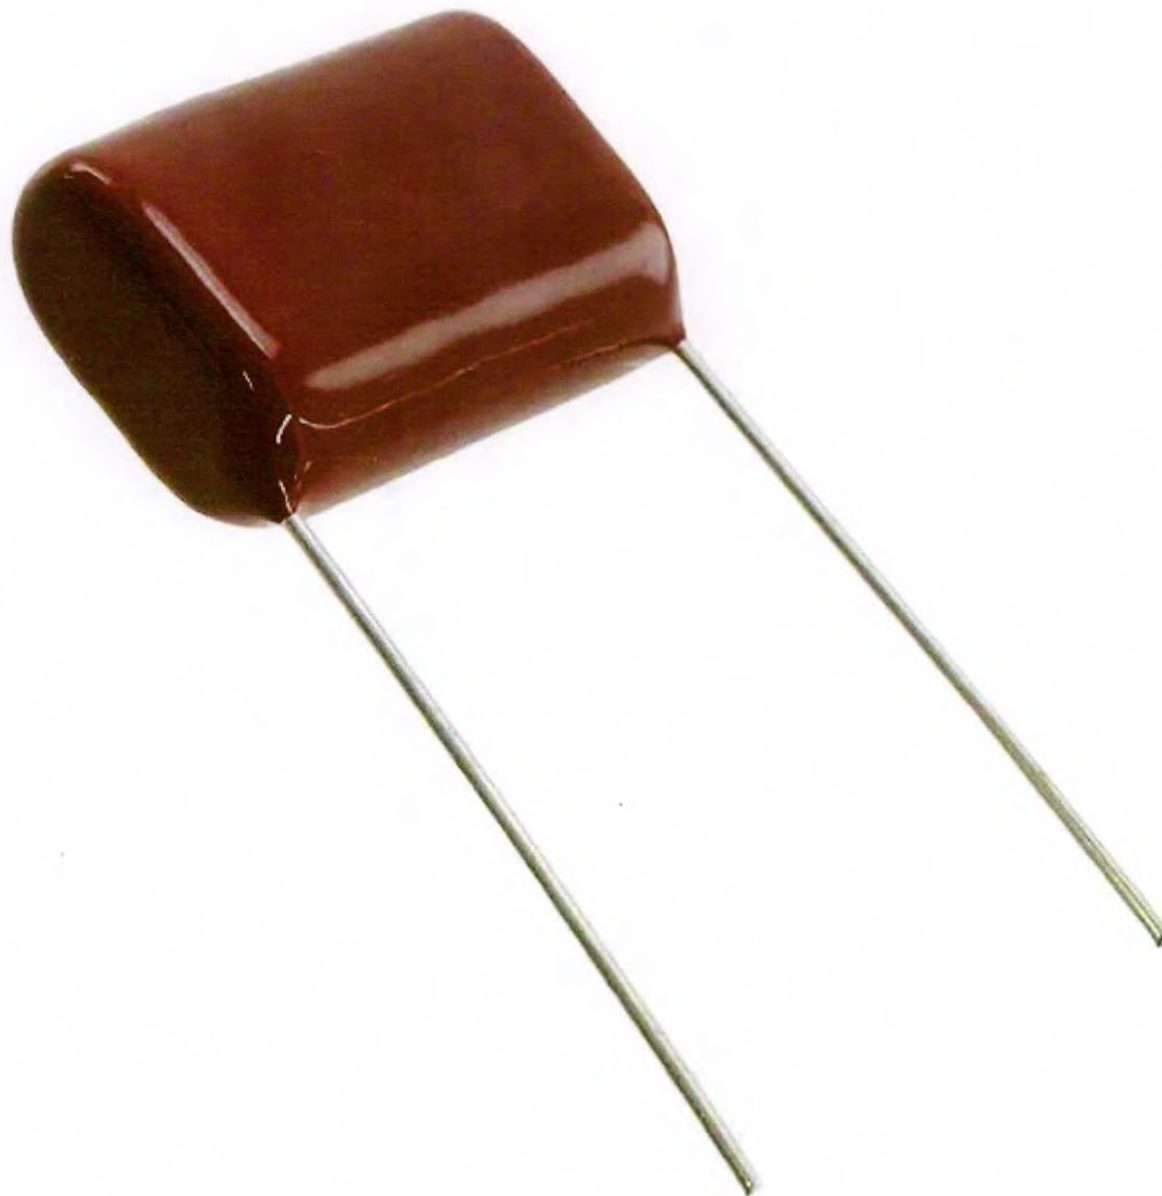

Датчик положения тела




датчик положения тела

Сетевой шнур



Крючок для вешания (встроены в компрессор)

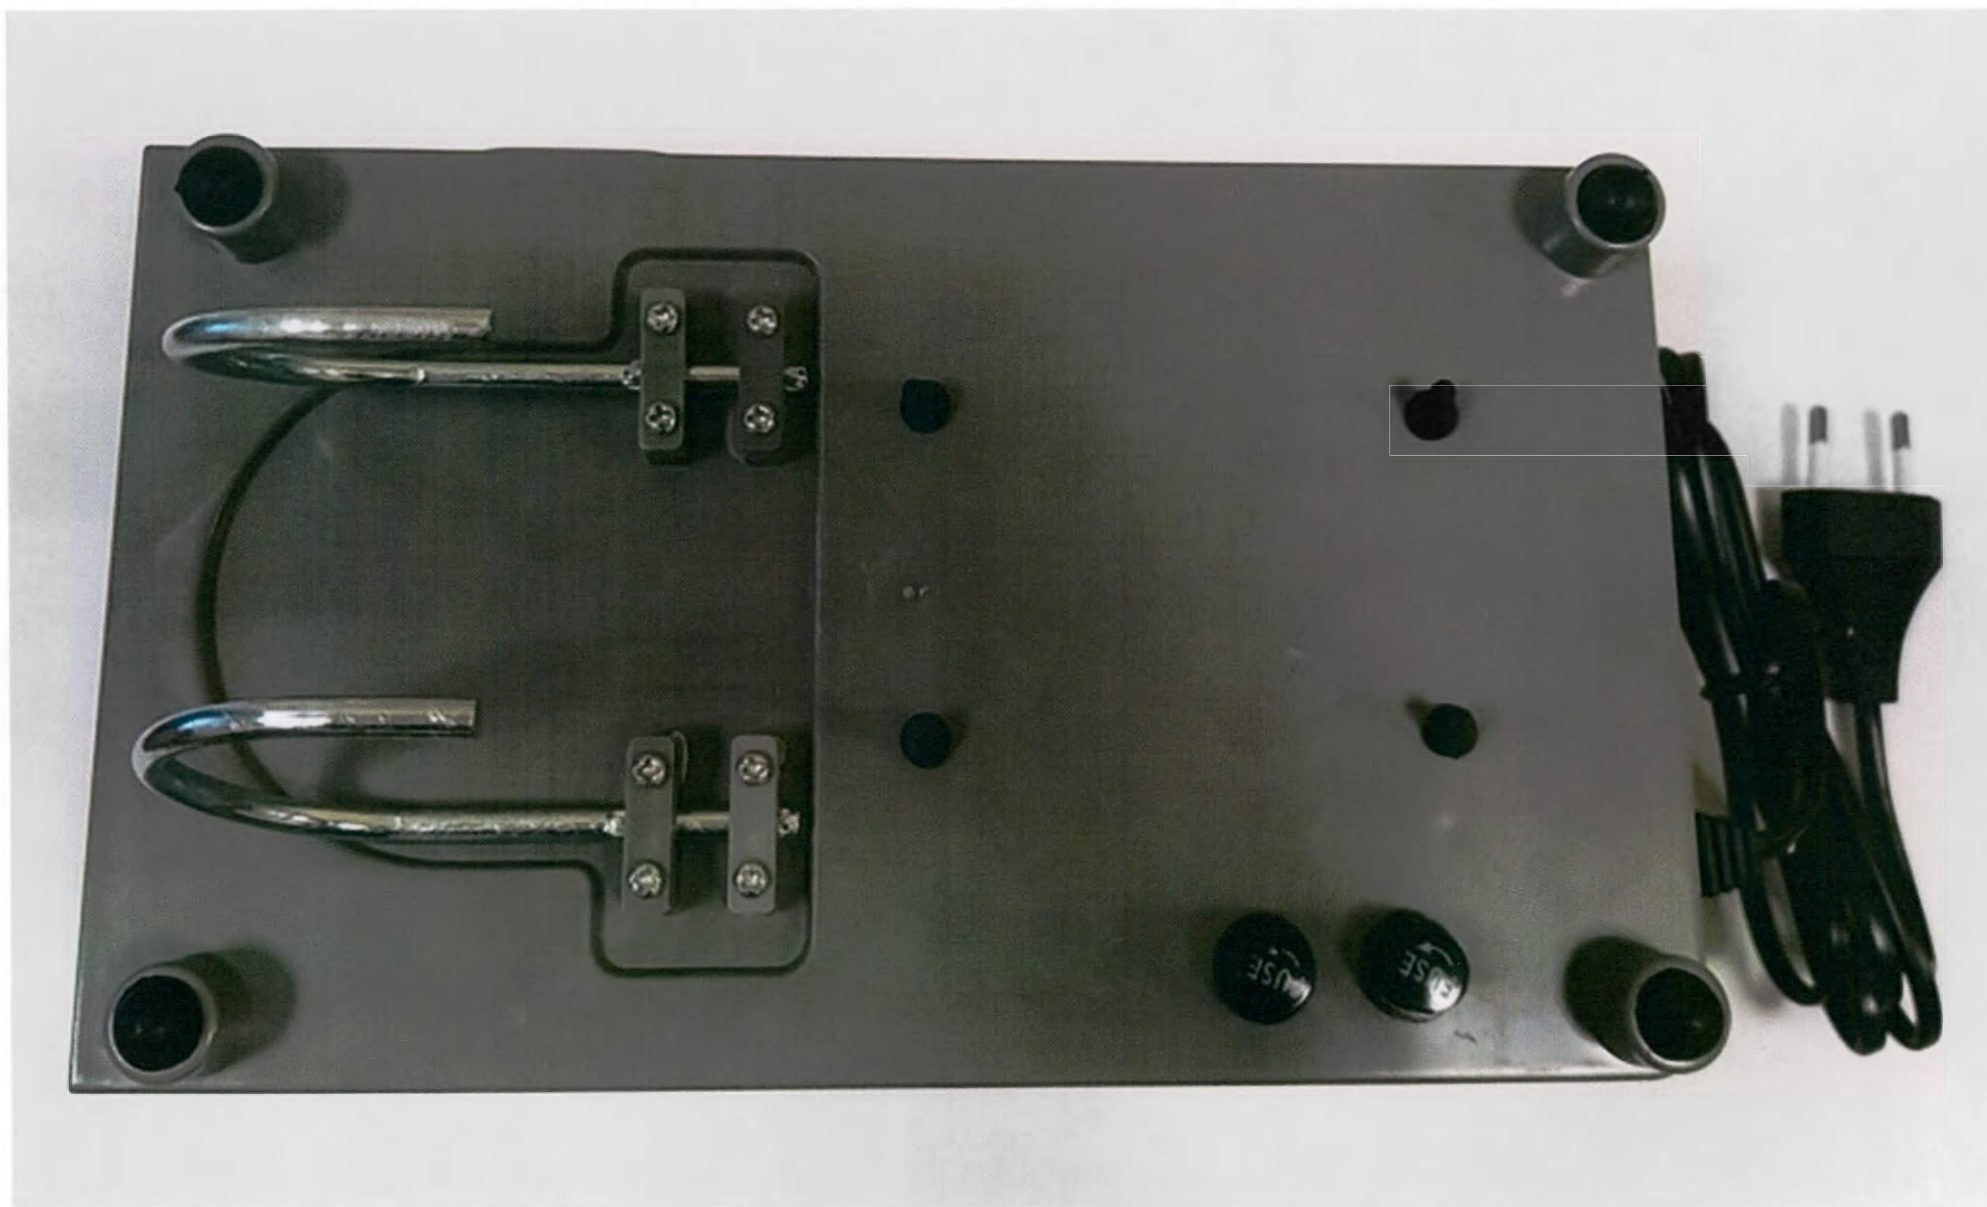



Пример маркировки

**Матрас противолежневый медицинский «МЕТ» по ТУ
32.50.50-013-11459109-2021 в вариантах исполнения с принадлежностями**

Матрас противолежневый медицинский MET ROVACARE в составе:

1. Матрас MET ROVACARE -100 - 1шт.	- крючок для вешания - 2 шт.
2. Компрессор MET KP-200 в составе:	- сетевой шнур – 1 шт.
- компрессор MET KP-200 - 1 шт.;	3. Шланг соединительный - 1 шт.
- датчик положения тела - 1 шт.;	4. Матрасная вставка- 1 шт.
- аккумуляторная батарея - 1 шт.;	5. Инструкция по эксплуатации - 1шт
- зарядное устройство - 1 шт.;	
- датчик давления – 1 шт	



ООО "МЕТ", 142784, Россия, Москва, Киевское ш.
22-й км (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, этаж
5, блок Г

Максимальная нагрузка 200 кг





11.2022

LOT

112022

Габаритные размеры,мм
2010x940x120

Утилизация как класс А

Гарантийный срок службы – 1 год

РУ №...







40°C


-50




про-во Россия

Транспортная упаковка

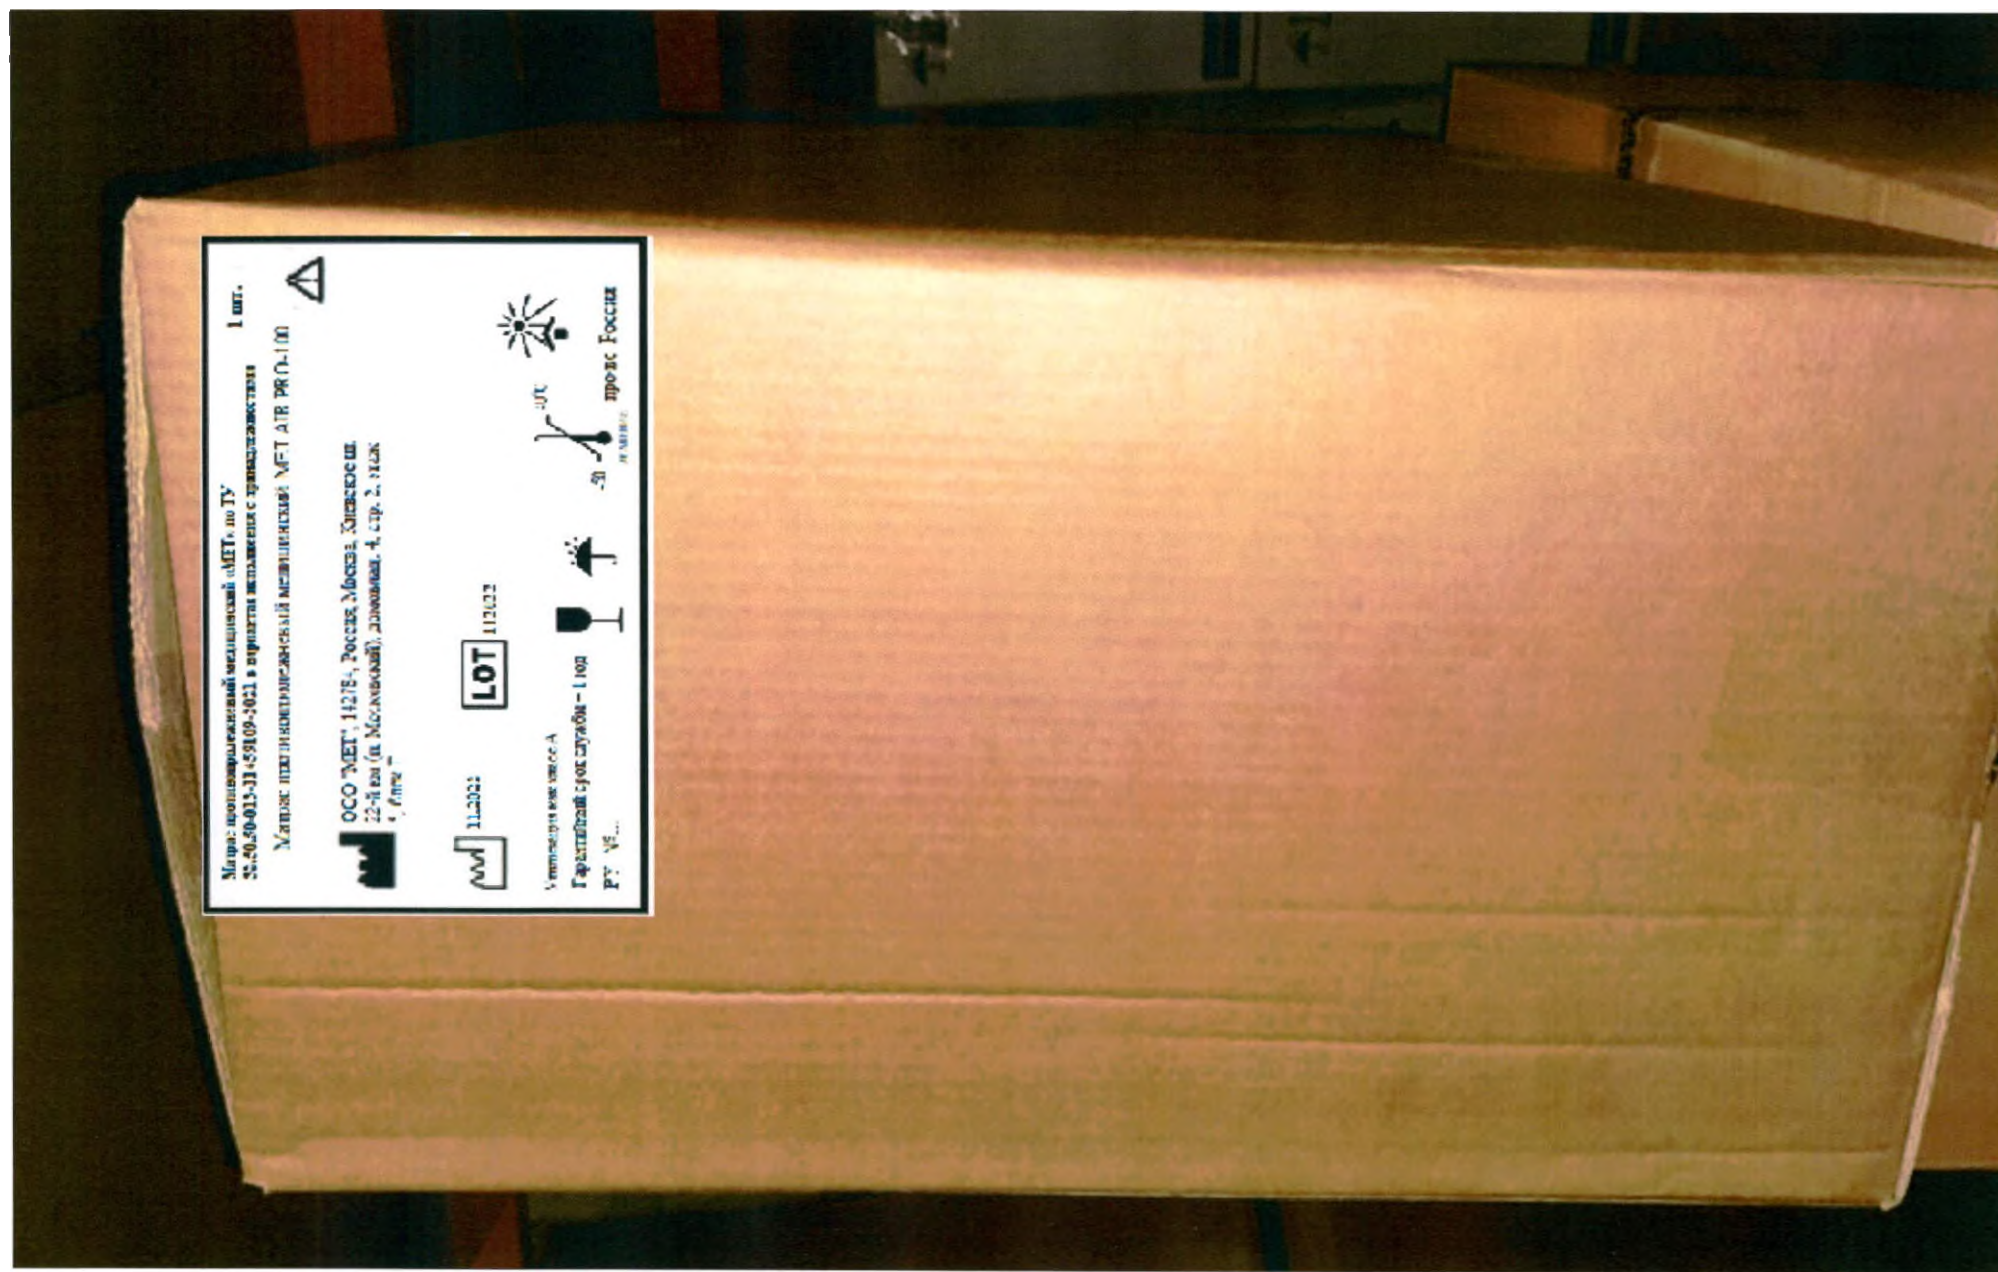

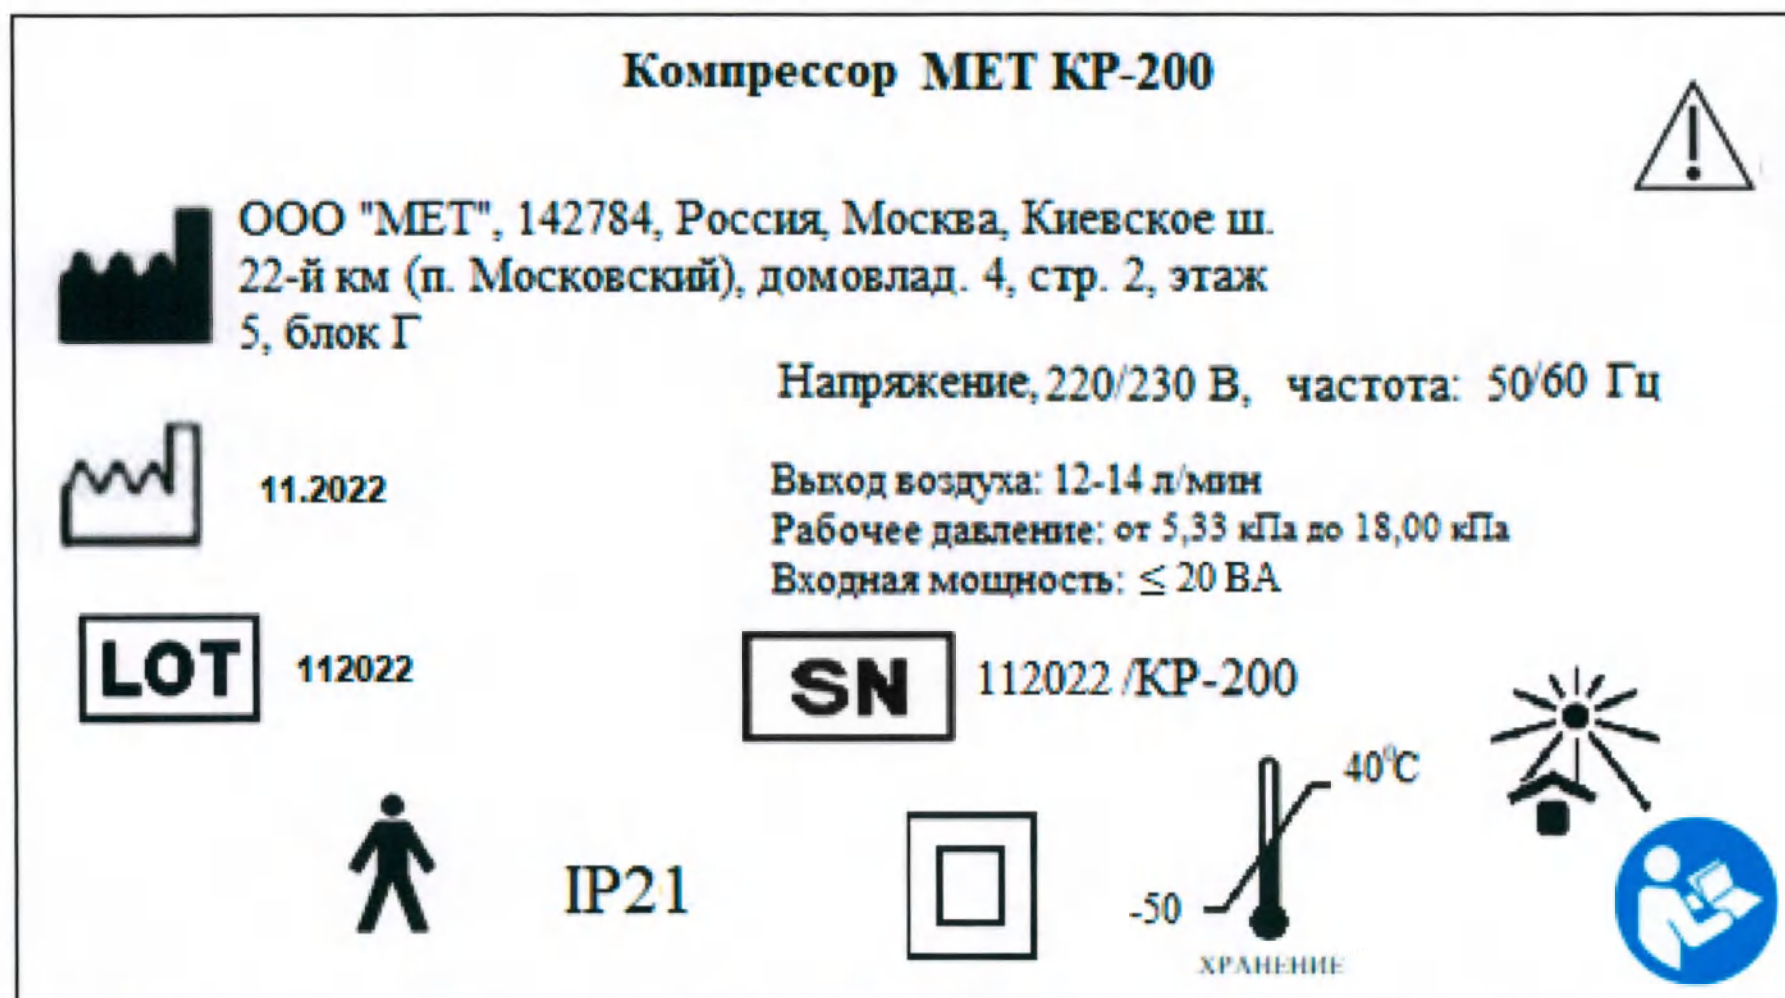

Компрессор МЕТ КР-300



ООО "МЕТ", 142784, Россия, Москва, Киевское ш.
22-й км (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, этаж
5, блок Г



11.2022

Напряжение, 220/230 В, частота: 50/60 Гц

Выход воздуха: 5-7 л/мин

Рабочее давление: от 5,33 кПа до 18,00 кПа

Входная мощность: ≤ 20 ВА



112022-1



112022-1/КР-300



IP21



Компрессор МЕТ КР-100



ООО "МЕТ", 142784, Россия, Москва, Киевское ш.
22-й км (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, этаж
5, блок Г



11.2022

Напряжение, 220/230 В, частота: 50/60 Гц

Выход воздуха: 6-8 л/мин

Рабочее давление: от 5,33 кПа до 18,00 кПа

Входная мощность: ≤ 20 ВА

LOT

112022-2

SN

112022-2 КР-100




IP21




ХРАНЕНИЕ



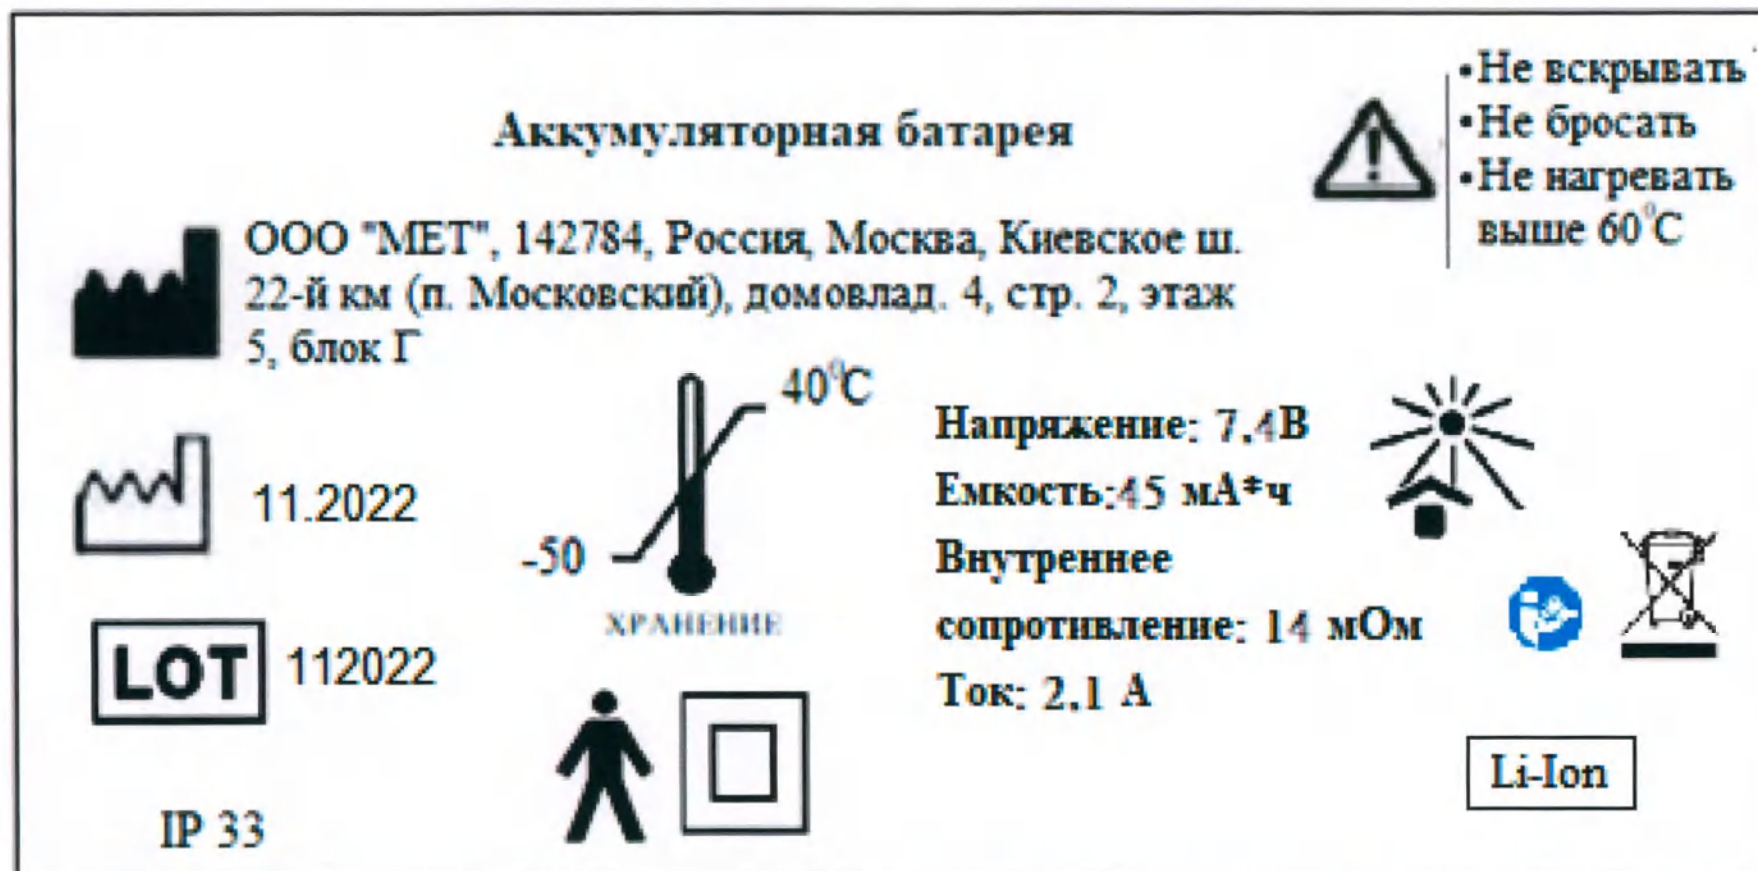

- Замена батарей осуществляется производителем
- Замена недостаточно обученным персоналом может привести к ОПАСНОСТИ !

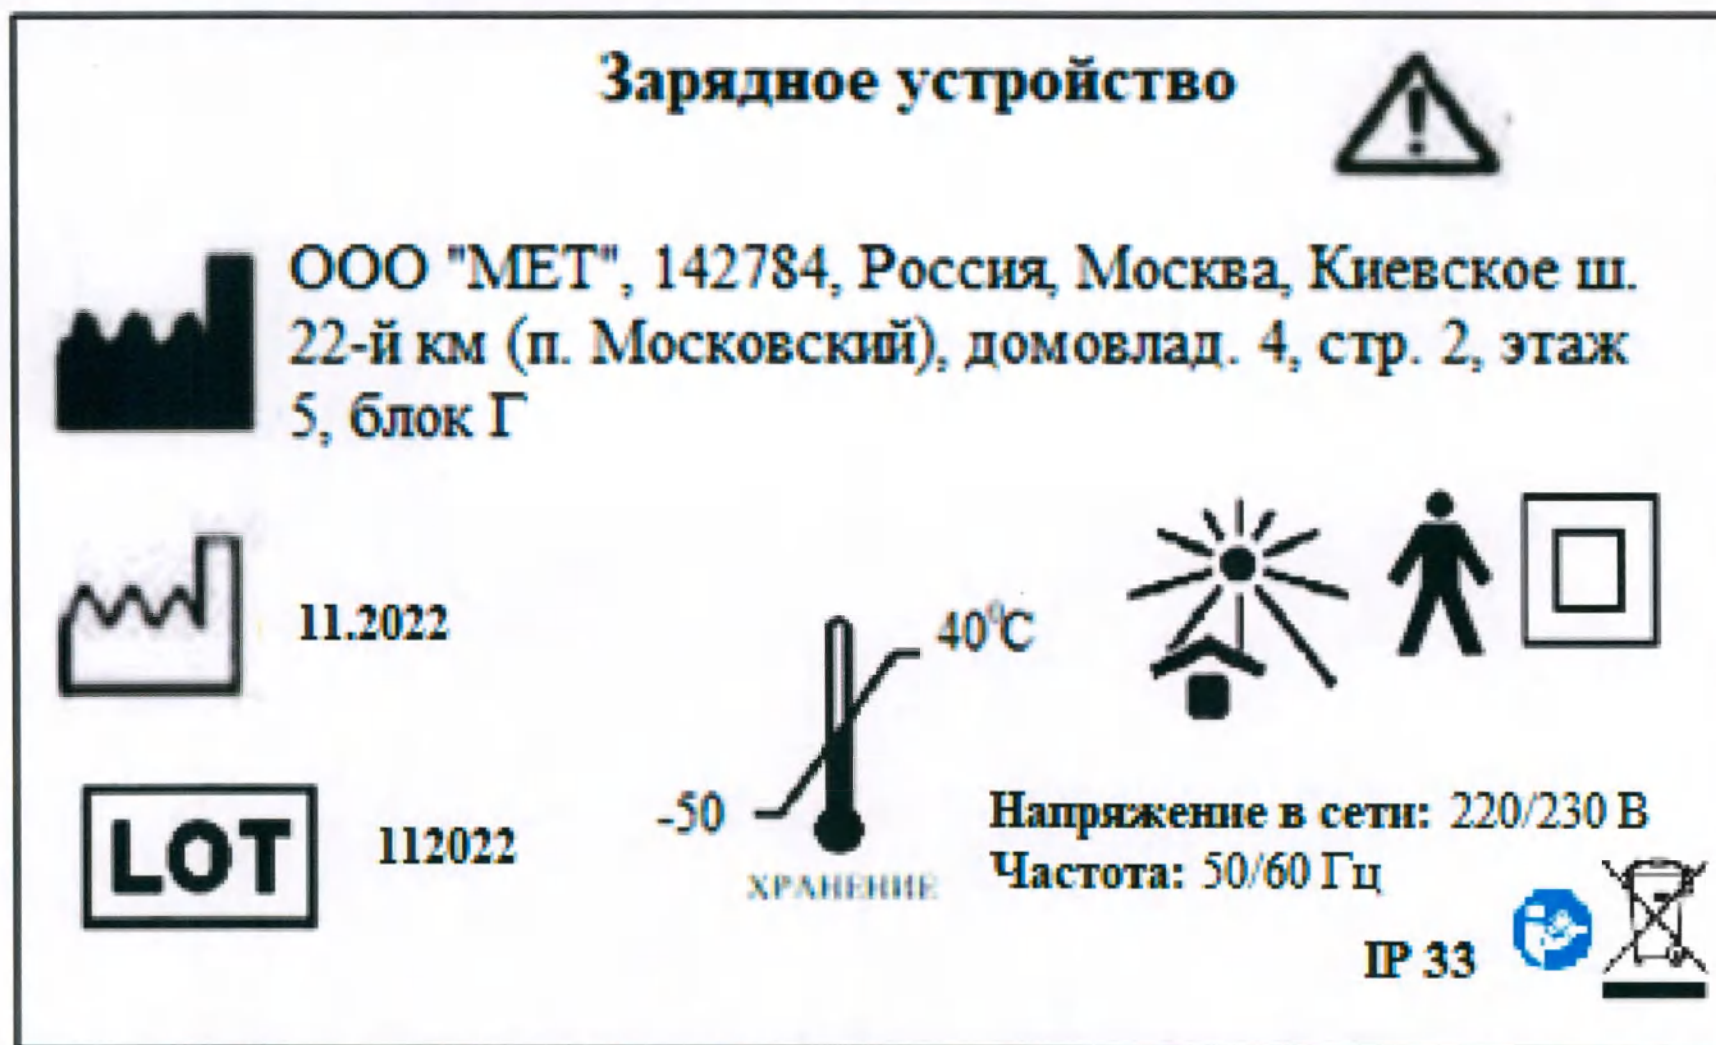

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

47 (сорок семь) листов

Должность генеральный директор

Подпись Иванов С.В.

«28» август 2023 г. М.П.

