

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ВИТ»
В.А. Климов
« 7 » января 2024 г.



**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Имитатор опорной нагрузки подошвенный модель Корвит
по ТУ 9444-003-08627508-2008**

Имитатор опорной нагрузки подошвенный модель КОРВИТ

ТУ 9444-003-08627508-2008

РУ № ФСР 2009/04901 от 03.12.2020г.

Зав. № 0598

Выпуск: 04. 2023

Масса 7 кг

Номинальное напряжение питания 230 В

Номинальная потребляемая мощность 120 Вт

Частота сети питания 50 Гц

Режим работы: 30 мин – работа, 30 мин - пауза



IP20

Изготовитель ООО «ВИТ»
197375, город Санкт-Петербург,
Новоколомяжский проспект,
дом 11, литер А, помещение 51-Н, кабинет 1
Тел.: 8(812)374-70-53, E-mail: ooovit@gmail.com

Фотографическое изображение 1. Маркировка блока управления (по п. 1.3.1 ТУ)



Имитатор опорной нагрузки подошвенный модель КОРВИТ

ТУ 9444-003-08627508-2008

РУ № ФСР 2009/04901 от 03.12.2020г.

Выпуск: 04. 2023

Срок службы: 5 лет

Транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя в условиях исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред, при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха 80% при плюс 25°C (верхнее значение)

Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в условиях исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред, при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха 80% при плюс 25°C (верхнее значение).



Изготовитель ООО «ВИТ»
197375, город Санкт-Петербург,
Новоколомяжский проспект,

Фотографическое изображение 2. Маркировка потребительской тары (по п. 1.3.3 ТУ)



Имитатор опорной нагрузки подошвенный модель КОРВИТ

TU 9444-003-08627508-2008

РУ № ФСР 2009/04901 от 03.12.2020г.

Выпуск: 04. 2023


Срок службы: 5 лет

Транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя в условиях исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред, при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха 80% при плюс 25°C (вернее значение)


Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в условиях исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред, при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха 80% при плюс 25°C (вернее значение).



Изготовитель ООО «Вит»
197375, город Санкт-Петербург,
Новокоммисский проспект,

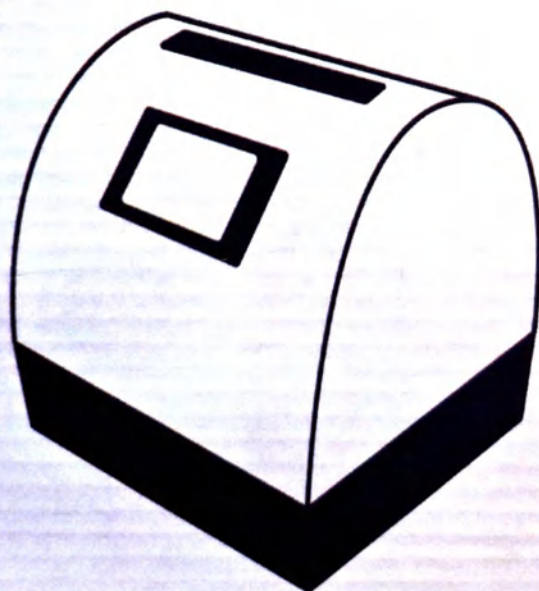

Фотографическое изображение 3. Потребительская тара

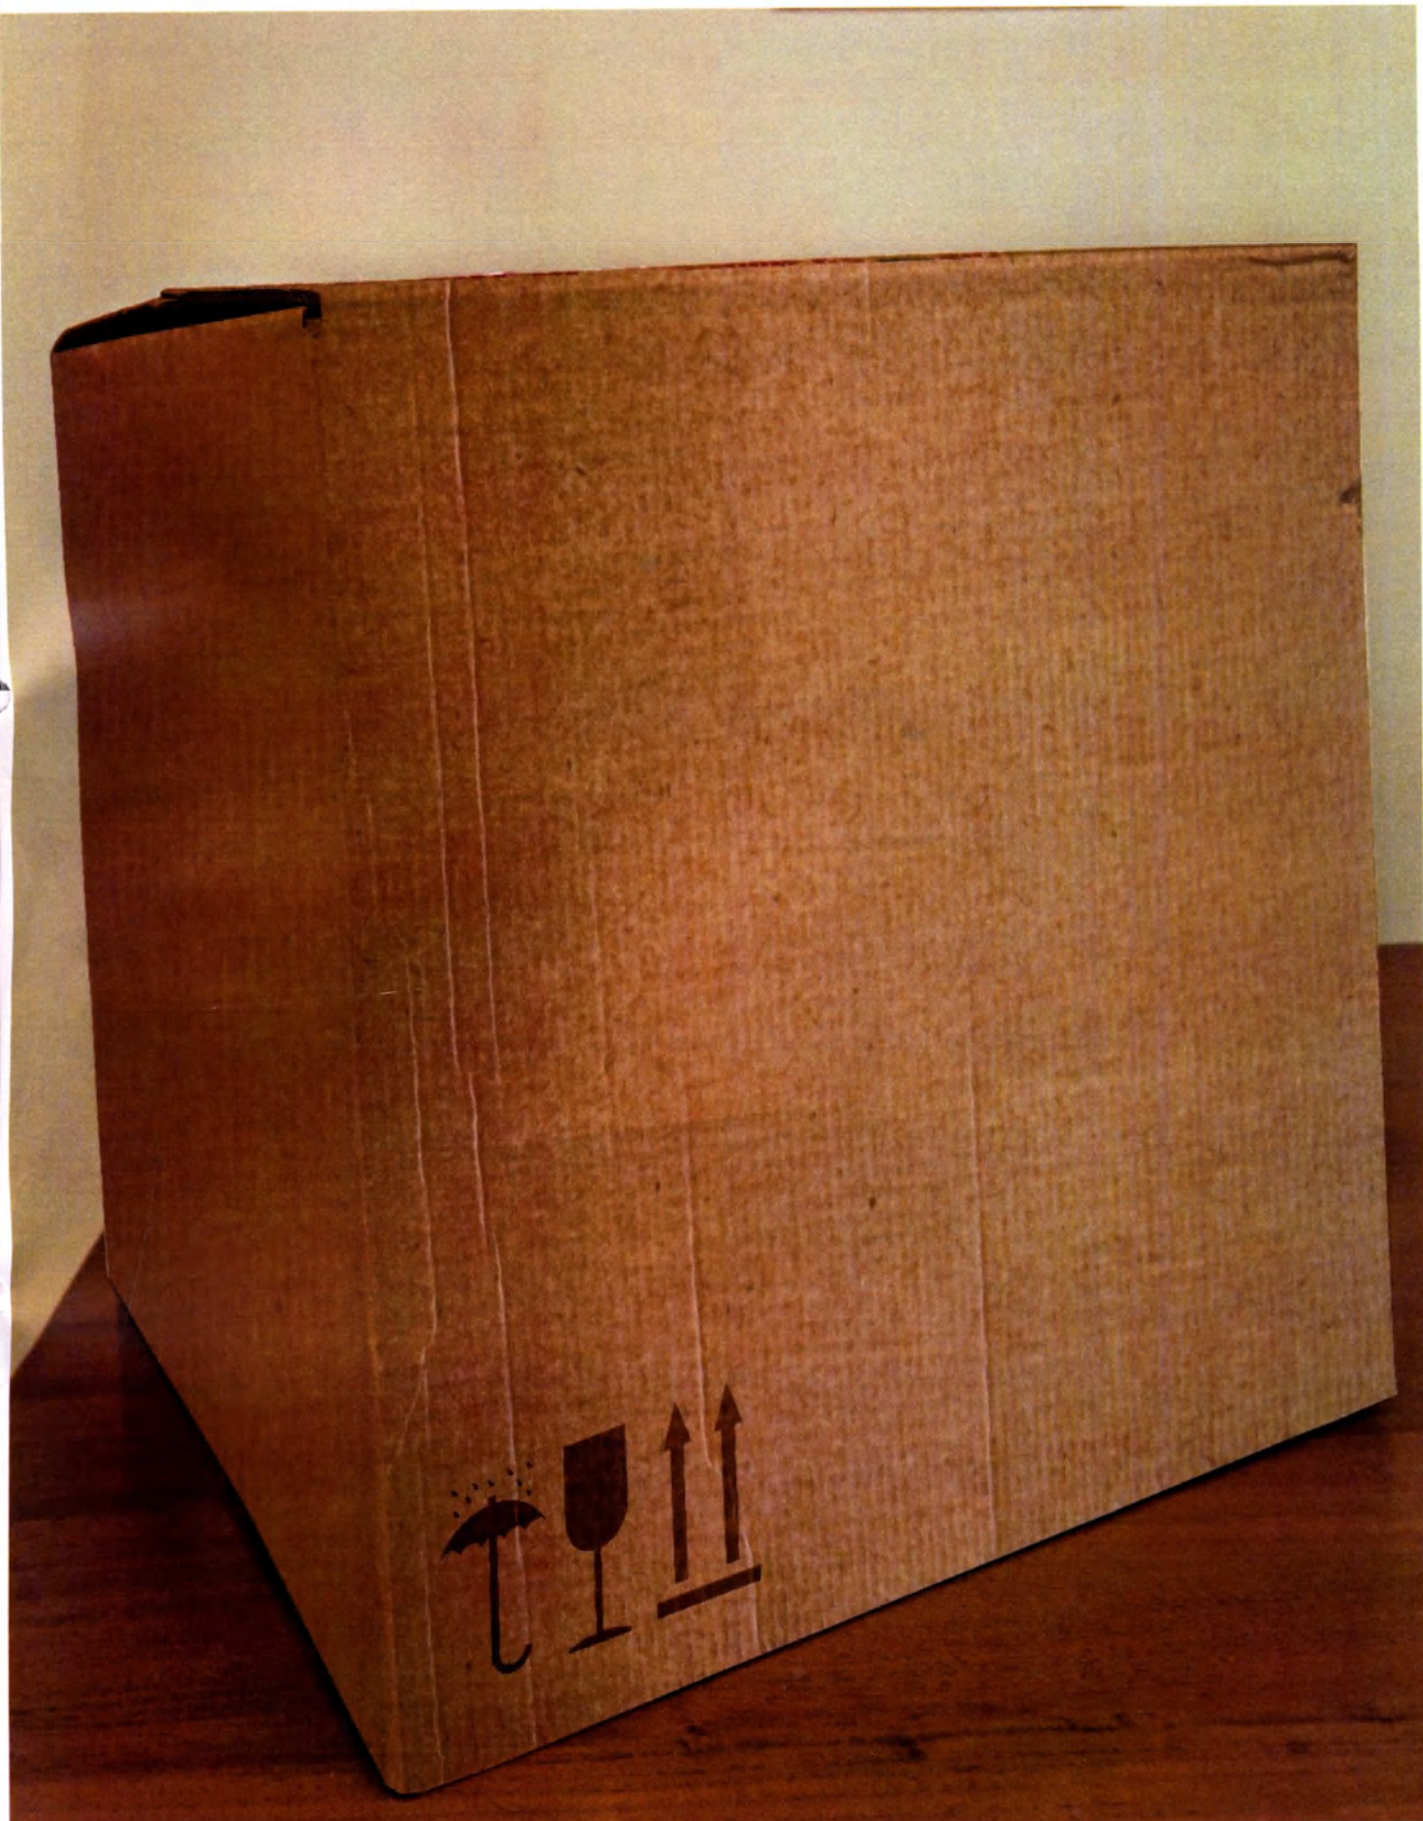

Фотографическое изображение 4. Транспортная тара

ООО «ВИТ»

Всего пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 4
(четырёх) листах

Директор

Климов В.В.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ВИТ»
В.А. Климов
« 07 » декабря 2023 г.



**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Имитатор опорной нагрузки подошвенный модель Корвит
по ТУ 9444-003-08627508-2008**




Фотографическое изображение 1. Имитатор опорной нагрузки подошвенный модель Корвит по ТУ 9444-003-08627508-2008. Общий вид.




Фотографическое изображение 2. Блок управления ТНУК.468351.001




Фотографическое изображение 3. Ортез с пневмостелькой 11-13 - ТНУК.521790.012

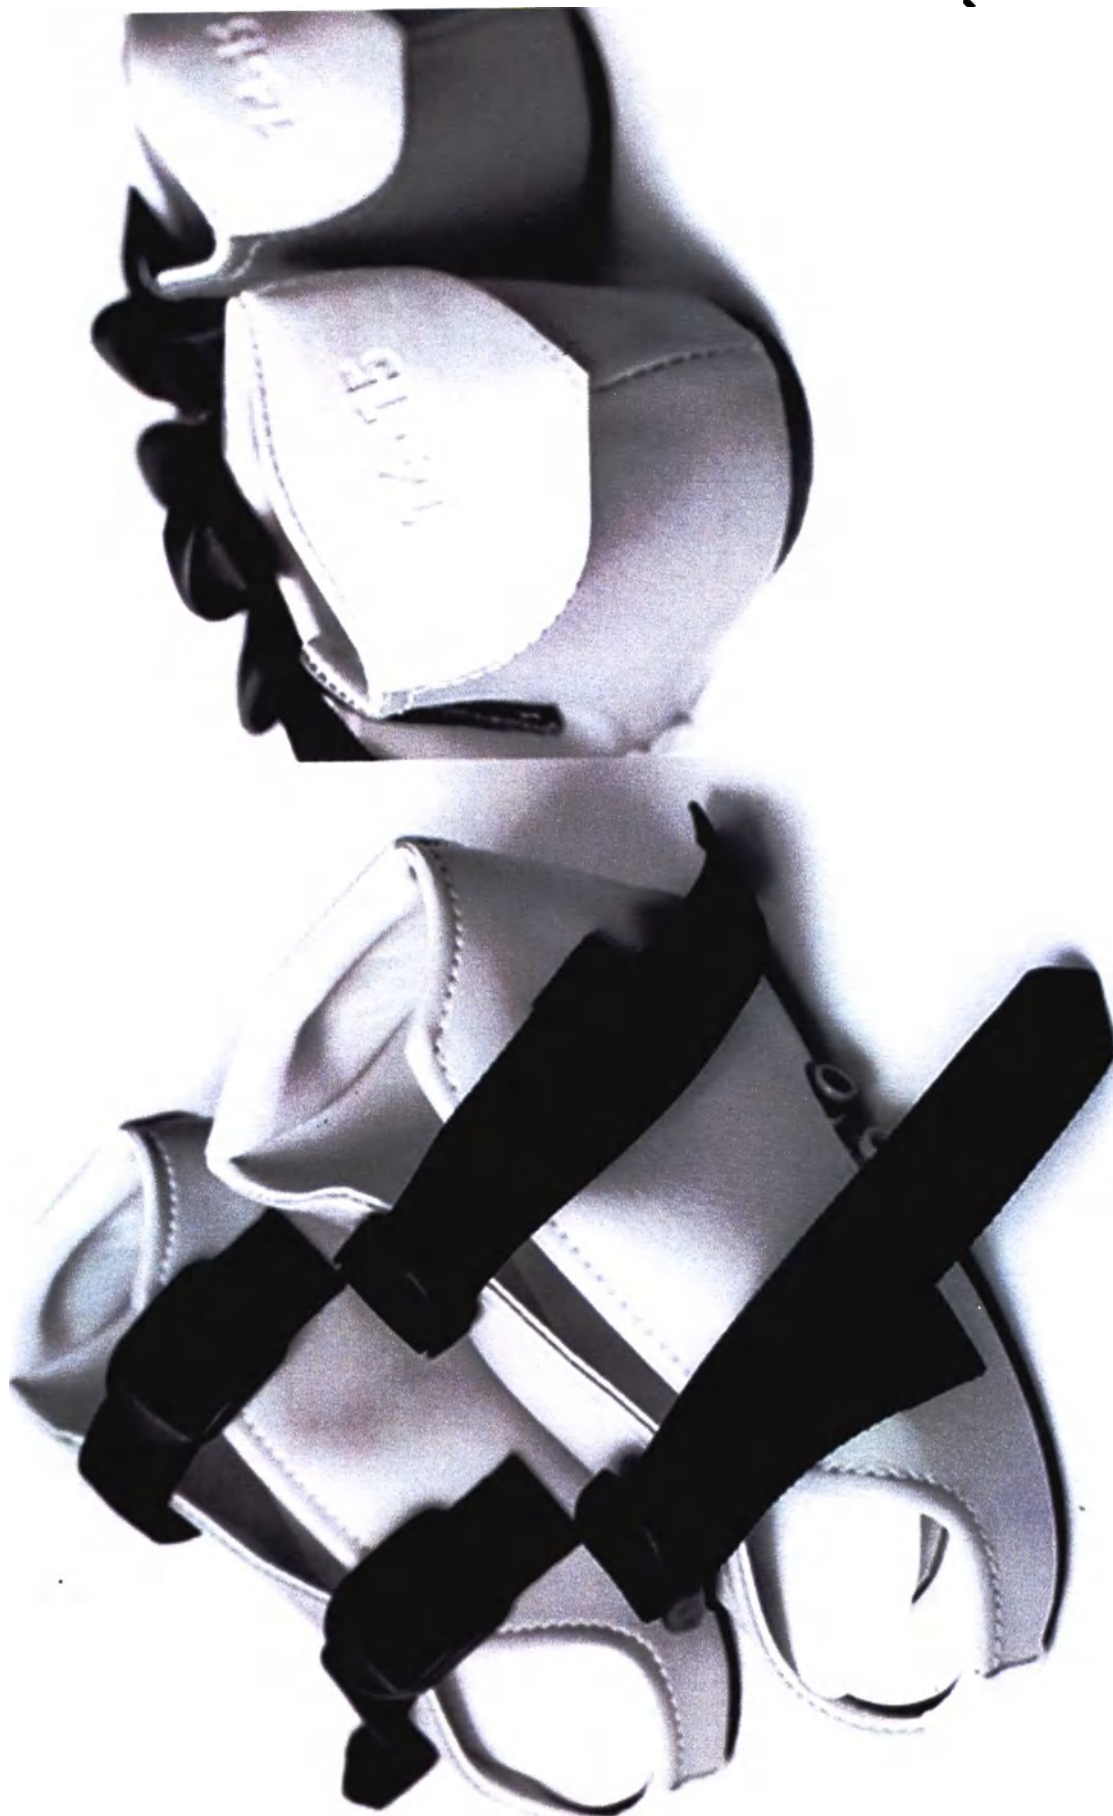

Фотографическое изображение 4. Ортез с пневмостелькой 14-15 - ТНУК.521790.014

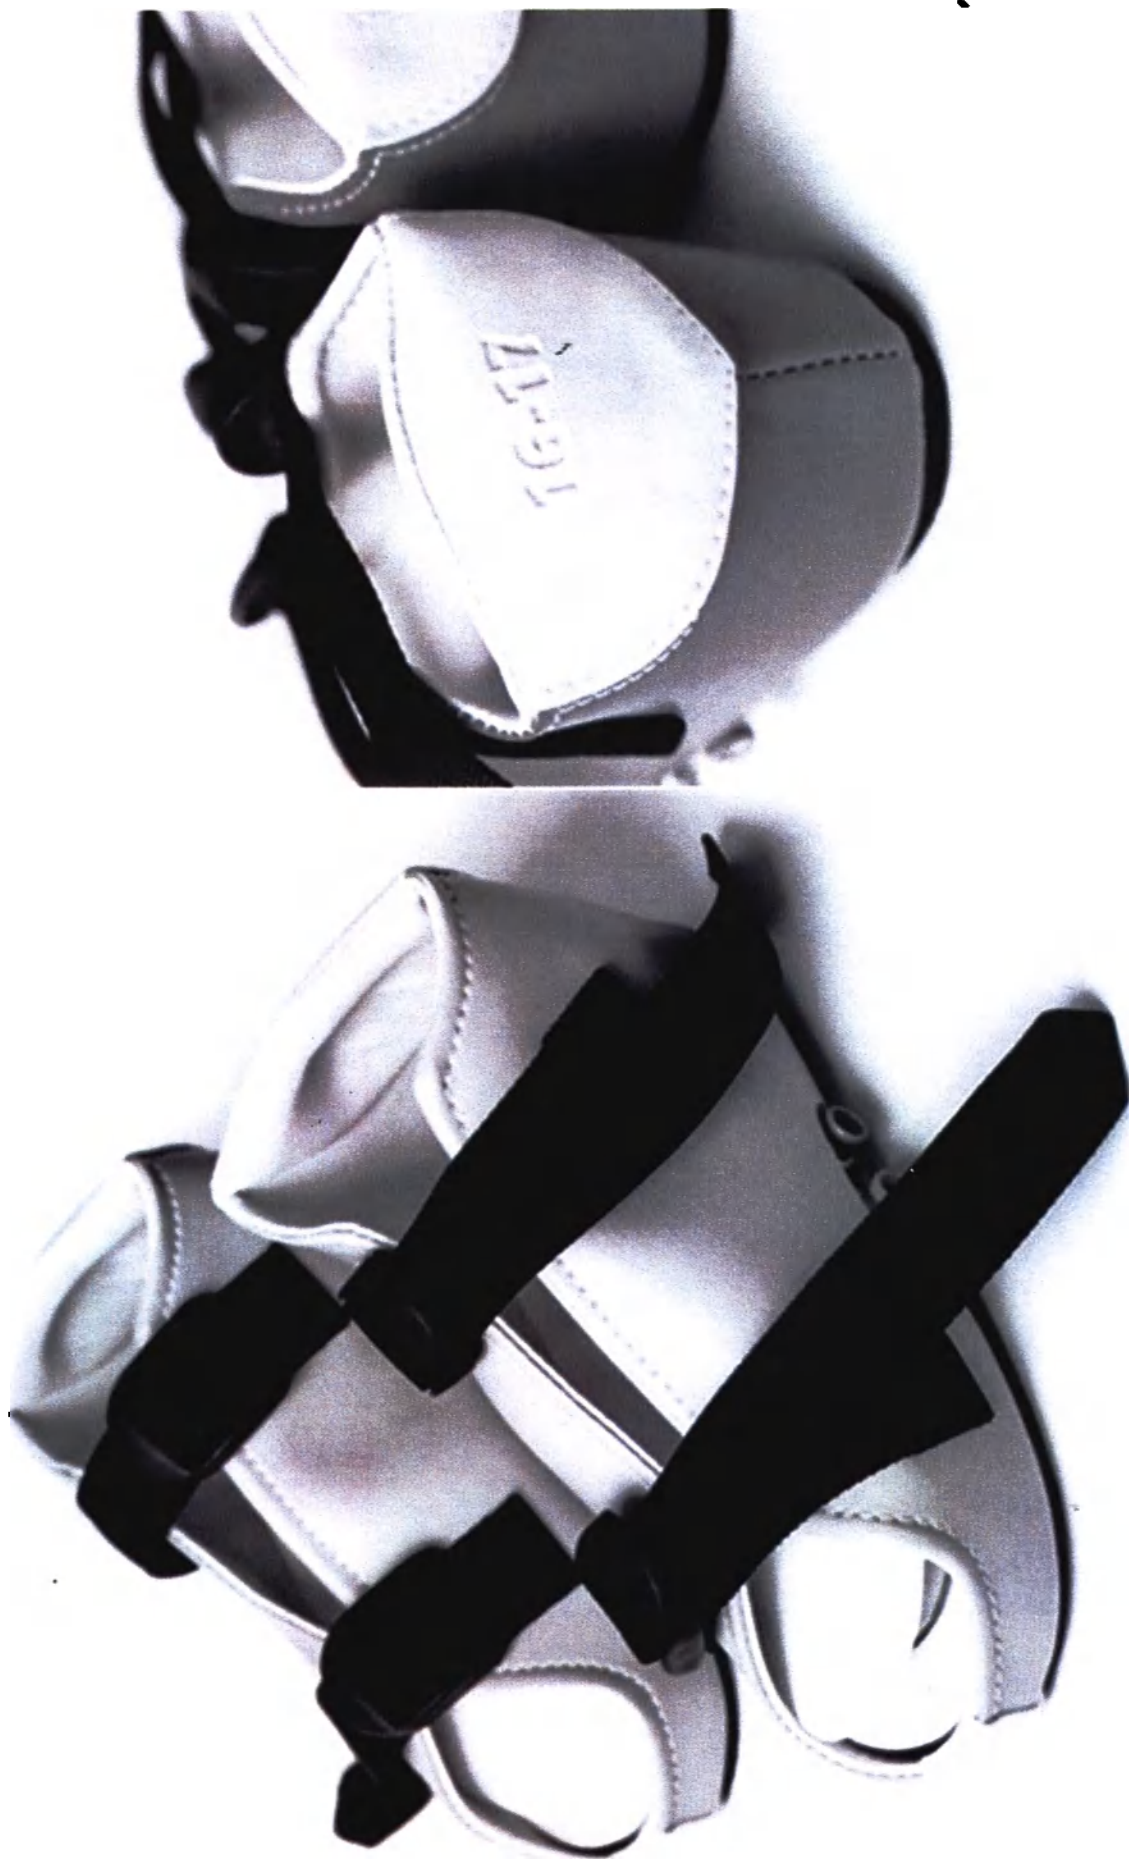

Фотографическое изображение 5. Ортез с пневмостелькой 16-17 - ТНУК.521790.016

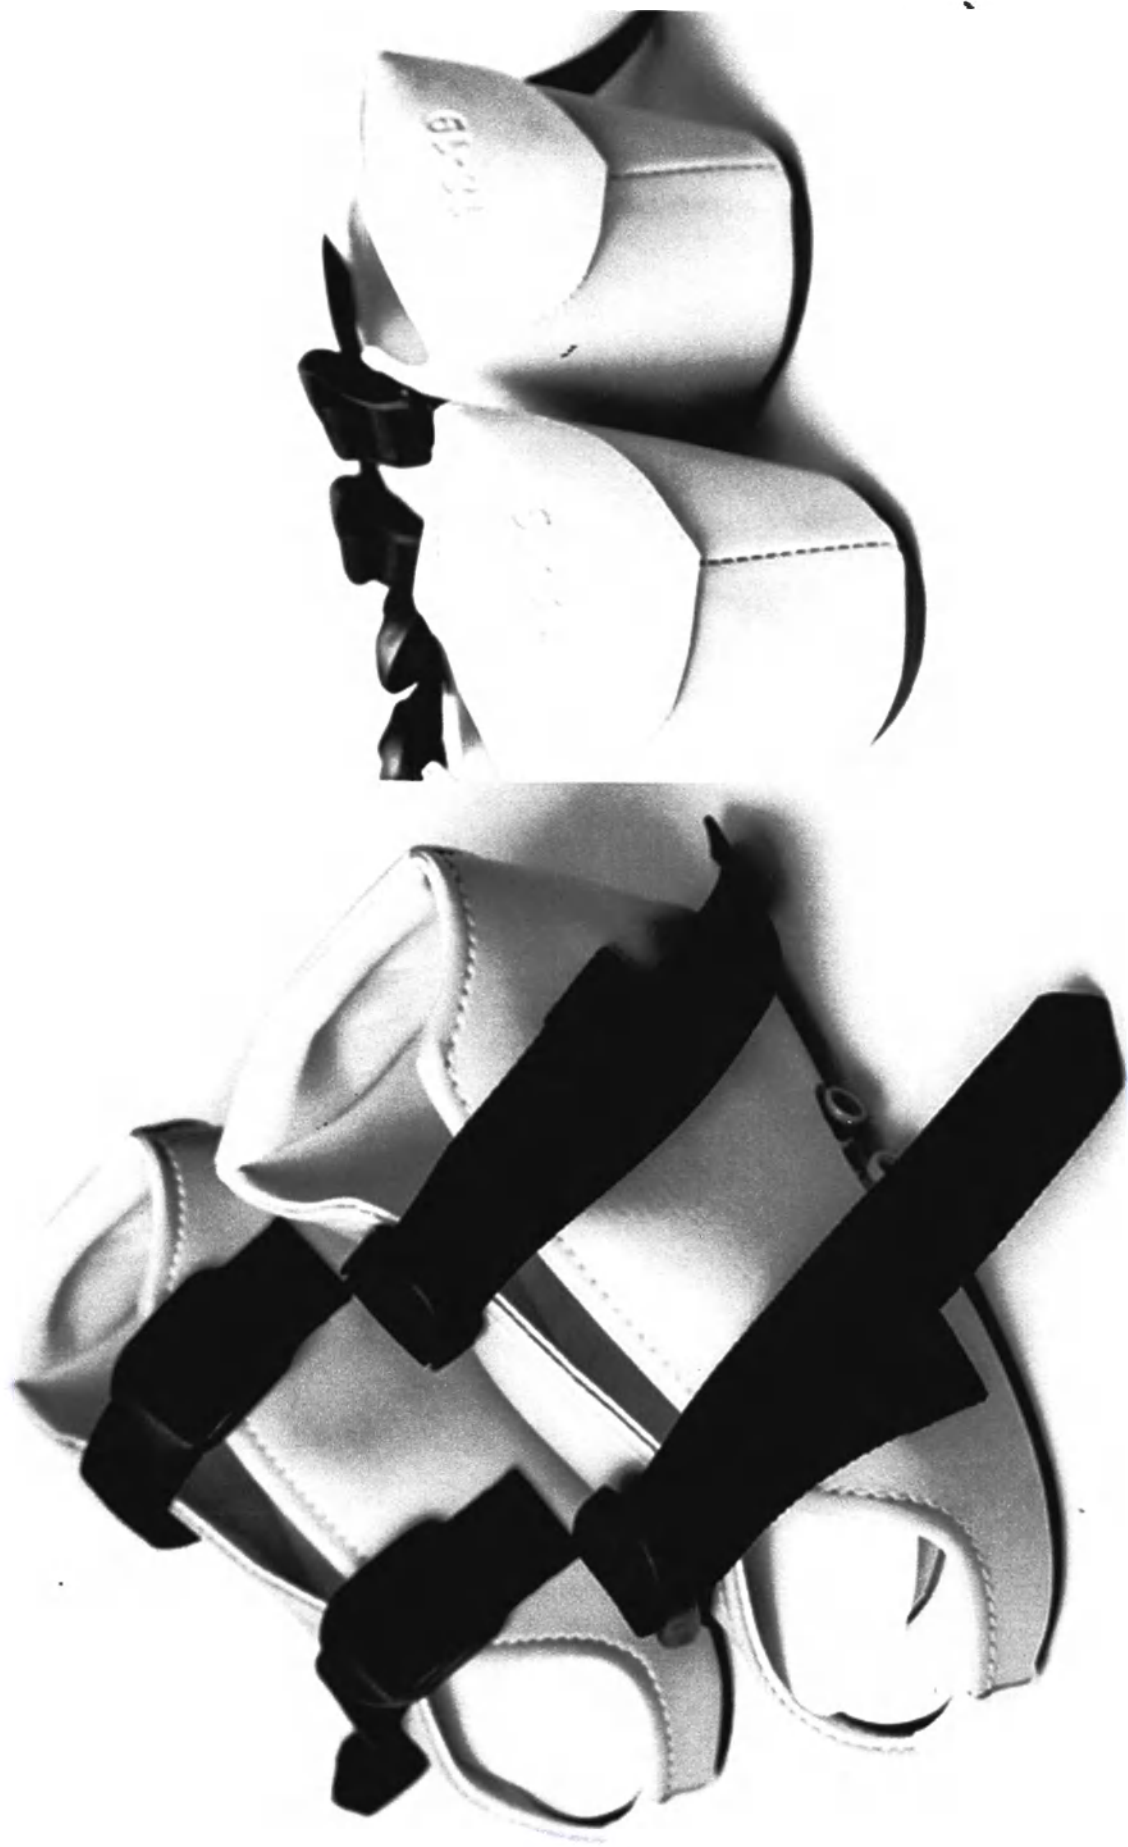


Фотографическое изображение 6. Ортез с пневмостелькой 18-19 - ТНУК.521790.019



Фотографическое изображение 7. Ортез с пневмостелькой 20-23 - ТНУК. 521790.022



Фотографическое изображение 8. Ортез с пневмостелькой 24-26 - ТНУК. 521790.025

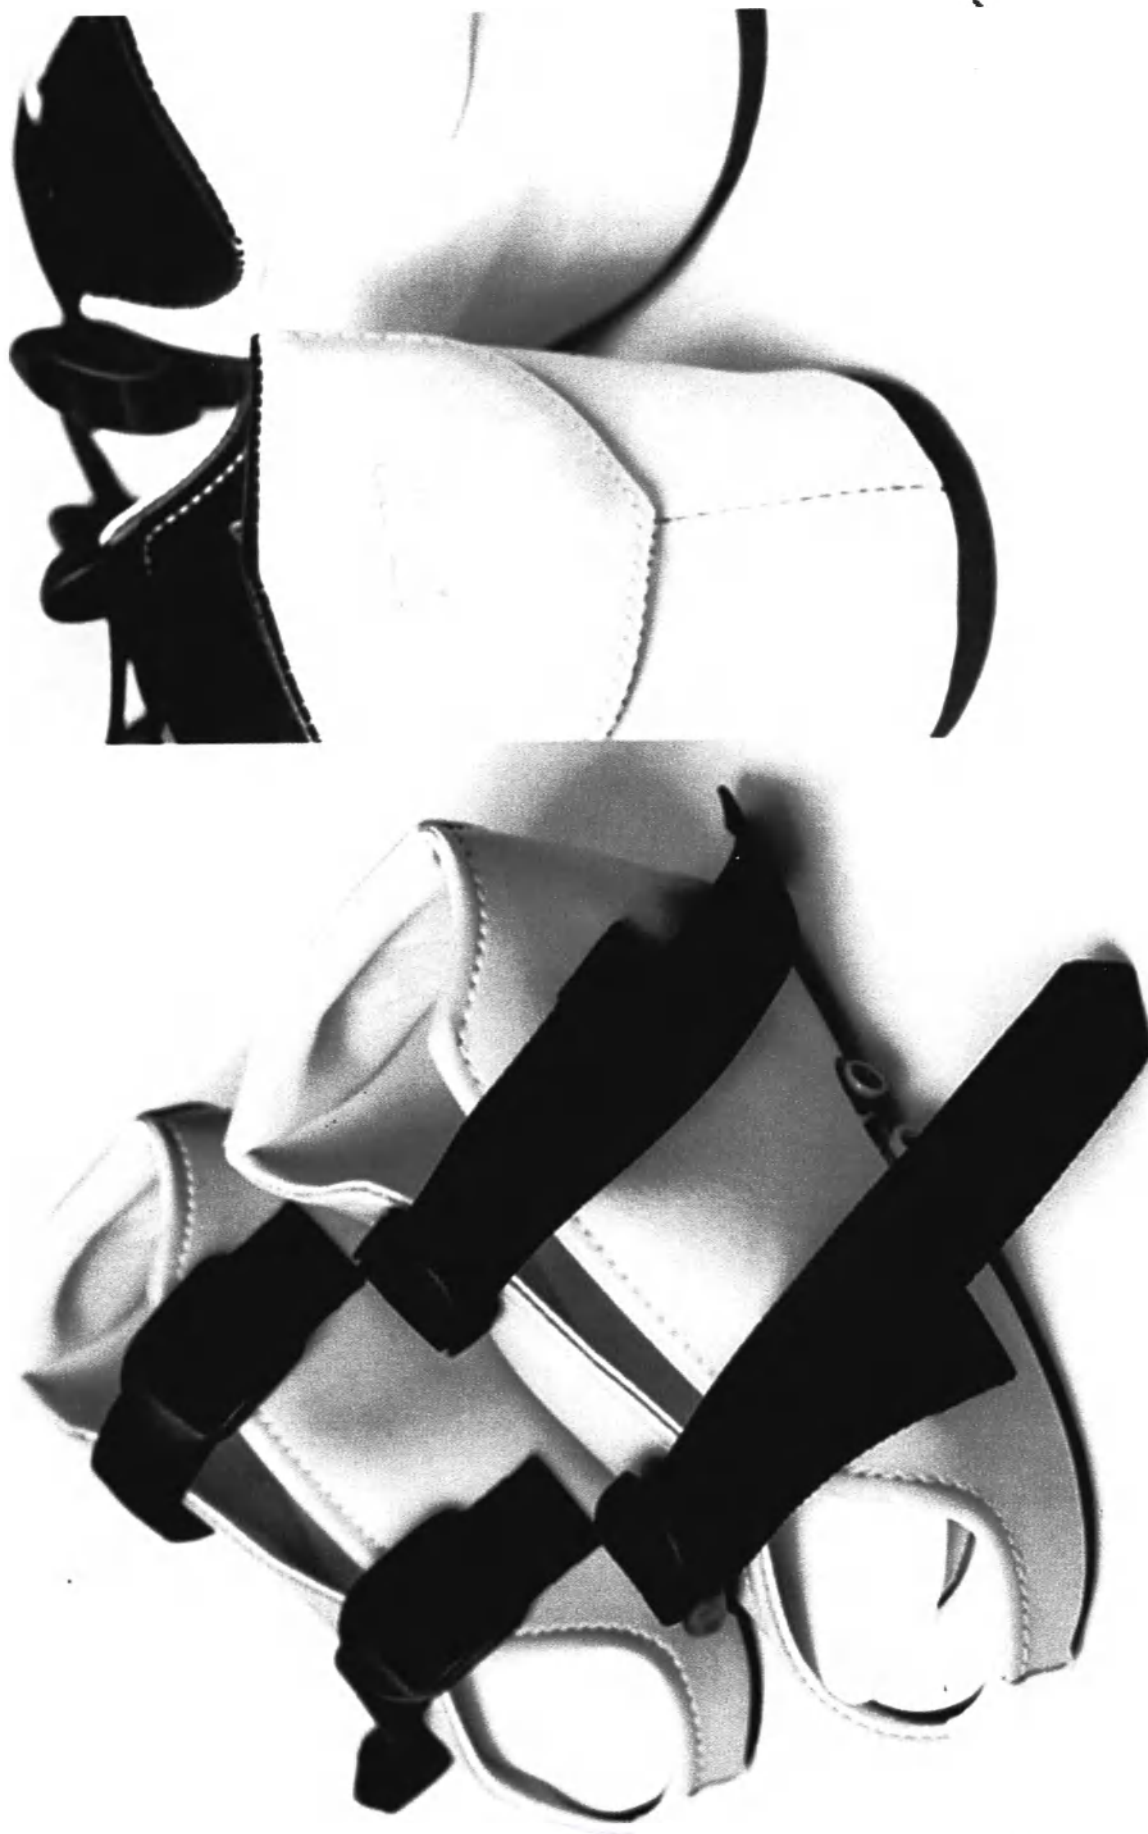

Фотографическое изображение 9. Ортез с пневмостелькой 27-29 - ТНУК. 521781.028



Фотографическое изображение 10. Кабель питания блока управления



Фотографическое изображение 11. Пневмопровод ТНУК.521782

ООО «ВИТ»
Всего пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 12
Листах

Директор _____

Климов В.В.

