

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «БТЛ»



Мираев И.

2018 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

«Система высокоинтенсивной магнитотерапии BTL-6000 Super Inductive System, варианты исполнения: BTL-6000 Super Inductive System Elite, BTL-6000 Super Inductive System Locus, BTL-6000 Super Inductive System Duo»



вид вариант исполнения BTL-6000 Super Inductive System Elite



Общий вид вариант исполнения BTL-6000 Super Inductive System Locus



Общий вид вариант исполнения BTL-6000 Super Inductive System Duo




I. Основной состав:

1. Вариант исполнения BTL-6000 Super Inductive System Elite

1.1. Блок управления



1.2. Кабель питания

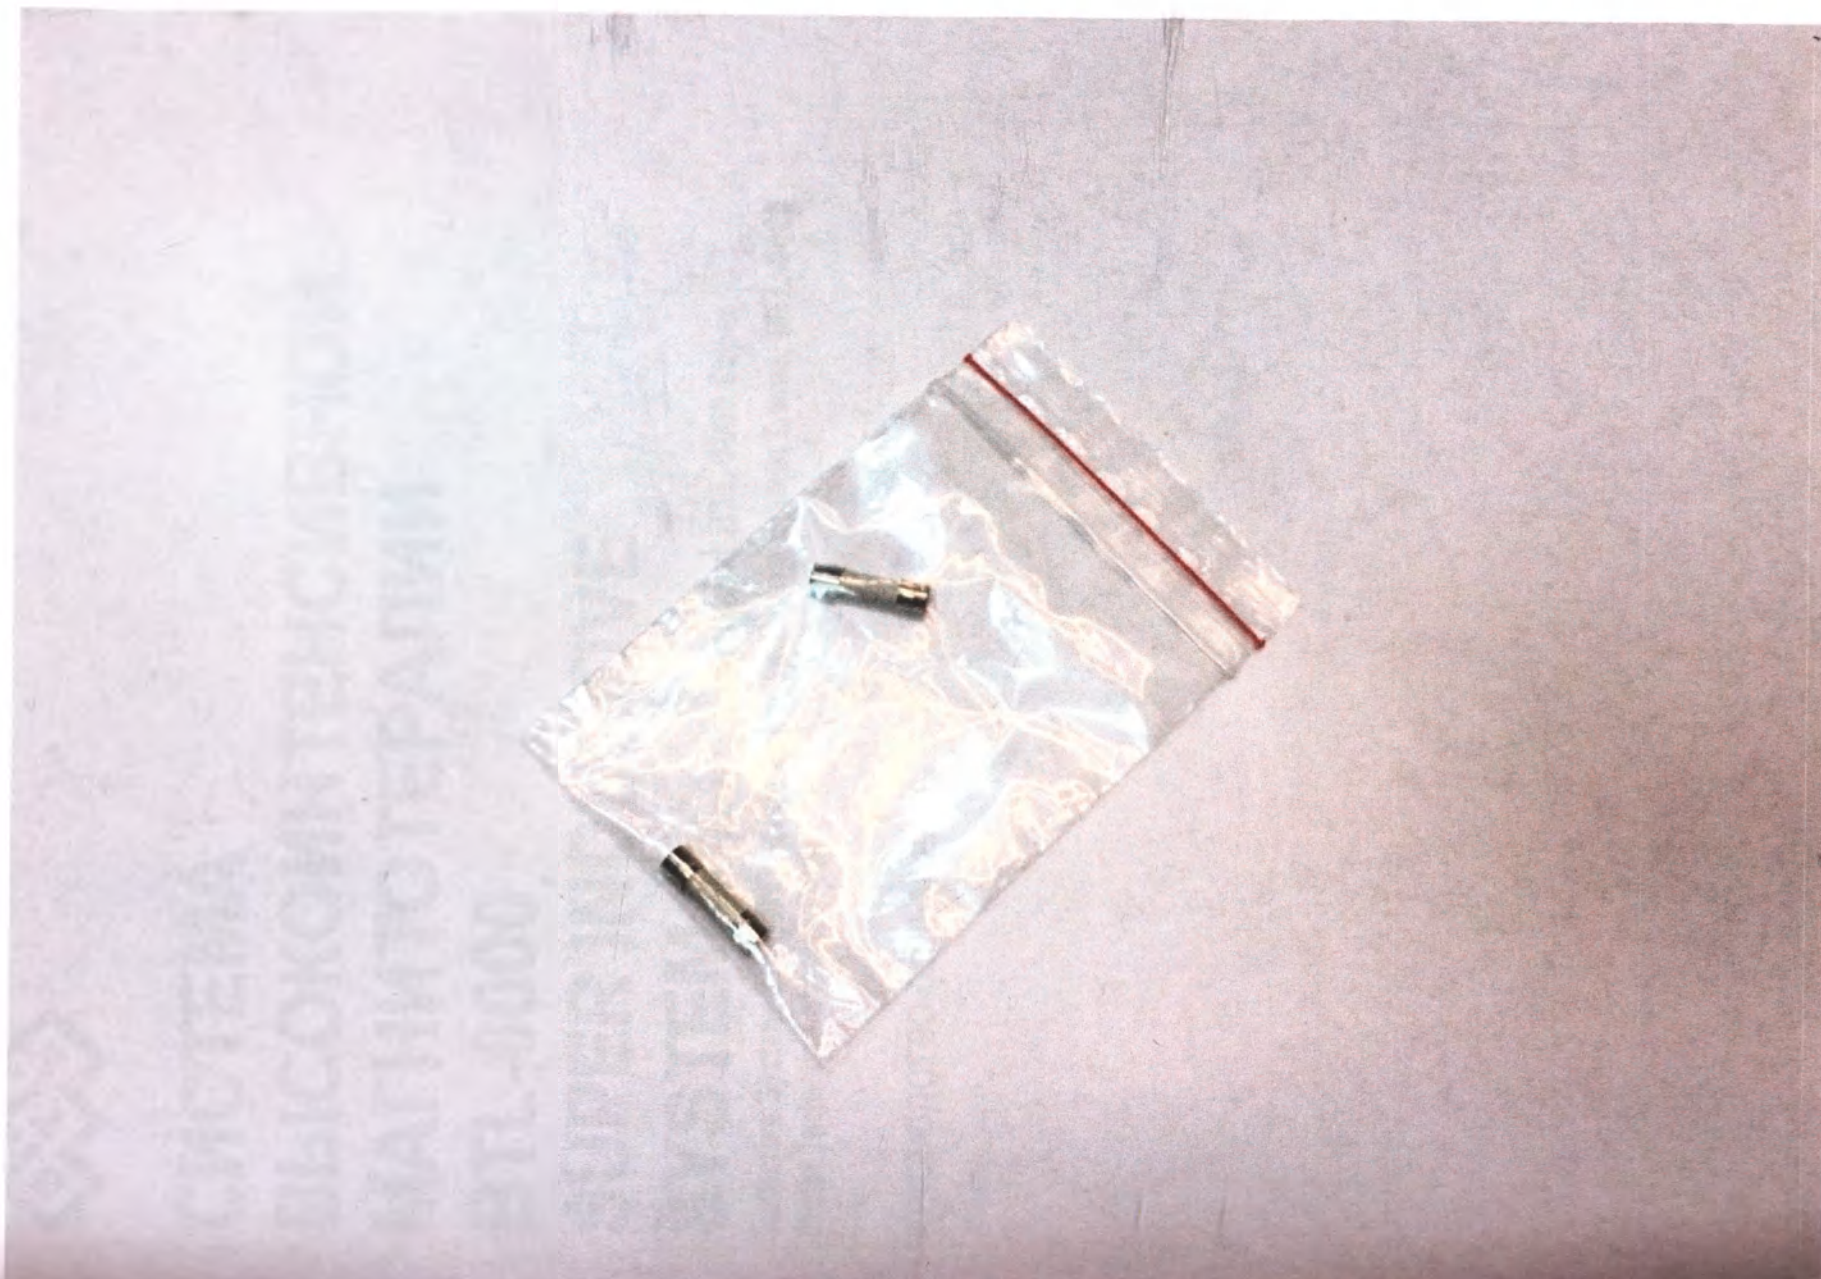

1.3. Запасные предохранители (2 шт.)



СИСТЕМА ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ BTL-6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM,

варианты исполнения BTL-6000 Super
Inductive System Elite, BTL-6000 Super Inductive System Locus, BTL-6000
Super Inductive System Duo»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство пользователя



1.5. Стилус для сенсорного экрана



1.6. 6-секционный держатель для аппликатора сфокусированного поля



1.7. Набор инструментов для установки 6-секционного держателя (гаечный ключ 10х13, трубчатый ключ 8 - 10, вороток для трубчатого ключа, винт М6х16 - 2 шт.)



1.8. Аппарат сфокусированного тока



1.9. Пылезащитный чехол




1.10. Аппликатор планарного поля



2. Вариант исполнения BTL-6000 Super Inductive System Locus
2.1. Блок управления BTL-6000 Super Inductive System Locus



2.2. Кабель питания

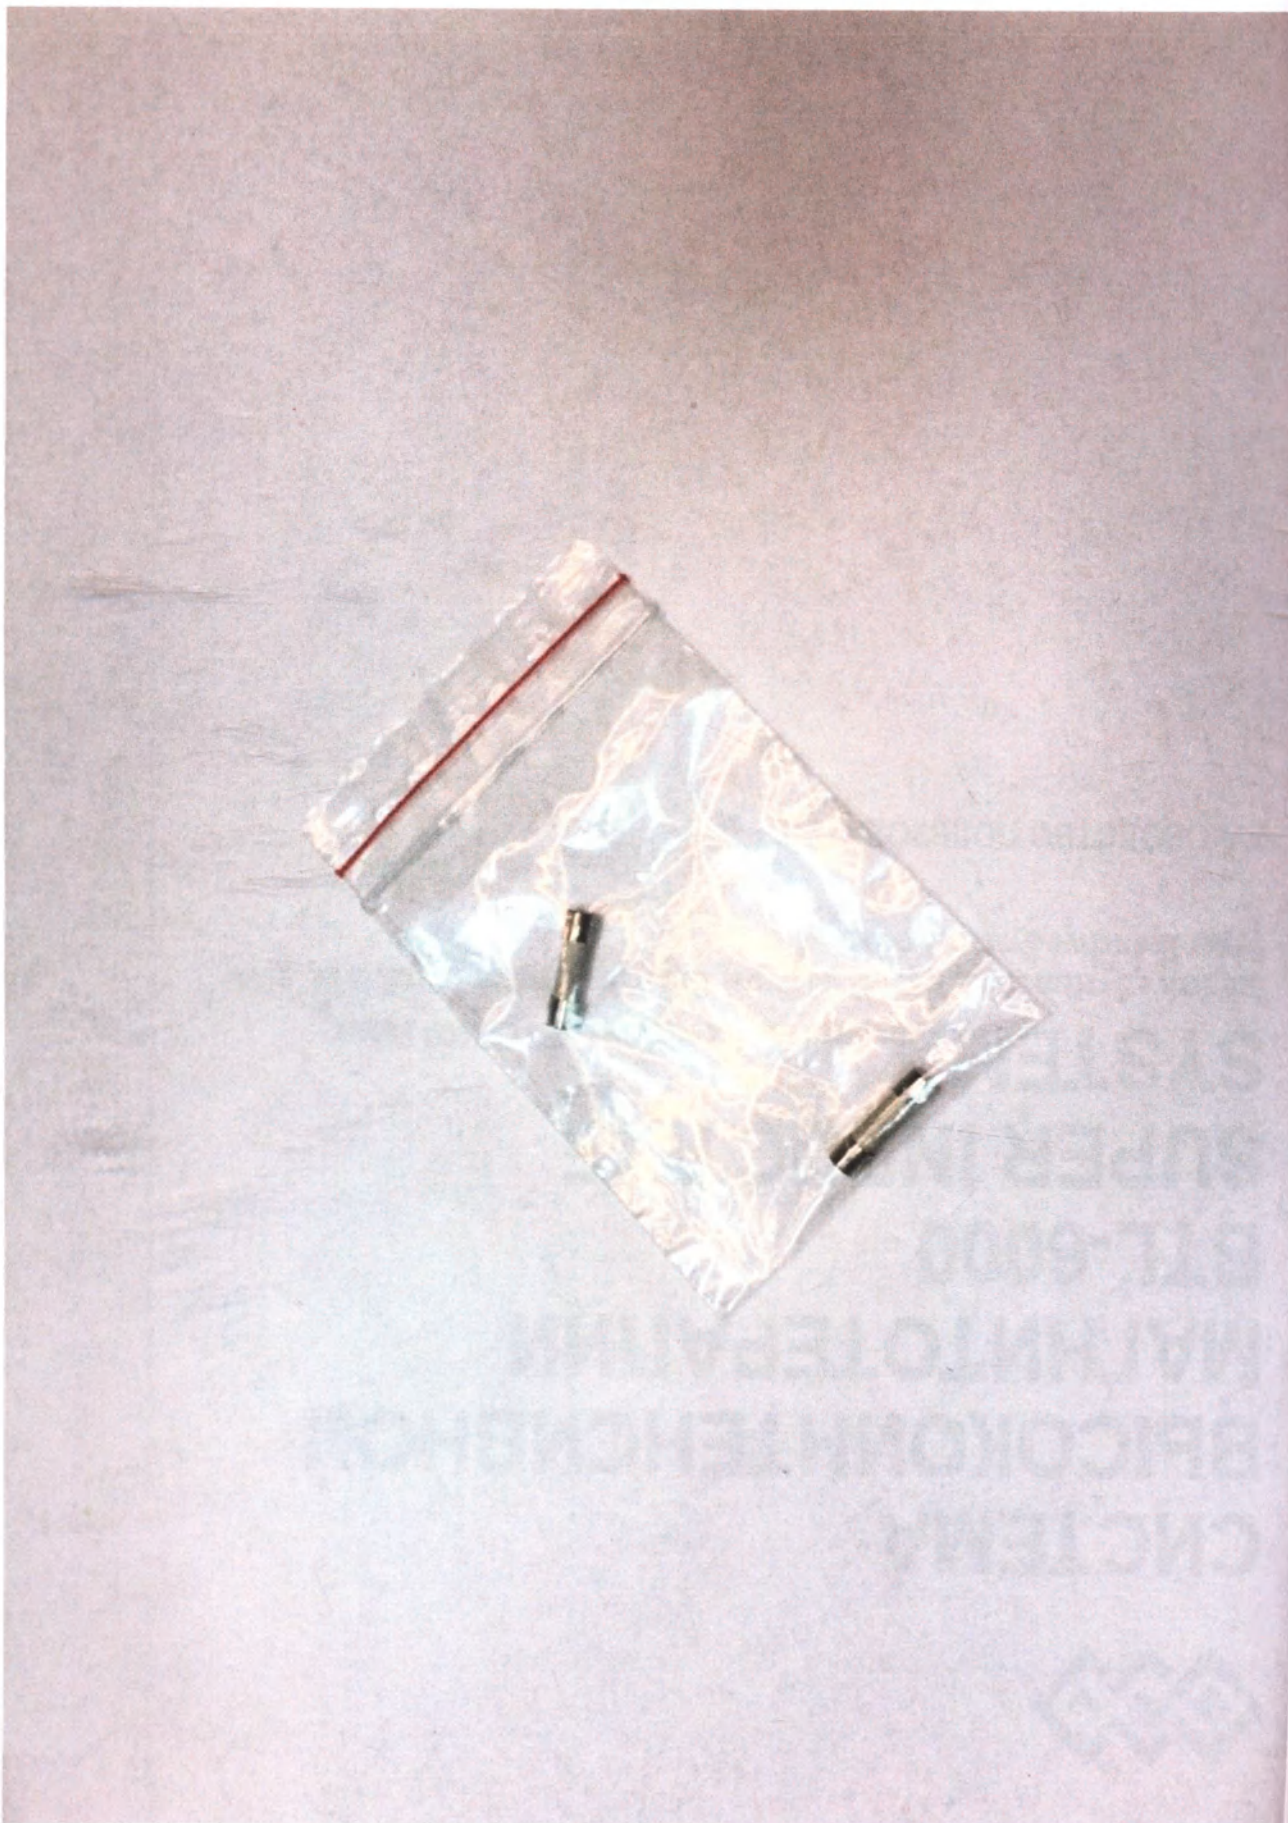

2.3. Занесенные предохранители (2 шт.)

5.5. Клейкая этикетка



СИСТЕМА ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ BTL-6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM,

варианты исполнения: BTL-6000 Super
Inductive System Elite, BTL-6000 Super Inductive System Locus, BTL-6000
Super Inductive System Duo»


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




2.5. Стилус для сенсорного экрана



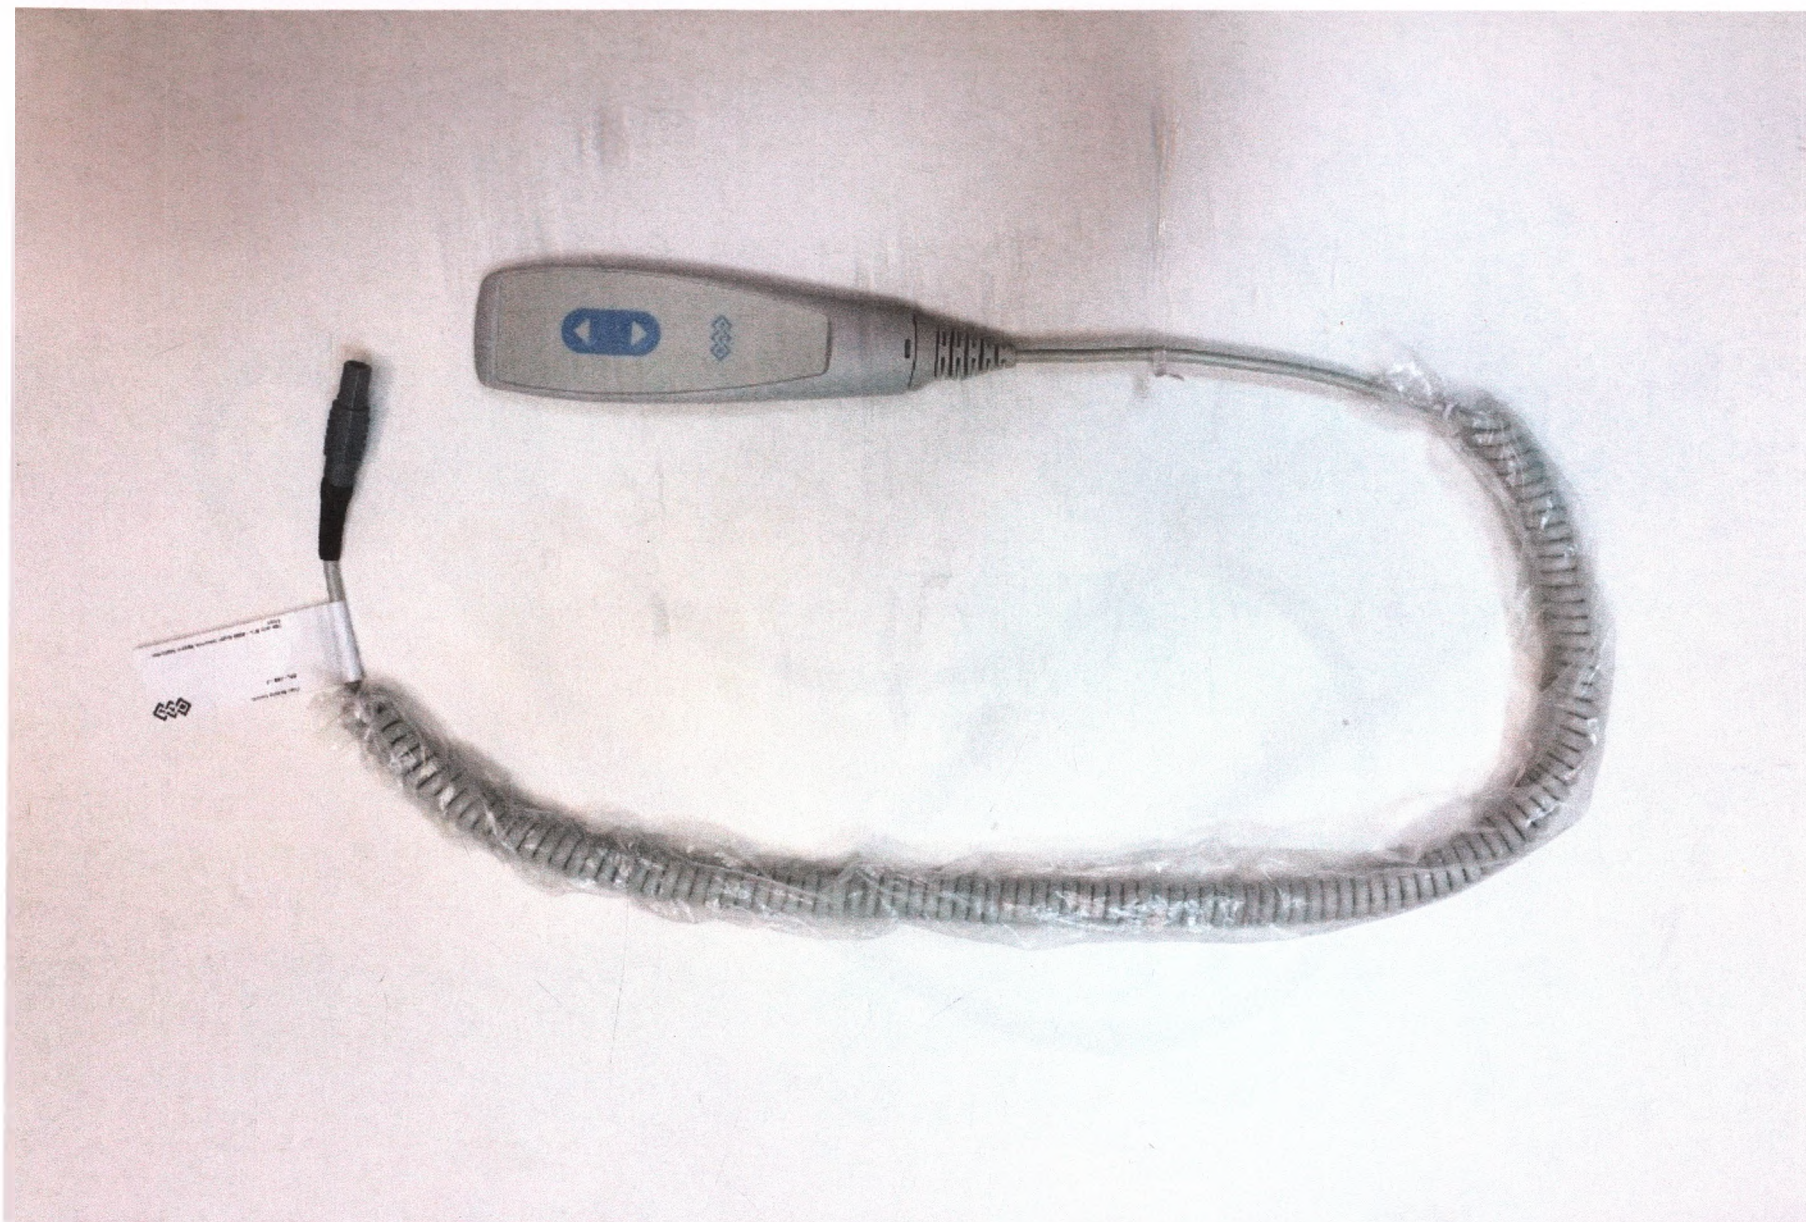

2.7. Пульт управления аппликатором кресло

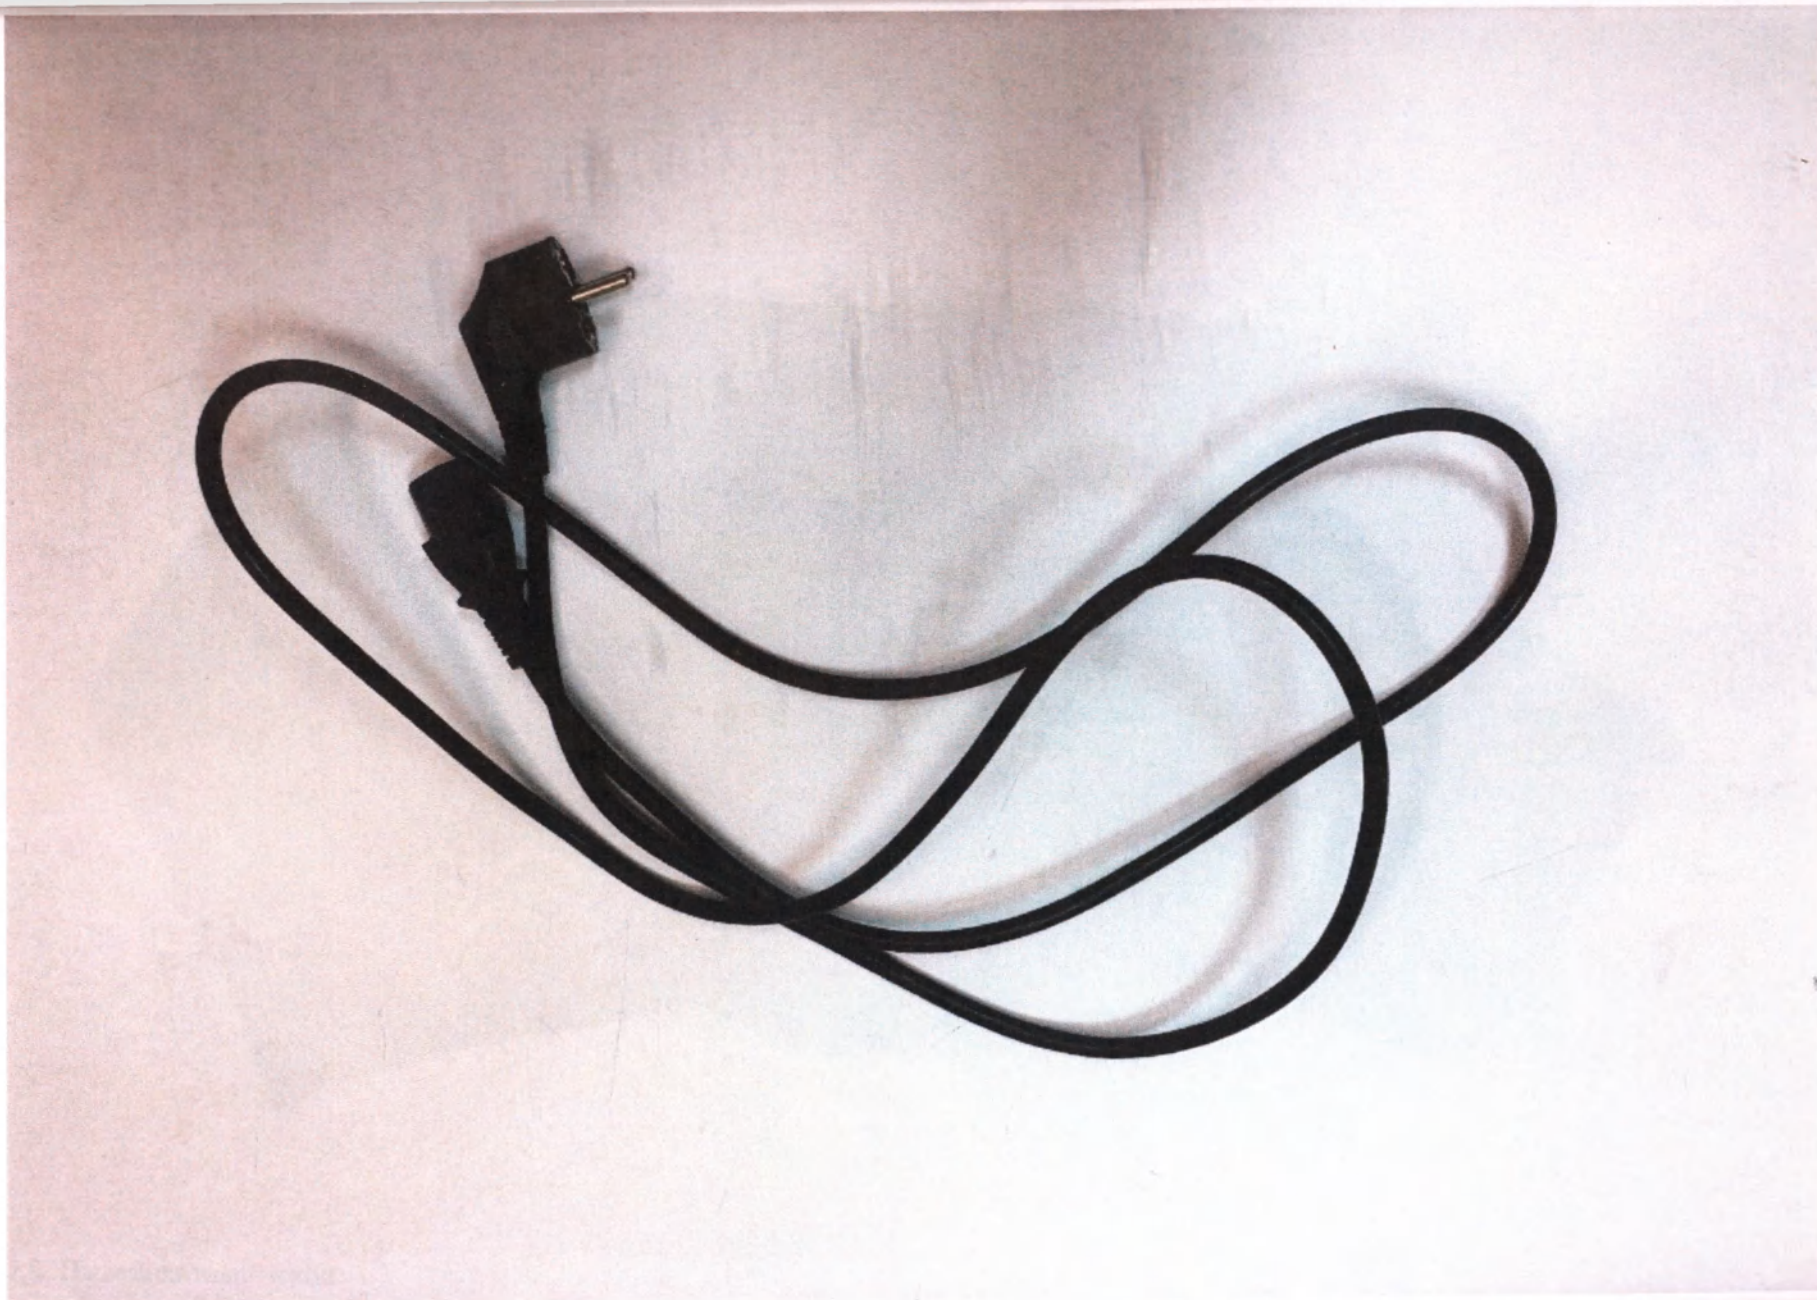

2.8. Кабель питания аппликатора кресло




2.9. Пылезащитный чехол





3.2. Кабель питания

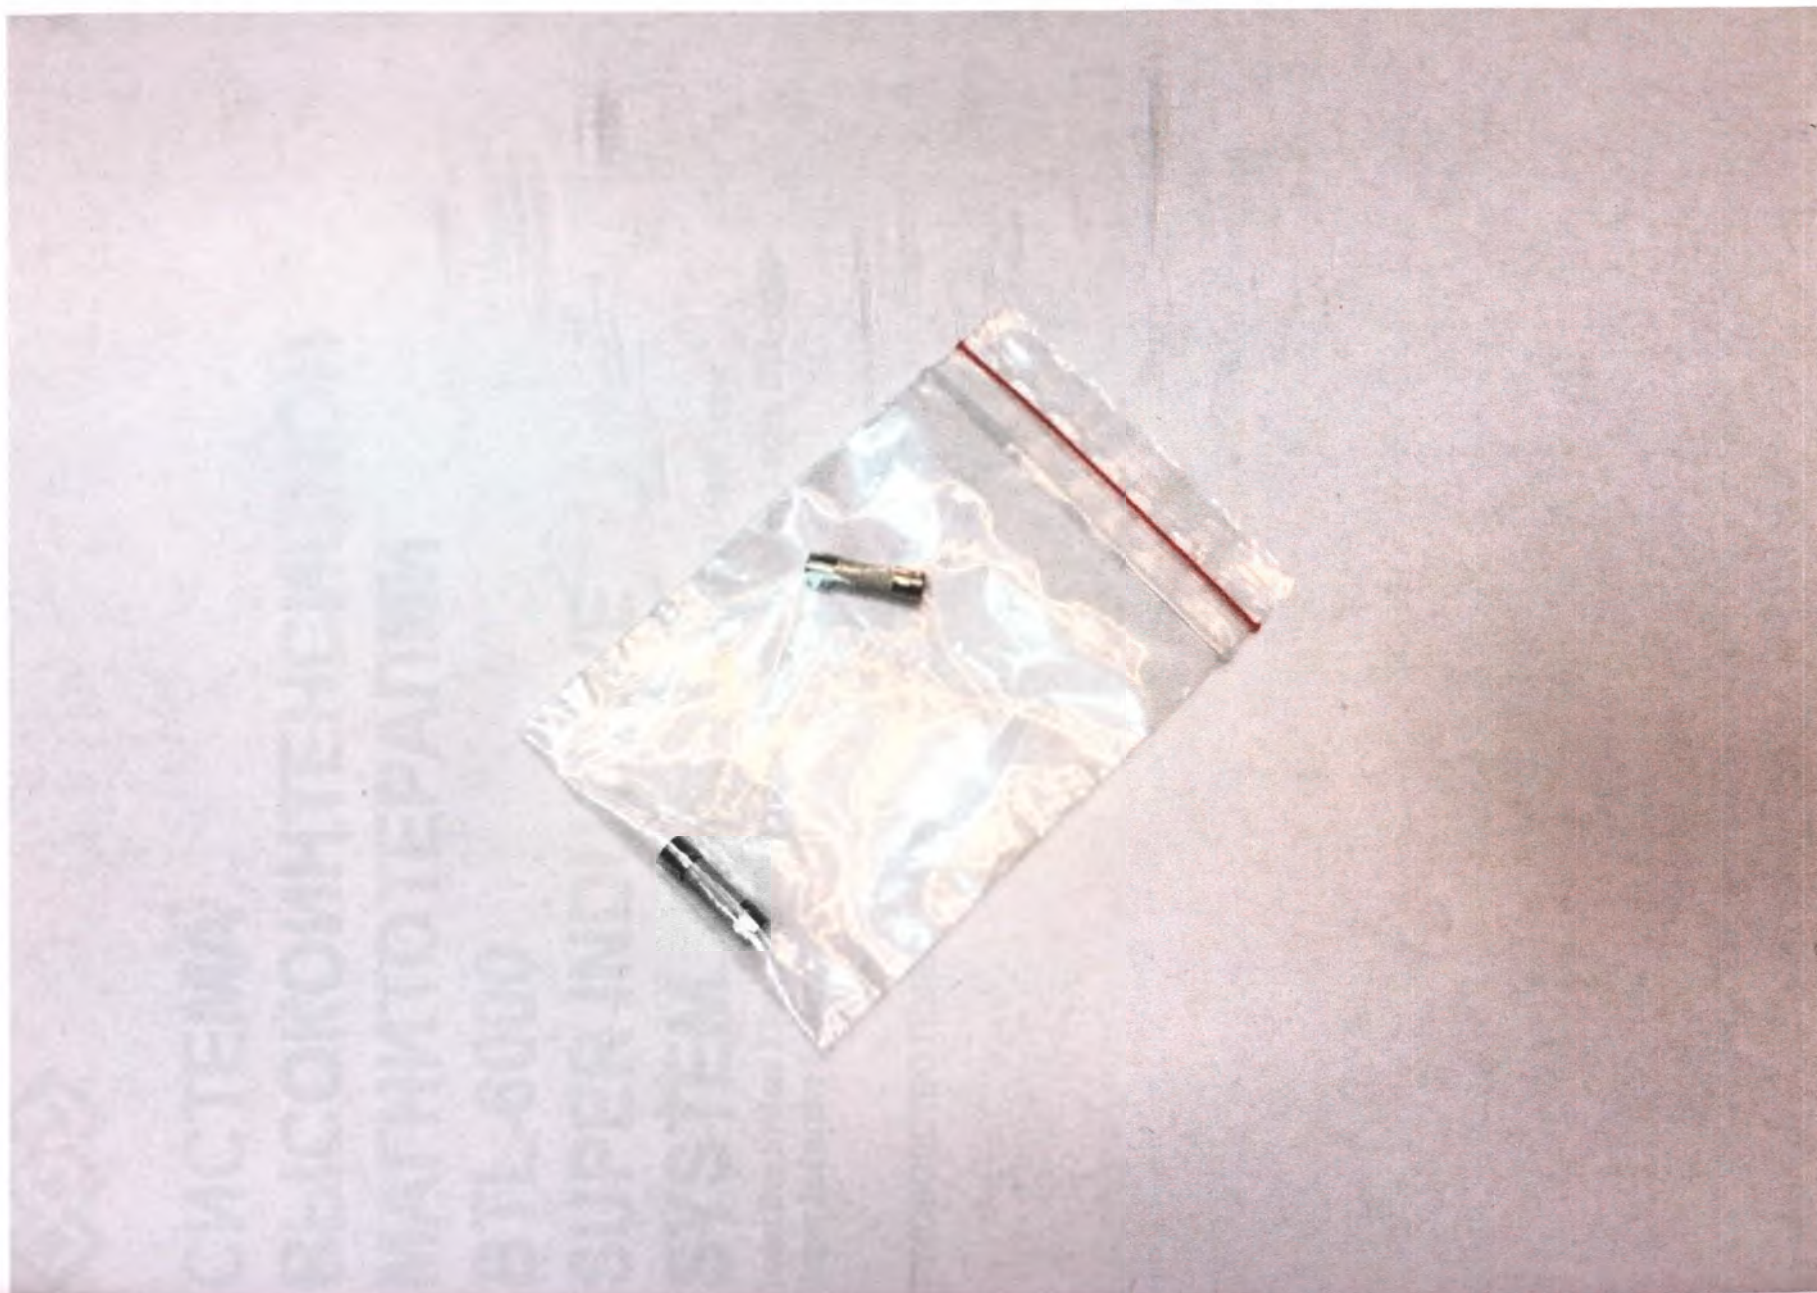

3.3. Запасные предохранители (2 шт.)



СИСТЕМА ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ BTL-6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM,

варианты исполнения BTL-6000 Super

Inductive System Elite, BTL-6000 Super Inductive System Locus, BTL-6000
Super Inductive System Duo»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


к руководству пользователя



3.5. 6-секционный держатель для аппликатора сфокусированного поля




3.6. Амплификатор сфокусированного поля

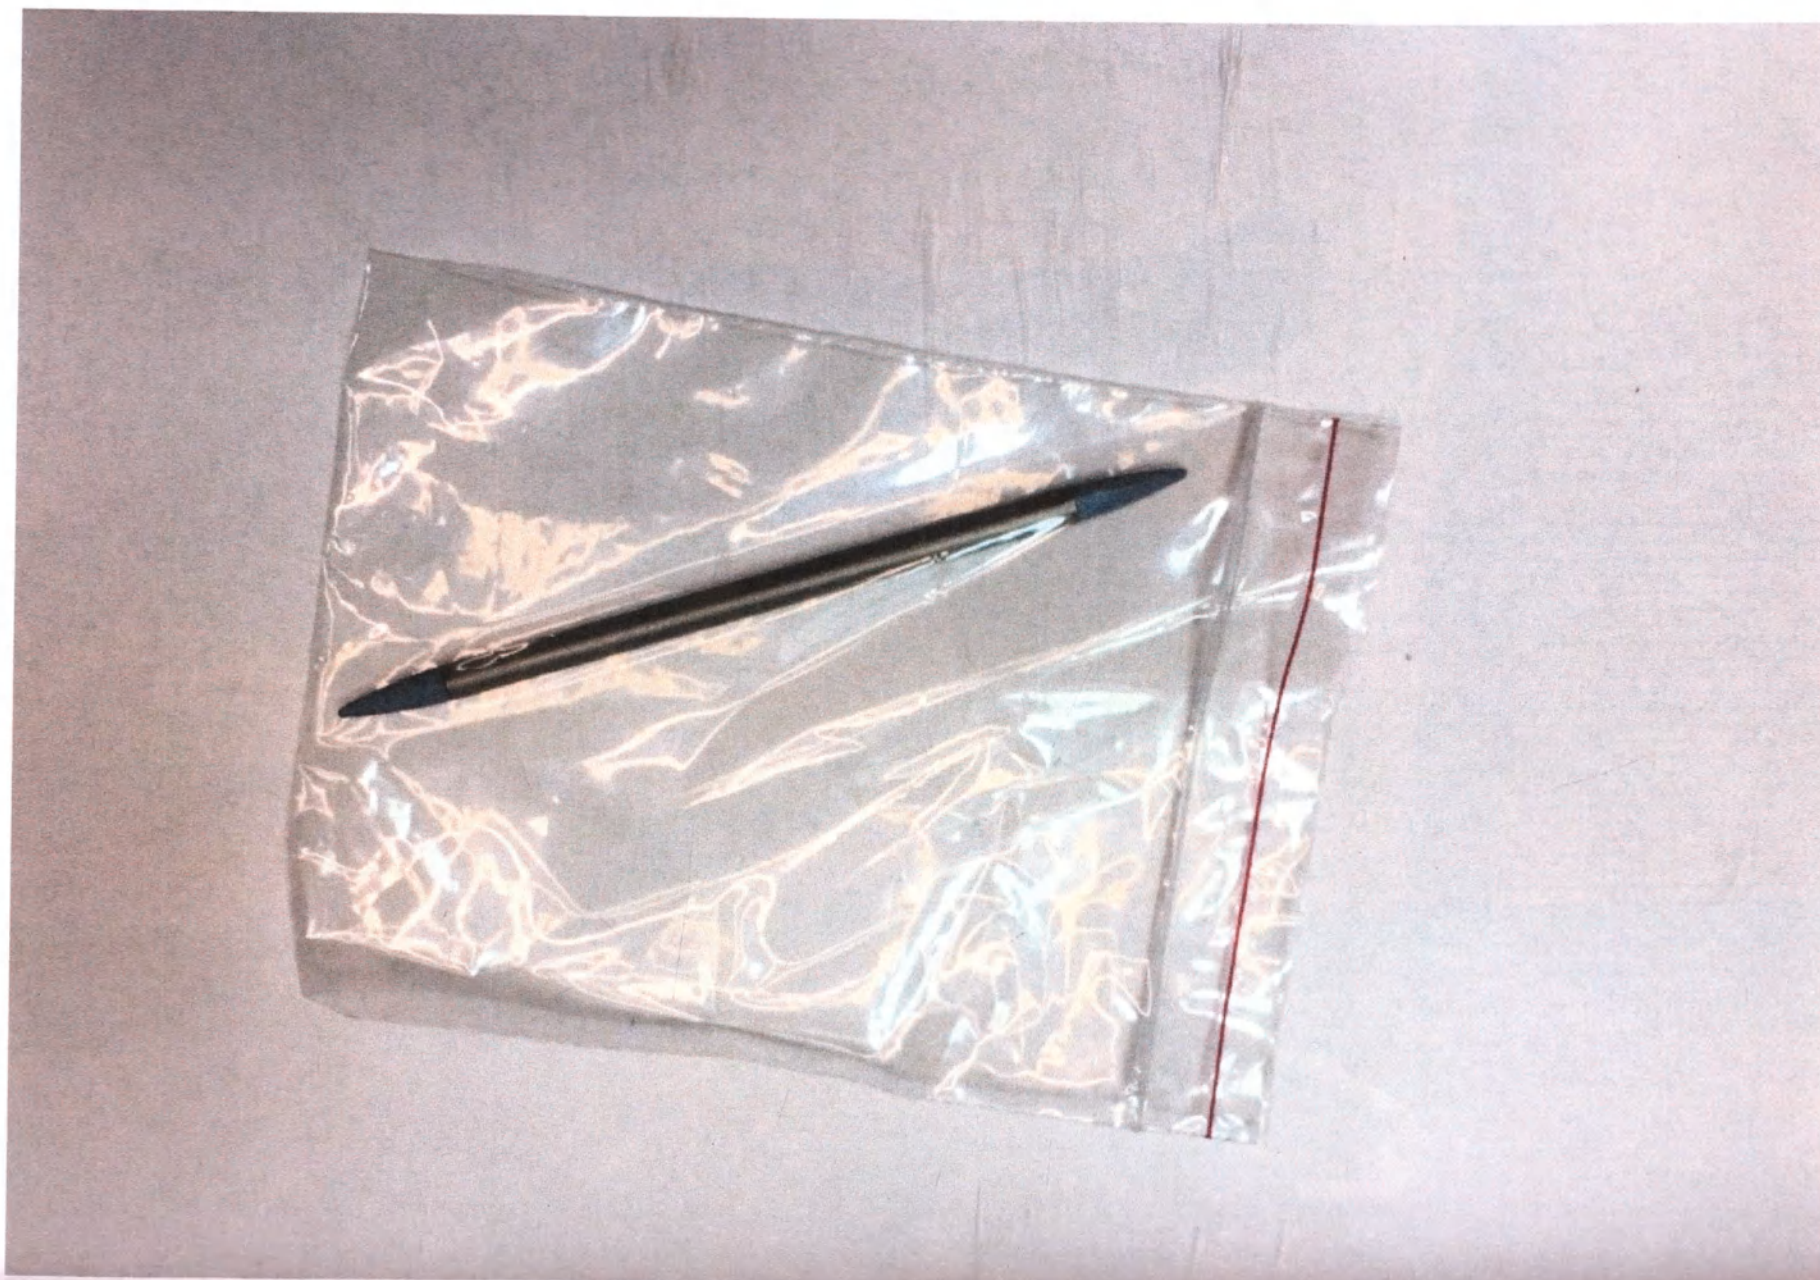


3.7. Стилус для сенсорного экрана



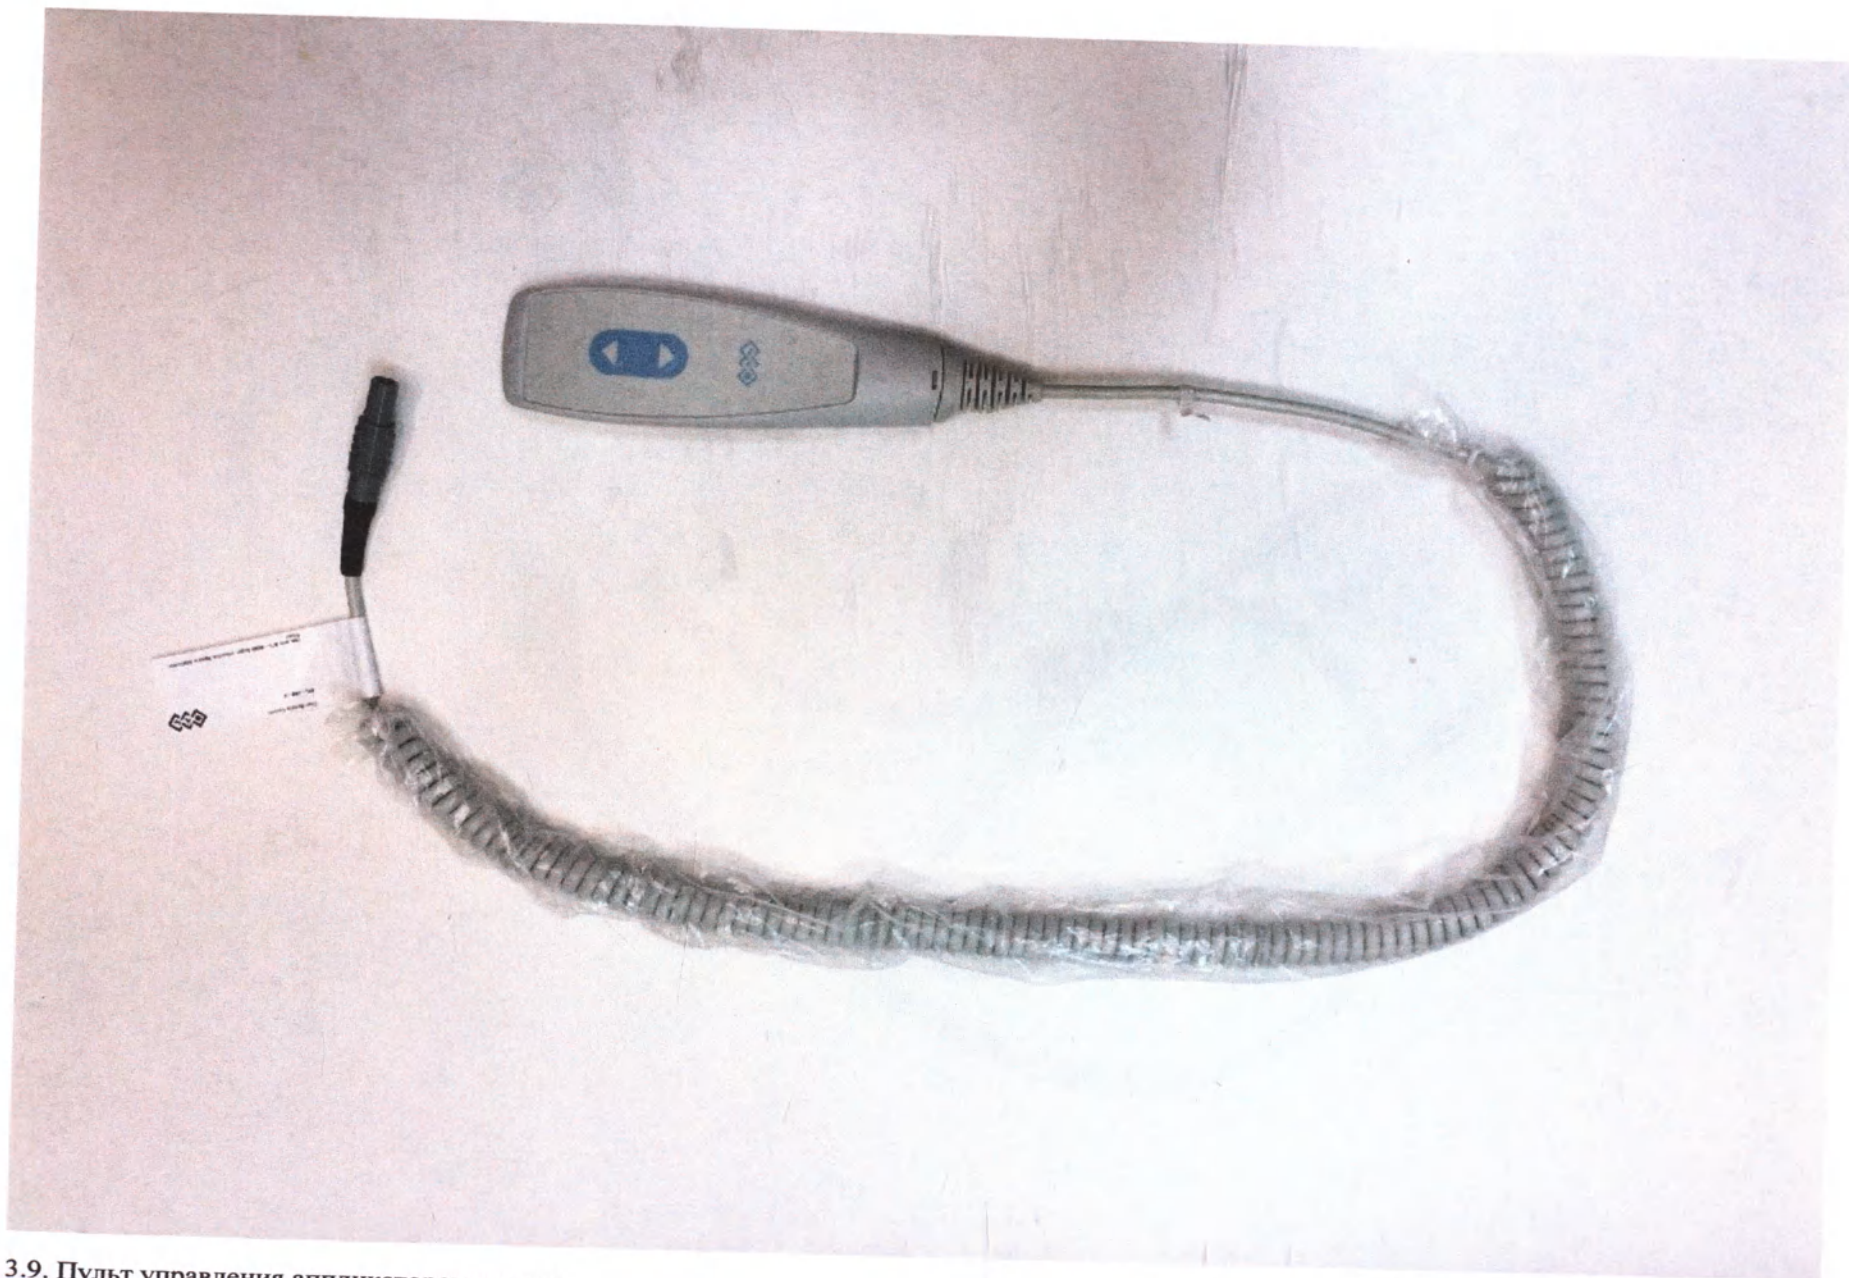

3.9. Пульт управления аппликатором кресло

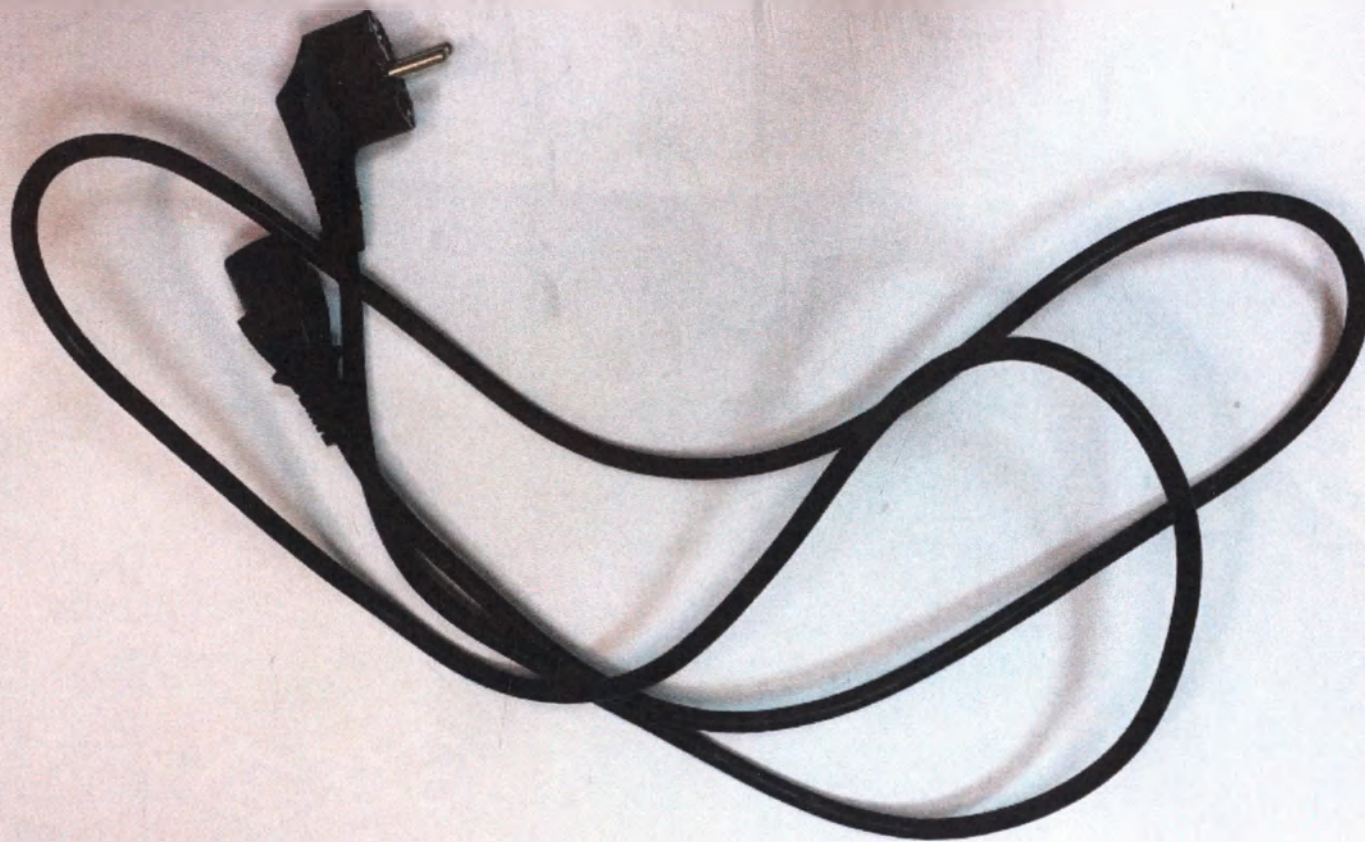

3.10. Кабель питания аппликатора кресло





3.13 Набор инструментов для установки 6-секционного держателя (гаечный ключ 10х13, трубчатый ключ 8 - 10, вороток для трубчатого ключа, винт



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 36 листов

Генеральный директор
Ильдар Мираев

