

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «БиоХимМак»



Н.Е. Тамм

2019 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Анализатор – рефлектметр «NuscoCard™ READER II»»

Производства

Alere Technologies AS, Norway

(Алере Технолоджиз АС, Норвегия)

Версия 3

Фото 1. Анализатор – рефлектметр «NycoCard™ READER II». Комплект поставки.

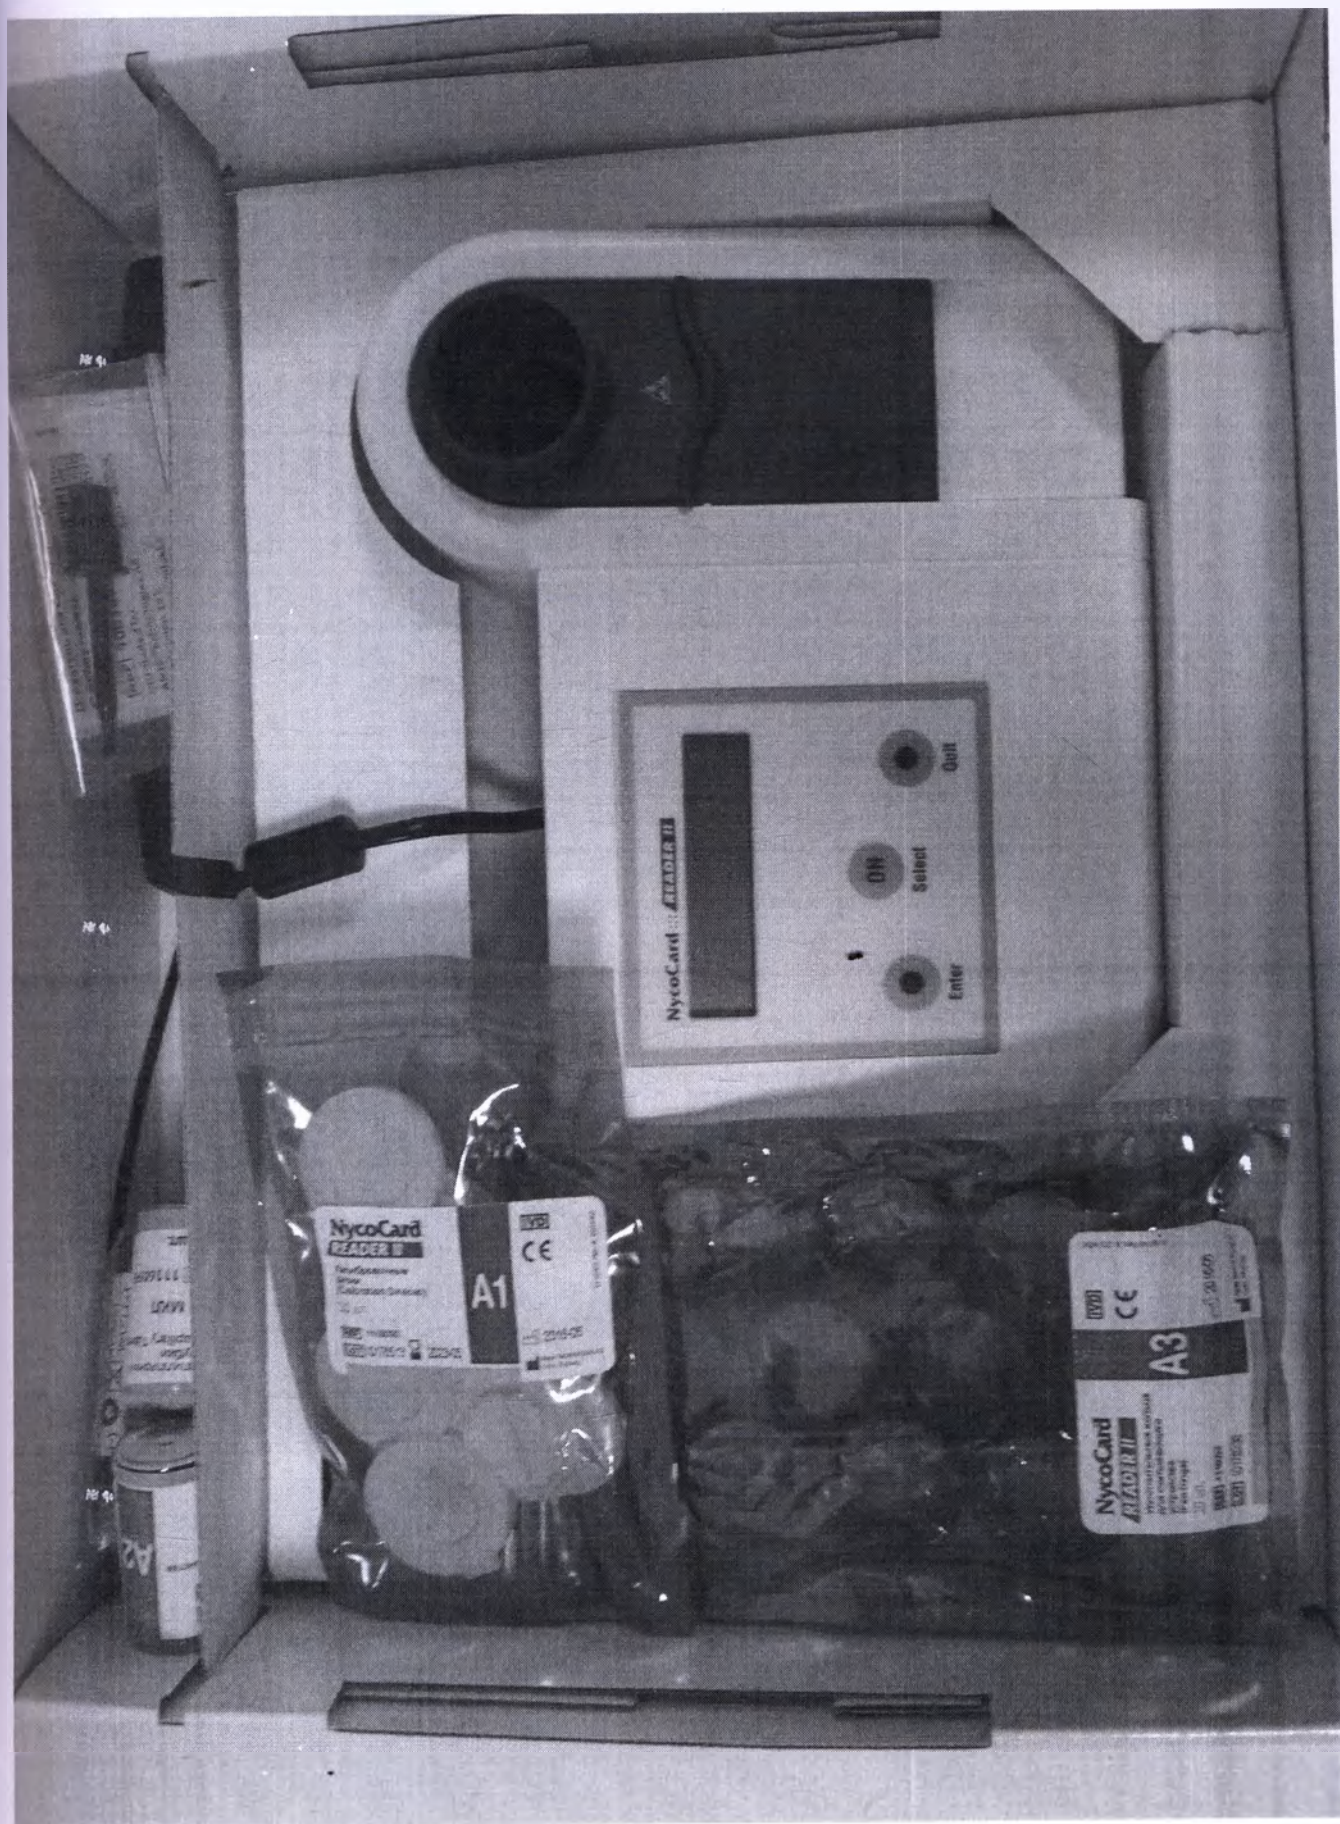


Фото 2. Анализатор – рефлектметр «Nycocard™ READER II»: адаптер для подключения в сеть и сменные элементы питания

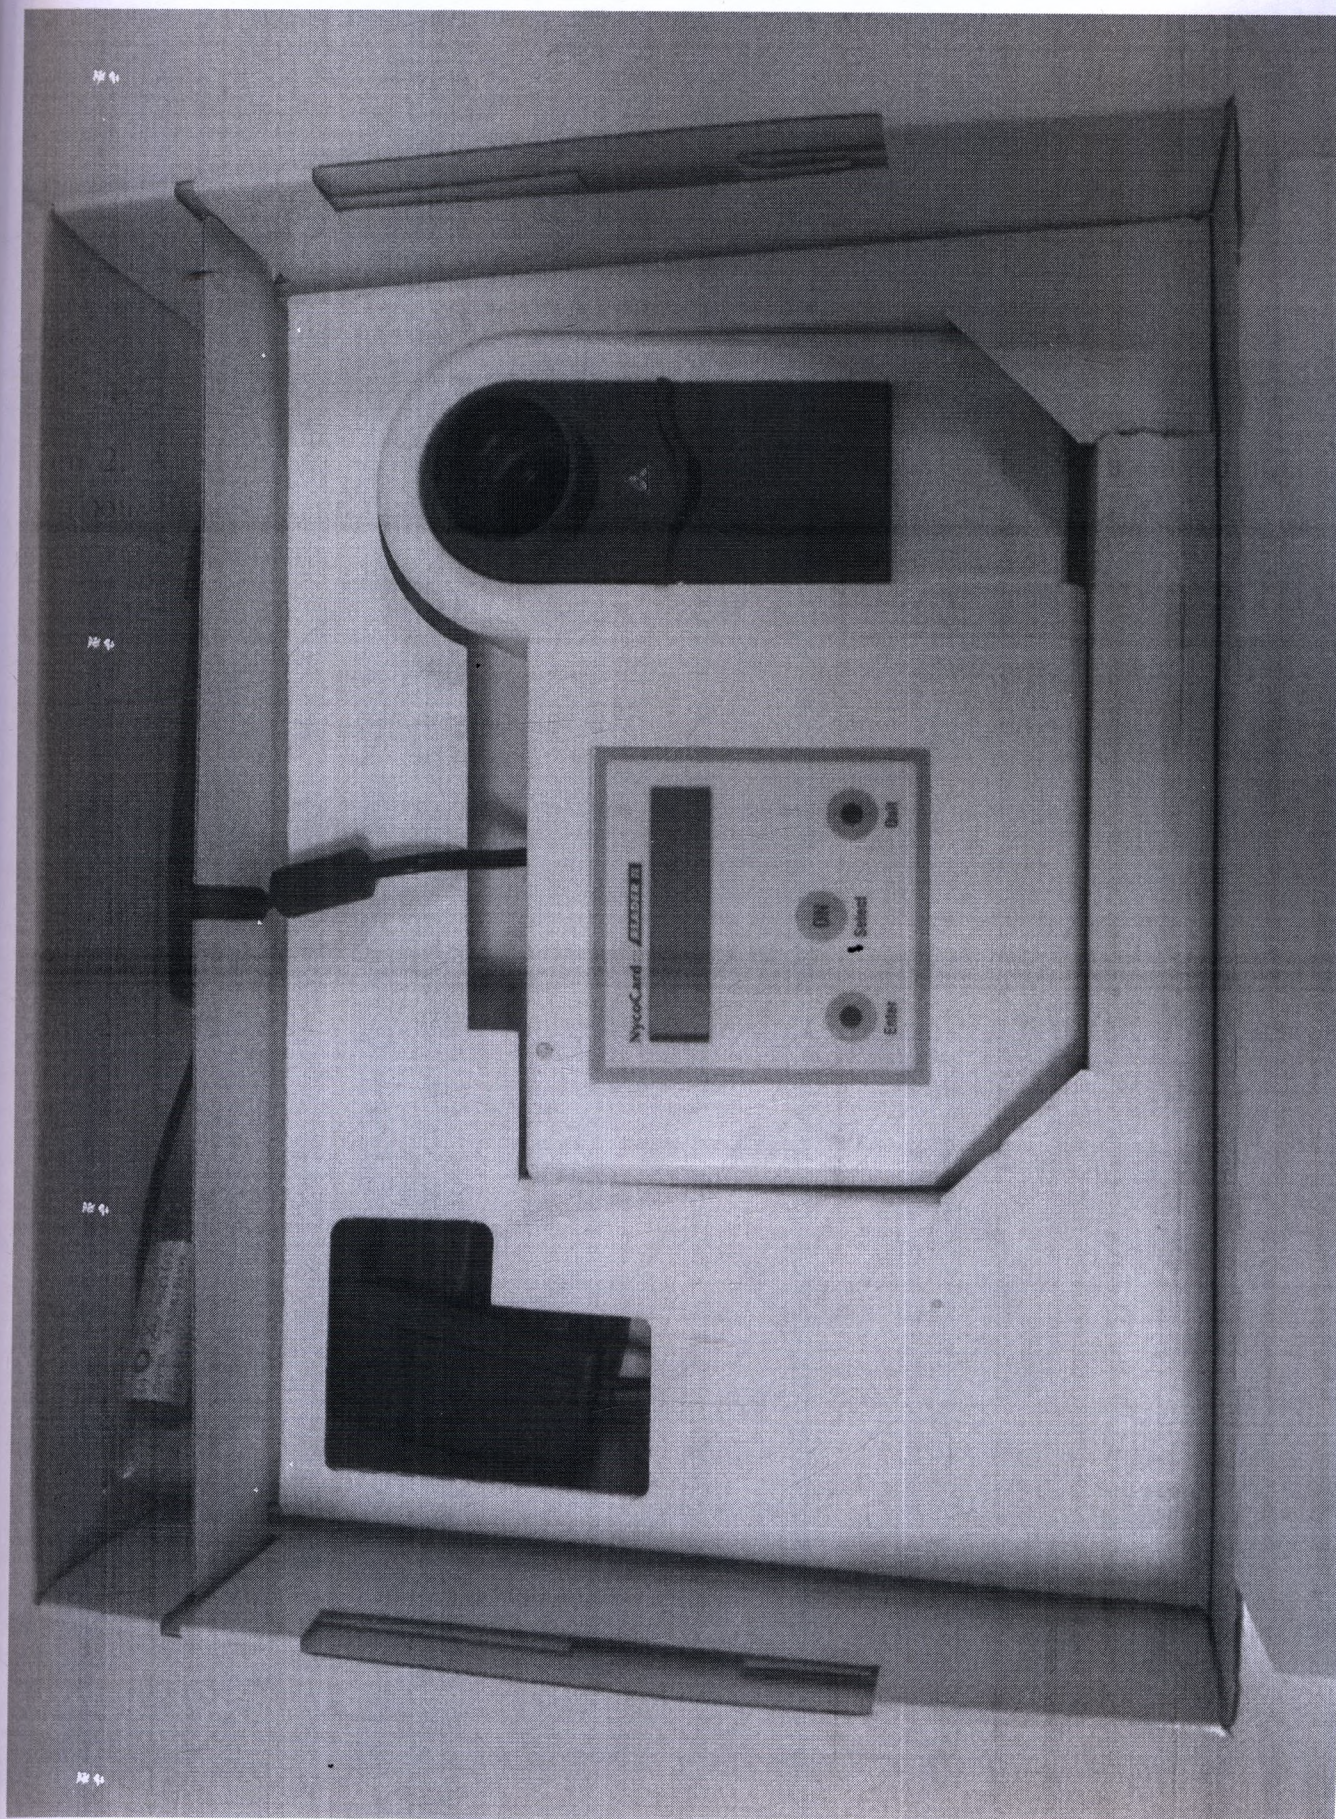


Фото 3. Анализатор – рефлектометр «NuscoCard™ READER II»: адаптер для подключения в сеть, считывающее устройство, коврик.

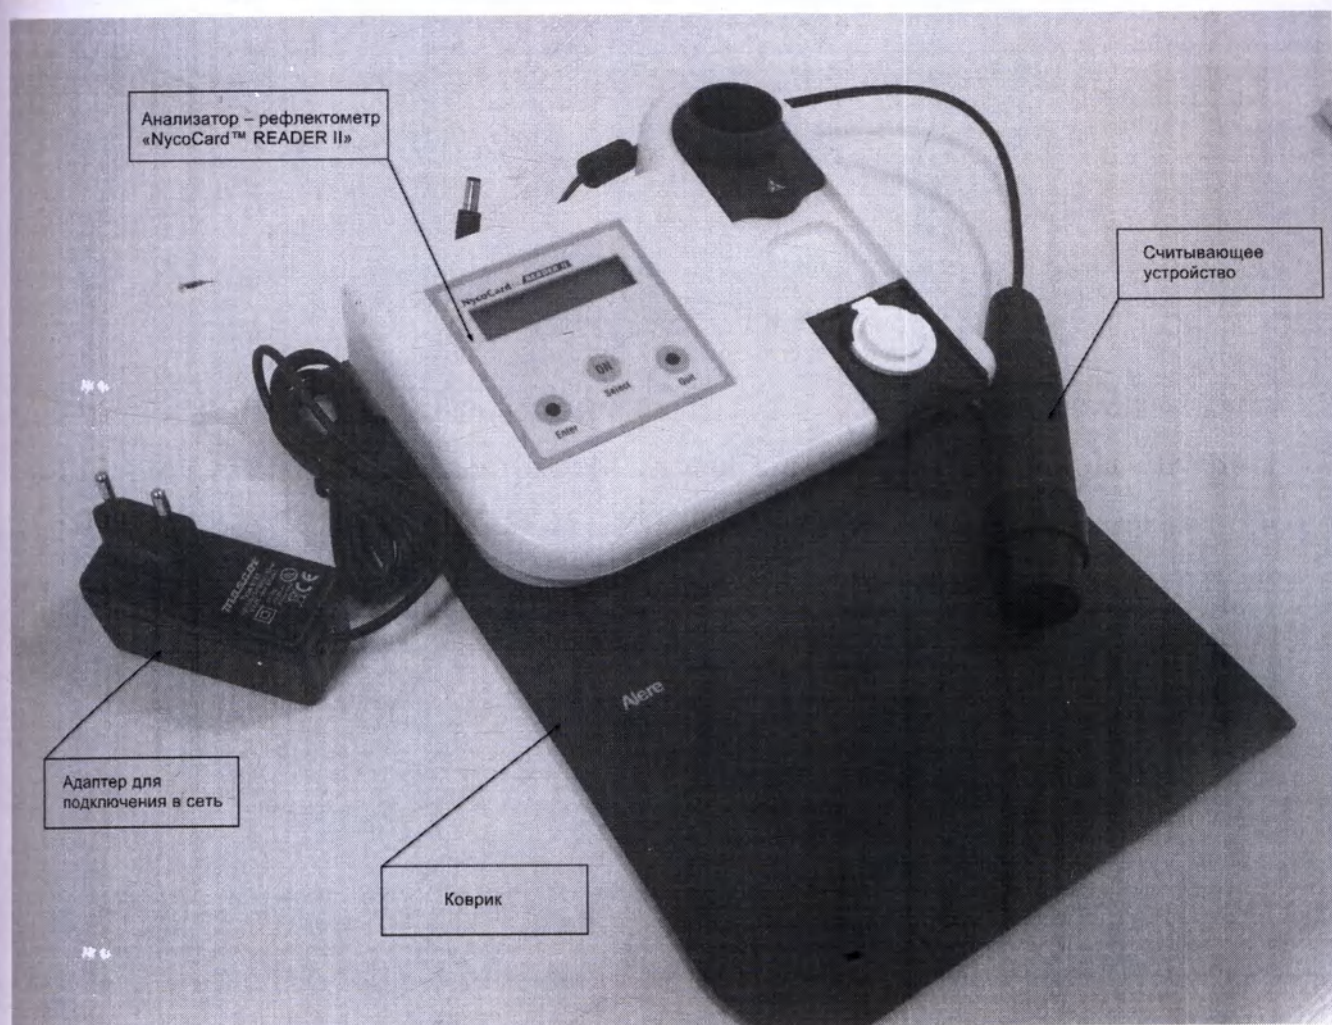


Фото 4. Анализатор – рефлектометр «NyscoCard™ READER II». Разъемы для адаптера для подключения в сеть (9 V), считывающего устройства (PEN), RS-232 порт для связи с компьютером.

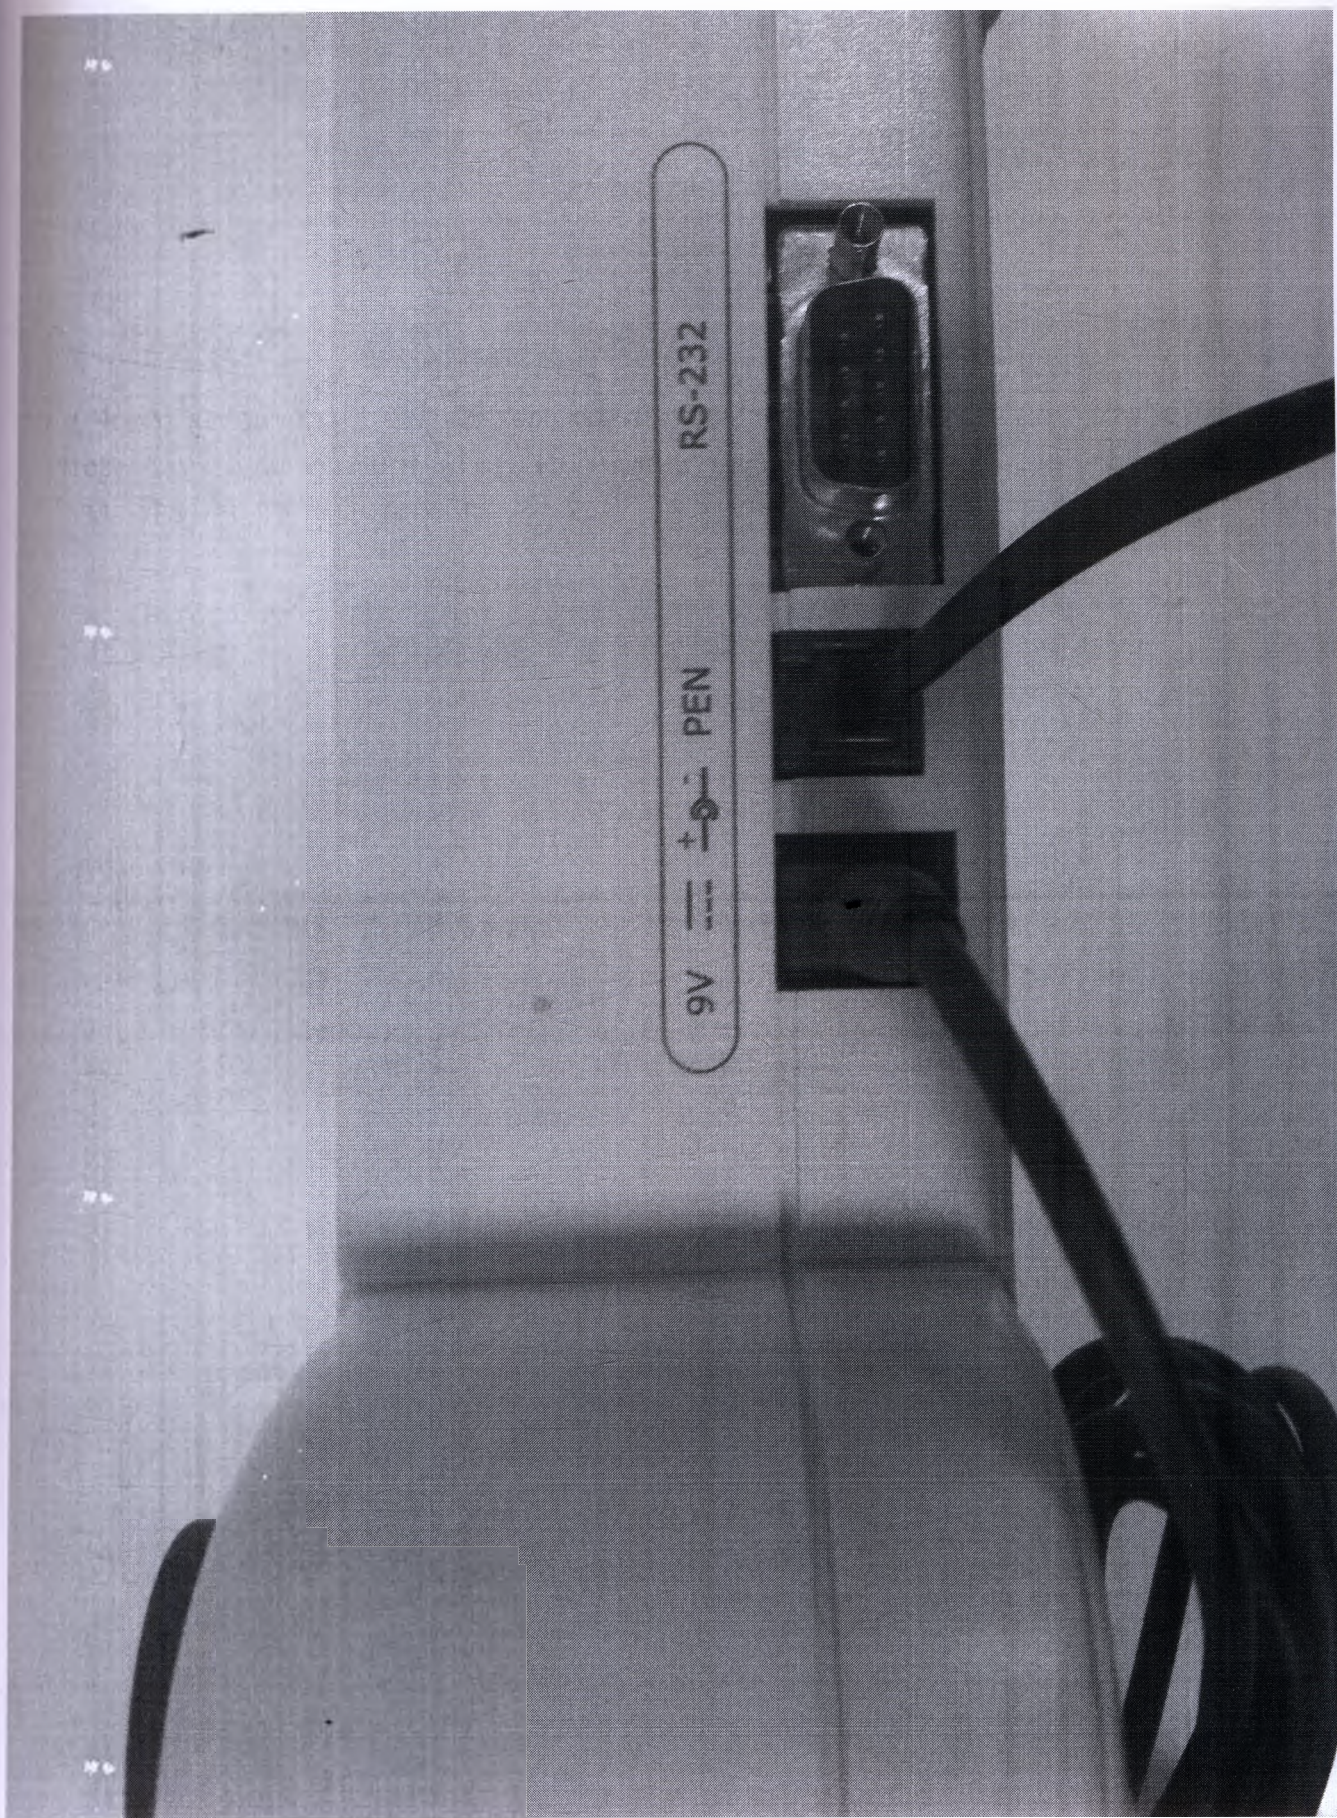


Фото 5. Анализатор – рефлектометр «Nycocard™ READER II». Маркировка. Крышка отсека со сменными элементами питания.

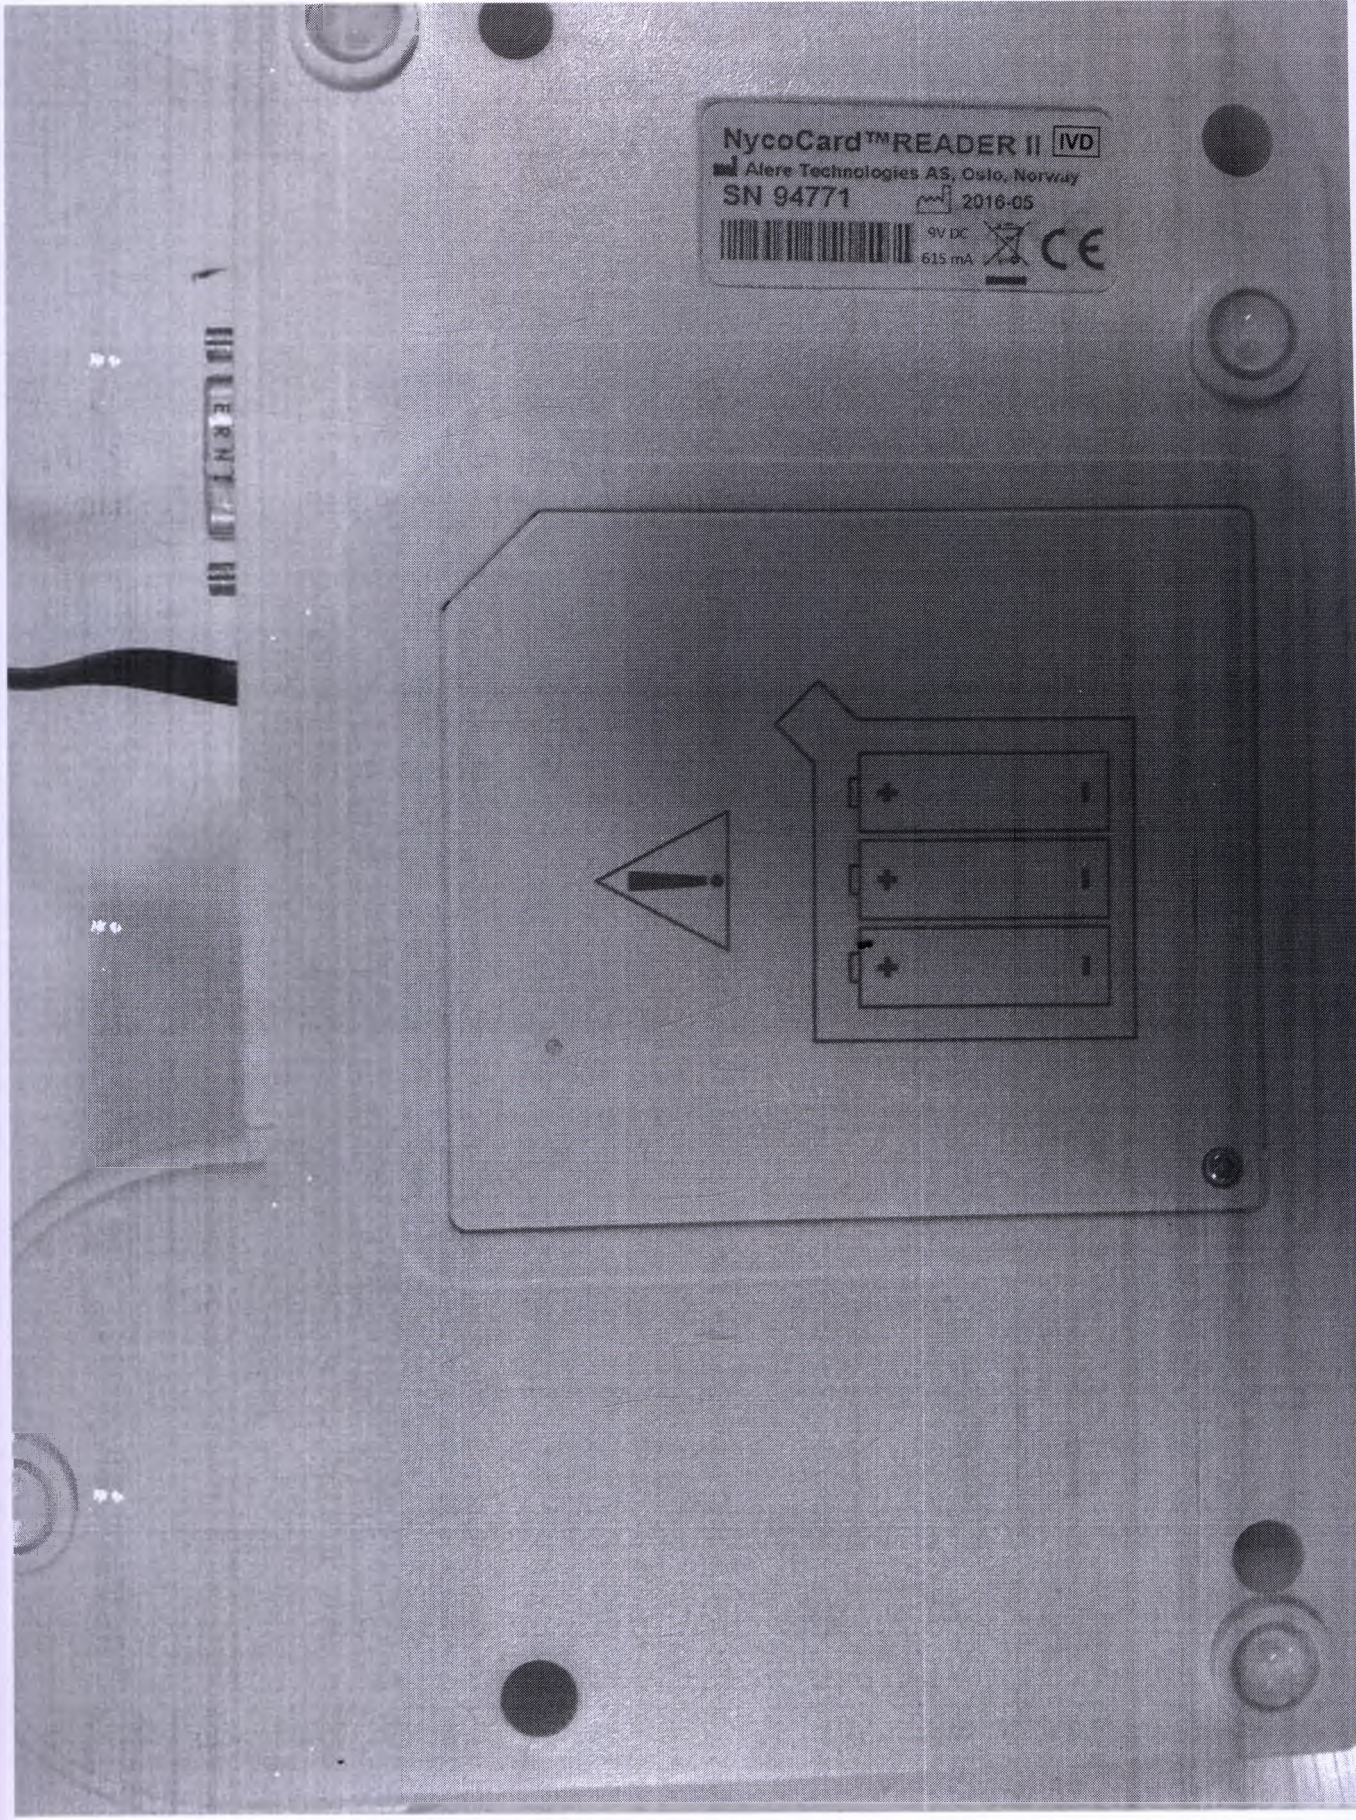


Фото 6. Калибровочные диски (Calibration Devices) – 10 шт.



Фото 7. Наконечники для считывающего устройства (Pen Tips) – 10 шт.



Фото 8. Уплотнительные кольца для считывающего устройства (Pen Rings) – 10 шт.



Фото 9. Капиллярные трубки 5 мкл (Capillary tubes 5 mcl) – 200 шт.

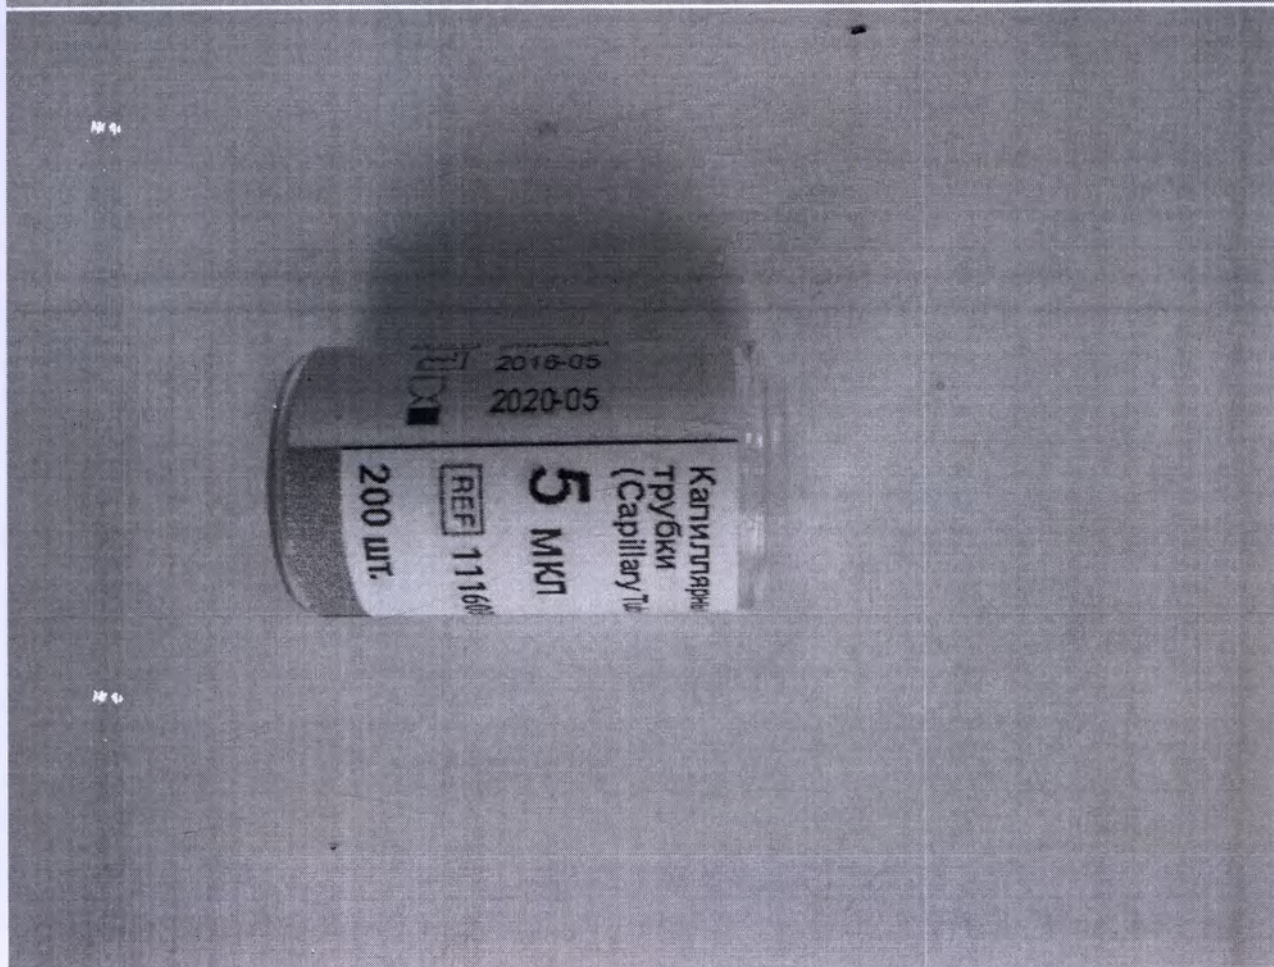
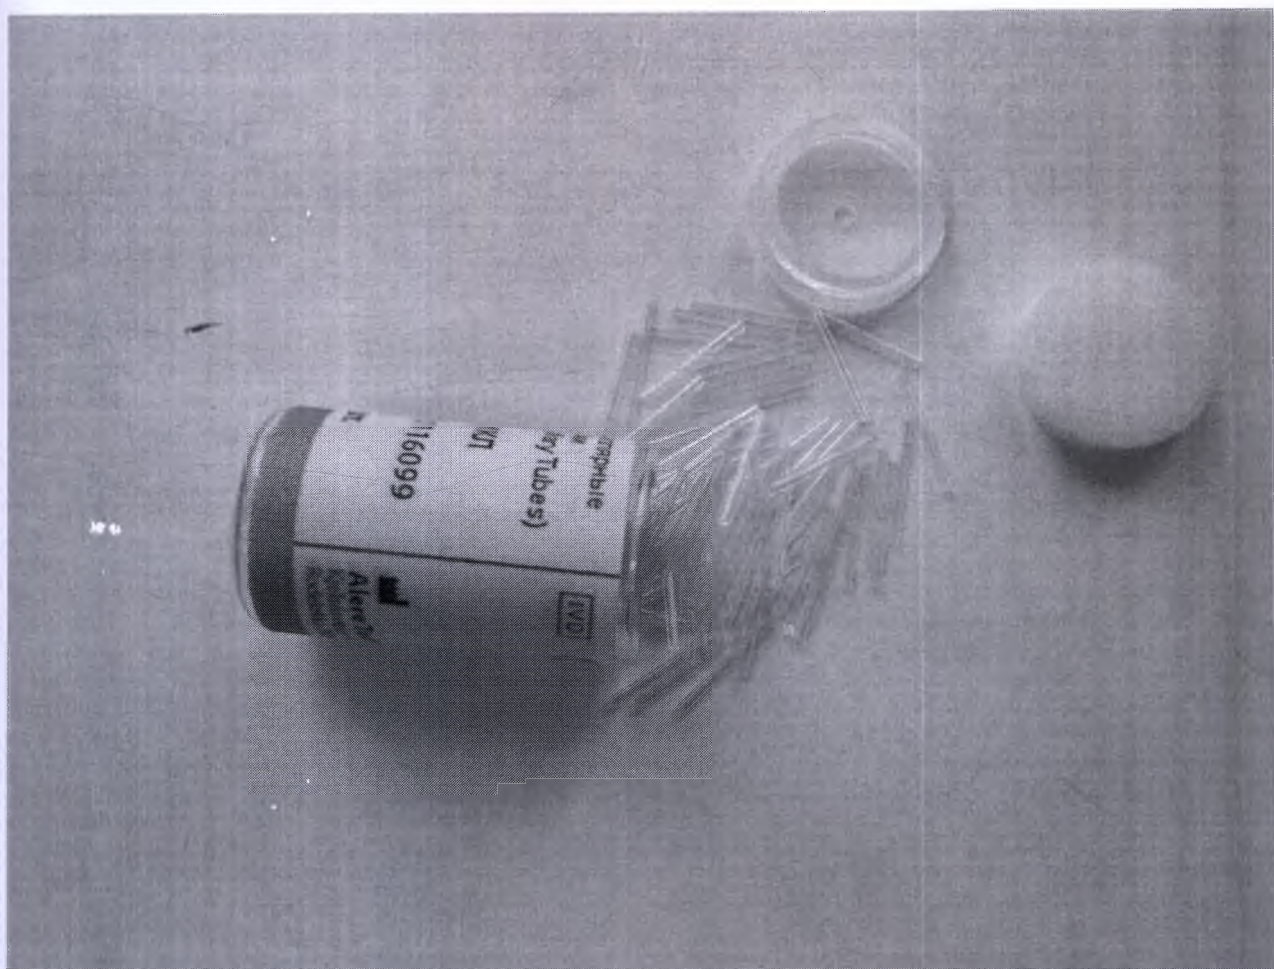


Фото 10. Держатель для капиллярных трубок (Capillary Holder) – 1 шт.



Фото 11. Адаптер для подключения в сеть – 1 шт.



Фото 12. Сменные элементы питания – 3 шт.



Фото 13. Коврик



Генеральный директор

ЗАО «БиоХимМак»


Н.Е.Тамм

Прошито и пронумеровано

листа (ов).



«УТВЕРЖДАЮ»

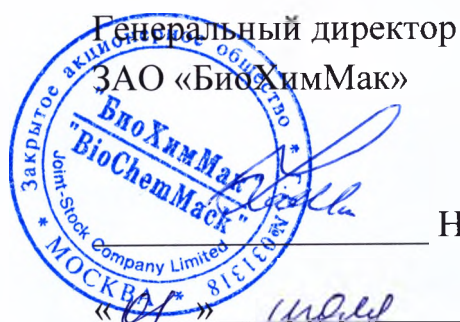

Н.Е. Тамм

«01» _____ 2019 г.

Образцы маркировки медицинского изделия
«Анализатор – рефлектометр «NyscoCard™ READER II»»

Производства
Alere Technologies AS, Norway
(Алере Технолоджиз АС, Норвегия)

Анализатор-рефлектометр «NycoCard™ READER II». Макет маркировки, наносимой на корпус Анализатора.

NycoCard™ READER II		IVD	
	Alere Technologies AS, Oslo, Norway		
SN			
штрих-код	9V DC* 615 mA		 

2. Анализатор-рефлектометр «NycoCard™ READER II». Макет маркировки, наносимой на Адаптер для подключения в сеть.

MASCOT Type 9725		
Вход: 100-250 В, 50-60Гц, 150мА Выход: 9В DC*, max 615 мА		
	ITE-Power Supply** 11XA	
		

* - постоянного тока

** - ITE-Power Supply - Источник питания для информационно-технологического оборудования

3. Калибровочные диски (Calibration Devices). Макет маркировки индивидуальной упаковки.

NycoCard READER II Калибровочные диски (Calibration Devices) 10 шт. REF 1116092 LOT _____	A1	IVD CE  Alere Technologies AS Kjelsåsveien 161, P.O. Box 6863 Rodeløkka, NO-0504 Oslo, Norway Кьелсасвейен 161, а/я 6863 Роделокка, 0504 Осло, Норвегия
--	------------------	---

4. Наконечники для считывающего устройства (Pen Tips). Макет маркировки индивидуальной упаковки.

NycoCard READER II Наконечники для считывающего устройства (Pen Tips) 10 шт. REF 1116094 LOT _____	A2	IVD CE  Alere Technologies AS Kjelsåsveien 161, P.O. Box 6863 Rodeløkka, NO-0504 Oslo, Norway Кьелсасвейен 161, а/я 6863 Роделокка, 0504 Осло, Норвегия
---	------------------	---

5. Уплотнительные кольца для считывающего устройства (Pen rings). Макет маркировки индивидуальной упаковки.

Nycocard	IVD
READER II	CE
Уплотнительные кольца для считывающего устройства (Pen rings) 10 шт.	A3
REF 1116093	
LOT _____	
	Alere Technologies AS Kjelsåsveien 161, P.O. Box 6863 Rodeløkka, NO-0504 Oslo, Norway Кьелсасвейен 161, а/я 6863 Роделокка, 0504 Осло, Норвегия

6. Капиллярные трубки 5 мкл (Capillary tubes 5 mcl). Макет маркировки индивидуальной упаковки.

LOT	Капиллярные трубки (Capillary tubes)	IVD		CE
	5 мкл		Alere Technologies AS Kjelsåsveien 161, P.O. Box 6863 Rodeløkka, NO-0504 Oslo, Norway Кьелсасвейен 161, а/я 6863 Роделокка, 0504 Осло, Норвегия	
	REF 1116099			
	200 шт.			

7. Держатель для капиллярных трубок (Capillary Holder). Макет маркировки индивидуальной упаковки.

Держатель для капиллярных трубок
(Capillary Holder)

1 шт.

REF 1003668

штрих-код



Alere Technologies AS

Kjelsåsveien 161, P.O. Box 6863

Rodeløkka, NO-0504 Oslo, Norway

Кьелсасвейен 161, а/я 6863

Роделокка, 0504 Осло, Норвегия

8. Анализатор-рефлектометр «Nycocard™ READER II». Макет маркировки индивидуальной упаковки.

Nycocard™ READER II	
SN _____	 _____
штрих-код	
	  
	Alere Technologies AS Kjelsåsveien 161, P.O. Box 6863 Rodeløkka, NO-0504 Oslo, Norway Кьелсасвейен 161, а/я 6863 Роделокка, 0504 Осло, Норвегия
 70°C -40°C	Питание: сменные элементы питания, адаптер для подключения в сеть
 93%	Параметры сменных элементов питания: перезаряжающиеся батареи NiMH (размер AA, 1,2 В) – 3 шт.
10% 	Параметры адаптера для подключения в сеть: Вход: 100-250В, 50-60 Гц, 150 мА Выход: 9 В DC (постоянного тока), 650 мА

Генеральный директор

ЗАО «БиоХимМак»



Н.Е.Тамм

Прошито и пронумеровано

листа (ов).