

## **Макет маркировки на медицинское изделие**

**Калибратор стандартный для обеспечения правильности количественного  
определения ревматоидного фактора (RF) в сыворотке крови человека  
турбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c  
«Ревматоидный фактор Калибратор Стандартный (Alinity c RF Standard)»**

**Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации**  
**Ревматоидный фактор Калибратор Стандартный (Alinity с RF Standard), кат. № 01R1601**



01R1601



Калибратор стандартный для обеспечения правильности количественного определения ревматоидного фактора (RF) в сыворотке крови человека турбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Ревматоидный фактор Калибратор Стандартный (Alinity с RF Standard)»

В составе: 1. Калибратор (Alinity с RF Standard) – 6 x 1,0 мл; 2. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Биокит, С. А.» (Biokit, S. A.), Av. Can Montcau 7, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona, Spain, Испания / Место производства: Biokit, S. A., Av. Can Montcau 7, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona, Spain / Страна происхождения: Испания / РУ № \_\_\_\_ от \_\_\_\_.

Инструкция по применению на русском языке: [www.corelaboratory.abbott/IFU](http://www.corelaboratory.abbott/IFU) / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

**Авторизованный представитель изготовителя на территории России:**

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 1

Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

**Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Ревматоидный фактор Калибратор**  
**Стандартный (Alinity с RF Standard), кат. № 01R1601**



**RF Standard**

PRODUCT OF SPAIN



DISTRIBUTED BY

Abbott Laboratories  
 +34 938 60 90 00  
 Barcelona, Spain  
 081 86 Lliçà d'Amunt  
 Av. Can Montcau 7  
 Biokit, S.A.

**Abbott**

**Alinity с RF Standard**

**Alinity с RF Standard**

**Abbott**

**CAL** 6 x 1.0 mL 200 IU/mL

**CONC**



**CONTAINS: AZIDE**



**REF**

[www.abbottdiagnostics.com/IFU](http://www.abbottdiagnostics.com/IFU)

**01R1601**

Версия




**Exp.**

**LOT**


Двумерный Штрих-код

Уникальный идентификатор изделия



690802R03


Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Ревматоидный фактор Калибратор  
Стандартный (Alinity с RF Standard), кат. № 01R1601

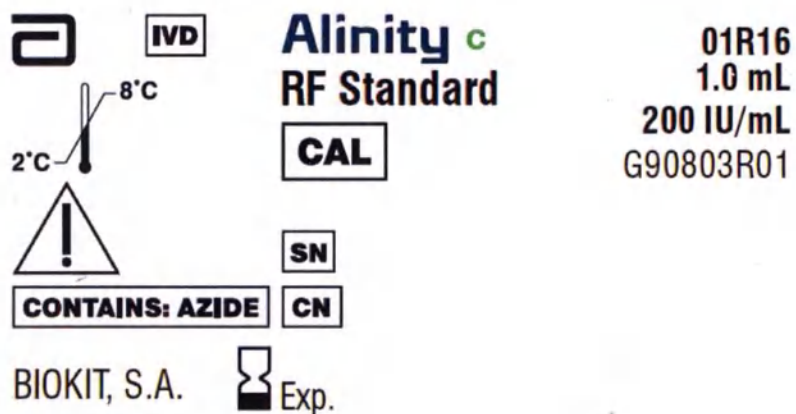



**Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие**  
**Калибратор стандартный для обеспечения правильности количественного**  
**определения ревматоидного фактора (RF) в сыворотке крови человека**  
**турбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с**  
**«Ревматоидный фактор Калибратор Стандартный (Alinity с RF Standard)»**

**Alinity с RF Standard**



**CAL** 6 x 1.0 mL **CONC** 200 IU/mL



**CONTAINS: AZIDE**



[www.abbottdiagnostics.com/IFU](http://www.abbottdiagnostics.com/IFU)

**R02**



**01R1601**



Exp.


**2025-06-20**



**01728L824**




G90802R03



(01) 00380740151218 (17) 250620

(10) 01728L824 (240) 01R1601 (91) RF

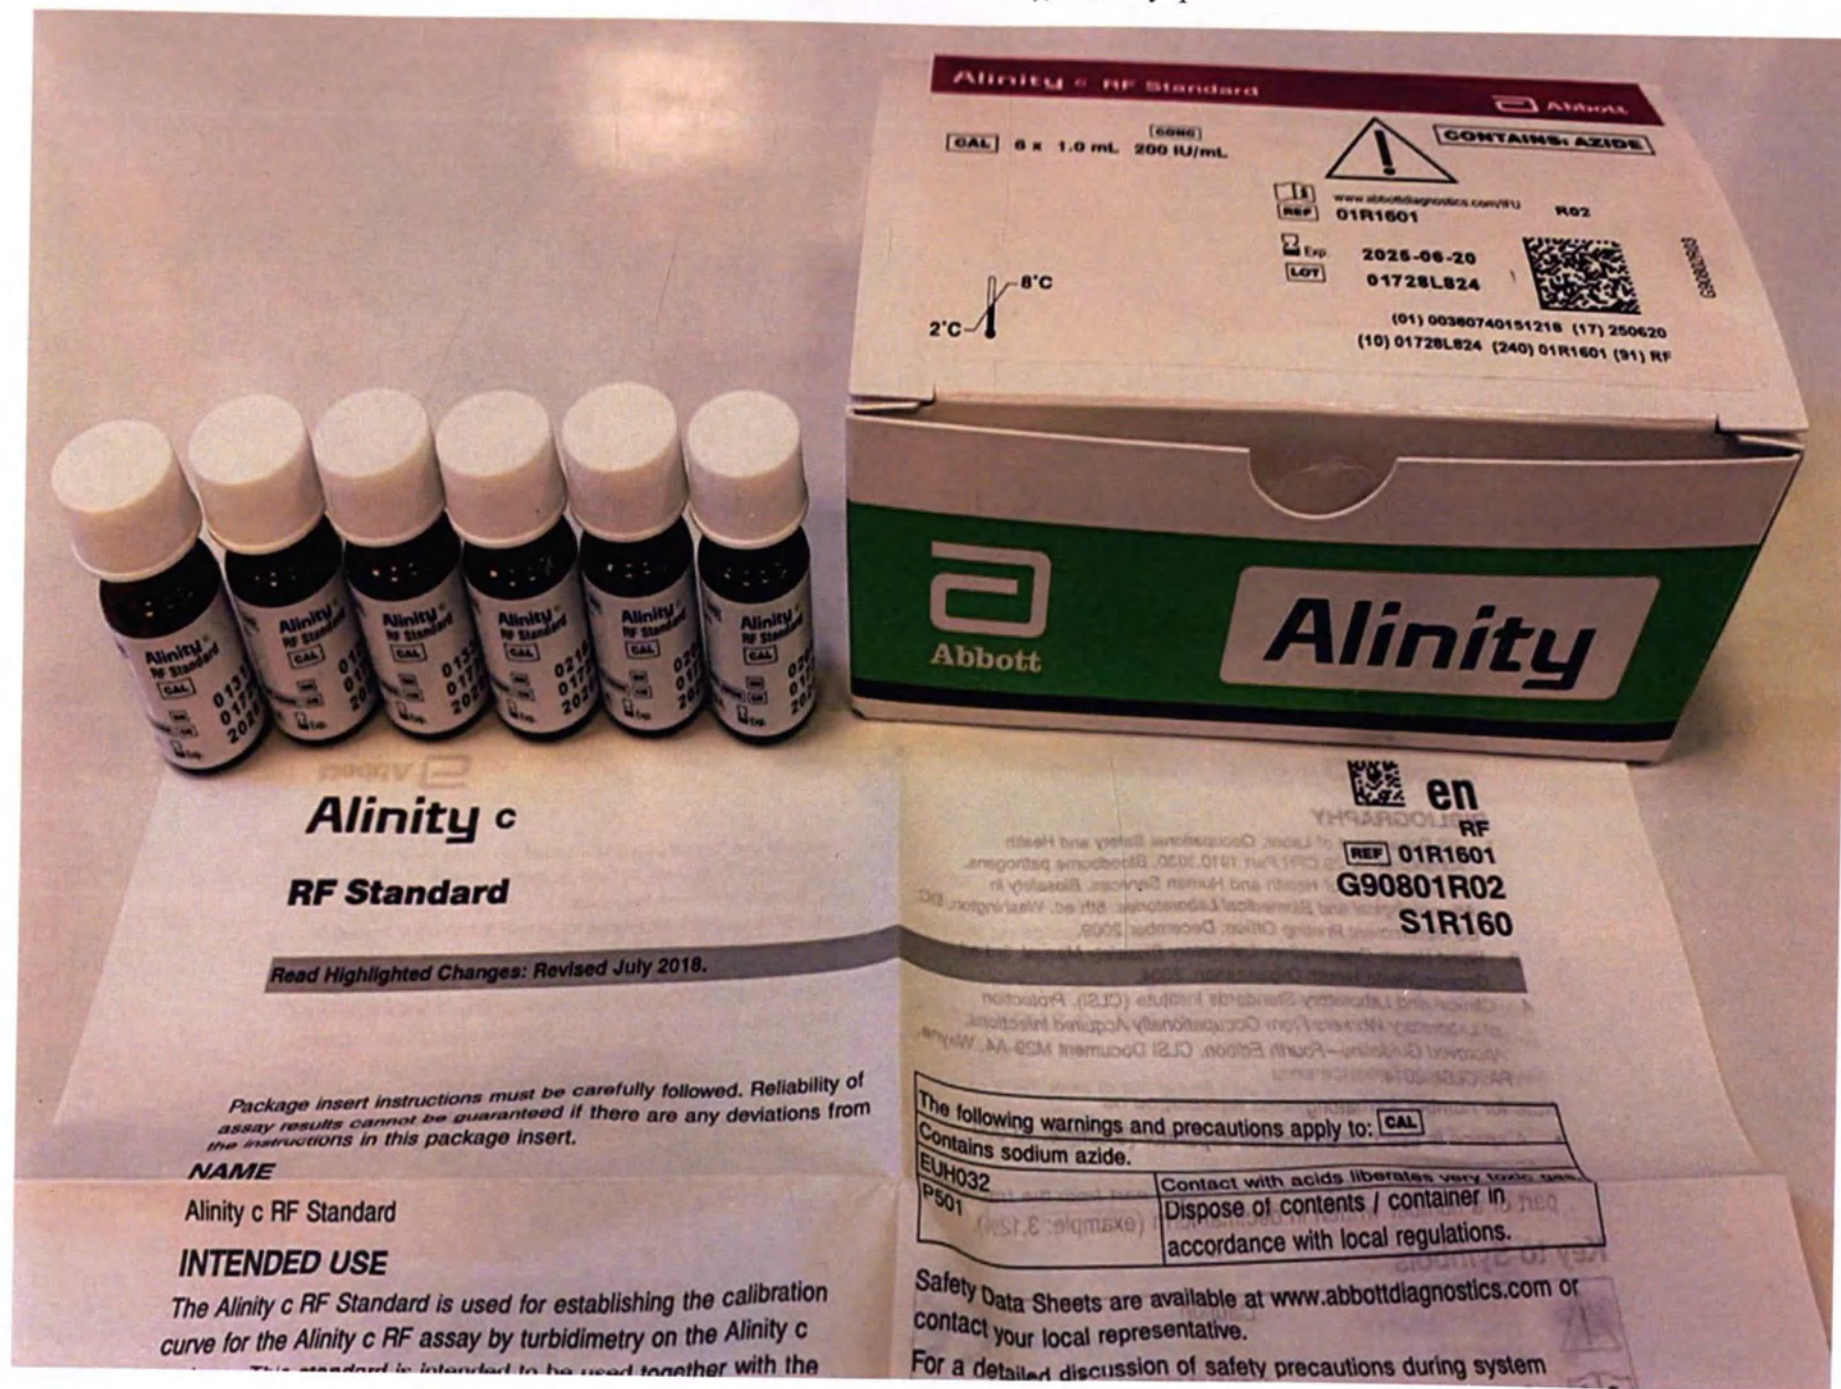







Подпись

*[Handwritten signature]*