


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Стол пациента Dornier Relax+ Endo




Стол пациента Dornier Relax+ Endo, в составе:

1. Основной (головной) сегмент стола, не более 5 шт.

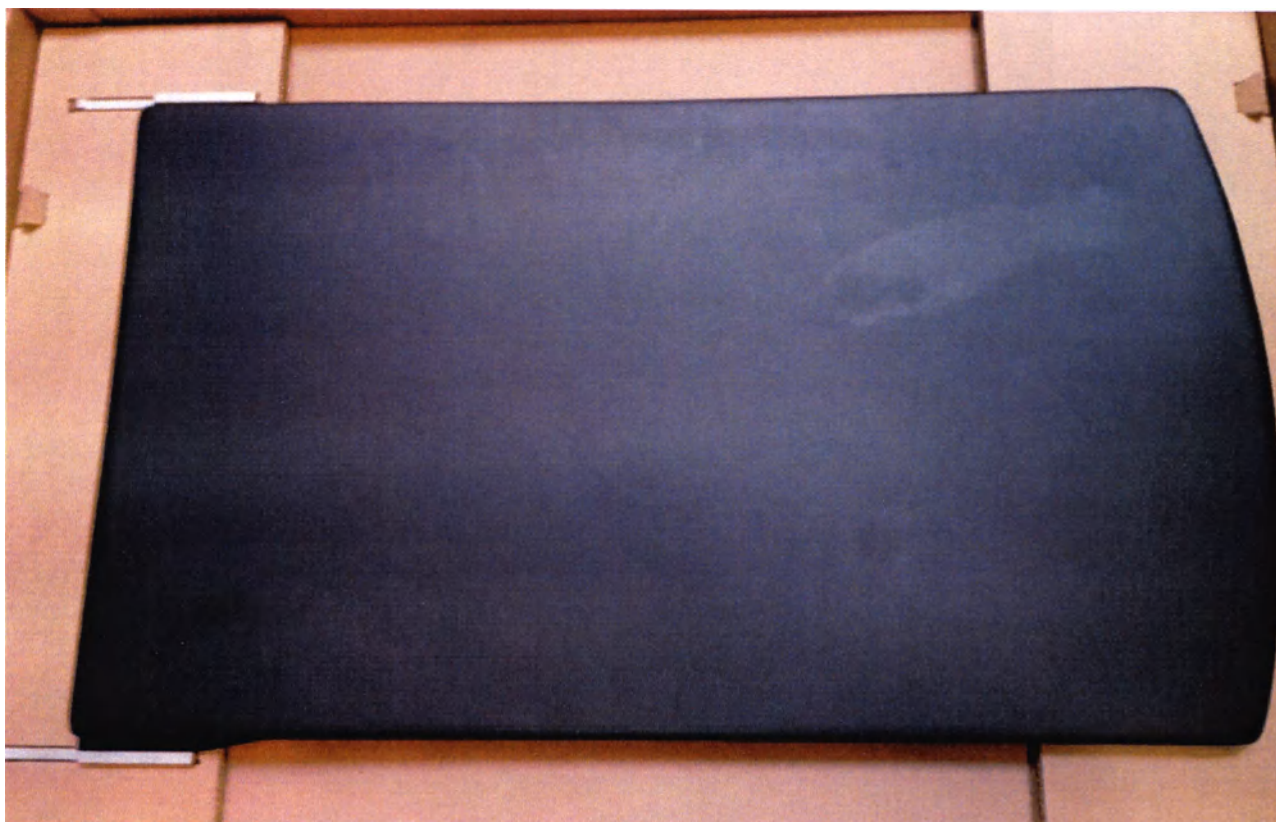

2. Электропроводный мат для основного сегмента стола, не более 5 шт.

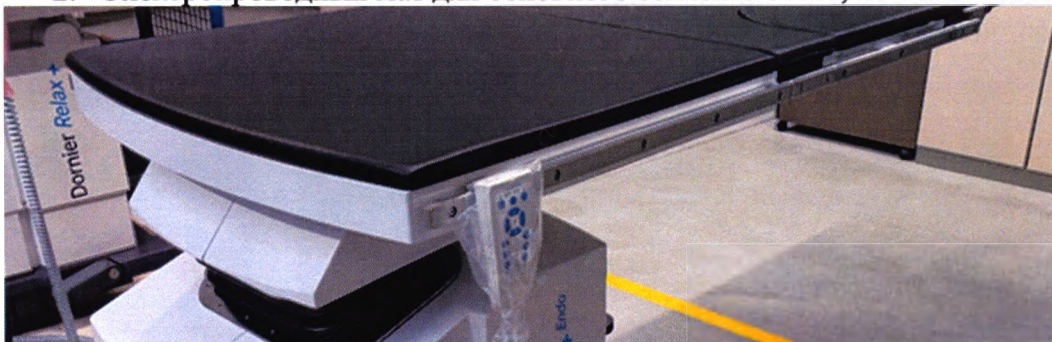

3. Кабель заземления, не более 5 шт.



4. Ручной пульт управления, не более 5 шт.



5. Руководство по эксплуатации



Руководство по эксплуатации

Стол для пациента

Dornier Relax+ Endo



Принадлежности:


1. Средний сегмент с 1 вырезом и вставкой с электропроводным матом, не более 5 шт.




2. Средний сегмент с 2 вырезами и вставками с электропроводным матом, не более 5 шт.



3. Средний сегмент без вырезов с электропроводным матом, не более 5 шт.

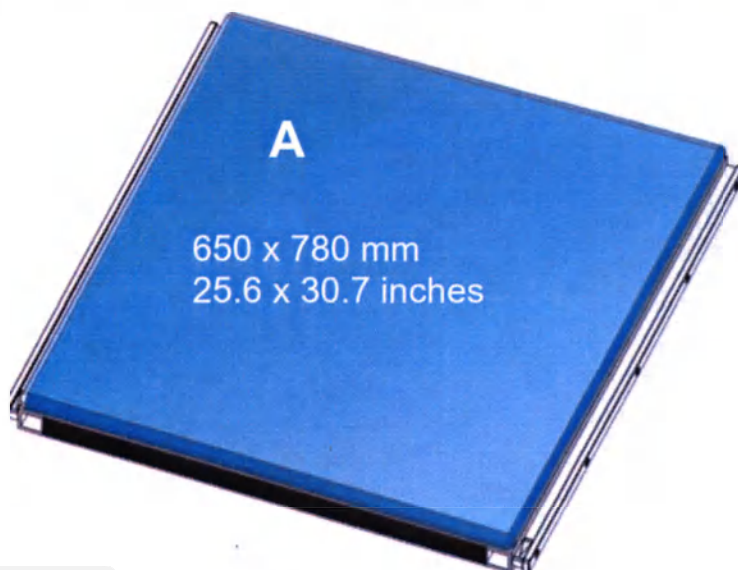

4. Хвостовой сегмент широкий с электропроводным матом, не более 5 шт.

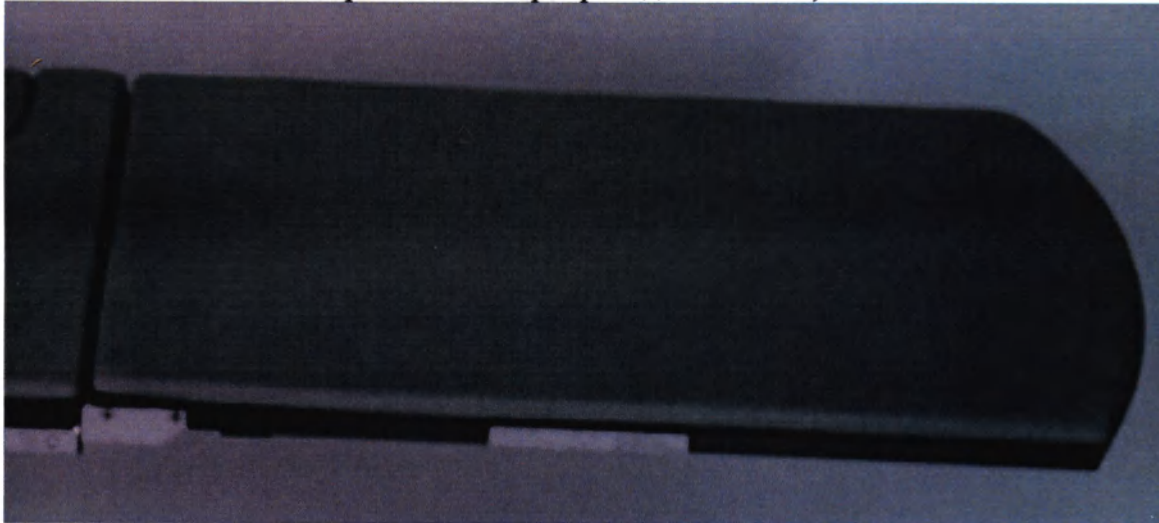

5. Хвостовой сегмент узкий с электропроводным матом, не более 5 шт.



6. Педаль управления столом, не более 5 шт.




7. Опоры для плеч пациента, не более 5 шт.



8. Штатив для инфузионных растворов, не более 5 шт.




9. Съёмная дополнительная секция основного сегмента стола с электропроводным матом, не более 5 шт.

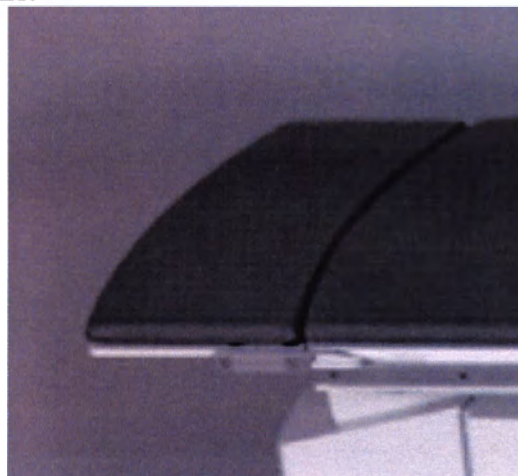

10. Подставка под руку пациента анестезиологическая, не более 5 шт.



11. Компрессионный ремень, не более 5 шт.

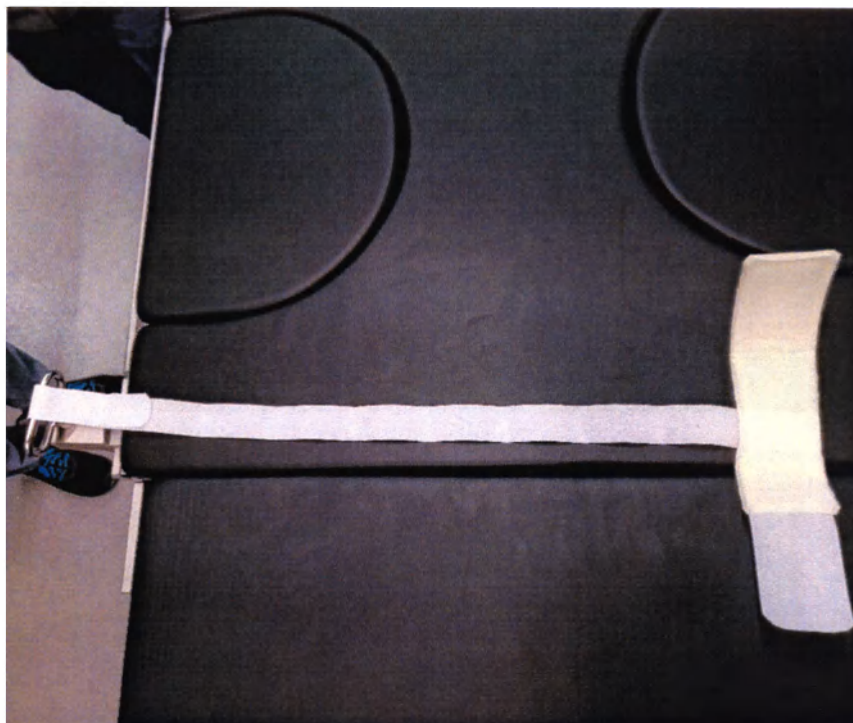

12. Эндоурологический набор с дренажными мешками, широкий, не более 5 шт., в составе:

12.1 Крепежная планка

12.2 Гибкая металлическая лента

12.3 Пластиковые дренажные мешки, 20 шт



13. Эндоурологический набор с дренажными мешками, узкий, не более 5 шт., в составе:


13.1 Крепежная планка

13.2 Гибкая металлическая лента

13.3 Пластиковые дренажные мешки, 20 шт



14. Пластиковые дренажные мешки, не более 200 шт.

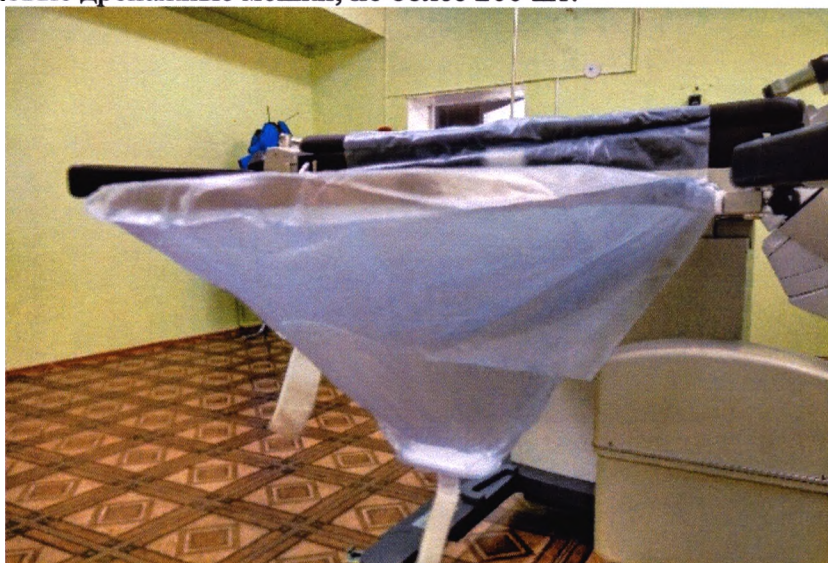

15. Подлокотники для врача, не более 6 шт.



16. Держатель для рулона бумаги, не более 5 шт.



17. Опоры для ног с подколенной фиксацией, не более 6 шт.




18. Опоры для ног на газовых пружинах с подколенной фиксацией, не более 6 шт.



19. Опоры для ног на газовых пружинах с фиксацией голеностопа, не более 6 шт.



20. Опоры для ног педиатрические, не более 6 шт.

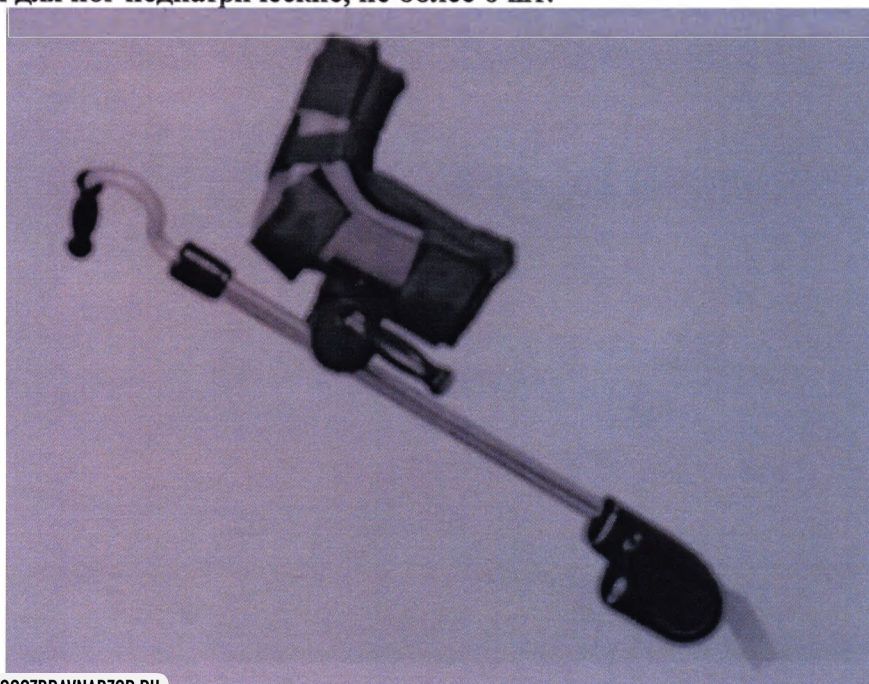


21. Ремень для фиксации тела пациента, не более 5 шт.




22. Валик-подголовник, не более 5 шт.



23. Подколенный клин, не более 5 шт.

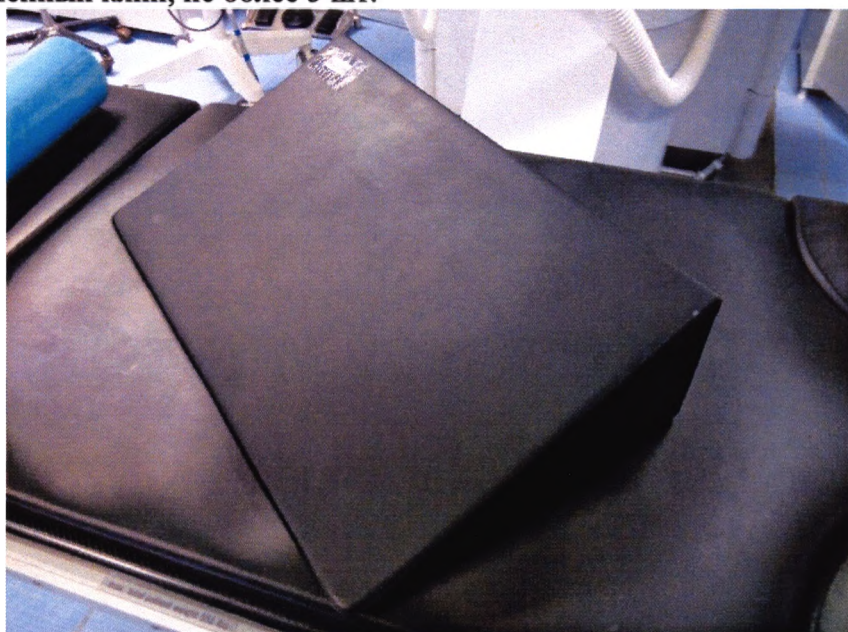

24. Ремень для фиксации руки пациента, не более 5 шт.

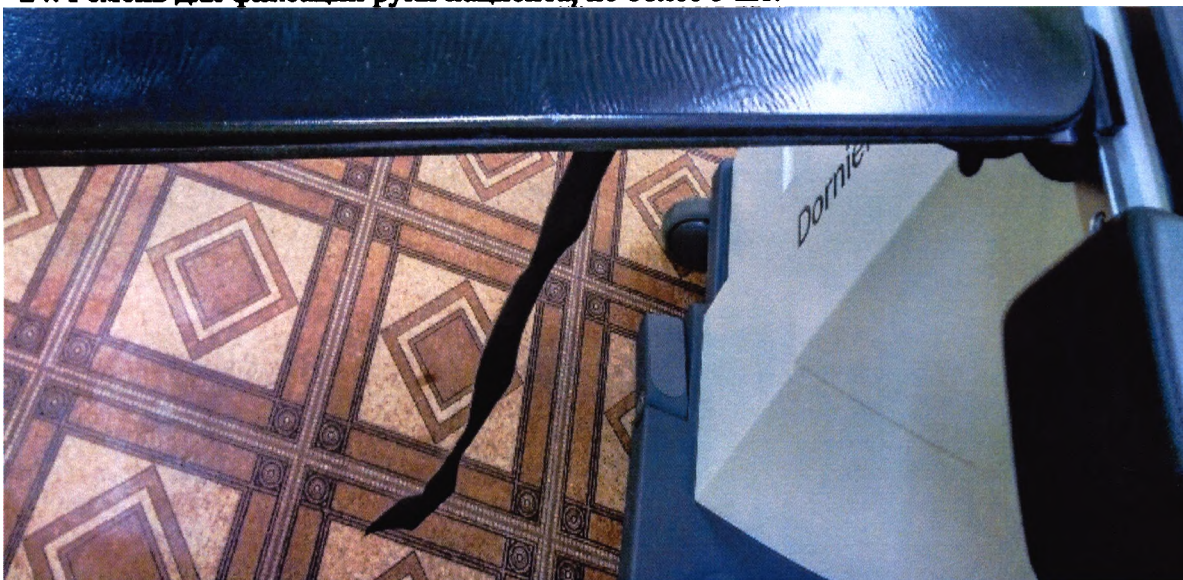


25. Держатель ручного пульта управления столом, не более 5 шт.



26. Удлинительный кабель ручного пульта управления, 5 м, не более 5 шт.




27. Удлинительный кабель ручного пульта управления, 10 м, не более 5 шт.

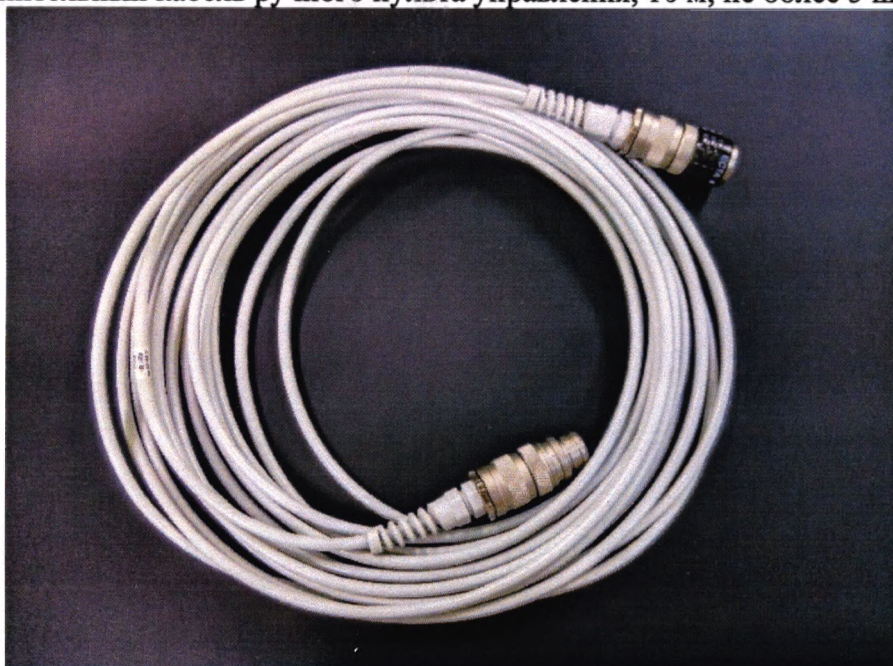


28. Удлинительный кабель ручного пульта управления, 20 м, не более 5 шт.



29. Педиатрическая полимерная проставка для среднего сегмента с 1 вырезом, не более 5 шт.

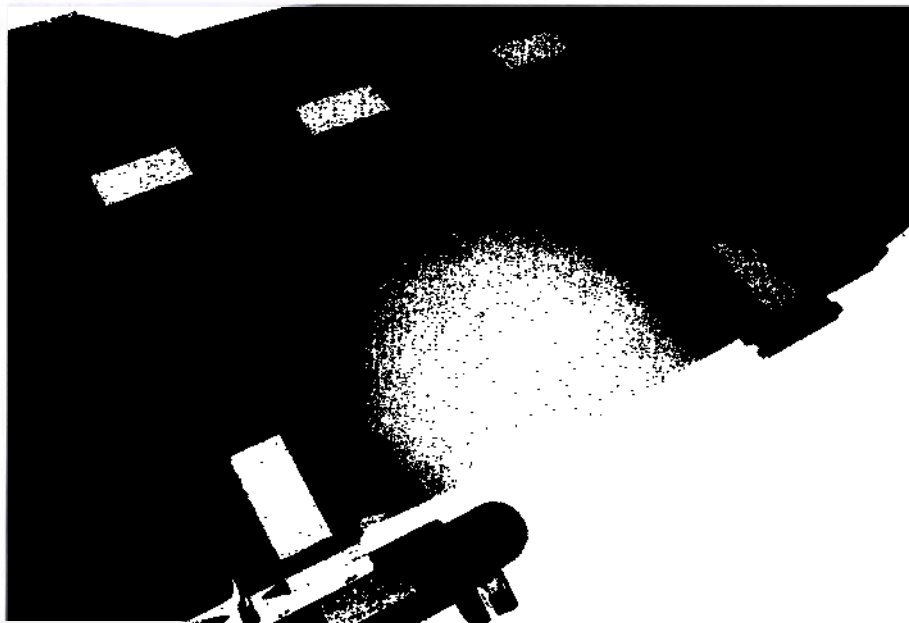

30. Педиатрическая полимерная проставка для среднего сегмента с 2 вырезами, не более 5 шт.

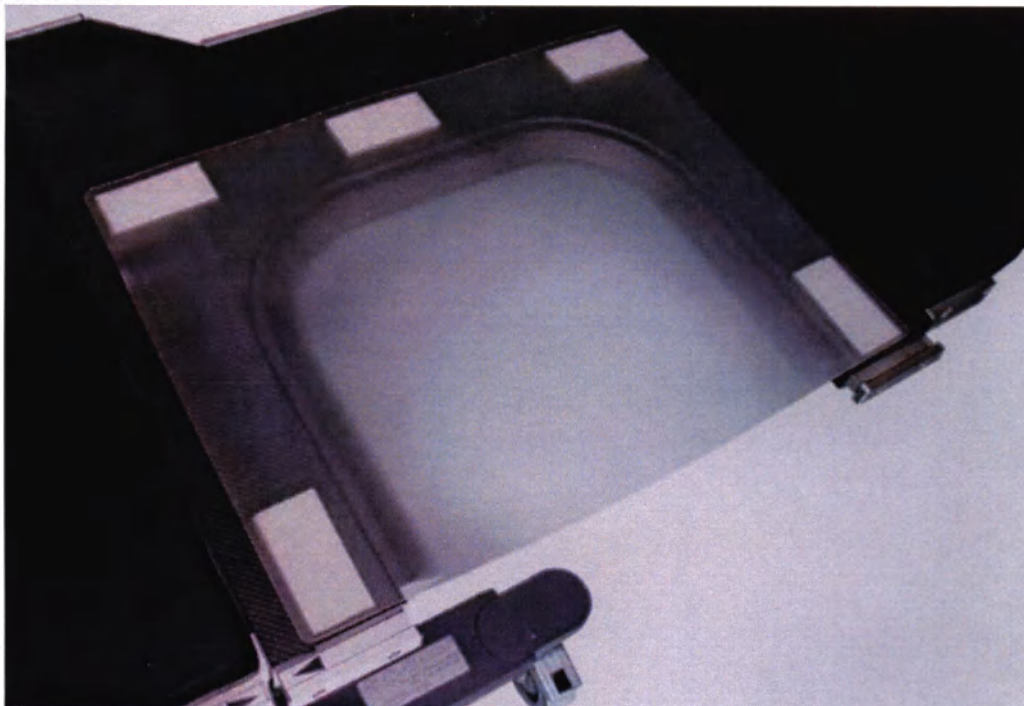

Генеральный директор

ООО «МИП-Тест» Жвакина Е.Е.

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

"05" __ февраля __ 2025г.

М.П. (при наличии)



(Подпись)

Пронумеровано, про... и
скреплено печатью

