

Ис. отказное дло. N 16920 от 29.03.2016.




Внешний вид изделия «Анализатор автоматический коагулометрический KG-500 с принадлежностями»



Внешний вид изделия «Анализатор автоматический коагулометрический KG-500 с принадлежностями»




Внешний вид изделия «Анализатор автоматический коагулометрический KG-500 с принадлежностями»

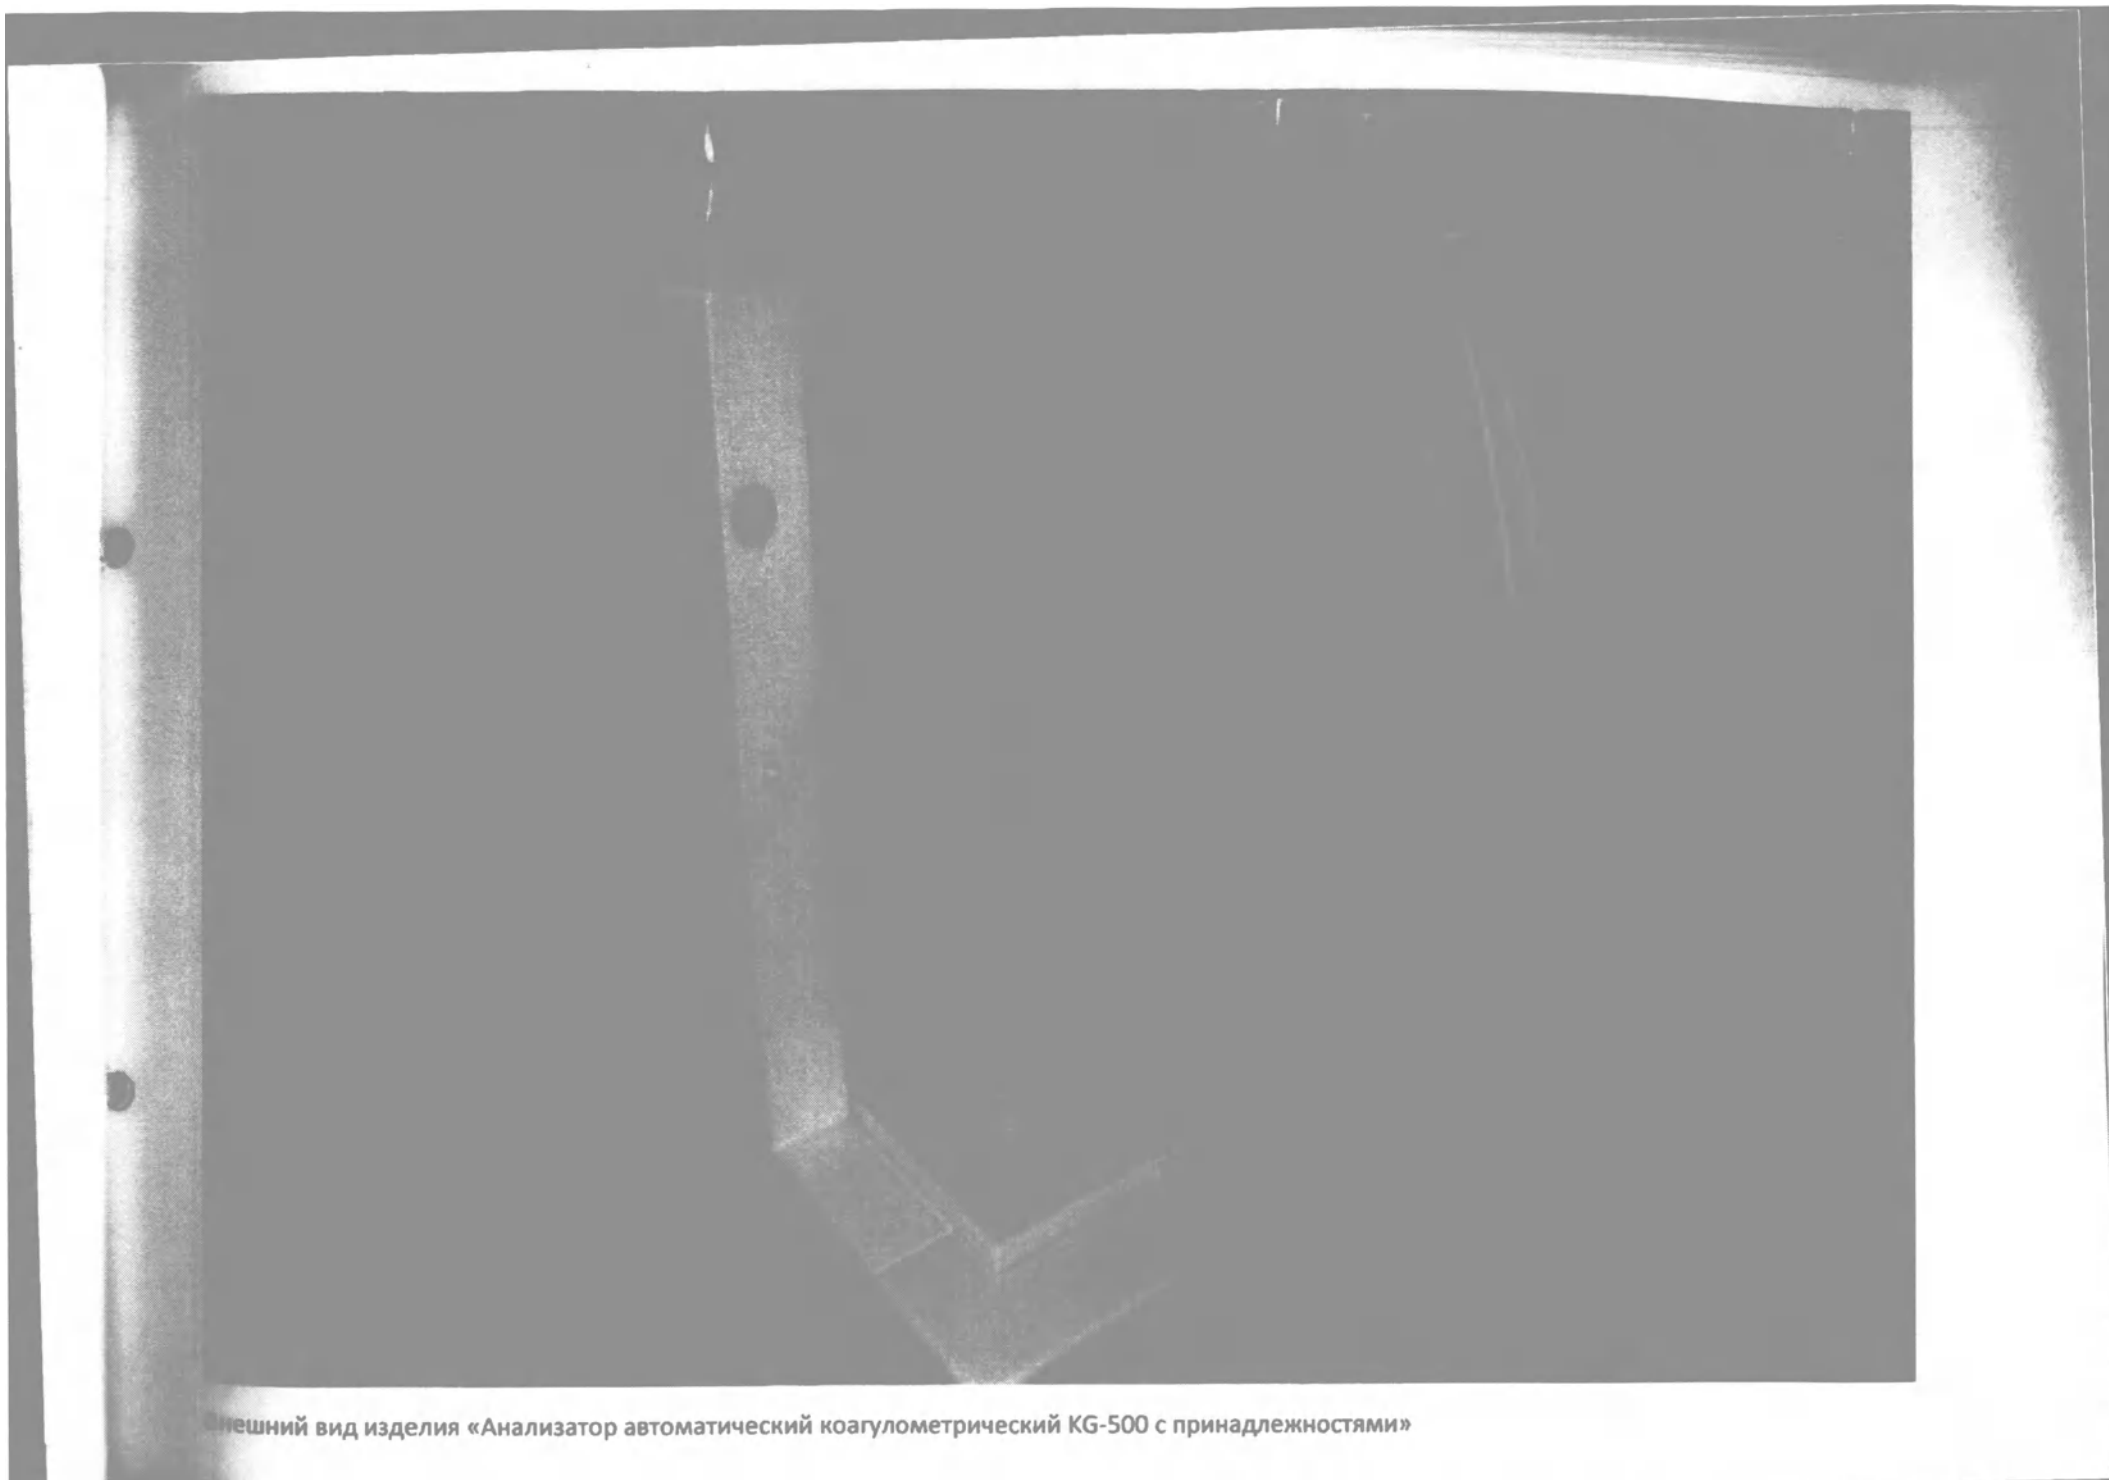


Внешний вид изделия «Анализатор автоматический коагулометрический KG-500 с принадлежностями»

Маркировка изделия

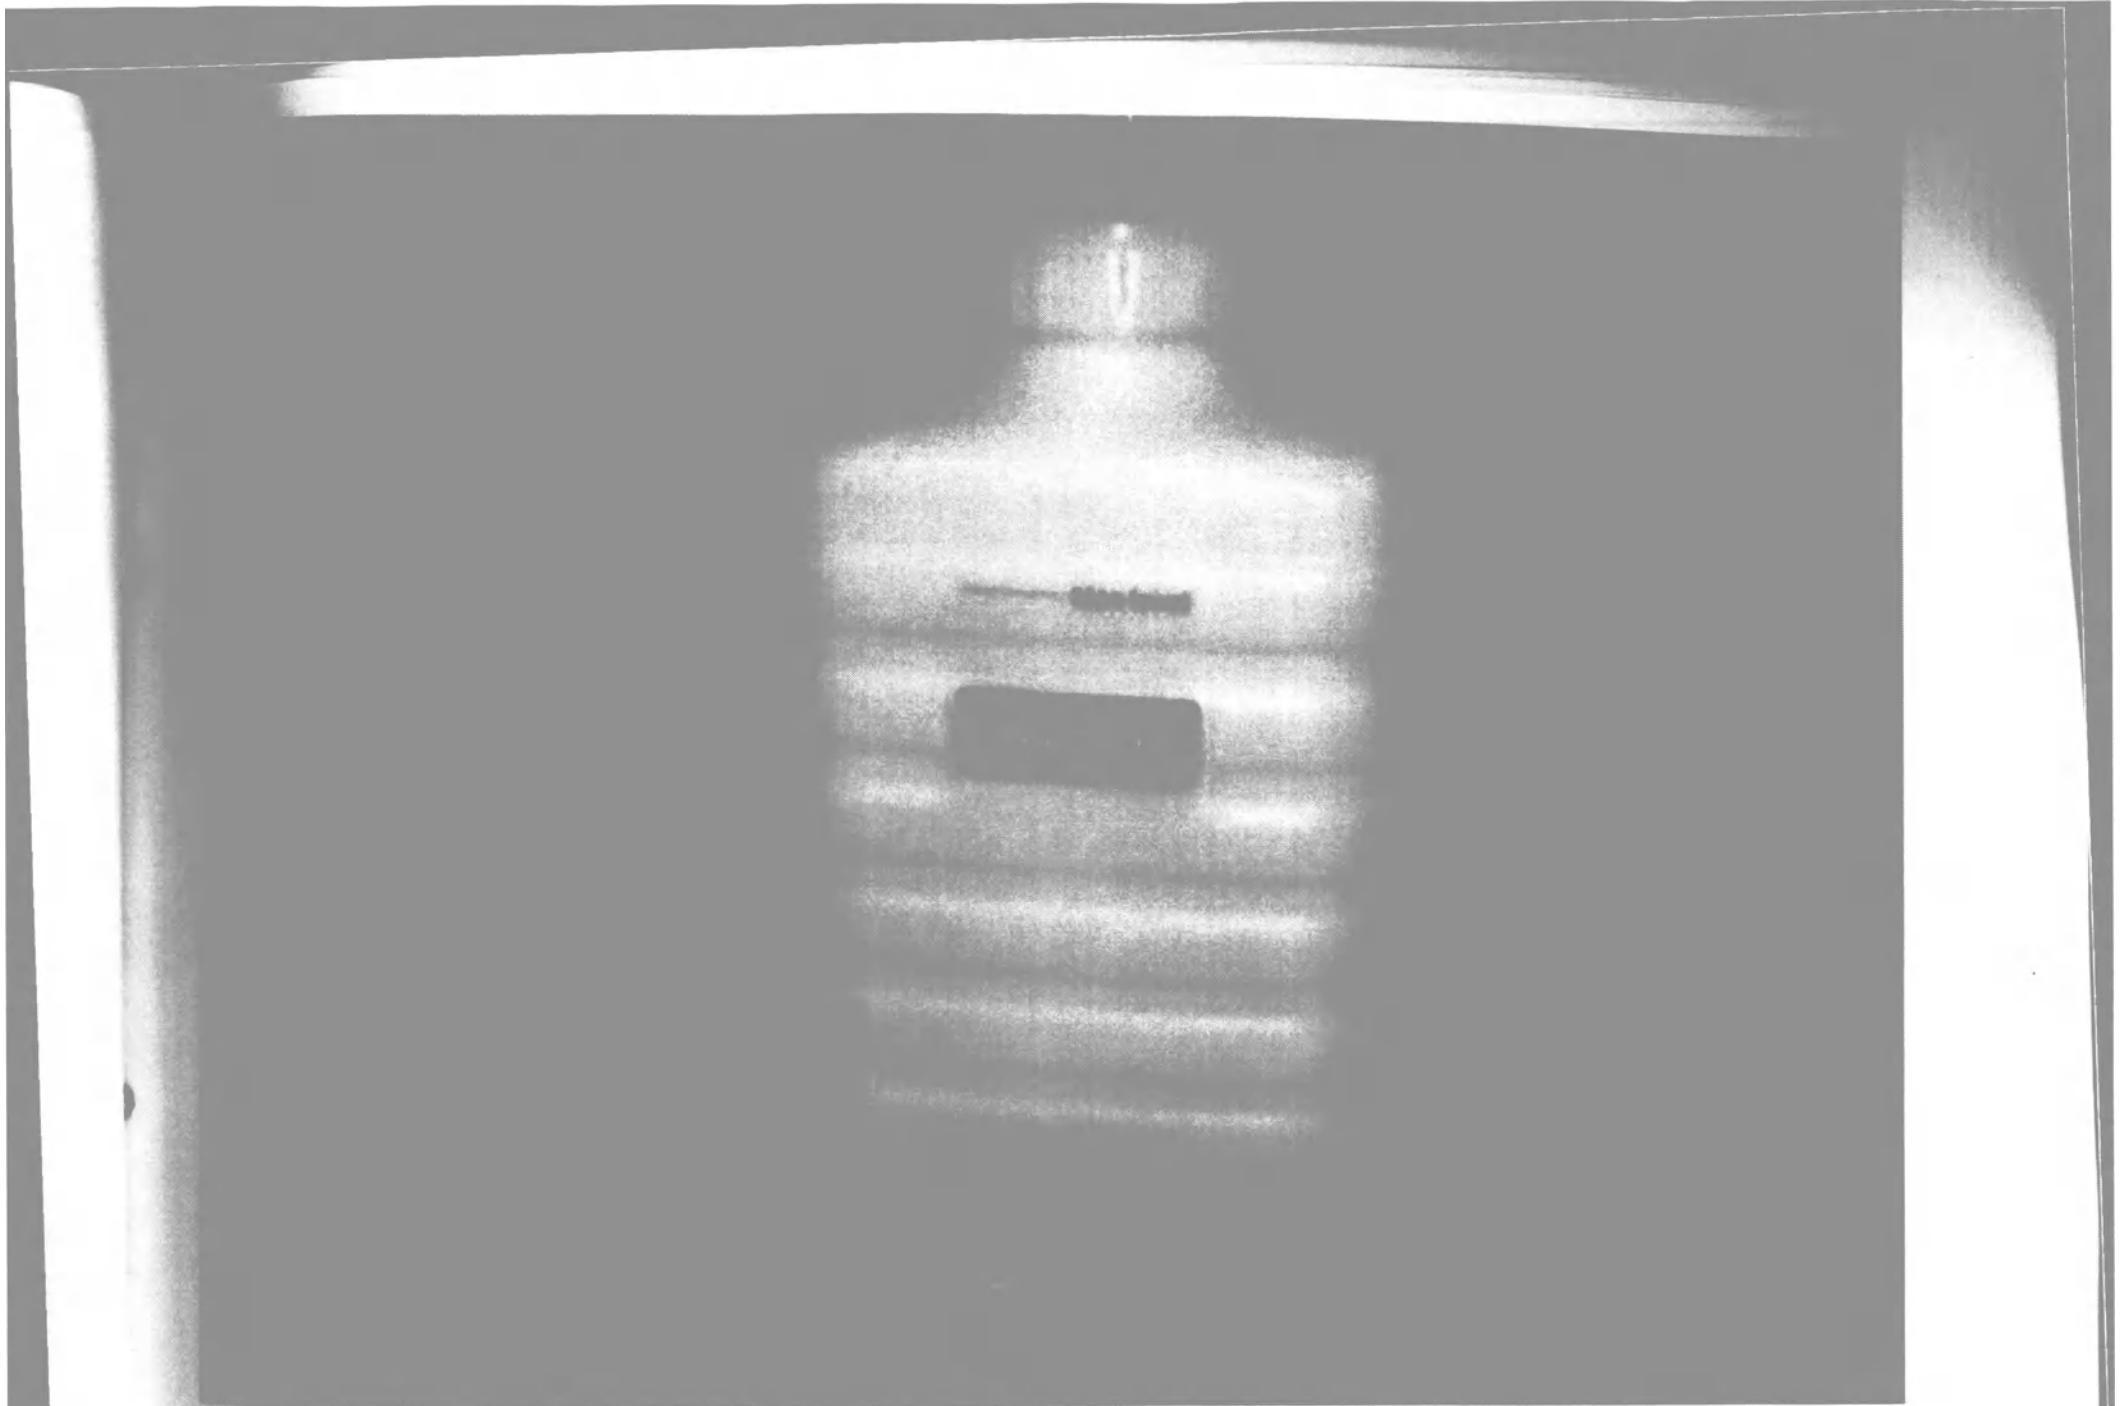

Контейнер для системной жидкости (Distilled water bottle) 1 шт

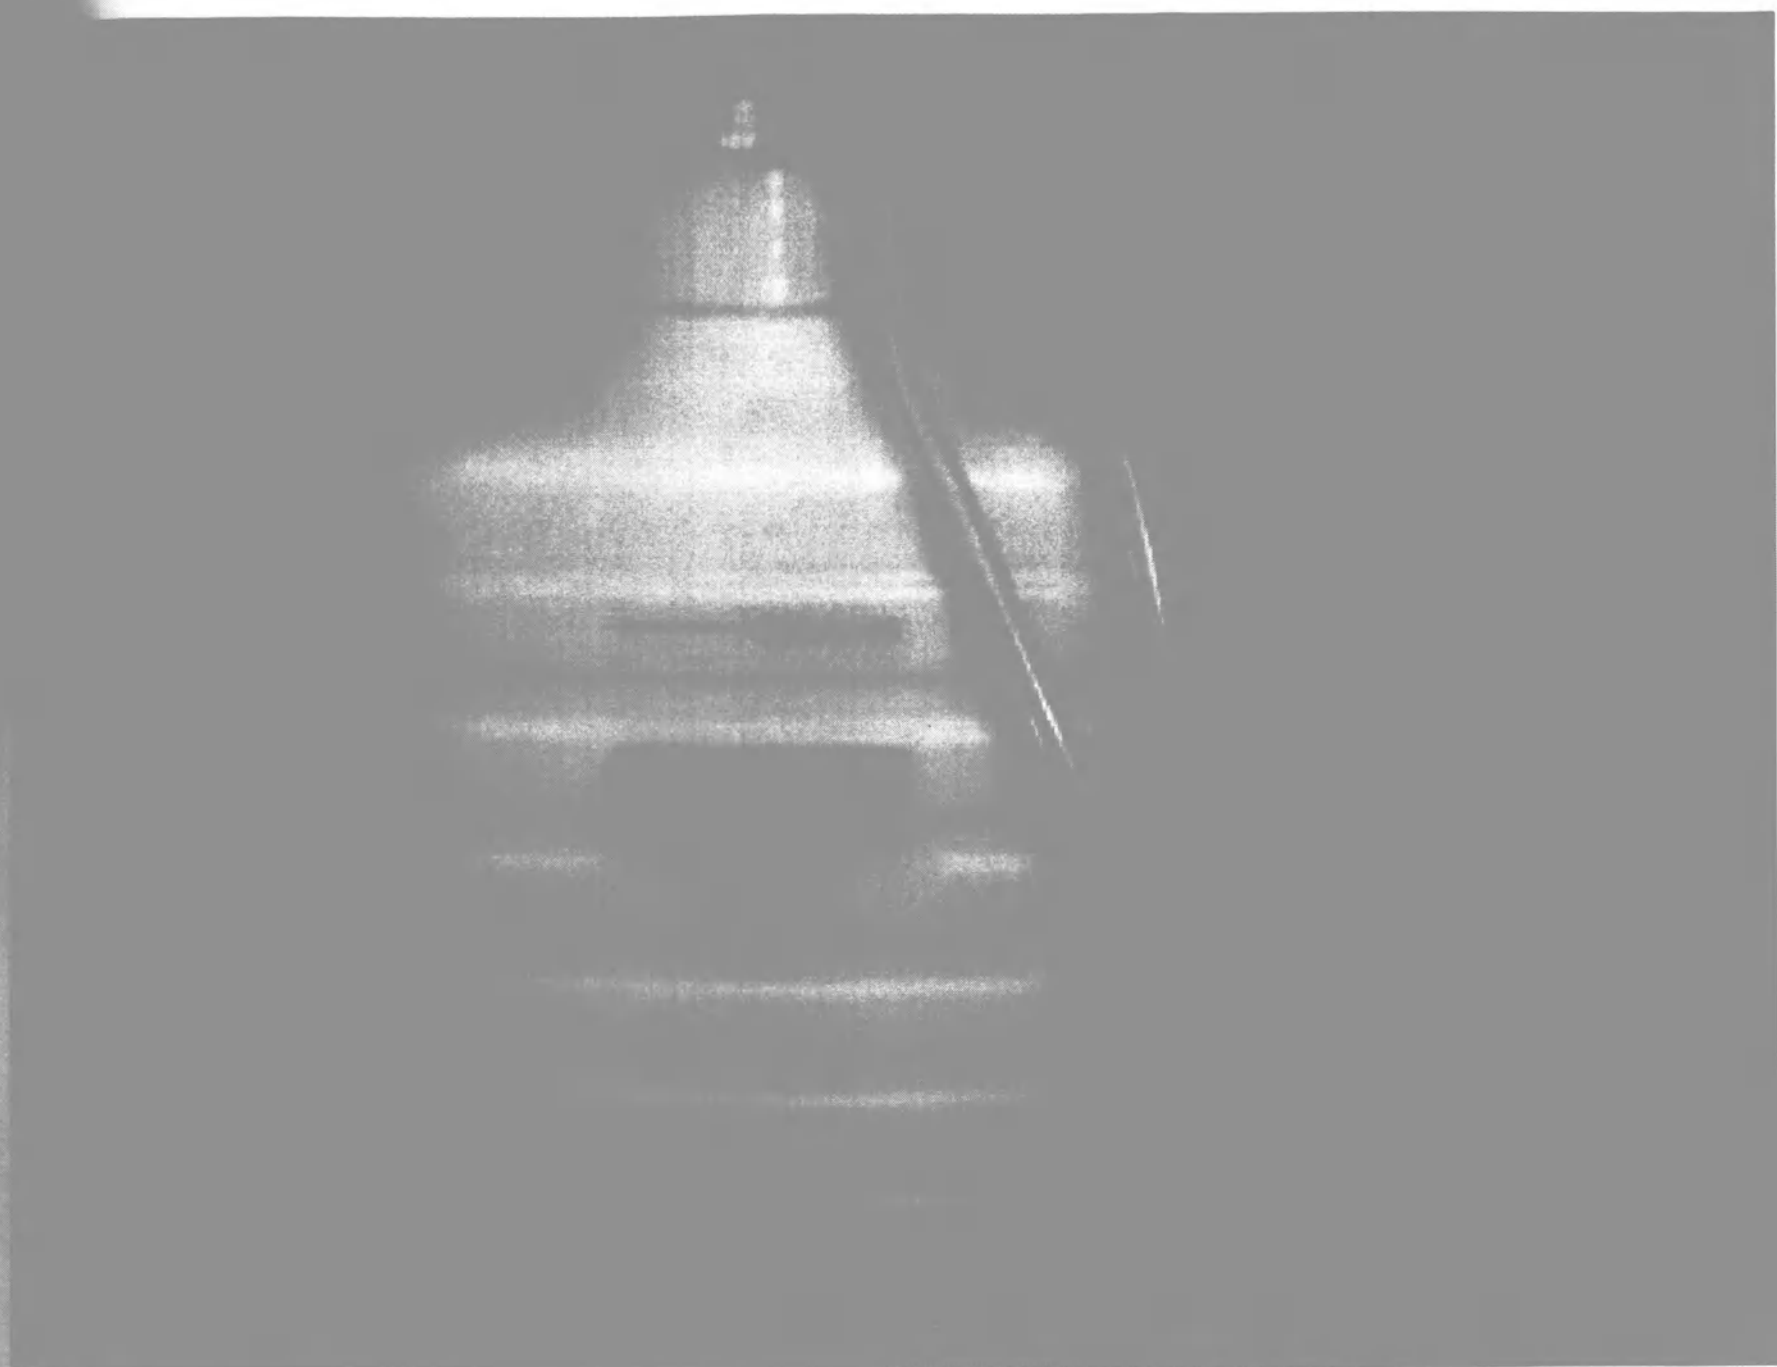

Контейнер для слива (Waste Bottle) 1 шт


Штатив для проб (Sample rack assembly) 3 шт

реагентов (Reagent Rack) 1 шт.

Шнур питания (Евро) (Power Cable (European Type)) 1 шт




Кабель заземления (Protective Grounding Wire) 1 шт

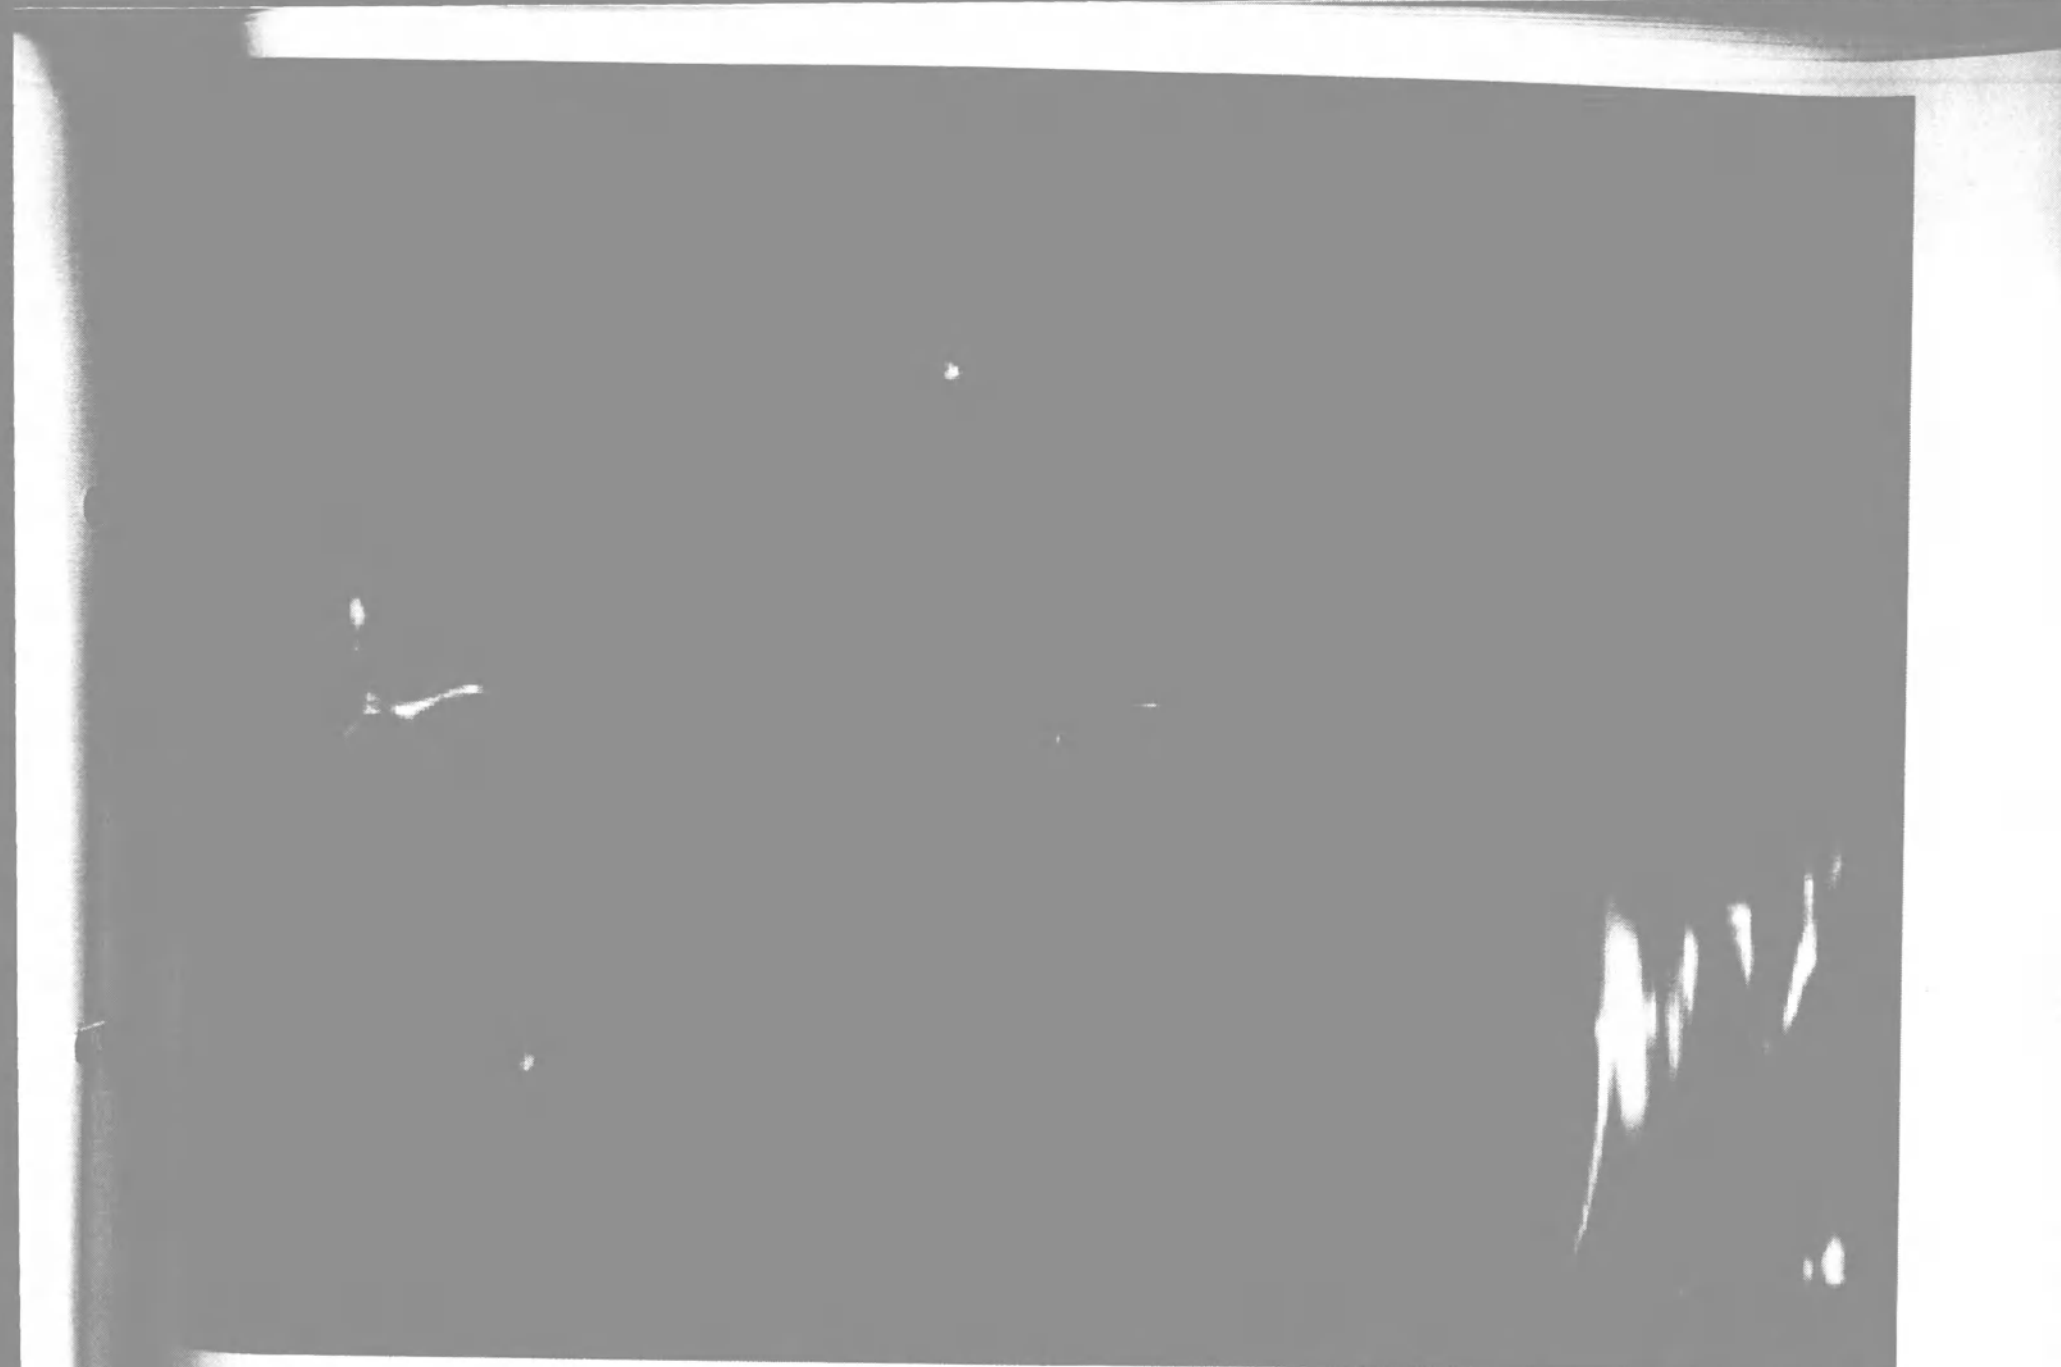


Адаптер для чашечек с образцами (Sample Cup Adapter) 1 шт



Адаптер для реагентных контейнеров (Reagent Cup Adapter) 3 шт

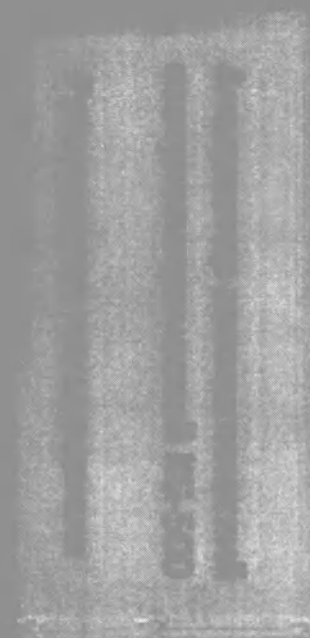


Инструкция пользователя (Operator's manual) 1 шт

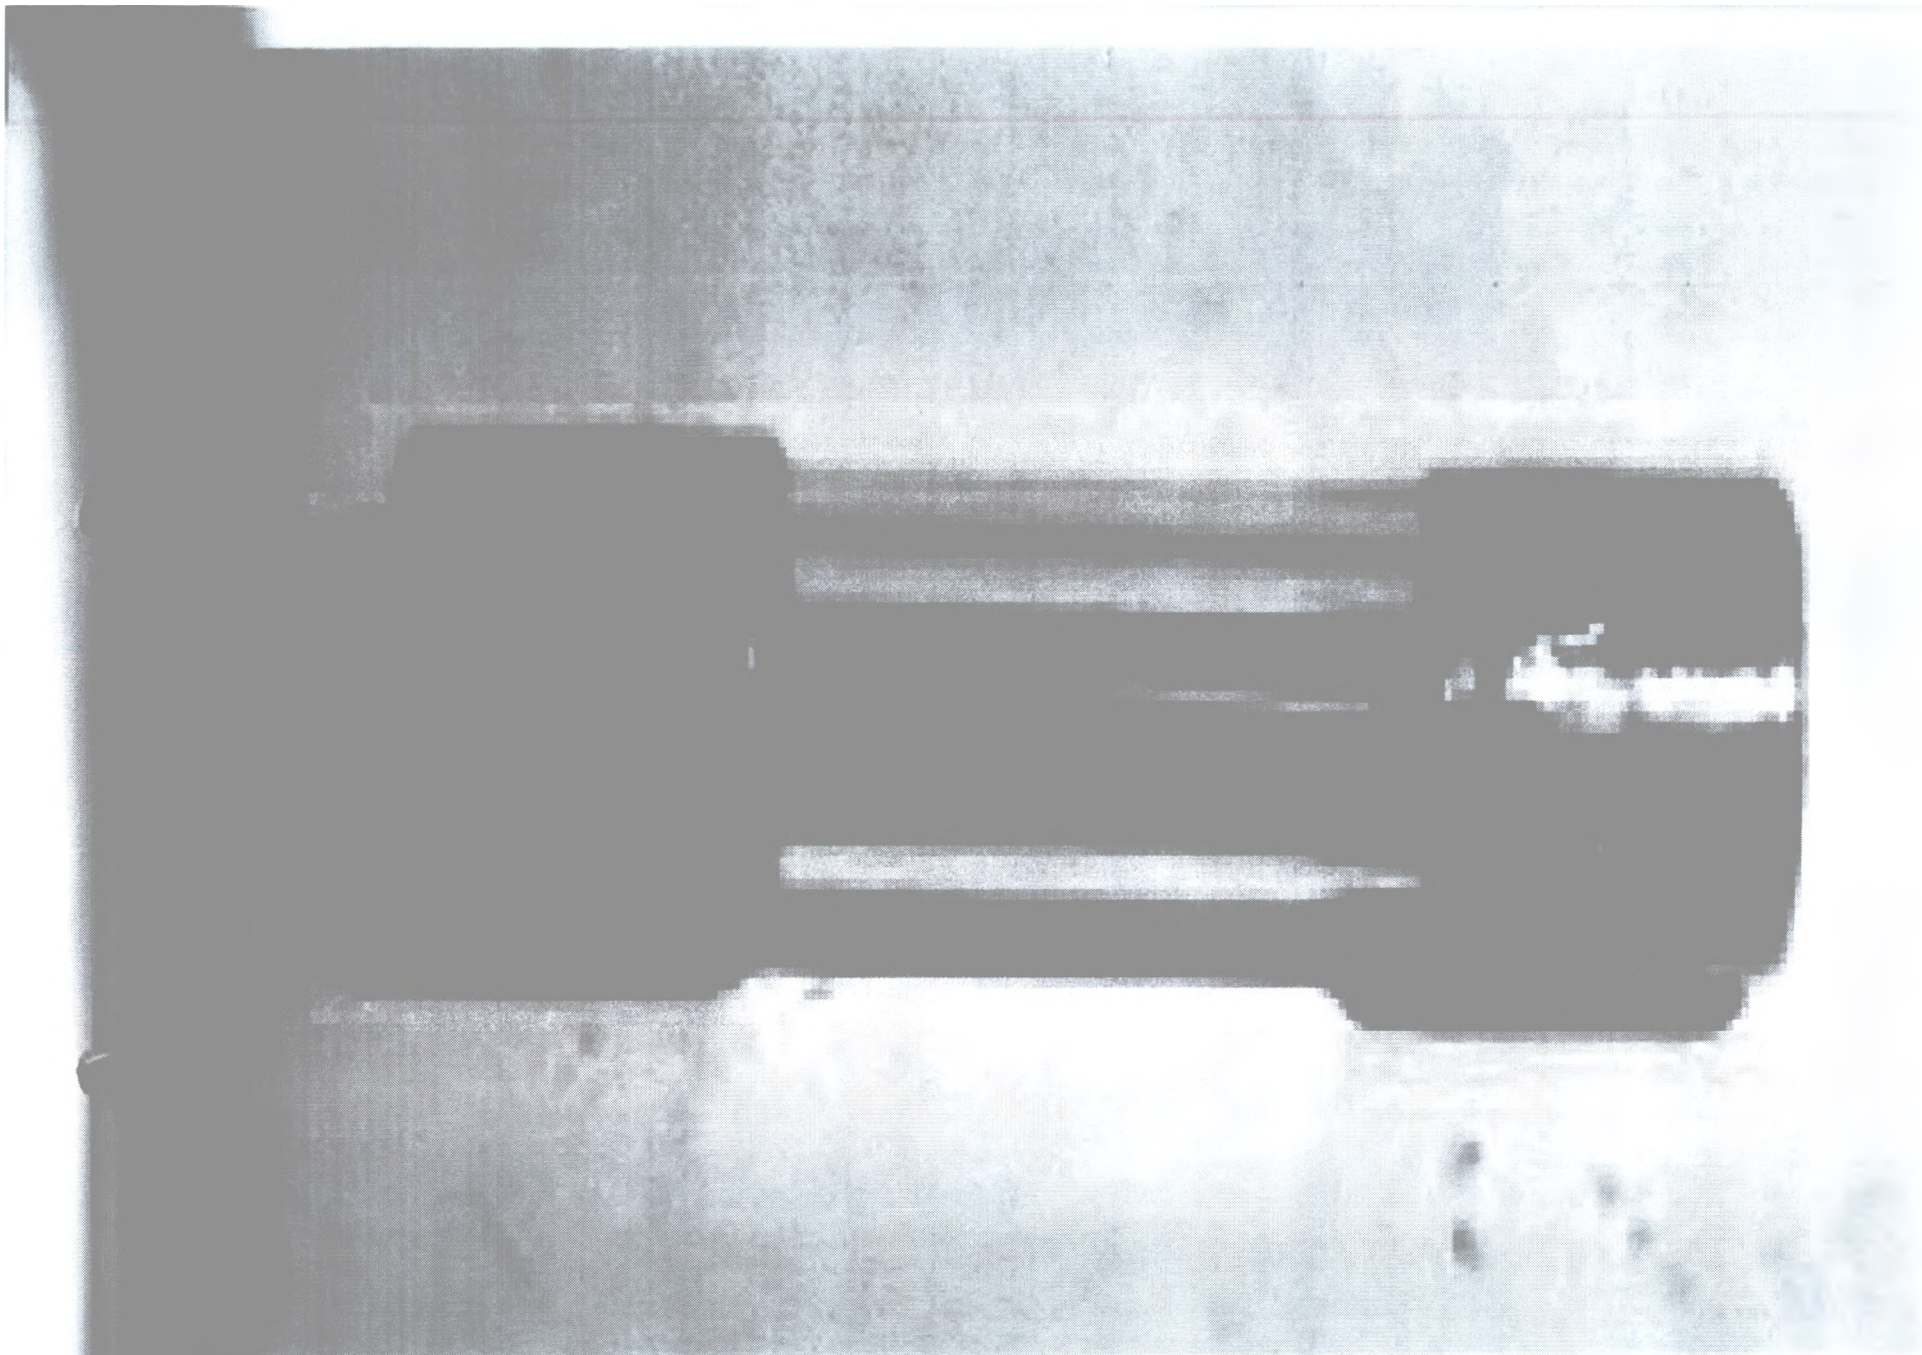

Предохранитель 250V-5A (Fuse 250V-5A) 2 шт

Стилус (Touch Pen) 1 шт

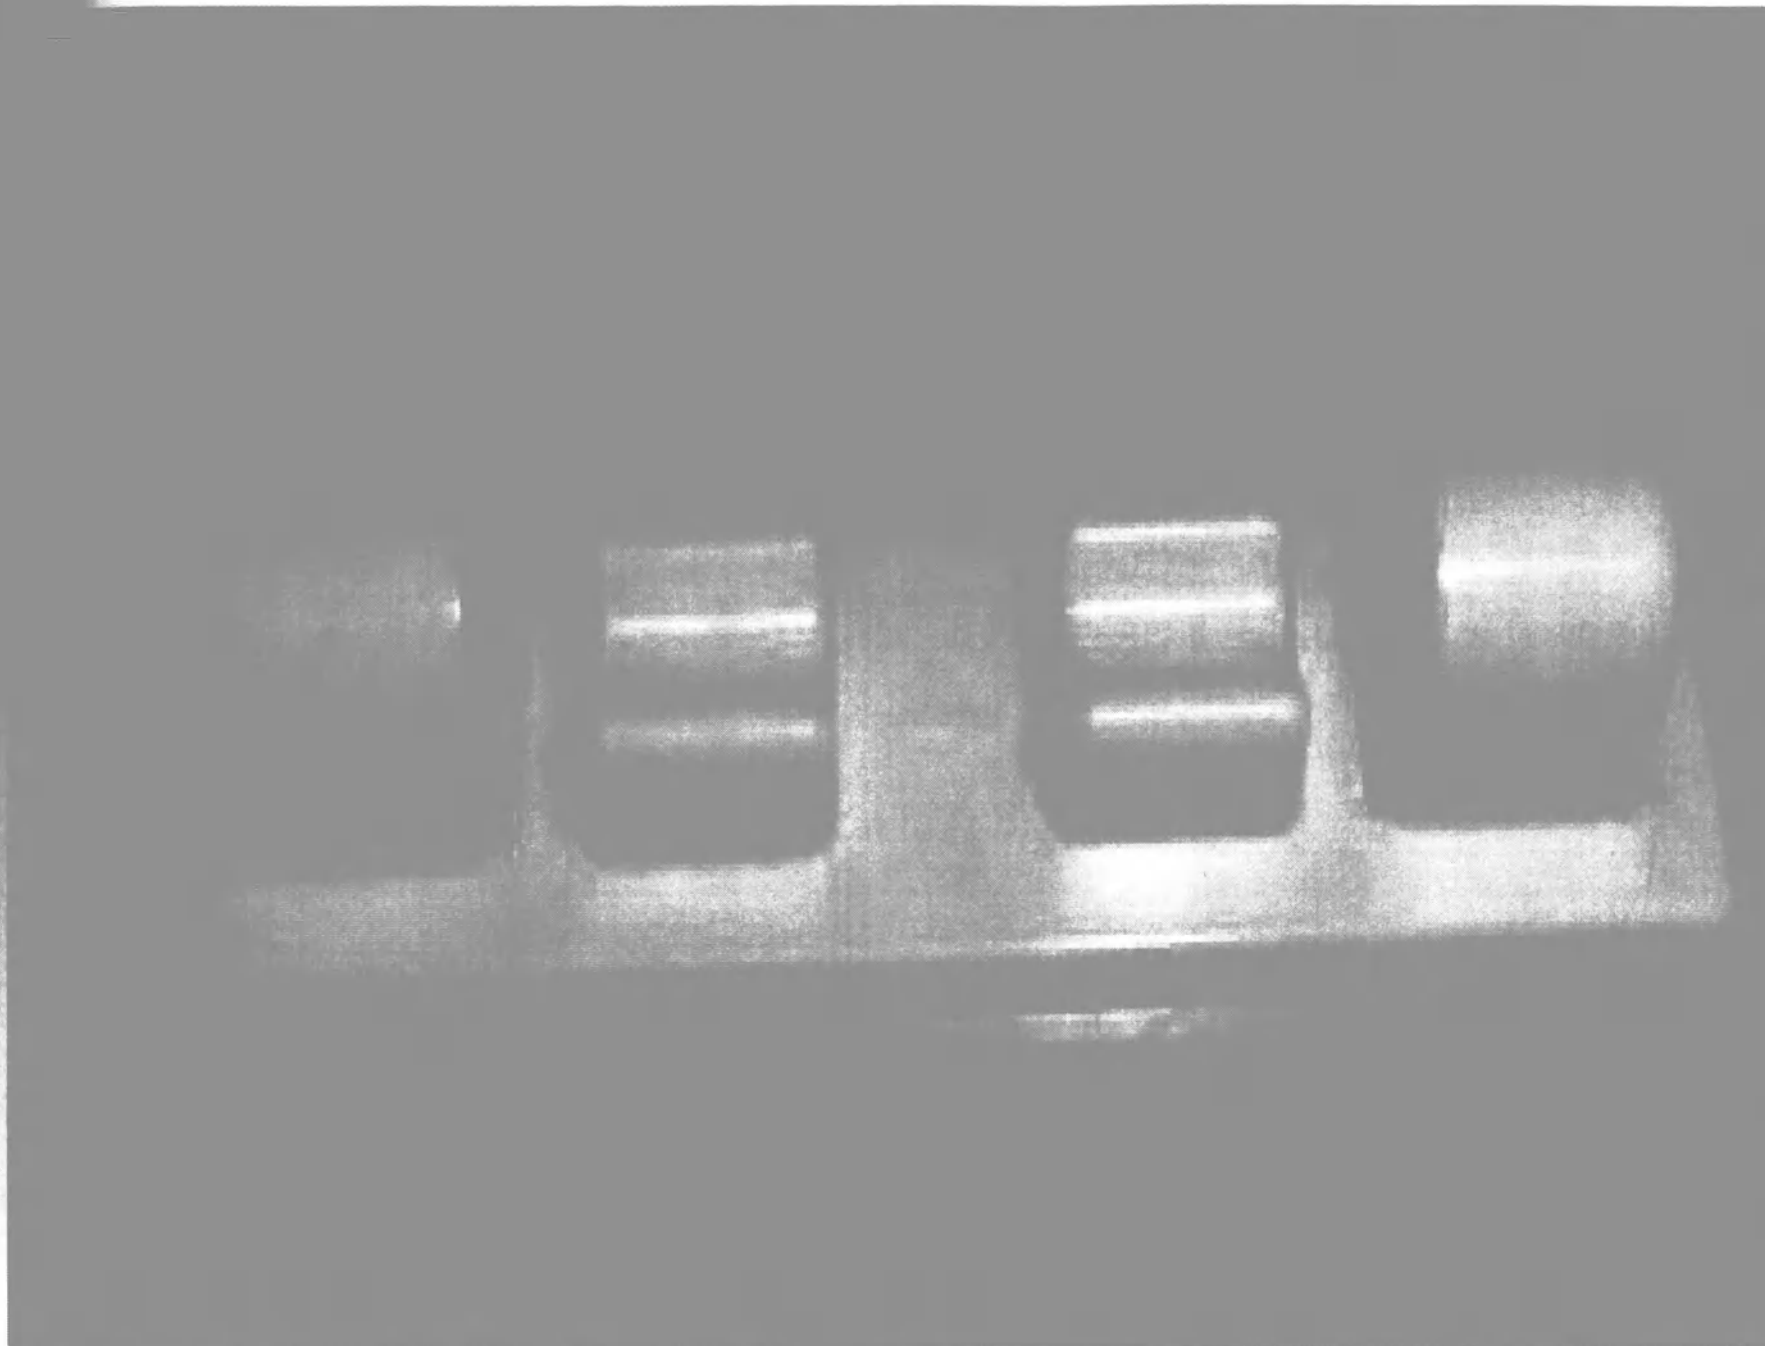

Держатель стилуса (Touch pen holder) 1 шт




Магнитная мешалка (Magnet Stirrer B515) 2 шт



Чашечки для образцов 1.5 мл (1.5mL Sample Cup) 100 шт




реакционные кюветы (Cuvette) 500 шт

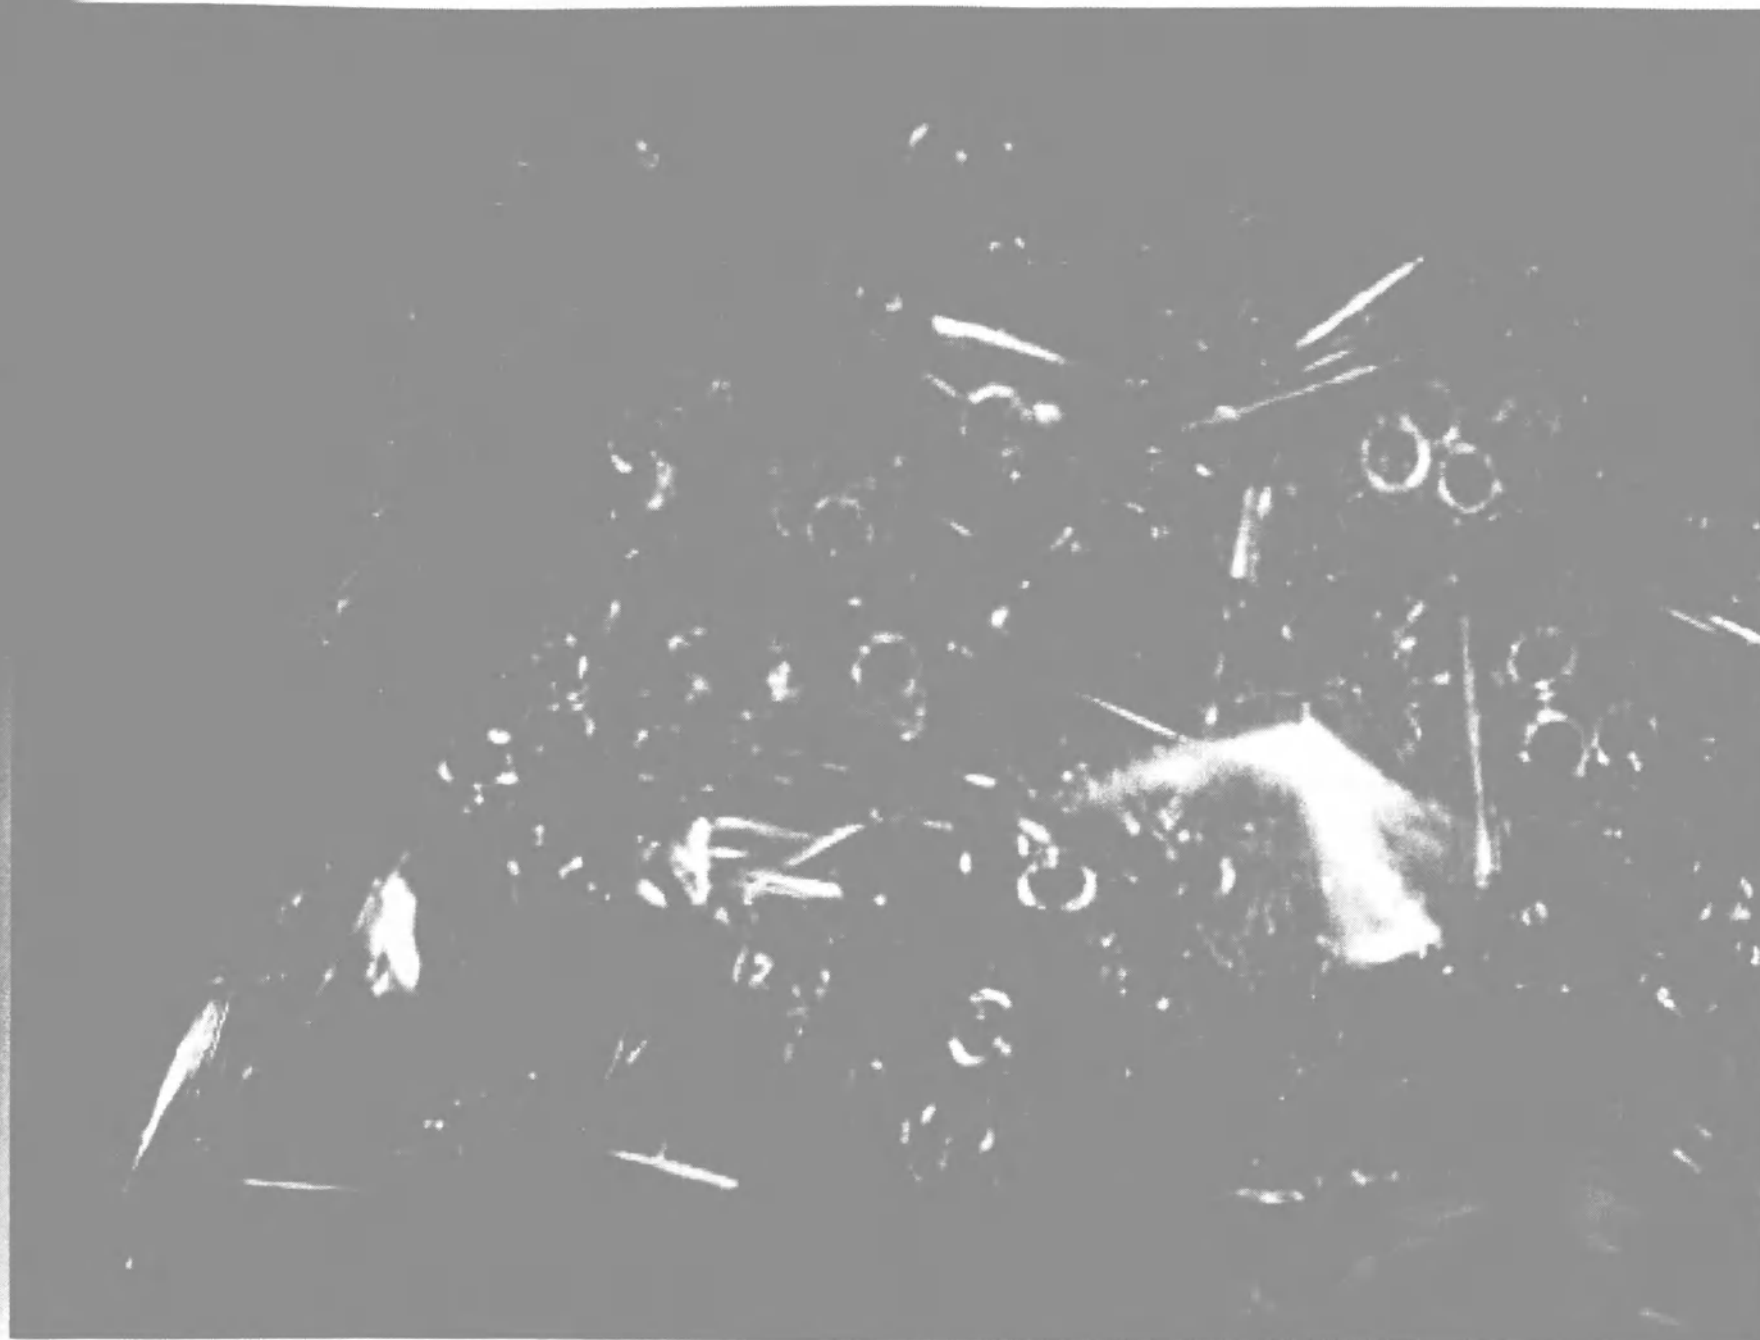


Двойные реакционные кюветы (Double cuvettes) 250 шт

бумага для встроенного термопритера (LTP1245 Printer Paper) 1 шт

Реагентный контейнер 23мм (23mm OD Reagent Cup) 2 шт.

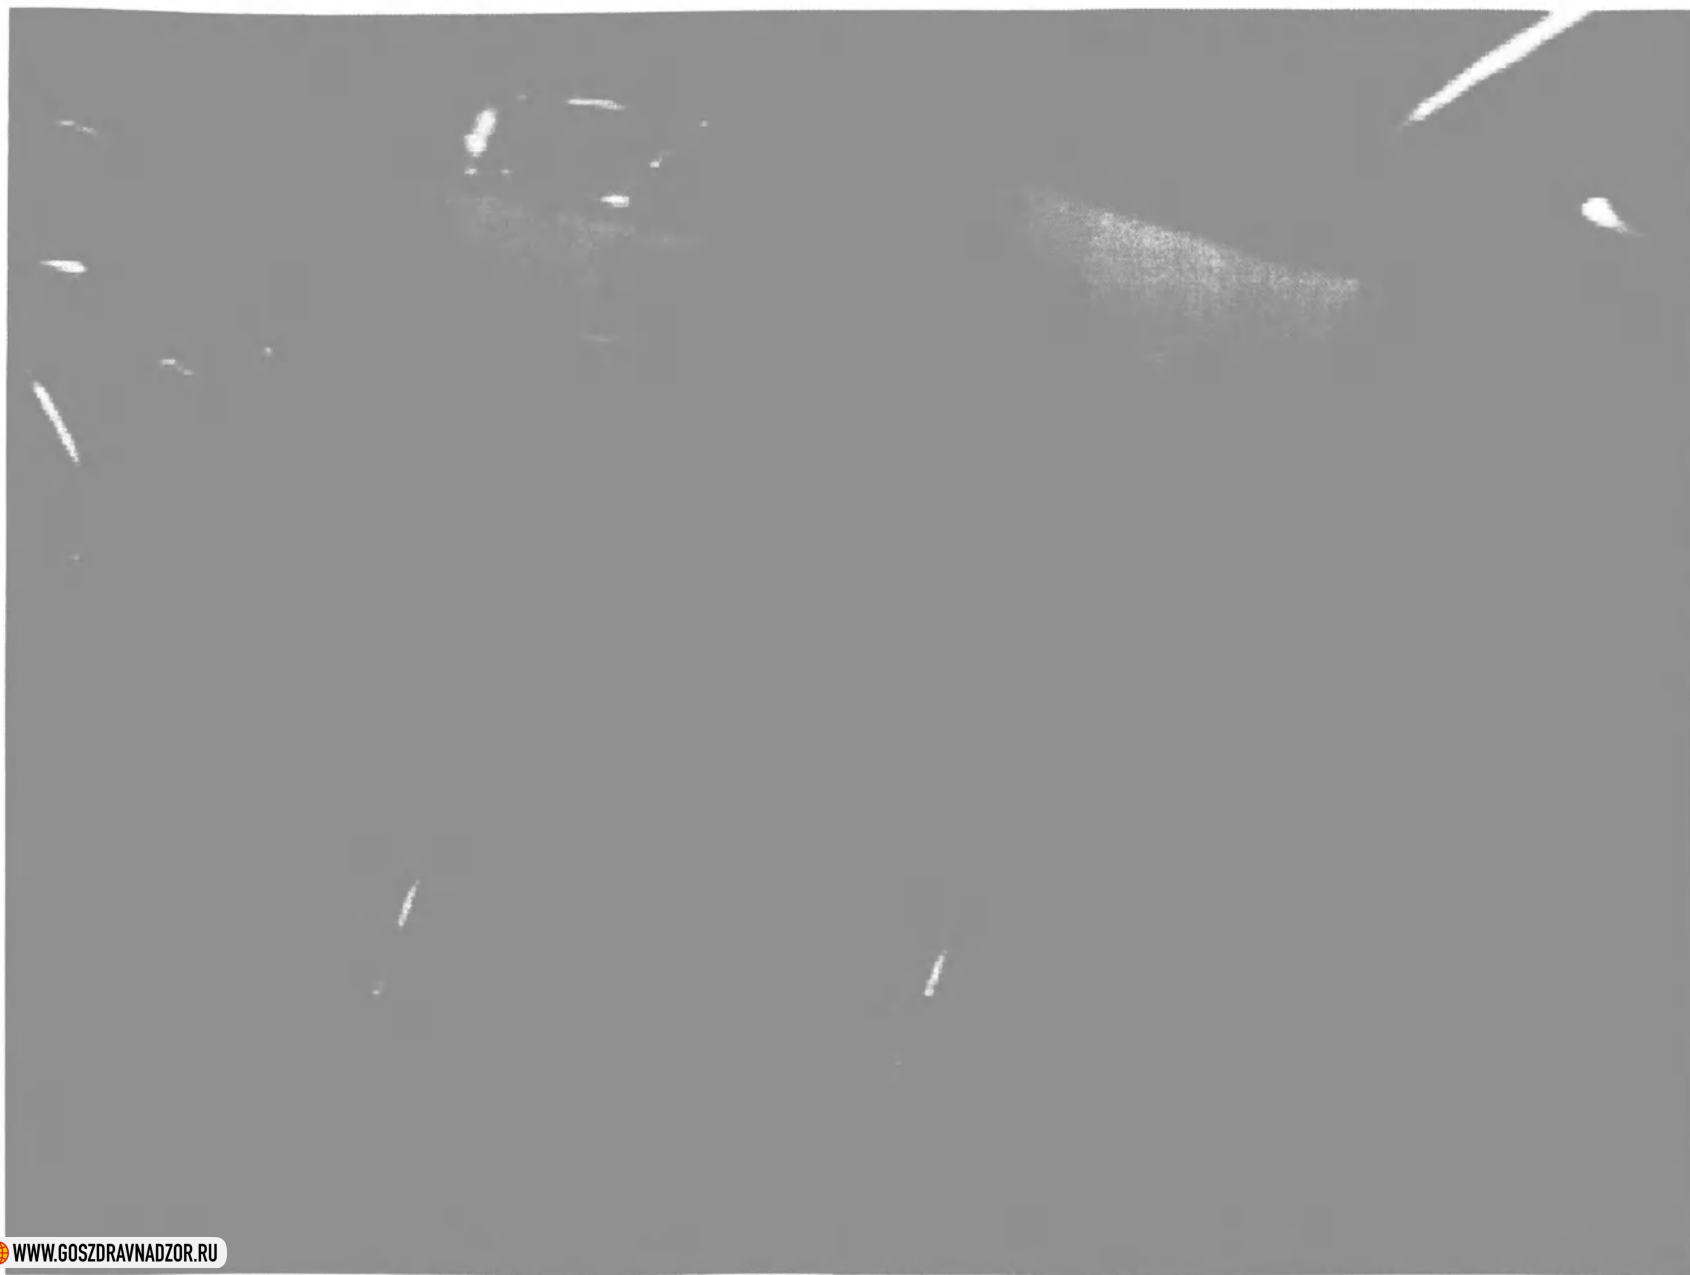

реагентный контейнер 35мм (35mm OD Reagent Cup) 2 шт.

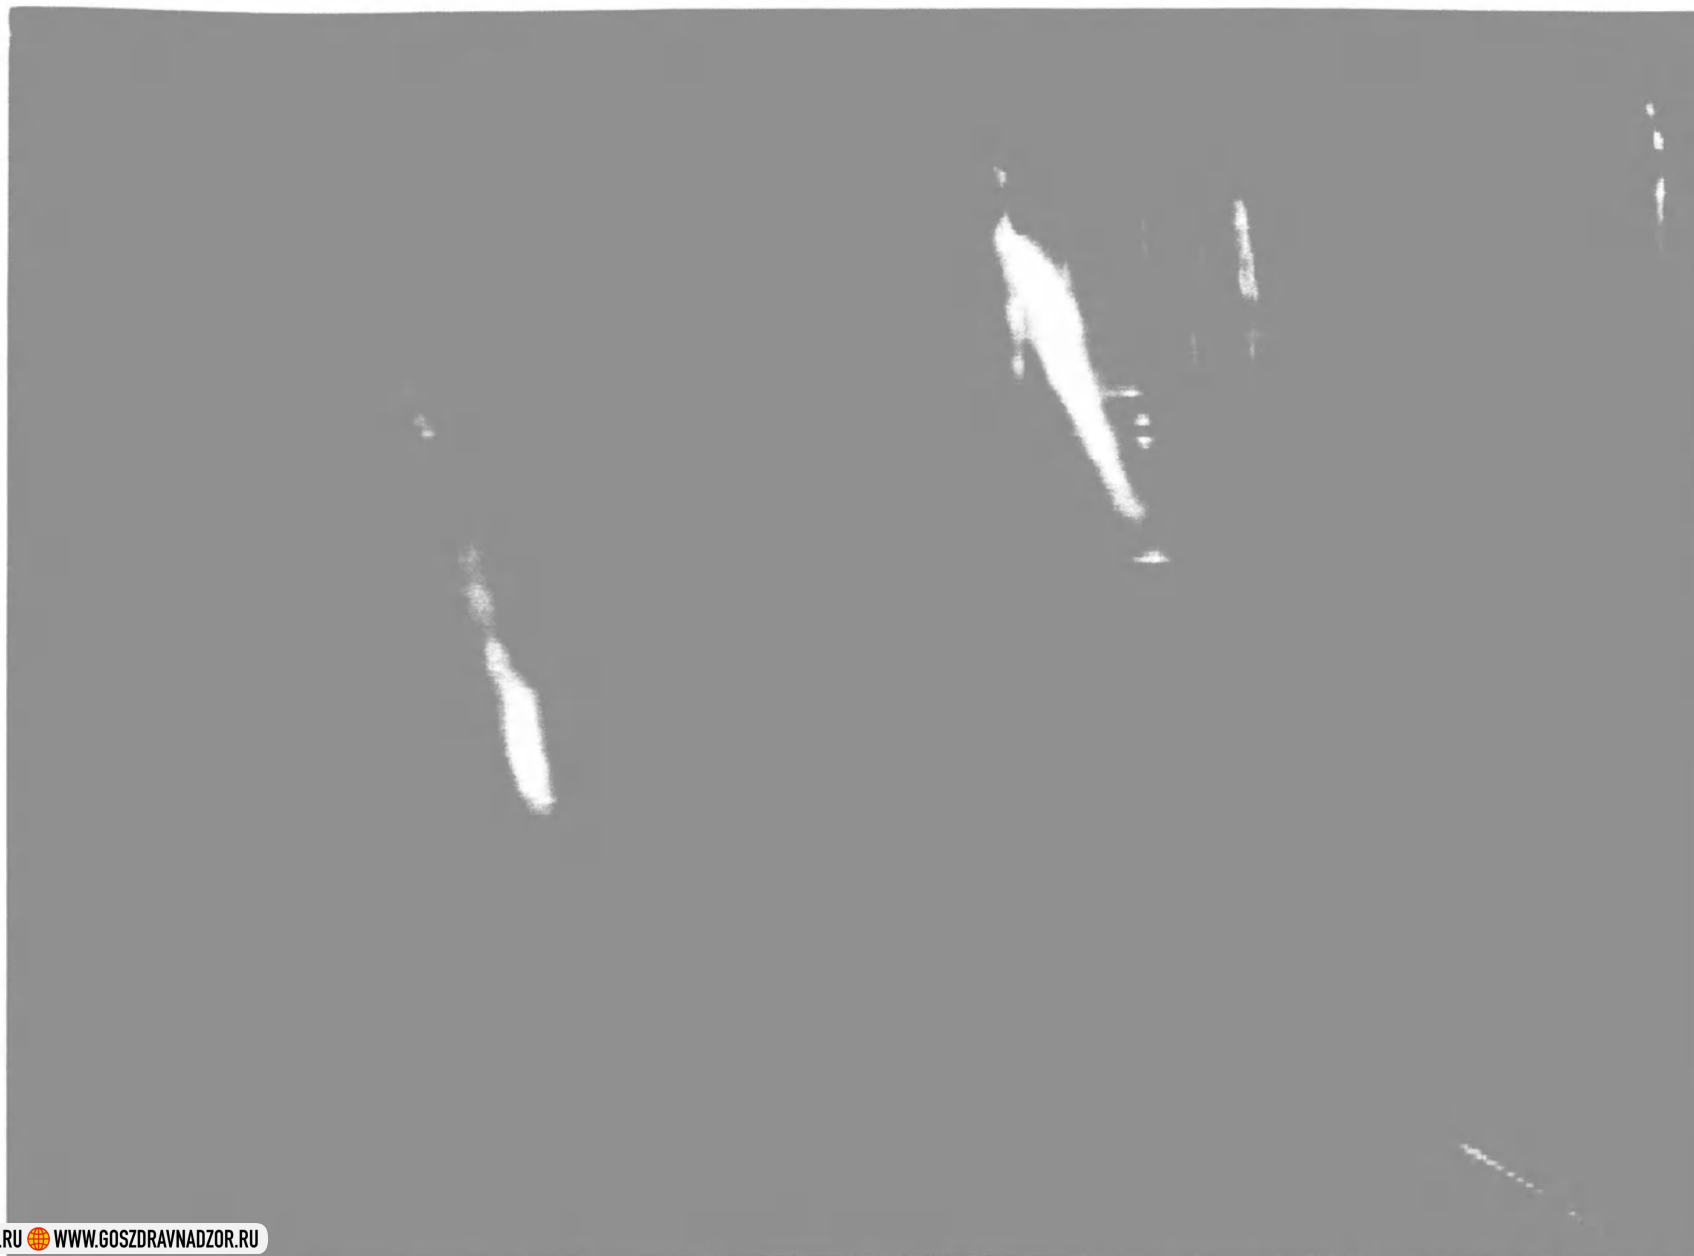

реагентный контейнер 28мм (28mm OD Reagent Cup) 2 шт.



регентная наклейка (Reagent Label) 1 шт.

PT TT APTT CaCl_2 FIB Buffer Clean

ка для прочистки дозирующего зонда (Cleaning Needle Wire) 1 шт.



раствор для жесткой очистки (RAC Cleaner) 3 шт.

Разбавитель образца (Negative control – Sample diluent) 1 шт.



Возбуждающий узел для магнитной мешалки

