

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «СОЛТ»

В.В. Заяц

2022 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**Гребенка наконечников на магнитные стержни для использования с системой выделения
нуклеиновых кислот, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50-002-01240893-2021**

производитель

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЛТ» (АО «СОЛТ»), РОССИЯ

Наименование и состав медицинского изделия:

Гребенка наконечников на магнитные стержни для использования с системой выделения нуклеиновых кислот, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-002-01240893-2021:

1. Гребенка наконечников на магнитные стержни 24 для использования с системой выделения нуклеиновых кислот (10 шт. х 10 уп.);

Инструкция по применению.

2. Гребенка наконечников на магнитные стержни 96 для использования с системой выделения нуклеиновых кислот (10 шт. х 10 уп.);

Инструкция по применению.



Рисунок 1 - Общий вид МИ для диагностики *in vitro*.
Гребенка наконечников на магнитные стержни для использования с системой выделения нуклеиновых кислот,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-002-01240893-2021:
Гребенка наконечников на магнитные стержни 24 для использования с системой выделения нуклеиновых кислот (10 шт. x 10 уп.);
Инструкция по применению.

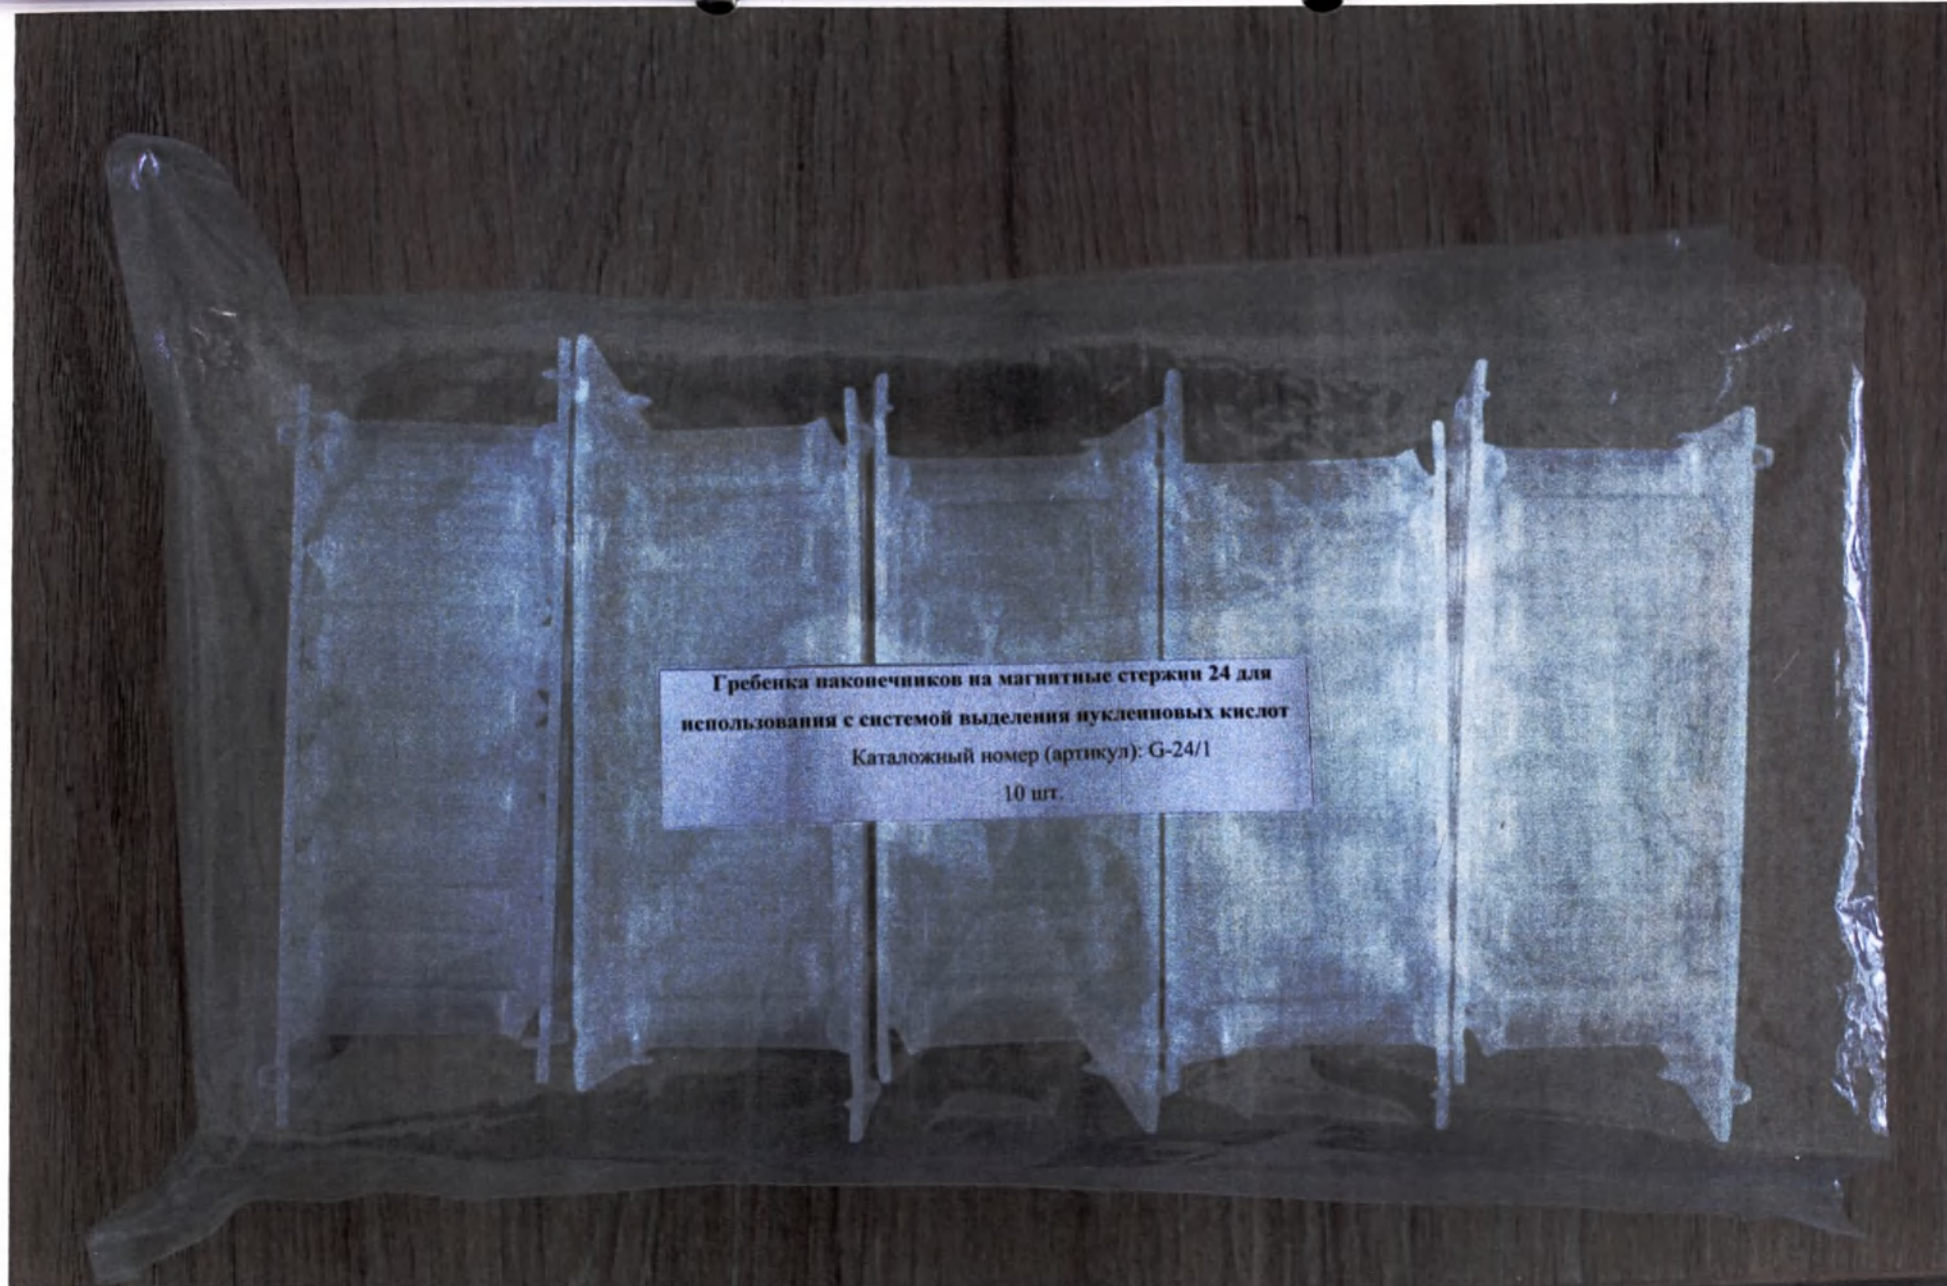


Рисунок 1.1 – Гребенка наконечников на магнитные стержни 24 для использования с системой выделения нуклеиновых кислот
(в первичной упаковке – 10 шт.)

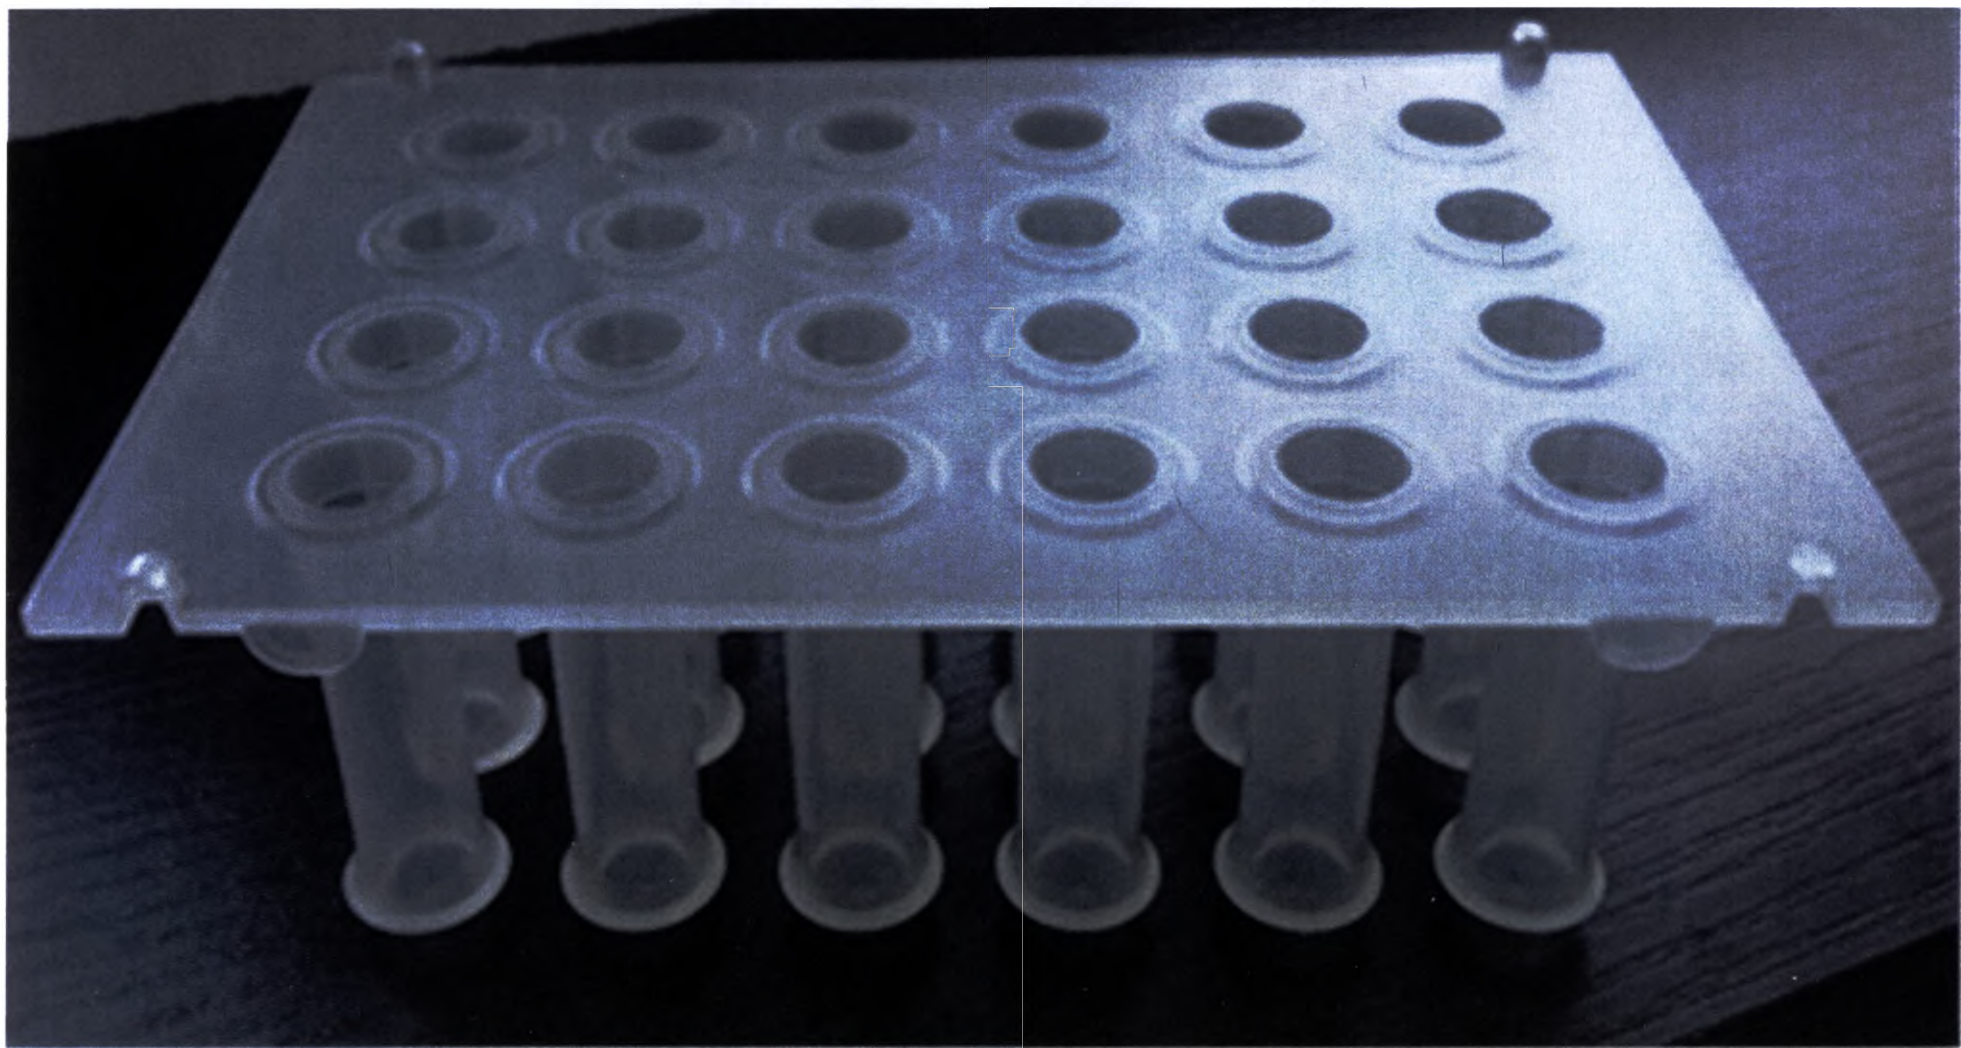


Рисунок 1.2 - Гребенка наконечников на магнитные стержни 24 для использования с системой выделения нуклеиновых кислот

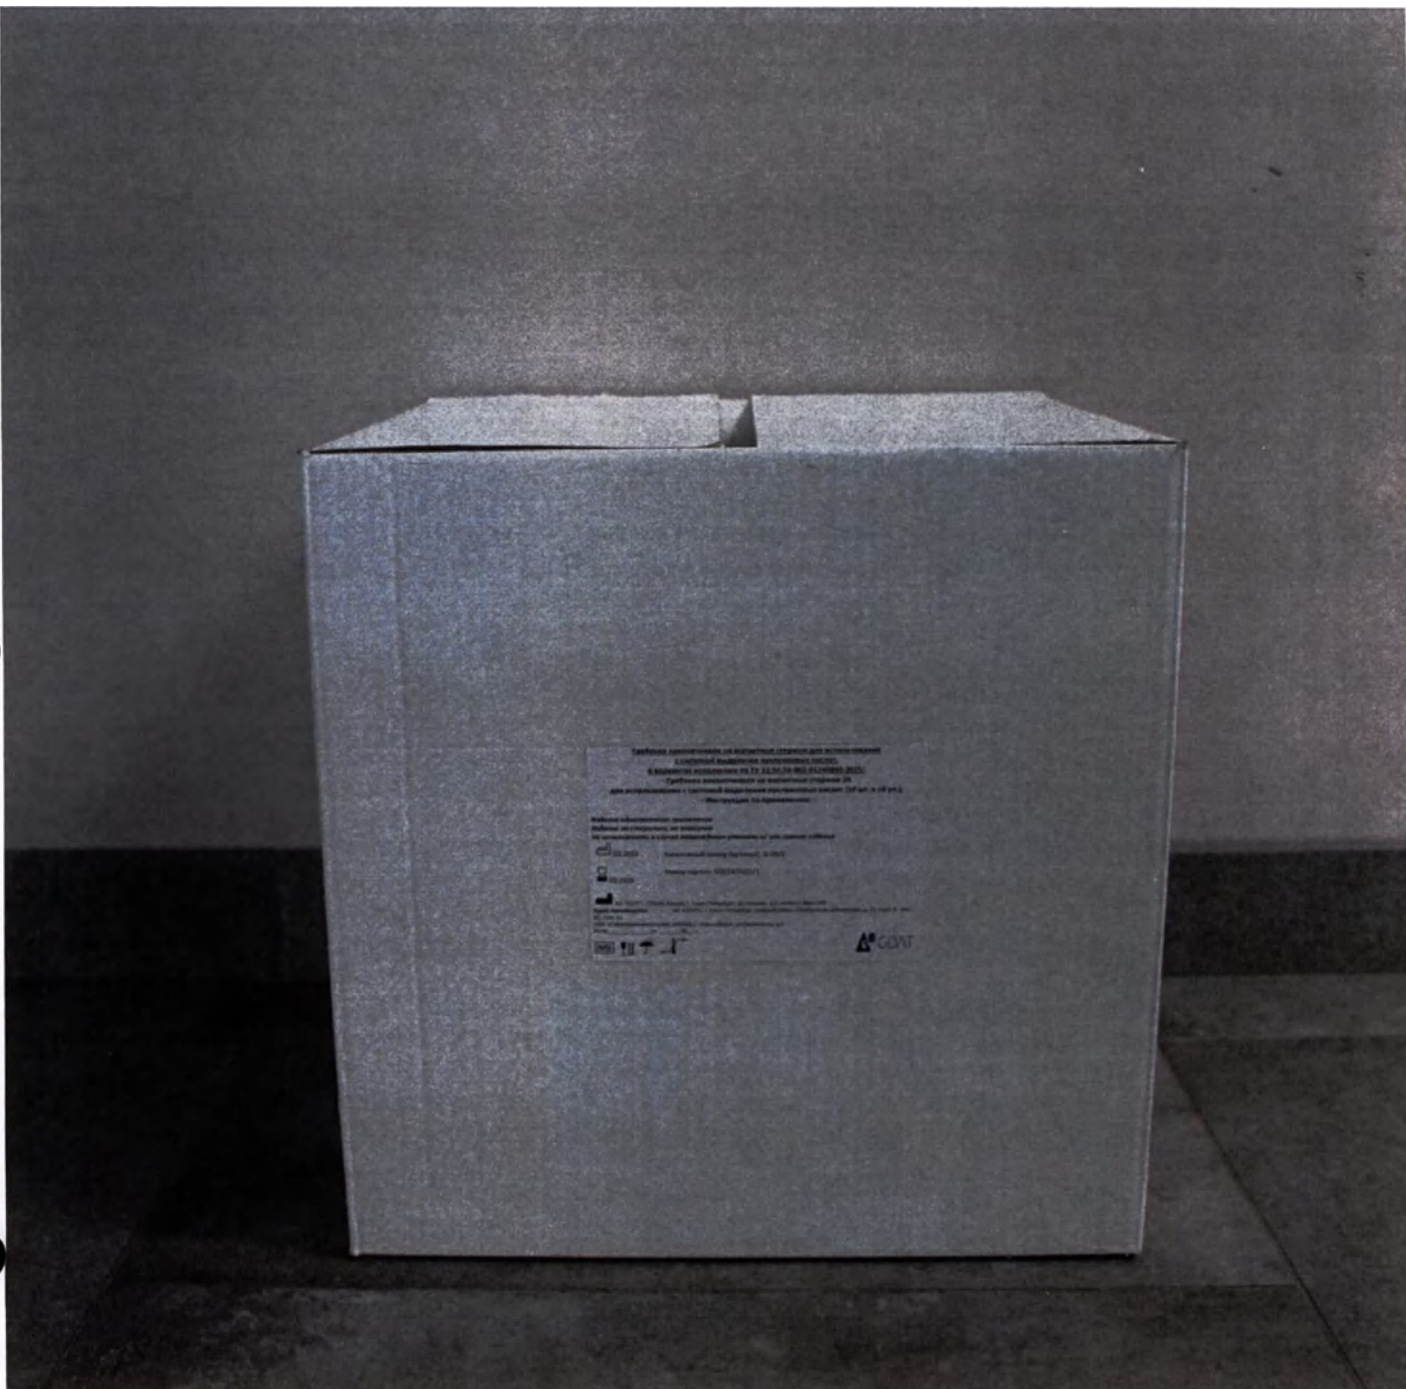


Рисунок 2 - Внешний вид вторичной (транспортной) упаковки (картонной коробки).

Гребенка наконечников на магнитные стержни для использования с системой выделения нуклеиновых кислот,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-002-01240893-2021:

Гребенка наконечников на магнитные стержни 24 для использования с системой выделения нуклеиновых кислот

**Гребенка наконечников на магнитные стержни для использования
с системой выделения нуклеиновых кислот,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-002-01240893-2021:**
- Гребенка наконечников на магнитные стержни 24
для использования с системой выделения нуклеиновых кислот (10 шт. х 10 уп.);
- Инструкция по применению.

Изделие однократного применения

Изделие не стерильно, не токсично

Не использовать в случае повреждения упаковки и/или самого изделия



02.2021

Каталожный номер (артикул): G-24/1



02.2026

Номер партии: SOC24/0221/1



АО "СОЛТ", 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.3, литер Б, офис 308

Адрес производства:

АО "СОЛТ", г. Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская набережная, д. 34, корп. 4, лит.

АС, пом. 1а

ООО «Сибкадемтехнологии», 630068, г. Новосибирск, ул.Одоевского, д.3

РУ № _____ от _____ 20__ г.




Рисунок 2.1 - Пример маркировки на транспортной (потребительской) упаковке (картонной коробке).

Гребенка наконечников на магнитные стержни для использования с системой выделения нуклеиновых кислот,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-002-01240893-2021:



Рисунок 3 - Общий вид МИ для диагностики in vitro

Гребенка наконечников на магнитные стержни для использования с системой выделения нуклеиновых кислот,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-002-01240893-2021:

Гребенка наконечников на магнитные стержни 96 для использования с системой выделения нуклеиновых кислот (10 шт. x 10 упр.);

Инструкция по применению



Гребенка наконечников на магнитные стержни 96 для
использования с системой выделения нуклеиновых кислот
Каталожный номер (артикул): G-96/1
10 шт.

Рисунок 3.1 – Гребенка наконечников на магнитные стержни 96 для использования с системой выделения нуклеиновых кислот
(в первичной упаковке – 10 шт.)

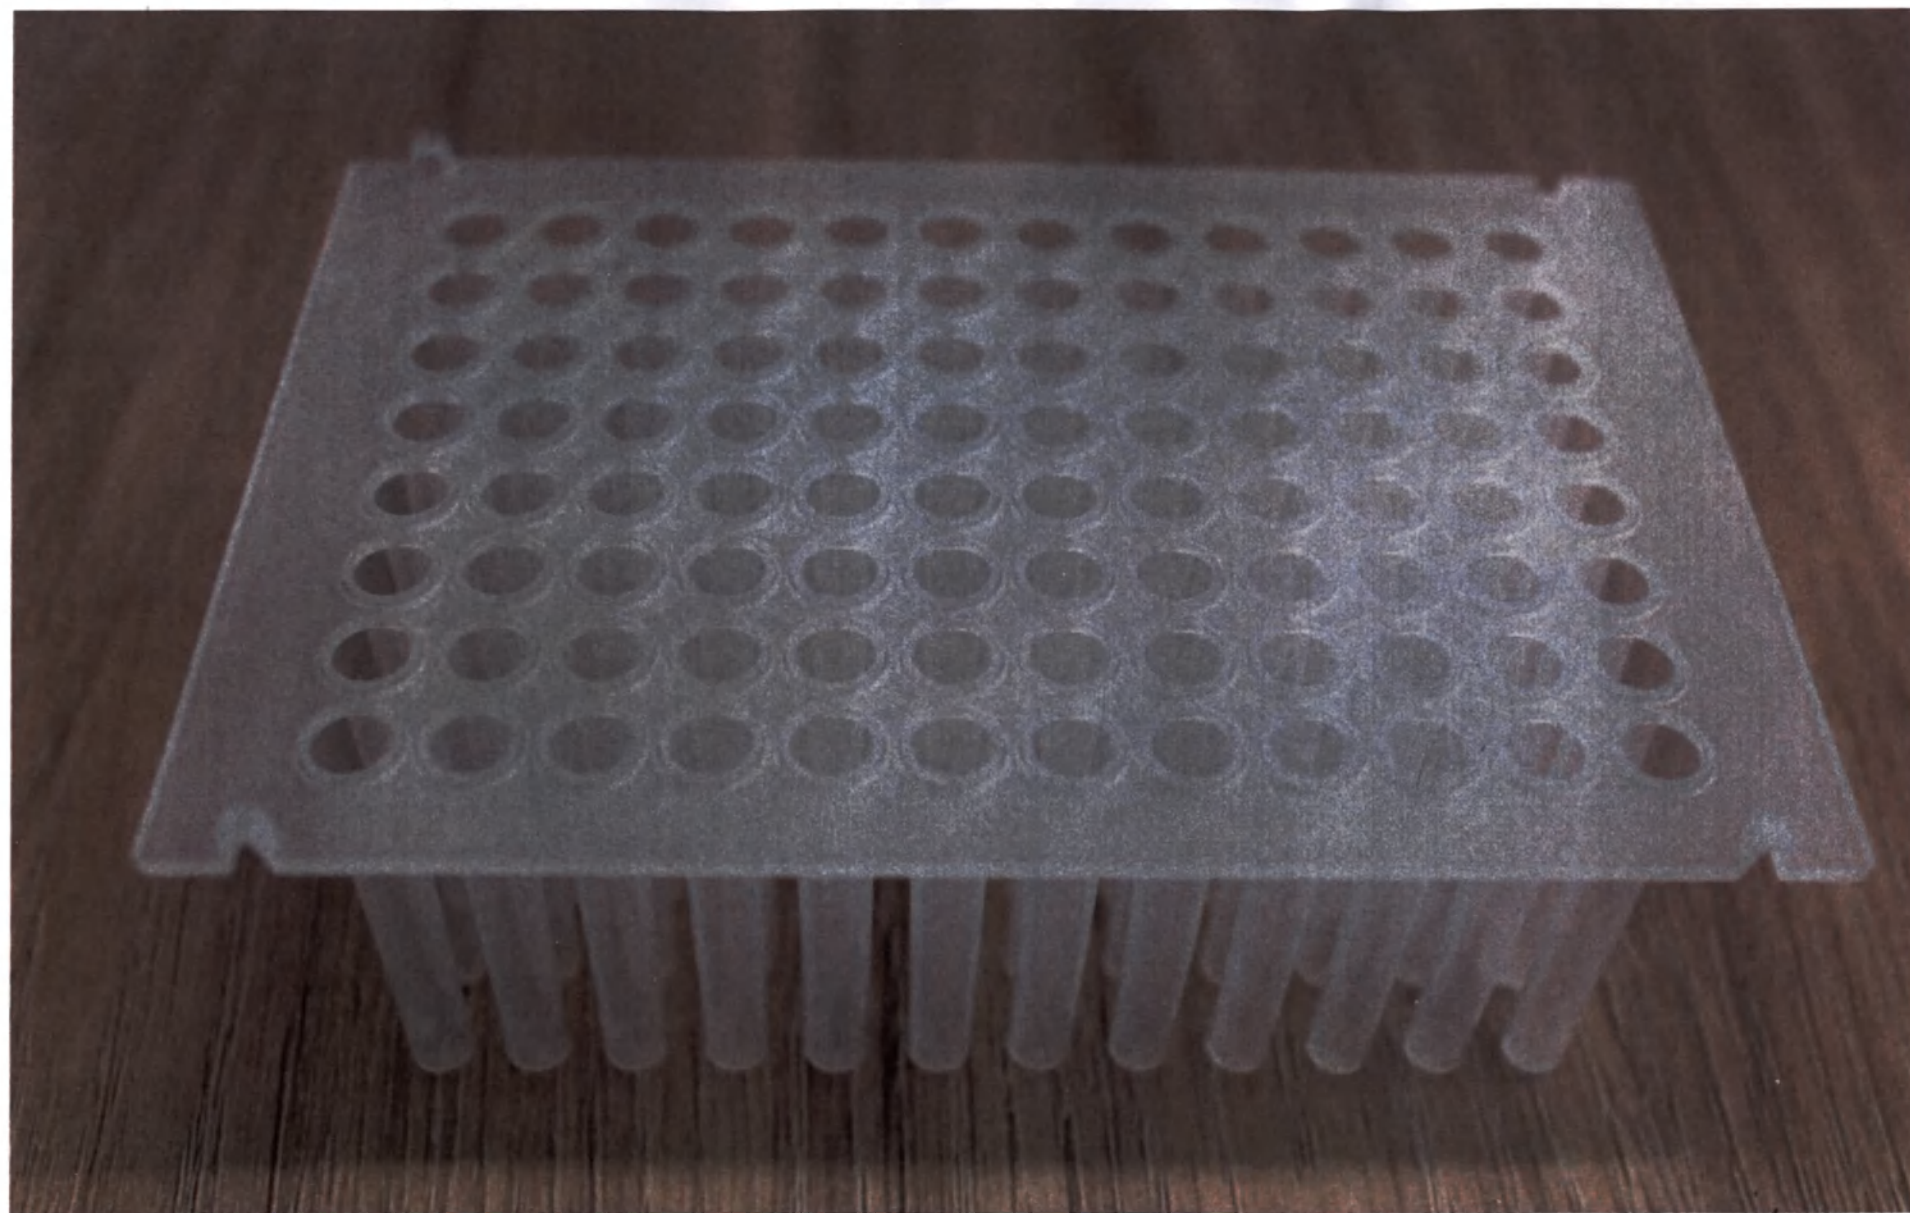


Рисунок 3.2 - Гребенка наконечников на магнитные стержни 96 для использования с системой выделения нуклеиновых кислот.

**Гребенка наконечников на магнитные стержни для использования
с системой выделения нуклеиновых кислот,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-002-01240893-2021:**

**- Гребенка наконечников на магнитные стержни 96
для использования с системой выделения нуклеиновых кислот (10 шт. x 10 уп.);
- Инструкция по применению.**

Изделие однократного применения

Изделие не стерильно, не токсично

Не использовать в случае повреждения упаковки и/или самого изделия



02.2021

Каталожный номер (артикул): G-96/1



02.2026

Номер партии: SOC96/0221/1



АО "СОЛТ", 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.3, литер Б, офис 308

Адрес производства: АО «СОЛТ», г. Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская набережная, д. 34, корп. 4, лит. АС, пом. 1а

ООО «Сибкадемтехнологии», 630068, г. Новосибирск, ул.Одоевского, д.3

РУ № _____ от _____ 20__ г.




Рисунок 4.1 - Пример маркировки на транспортной (потребительской) упаковке (картонной коробке).
Гребенка наконечников на магнитные стержни для использования с системой выделения нуклеиновых кислот,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-002-01240893-2021:

Прошито и скреплено печатью
на 12 листах

Генеральный директор
АО «СОЛТ»
Заяц В.В.

