

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТАГЛЕР»




_____ А.Н. Ляпин
« 26 » ноября 2021 г.


**Фотографии
медицинского изделия**

**Стол медицинский с электроприводом СО по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с
принадлежностями**


**Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями.
Общий вид**

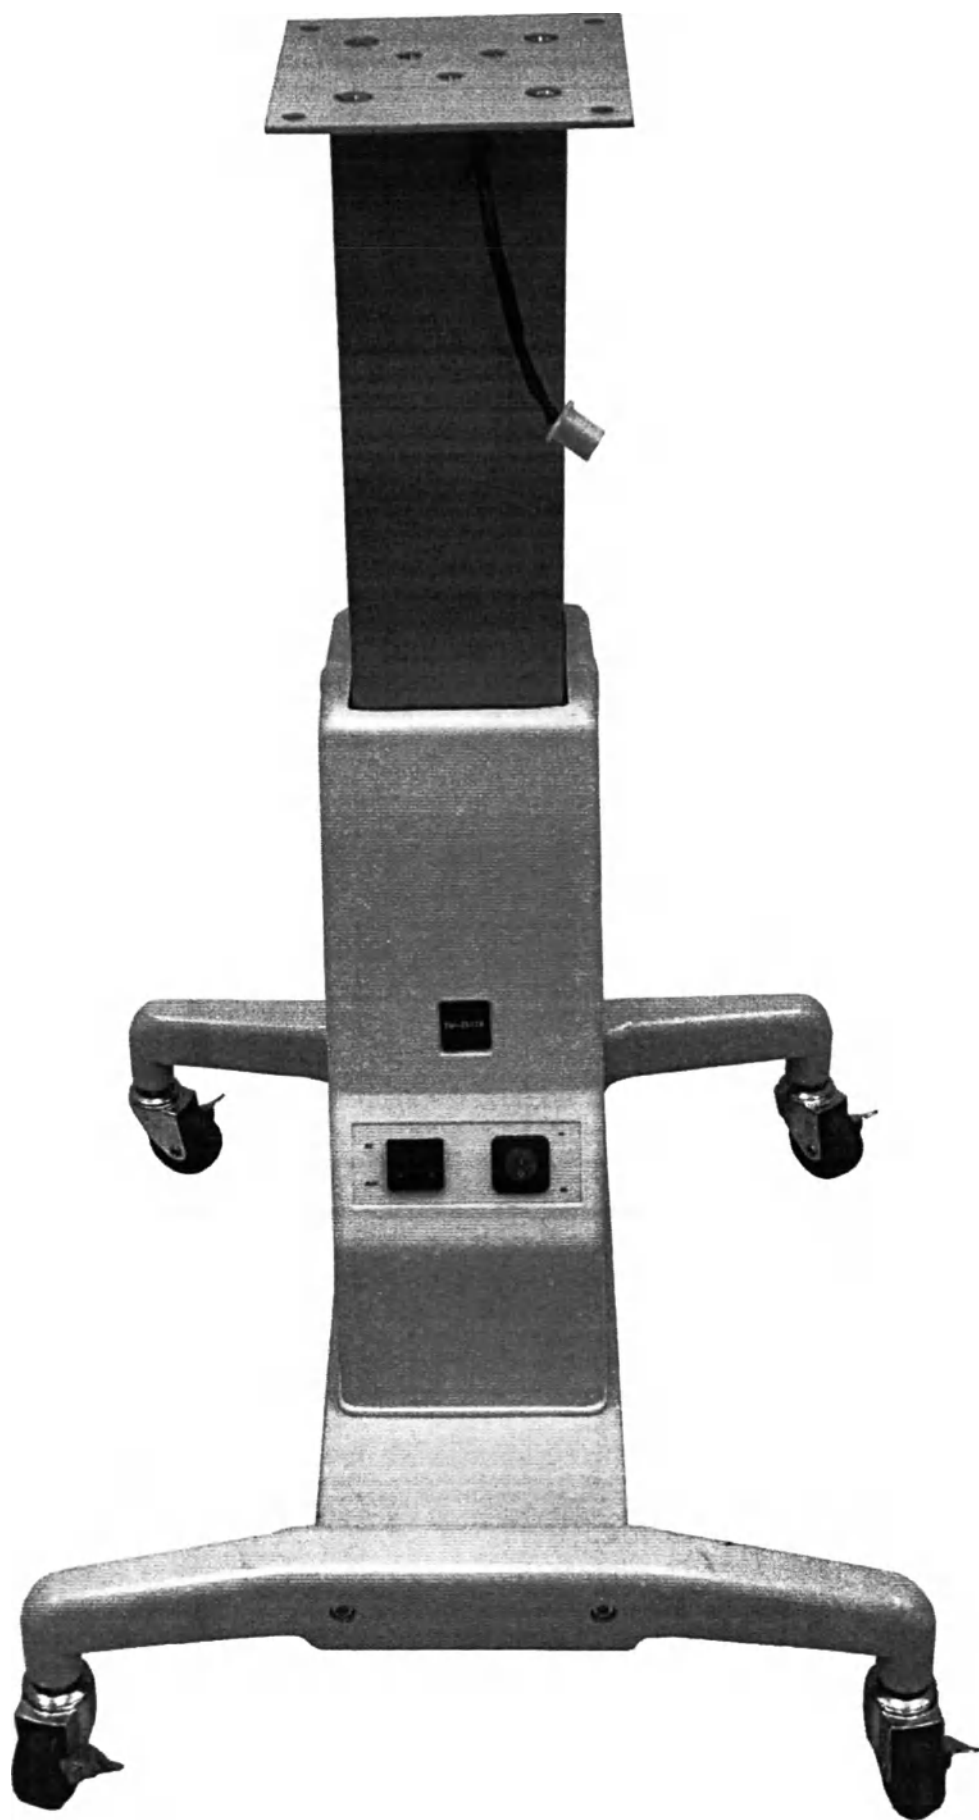


**Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями.
Опора с колёсами и подъёмный механизм стола в сборе**

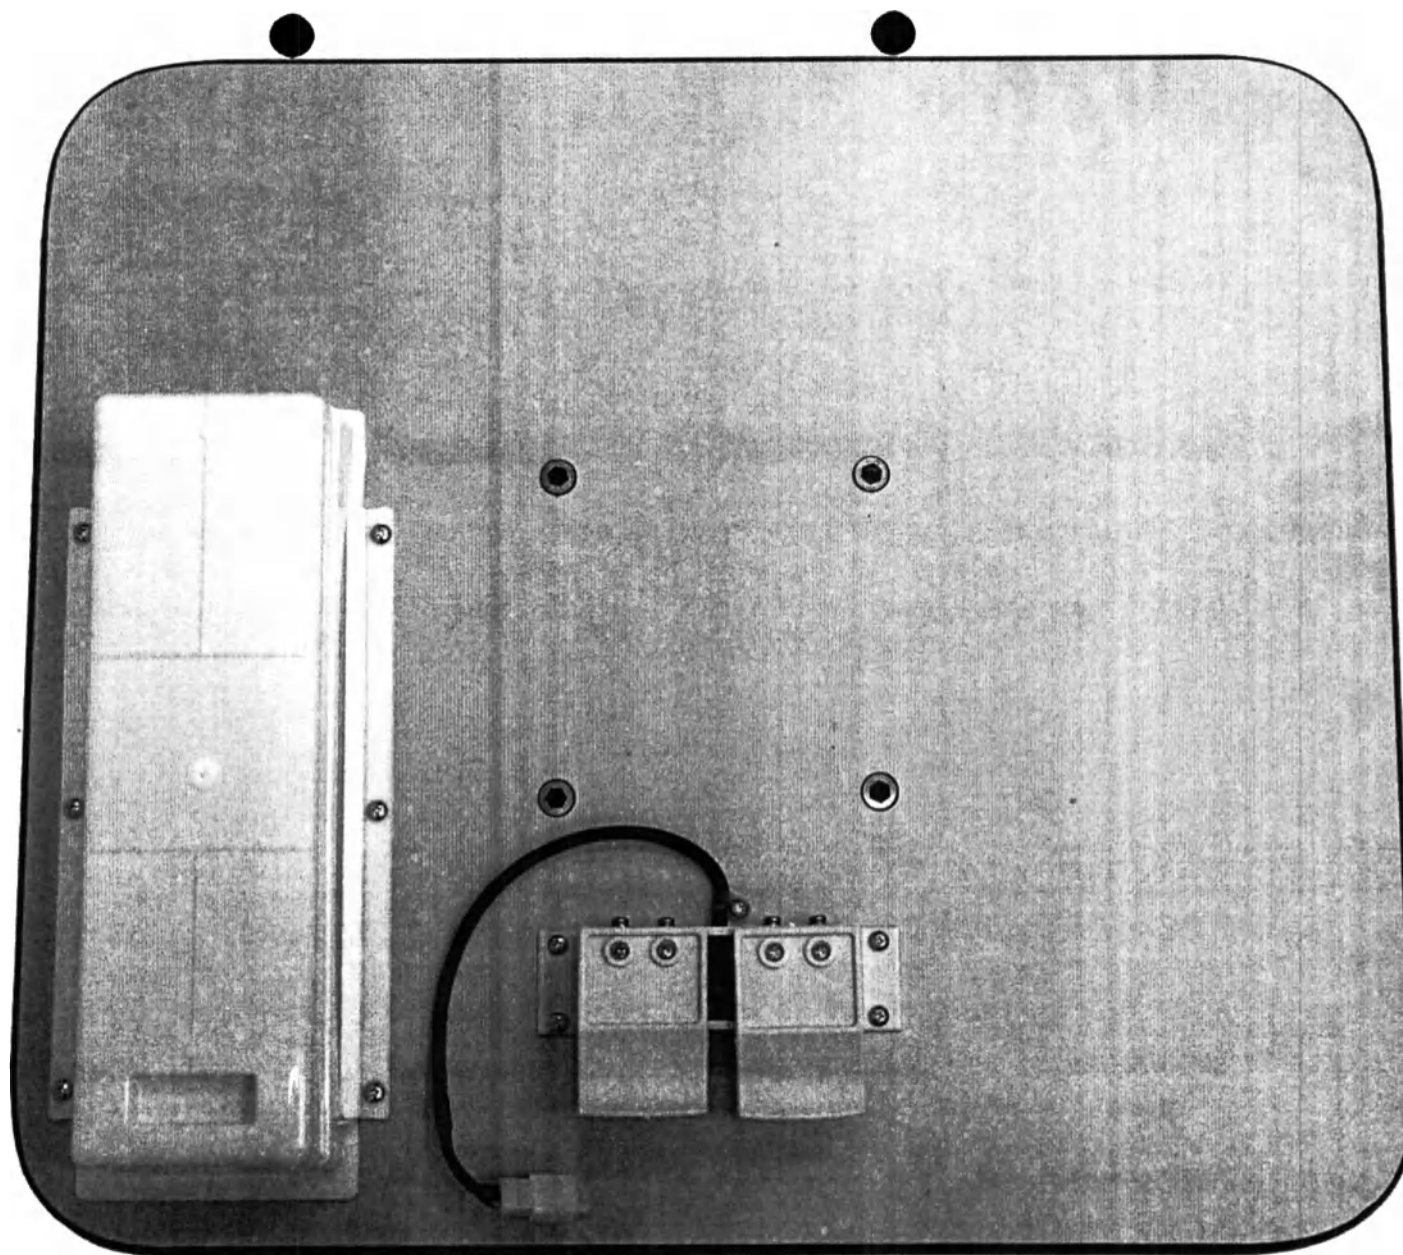


Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Столешница (вид снизу)

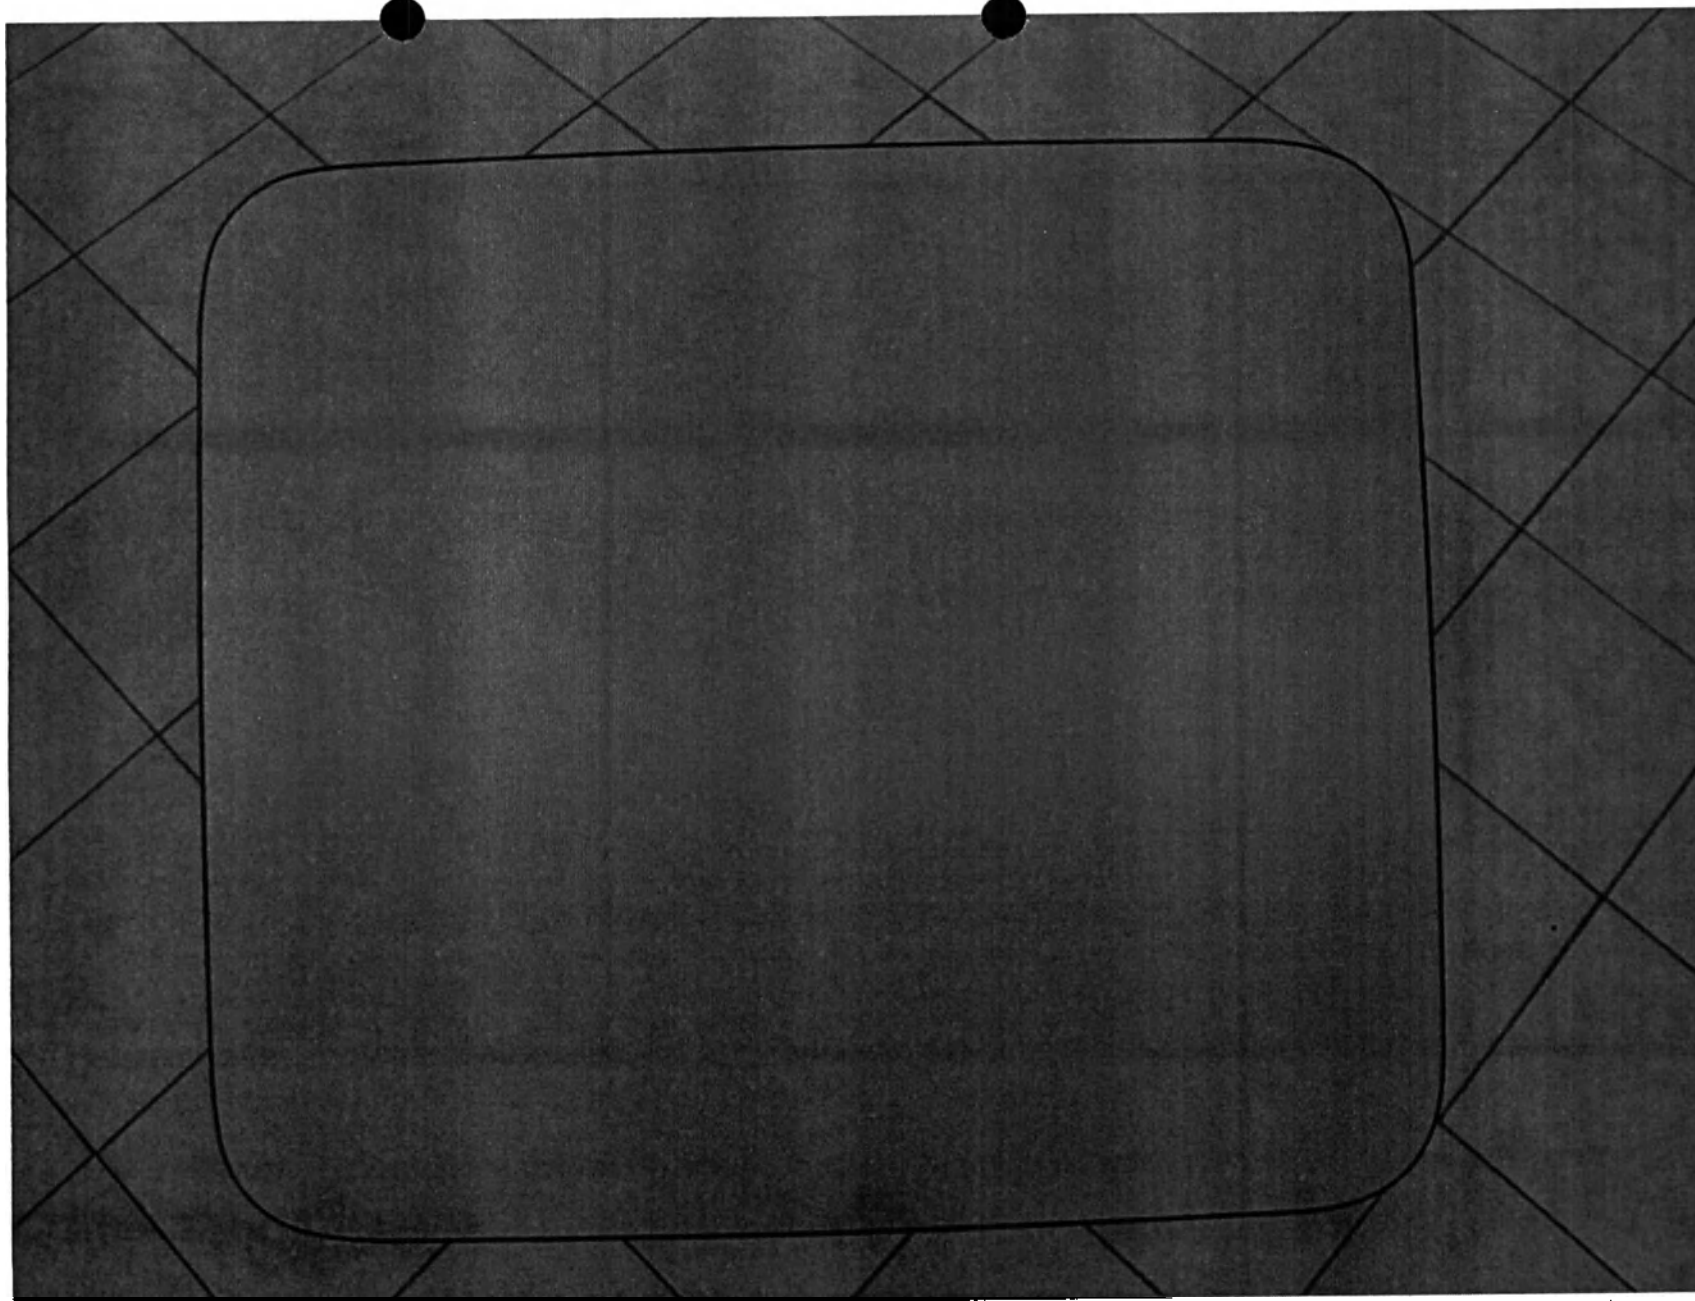


Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Столешница (вид сверху)

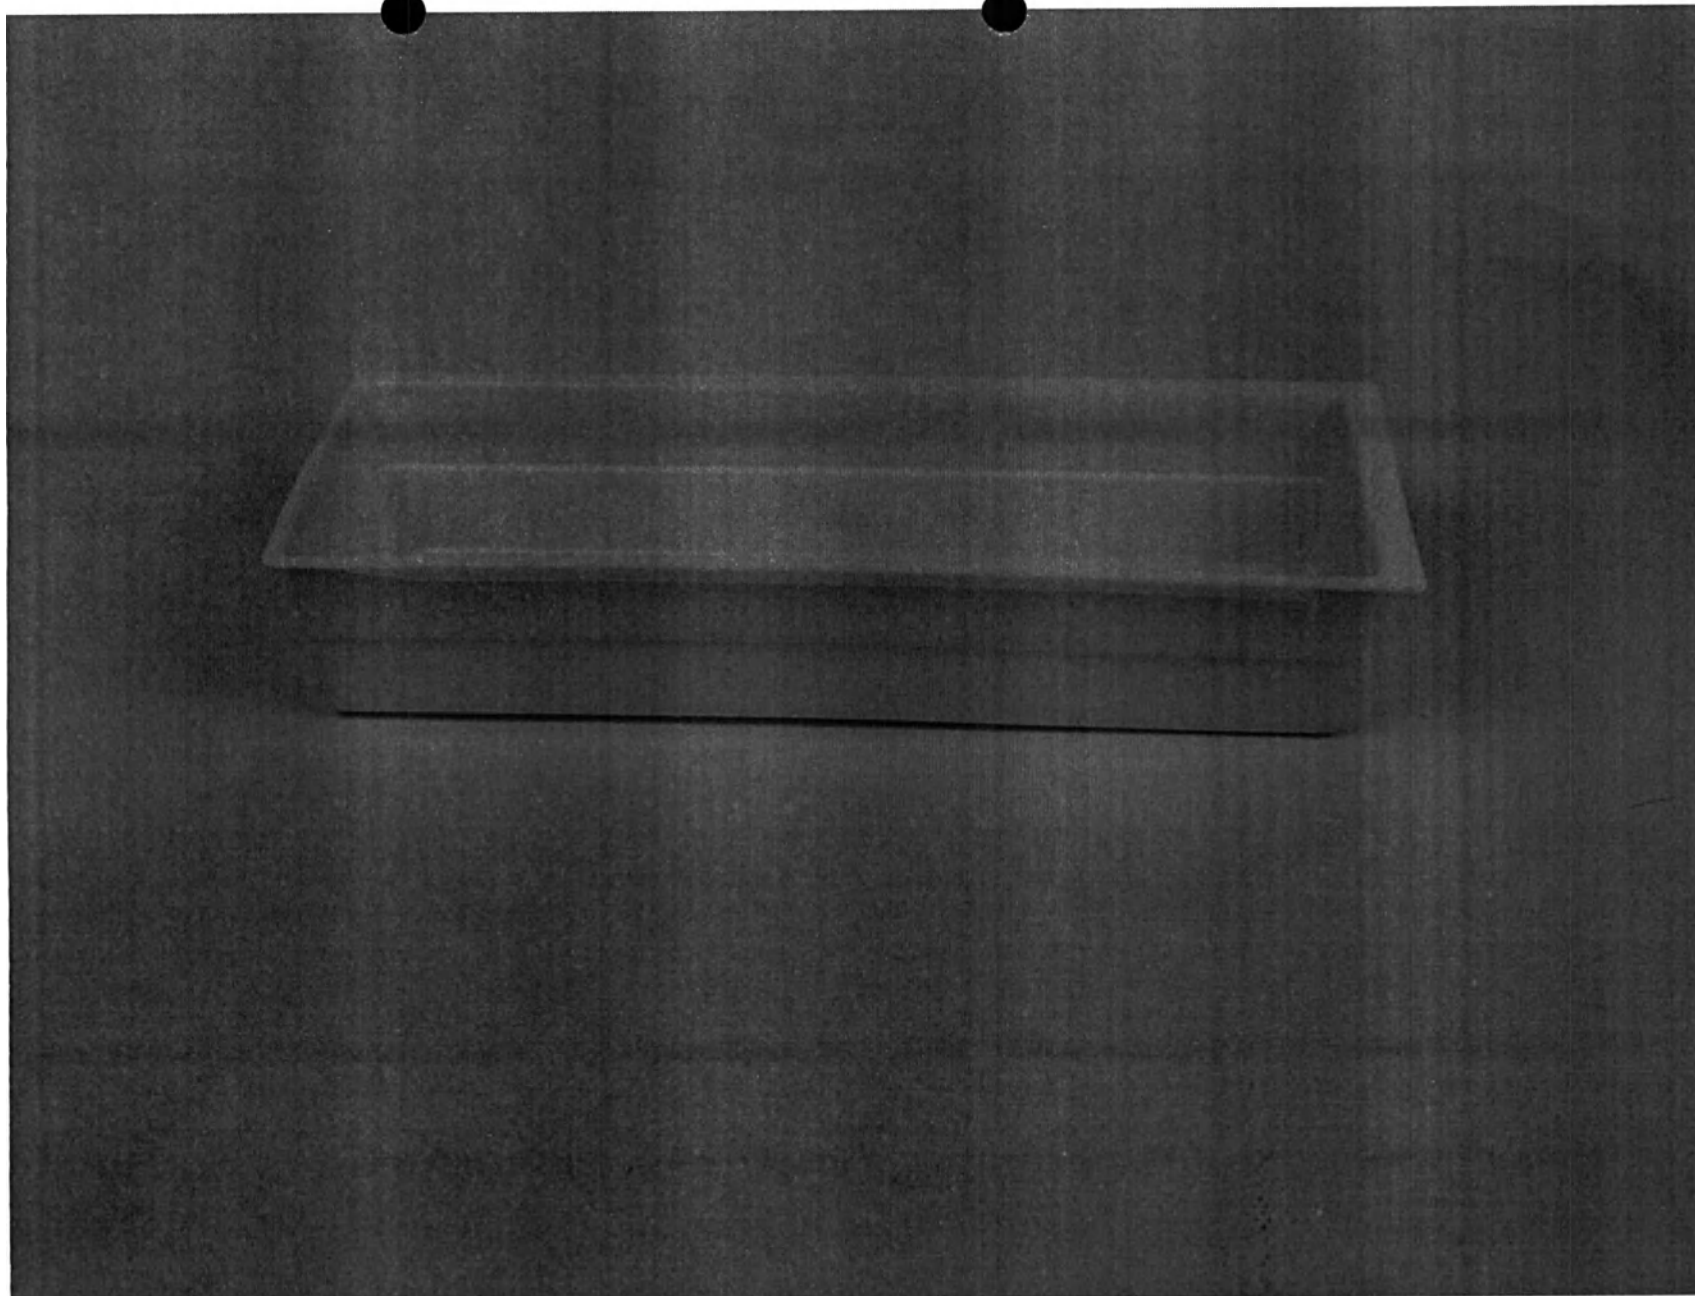


Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Ящик выдвижной в сборе

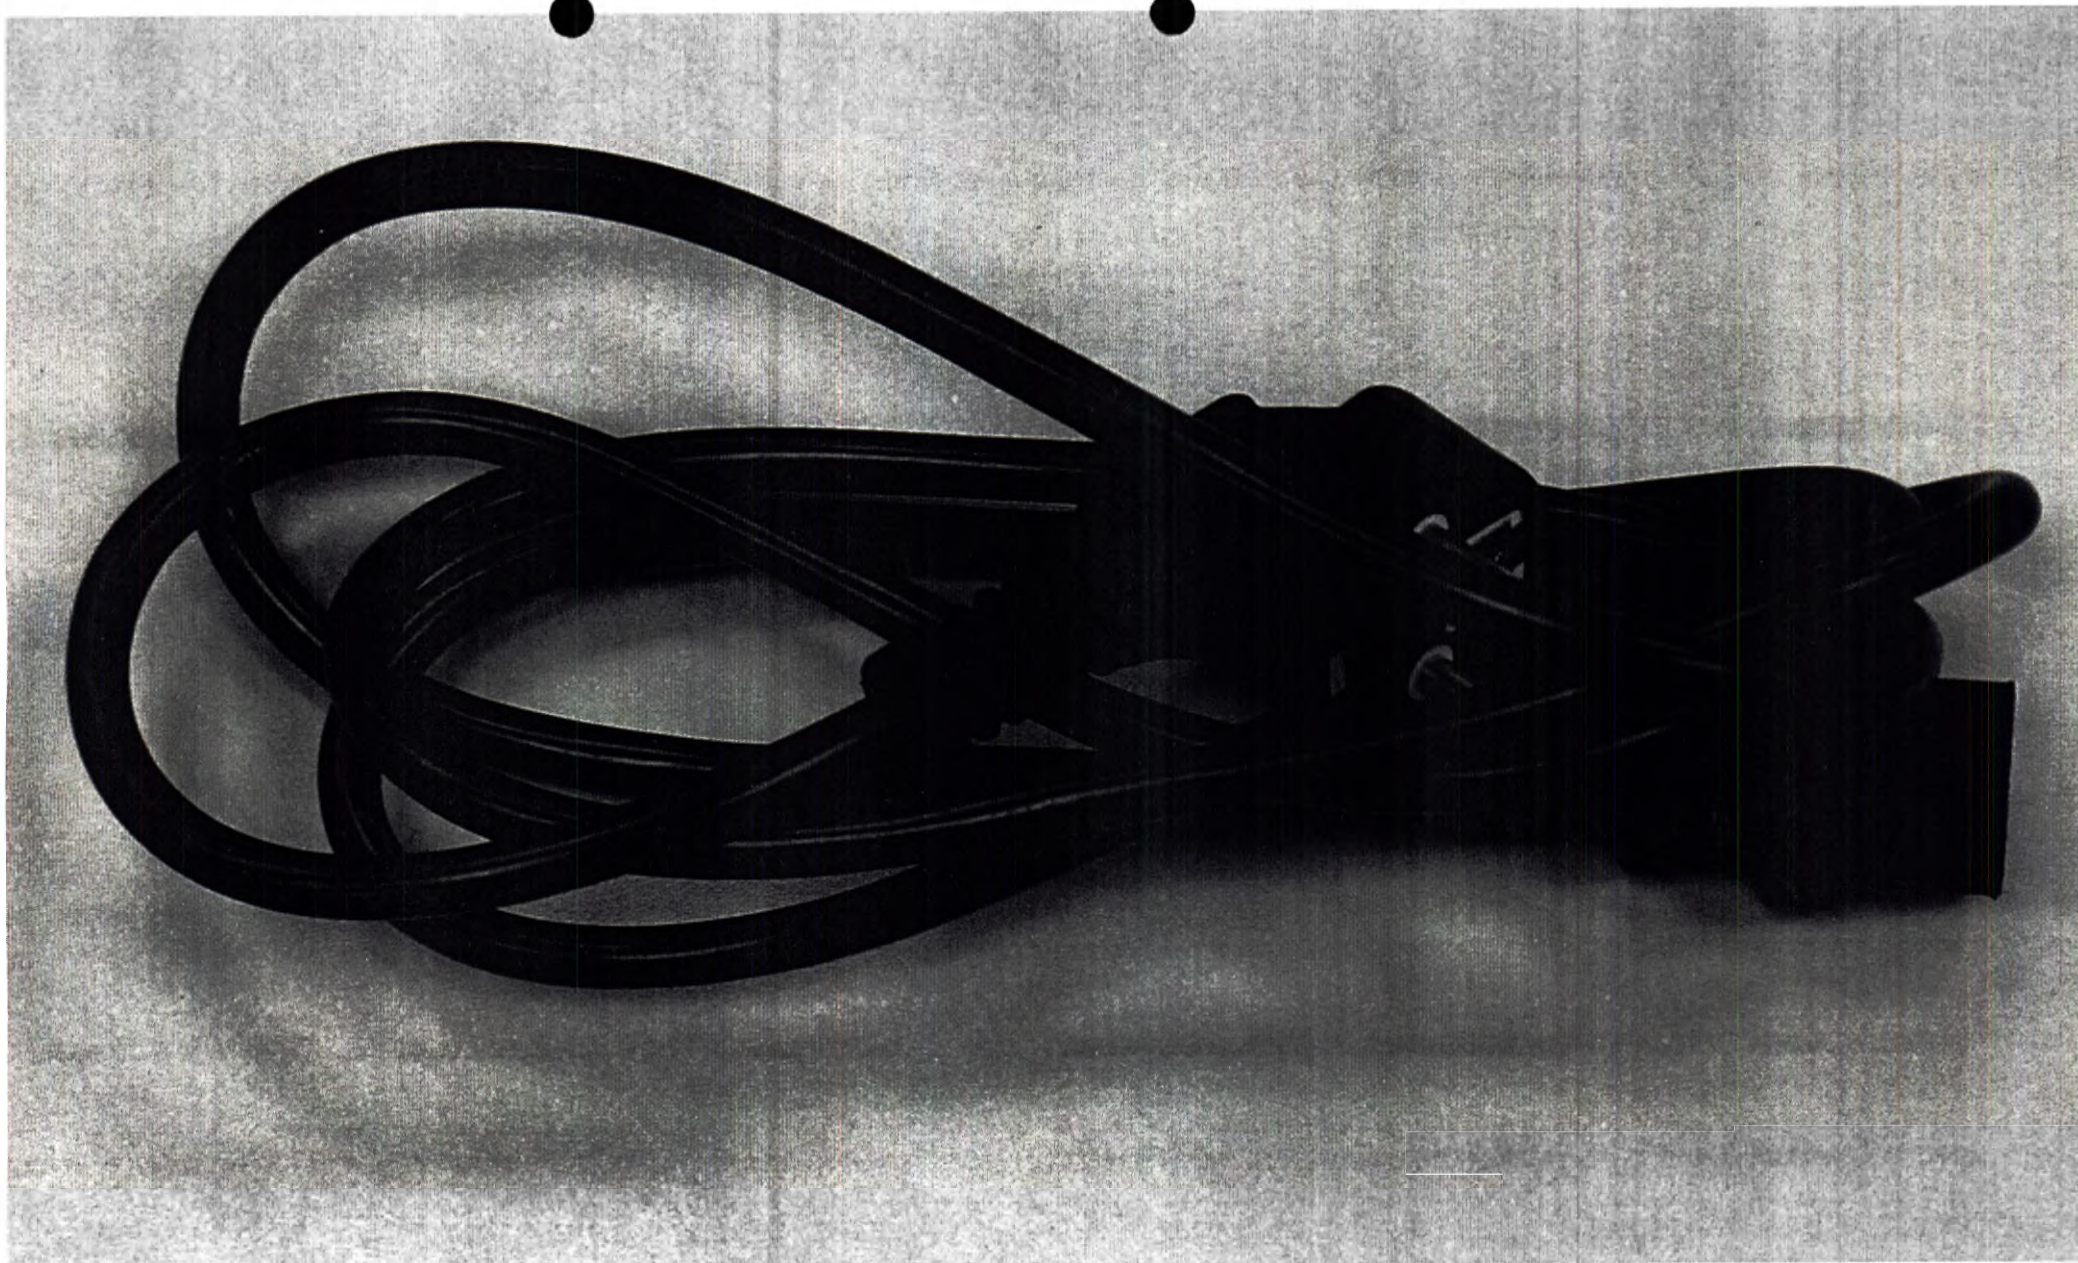


Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2020 с принадлежностями. Кабель электропитания

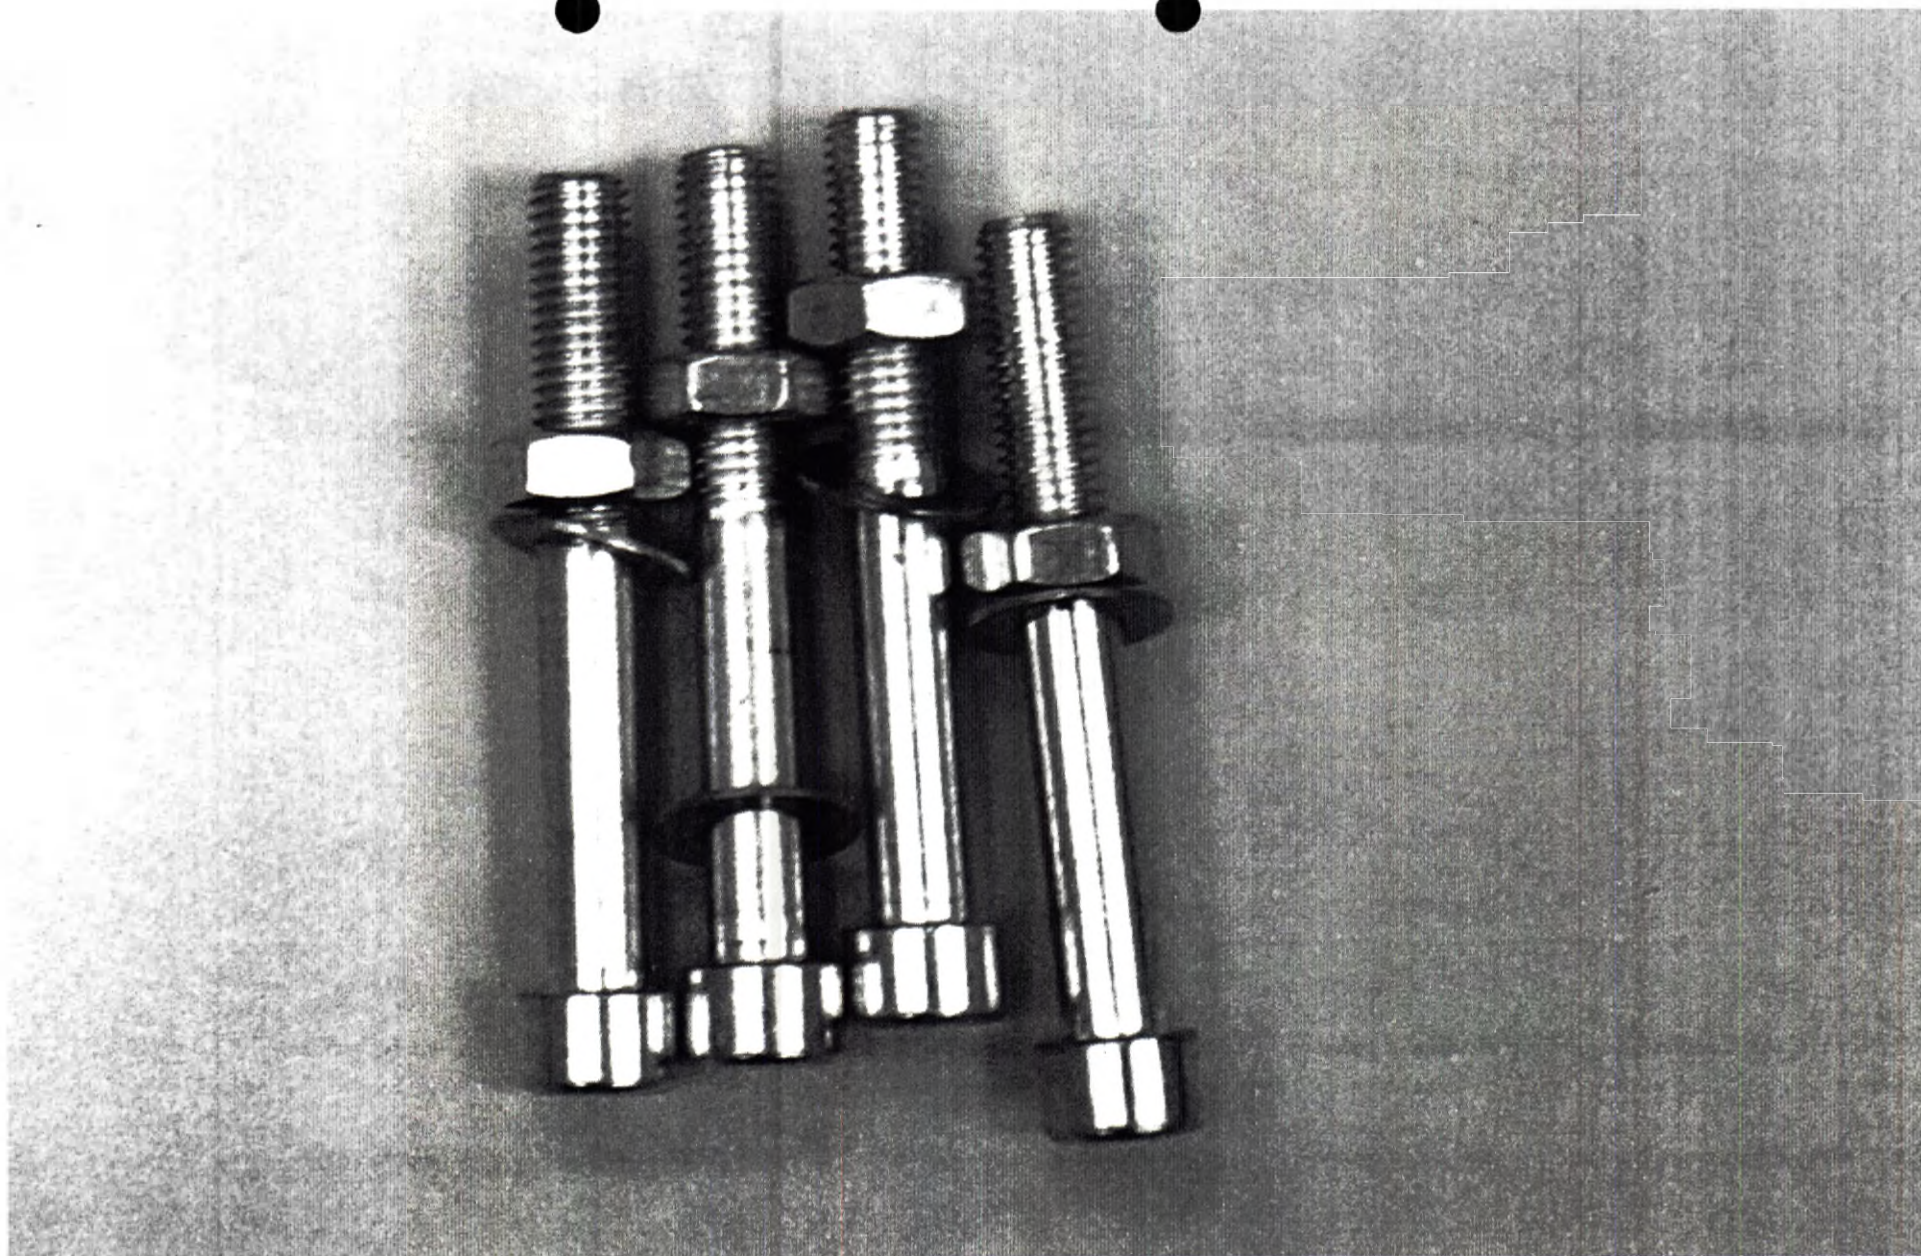


Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Принадлежности: болт (Ø8, L=65 мм) крепления опоры с шайбой и гайкой

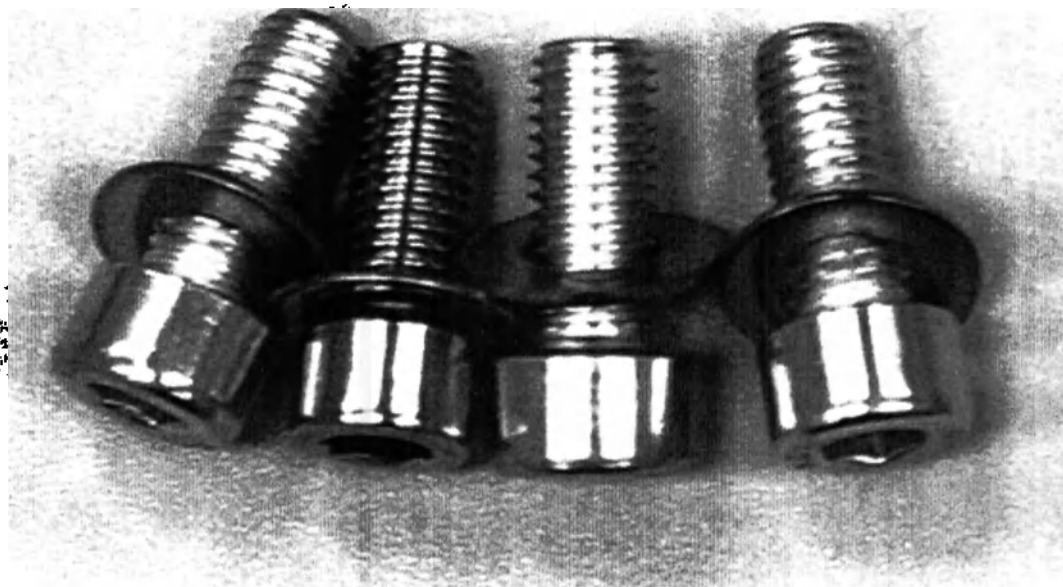

Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Принадлежности: болт (Ø8, L=20 мм) крепления столешницы с шайбой

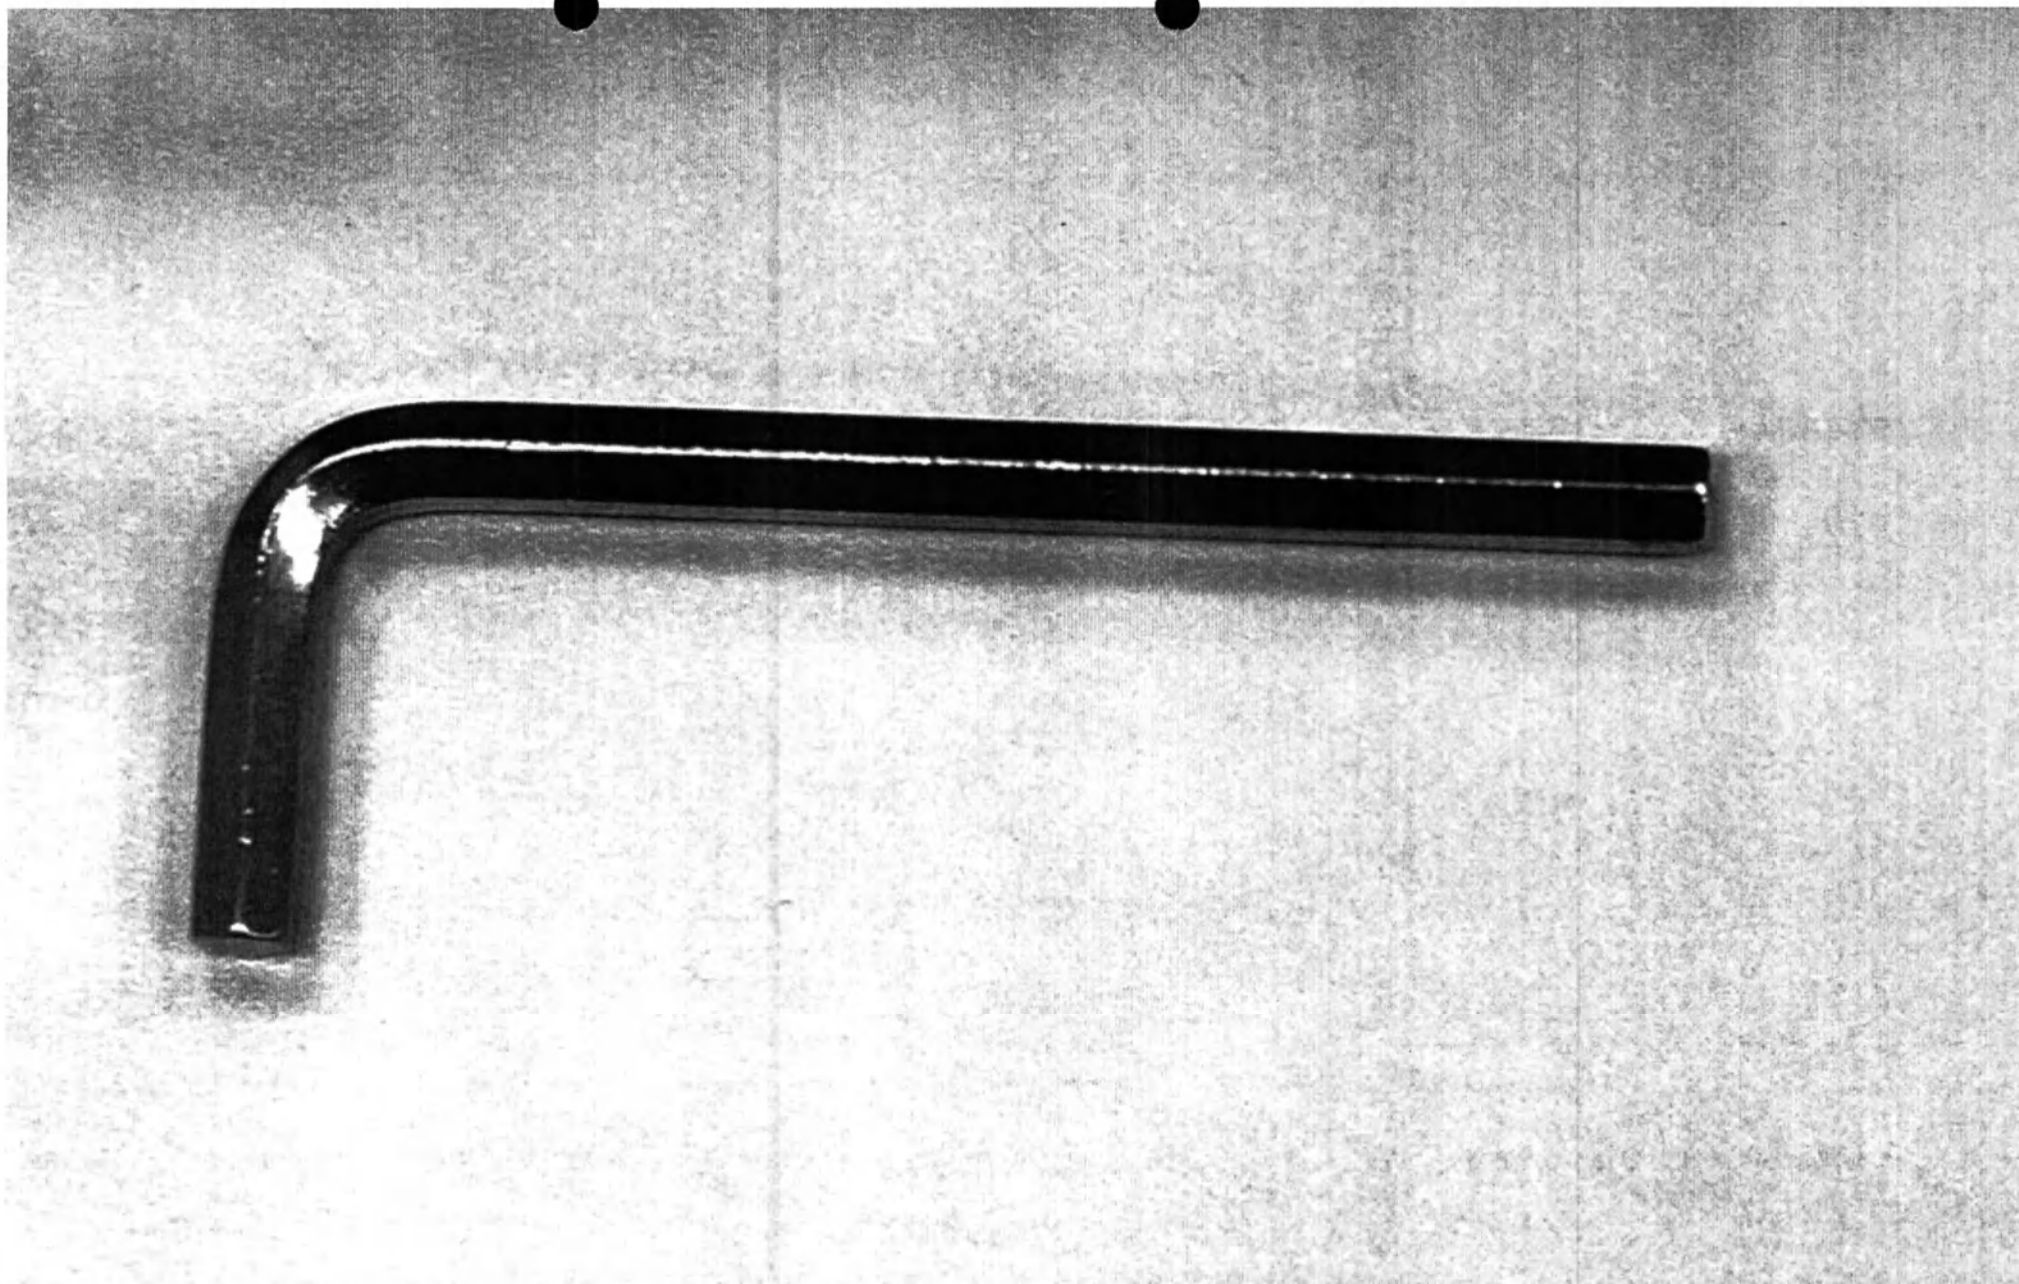

Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Принадлежности: ключ шестигранный

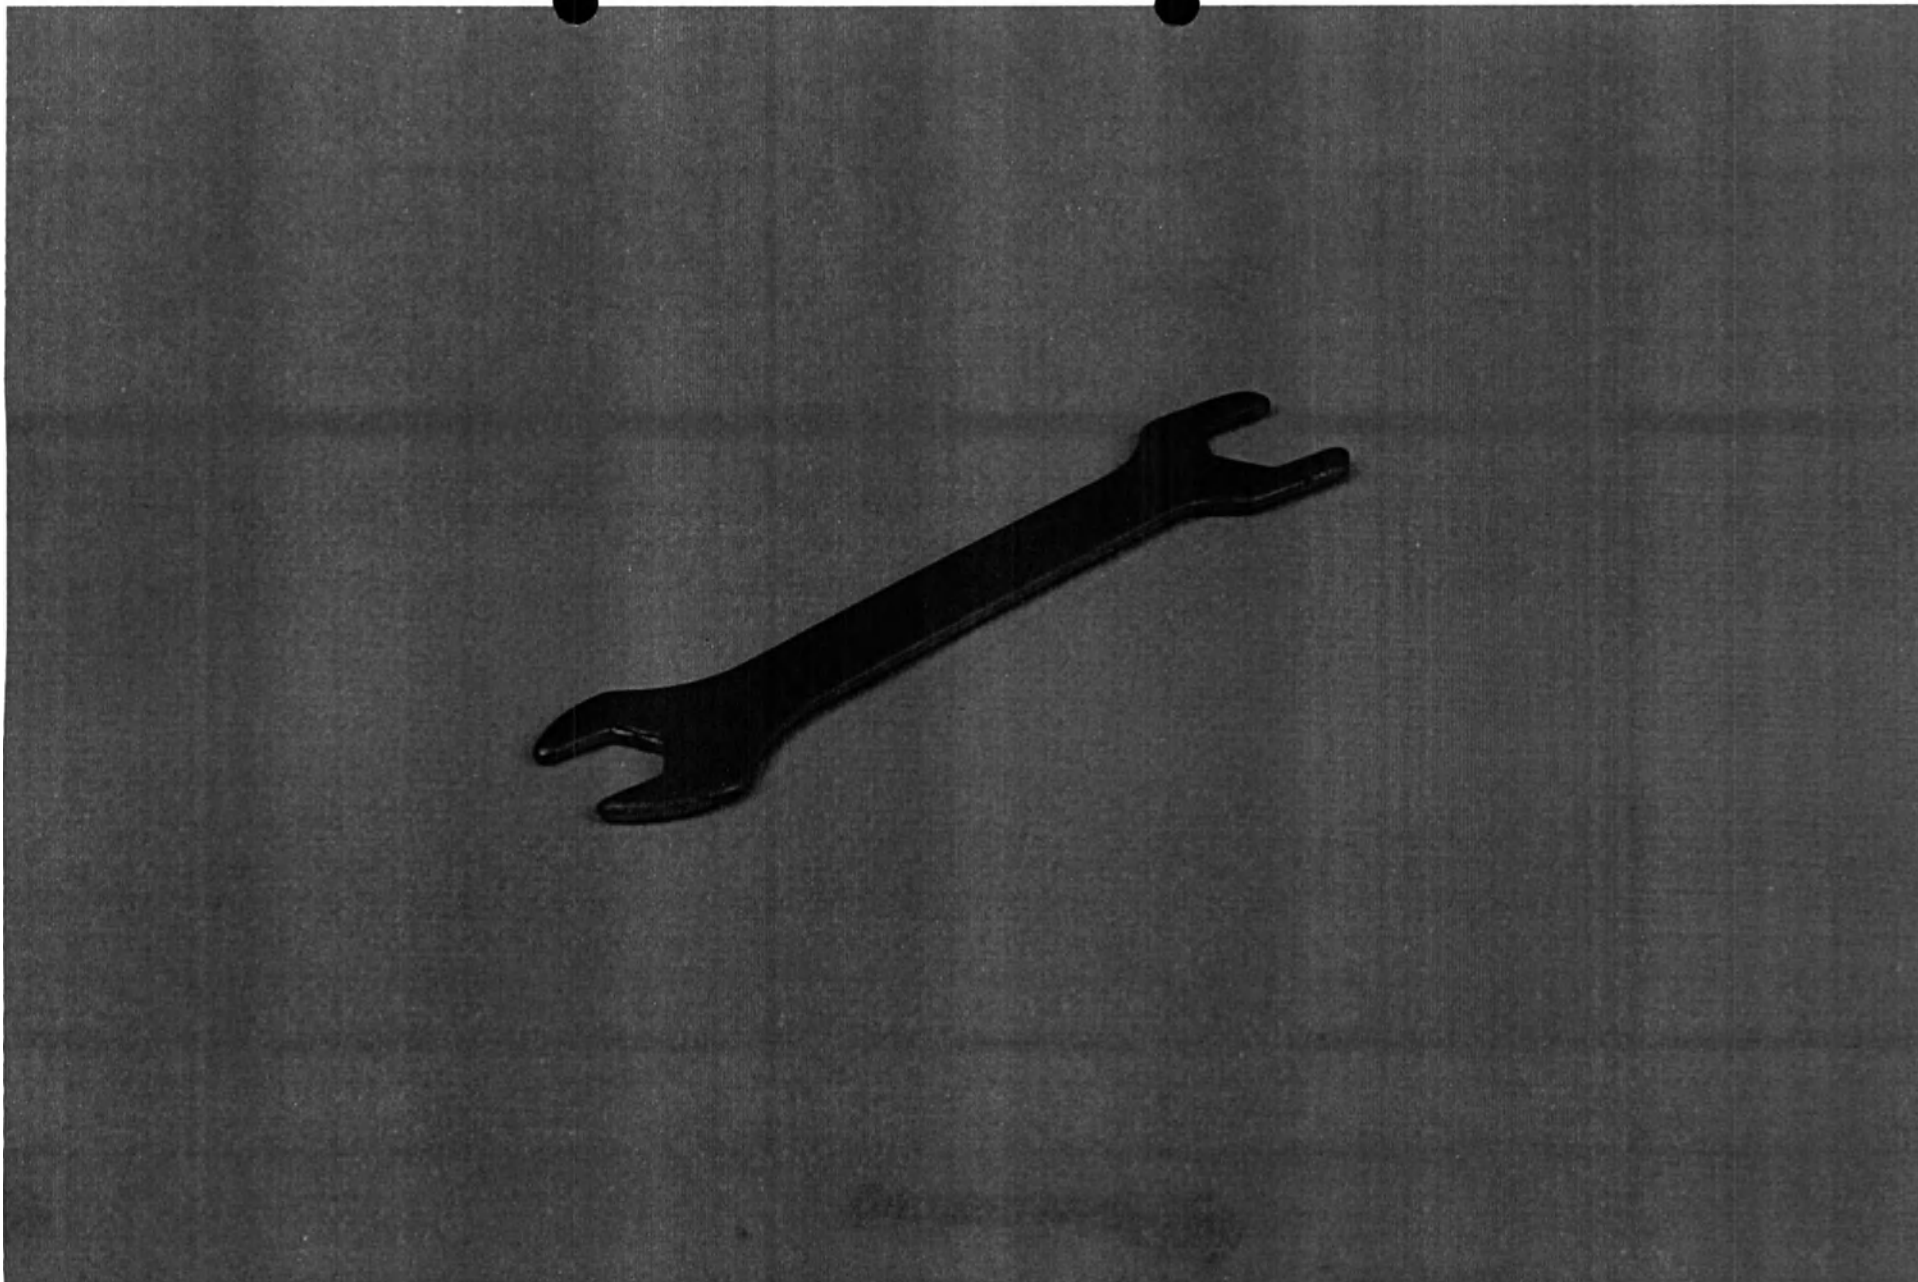

Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Принадлежности: ключ рожковый



Стол медицинский с электроприводом
СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021
с принадлежностями

Зав. № _____

Дата выпуска: _____. _____. 20____
220В±10%/50Гц
180Вт

Напряжение питания/частота
Потребляемая мощность не более
ТУ 32.50.30-008-01324118-2021

Рег. удостоверение: № _____ от _____ г.



ООО «ТАГЛЕР», Россия, 107076, г. Москва,
ул. Богородский вал, д.3, строение 29, эт.1,
пом. III, ком. 8,9



Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Маркировка на изделии



Стол медицинский с электроприводом
СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021
с принадлежностями

Зав. № _____

Дата выпуска: _____. _____. 20____

Комплект поставки:

1. Опора с колёсами и тормозами в сборе – 2 шт.
2. Основание стола с механизмом подъёма в сборе – 1 шт.
3. Столешница – 1 шт.
4. Ящик выдвижной в сборе – 1 шт.
5. Кабель электропитания – 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Принадлежности:

1. Болт (Ø8, L=65 мм) крепления опоры с шайбой и гайкой – 4 шт.
2. Болт (Ø8, L=20 мм) крепления столешницы с шайбой – 4 шт.
3. Ключ шестигранный – 1 шт.
4. Ключ рожковый – 1 шт.

Условия хранения и эксплуатации: +5° до +40°, относительная влажность 80% относительная влажность – 80 % при температуре 25°C, атмосферное давление 70 – 106 кПа.

ТУ 32.50.30-008-01324118-2021

Рег. удостоверение: № _____ от _____ г.



ООО «ТАГЛЕР», Россия, 107076, г. Москва,
ул. Богородский вал, д.3, строение 29, эт.1,
пом. III, ком. 8,9




Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Маркировка на потребительской упаковке




Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Общий вид




Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Опора с регулируемыми ножками

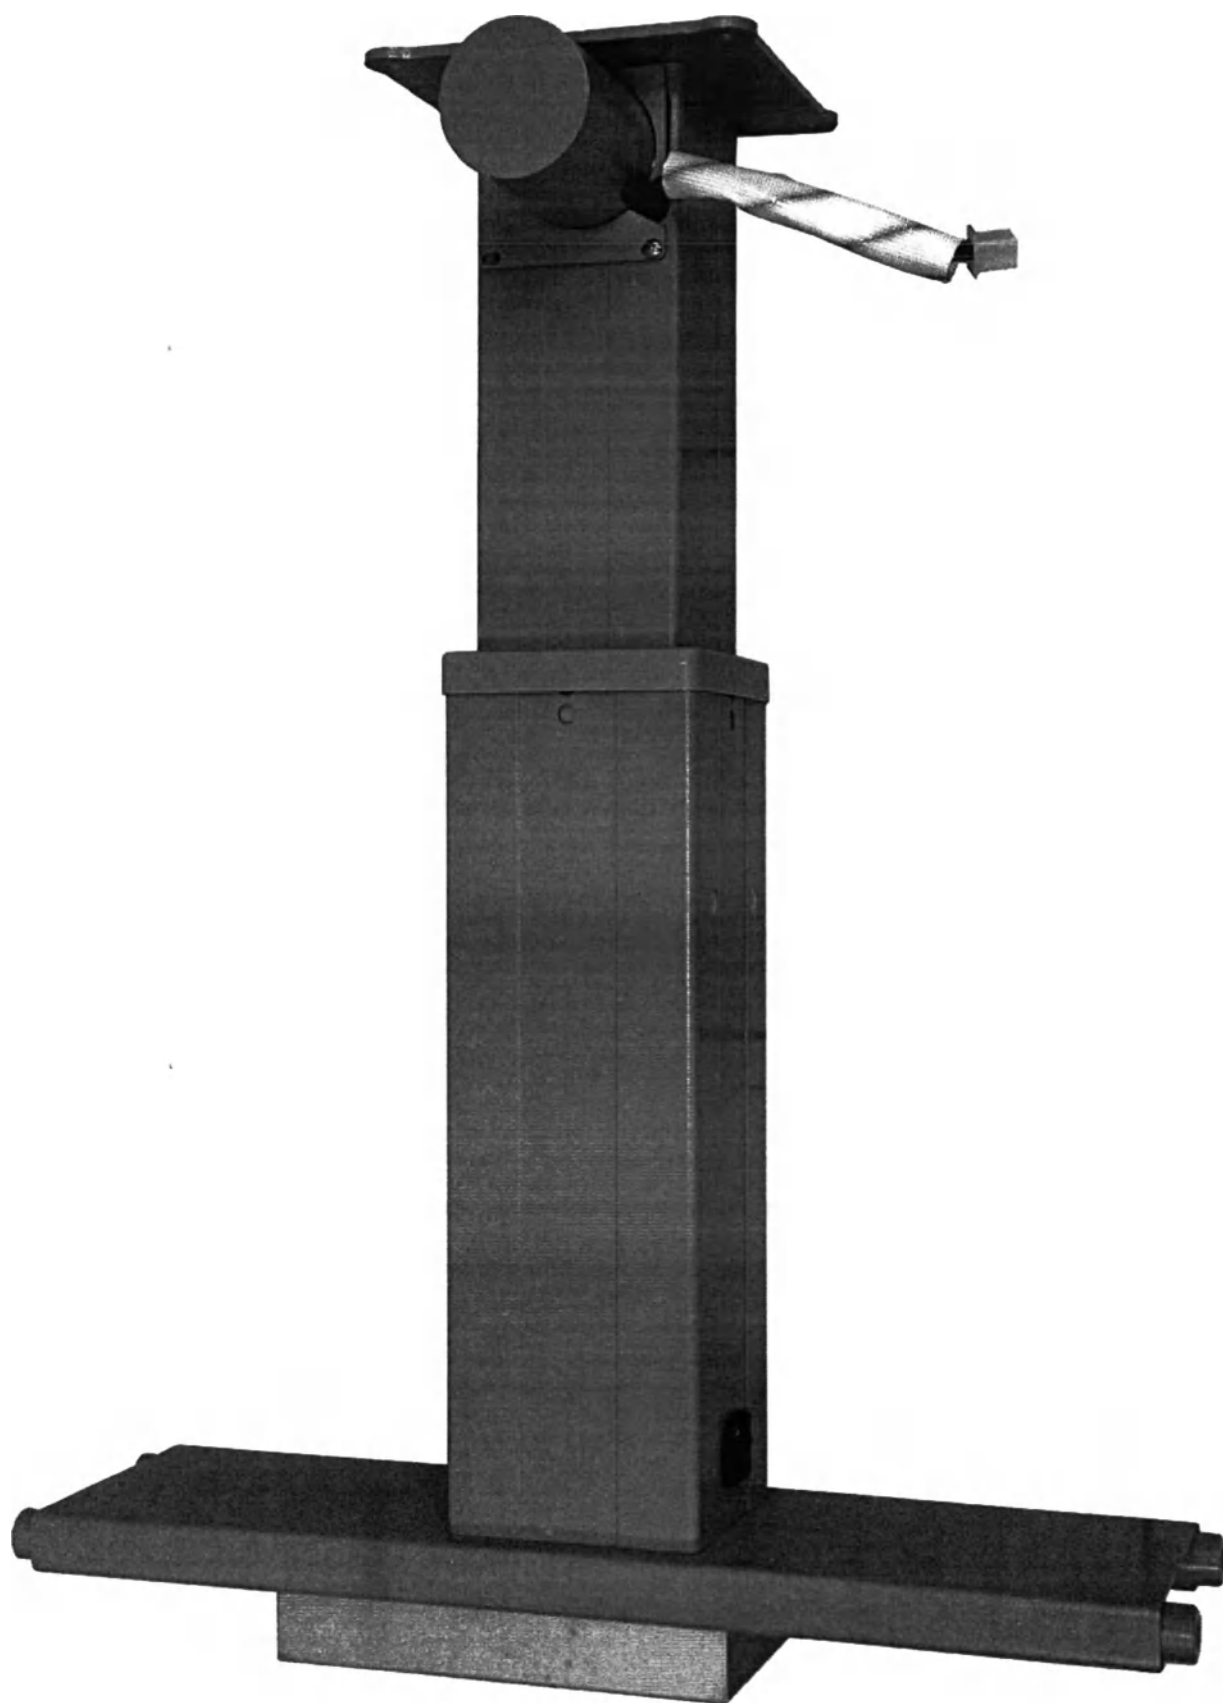


Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Основание стола с механизмом подъёма в сборе

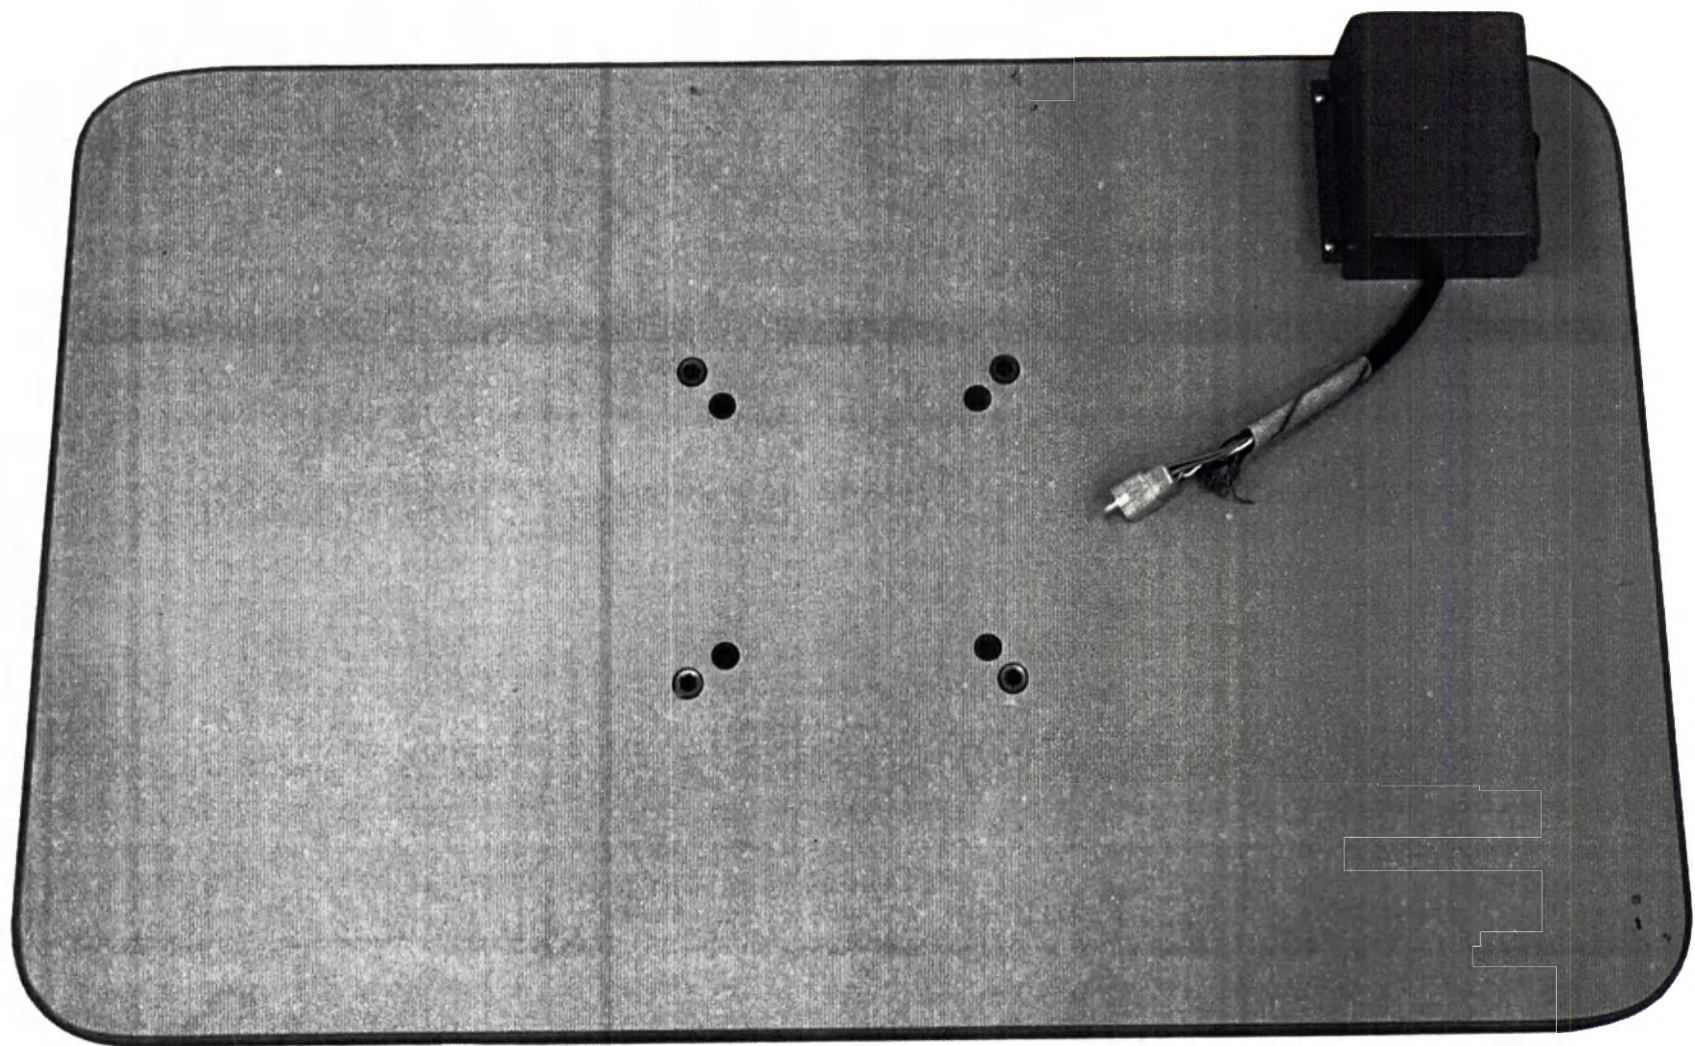


Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями Столешница (вид снизу)

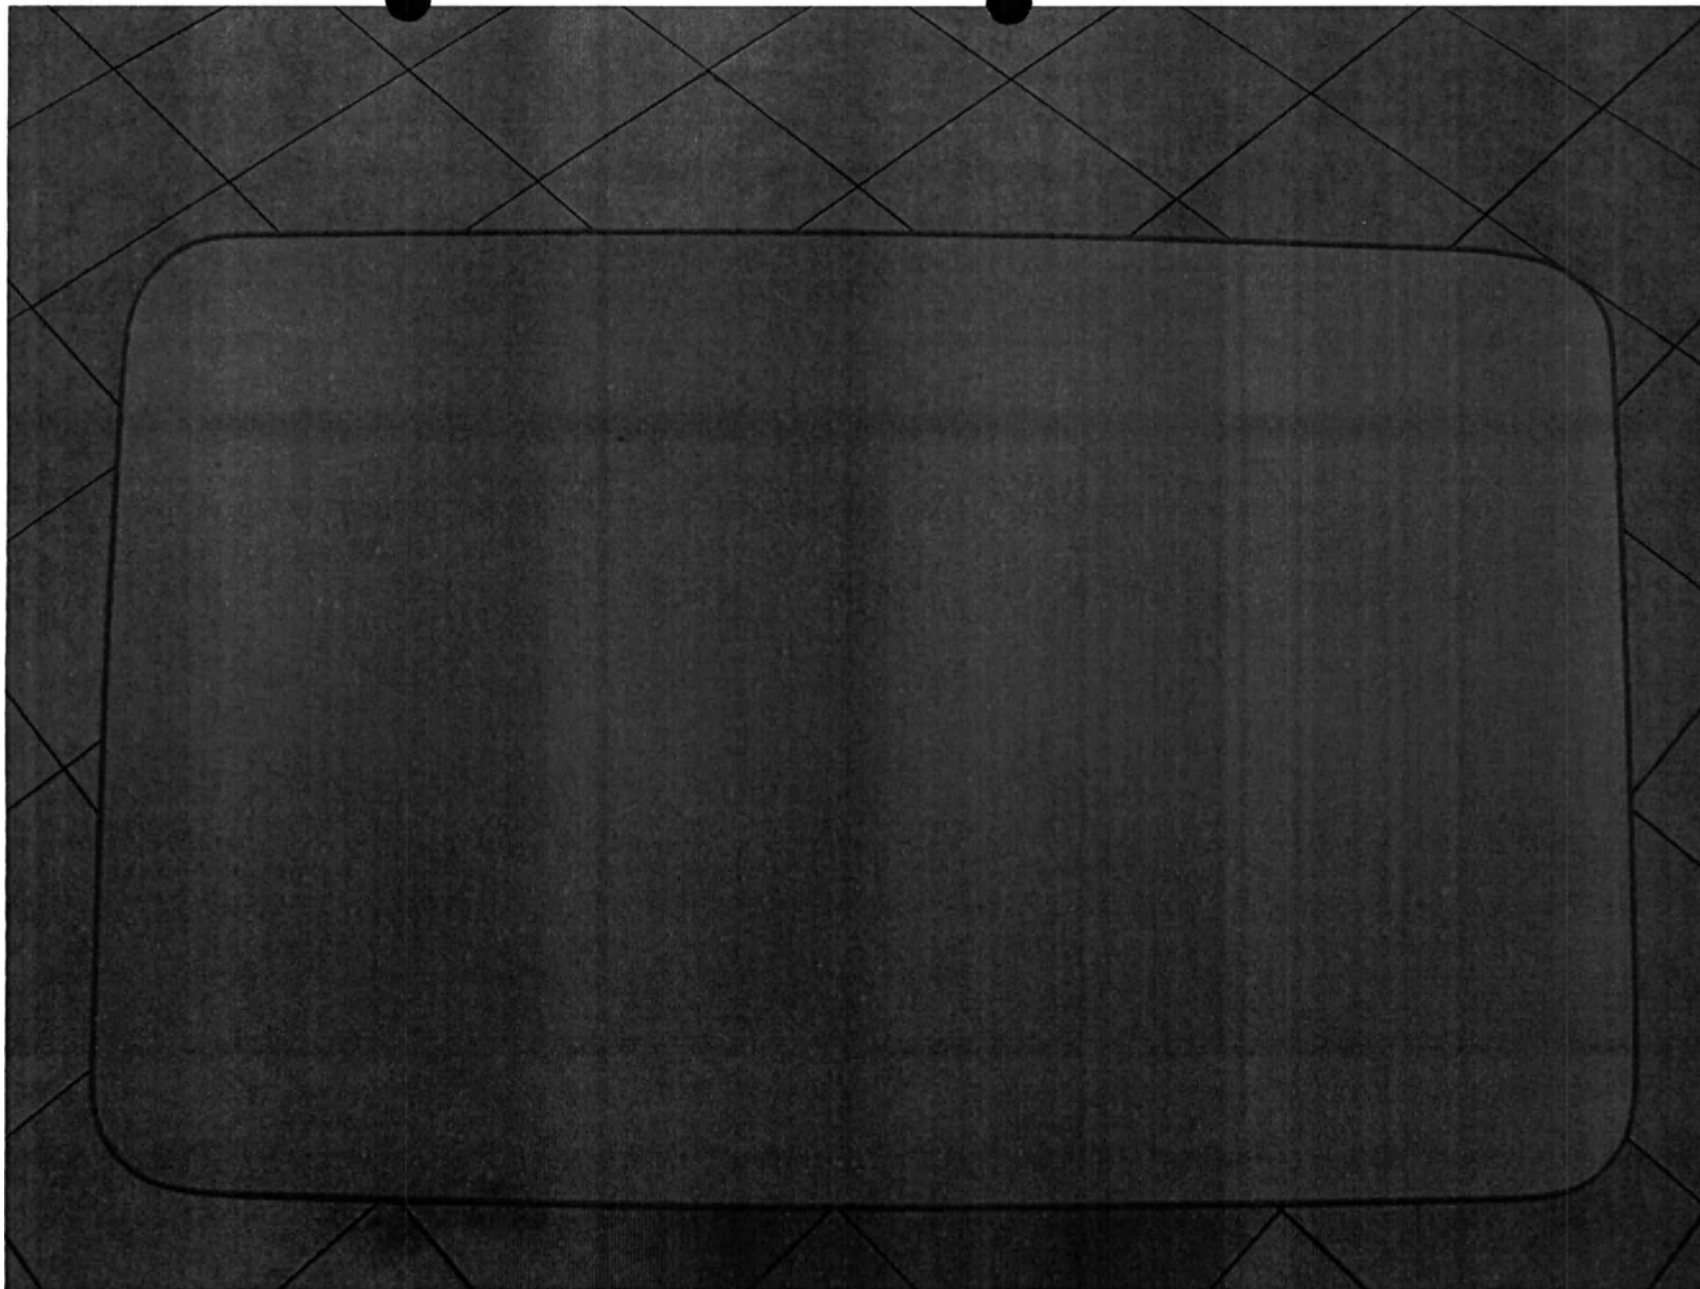


Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями Столешница (вид сверху)

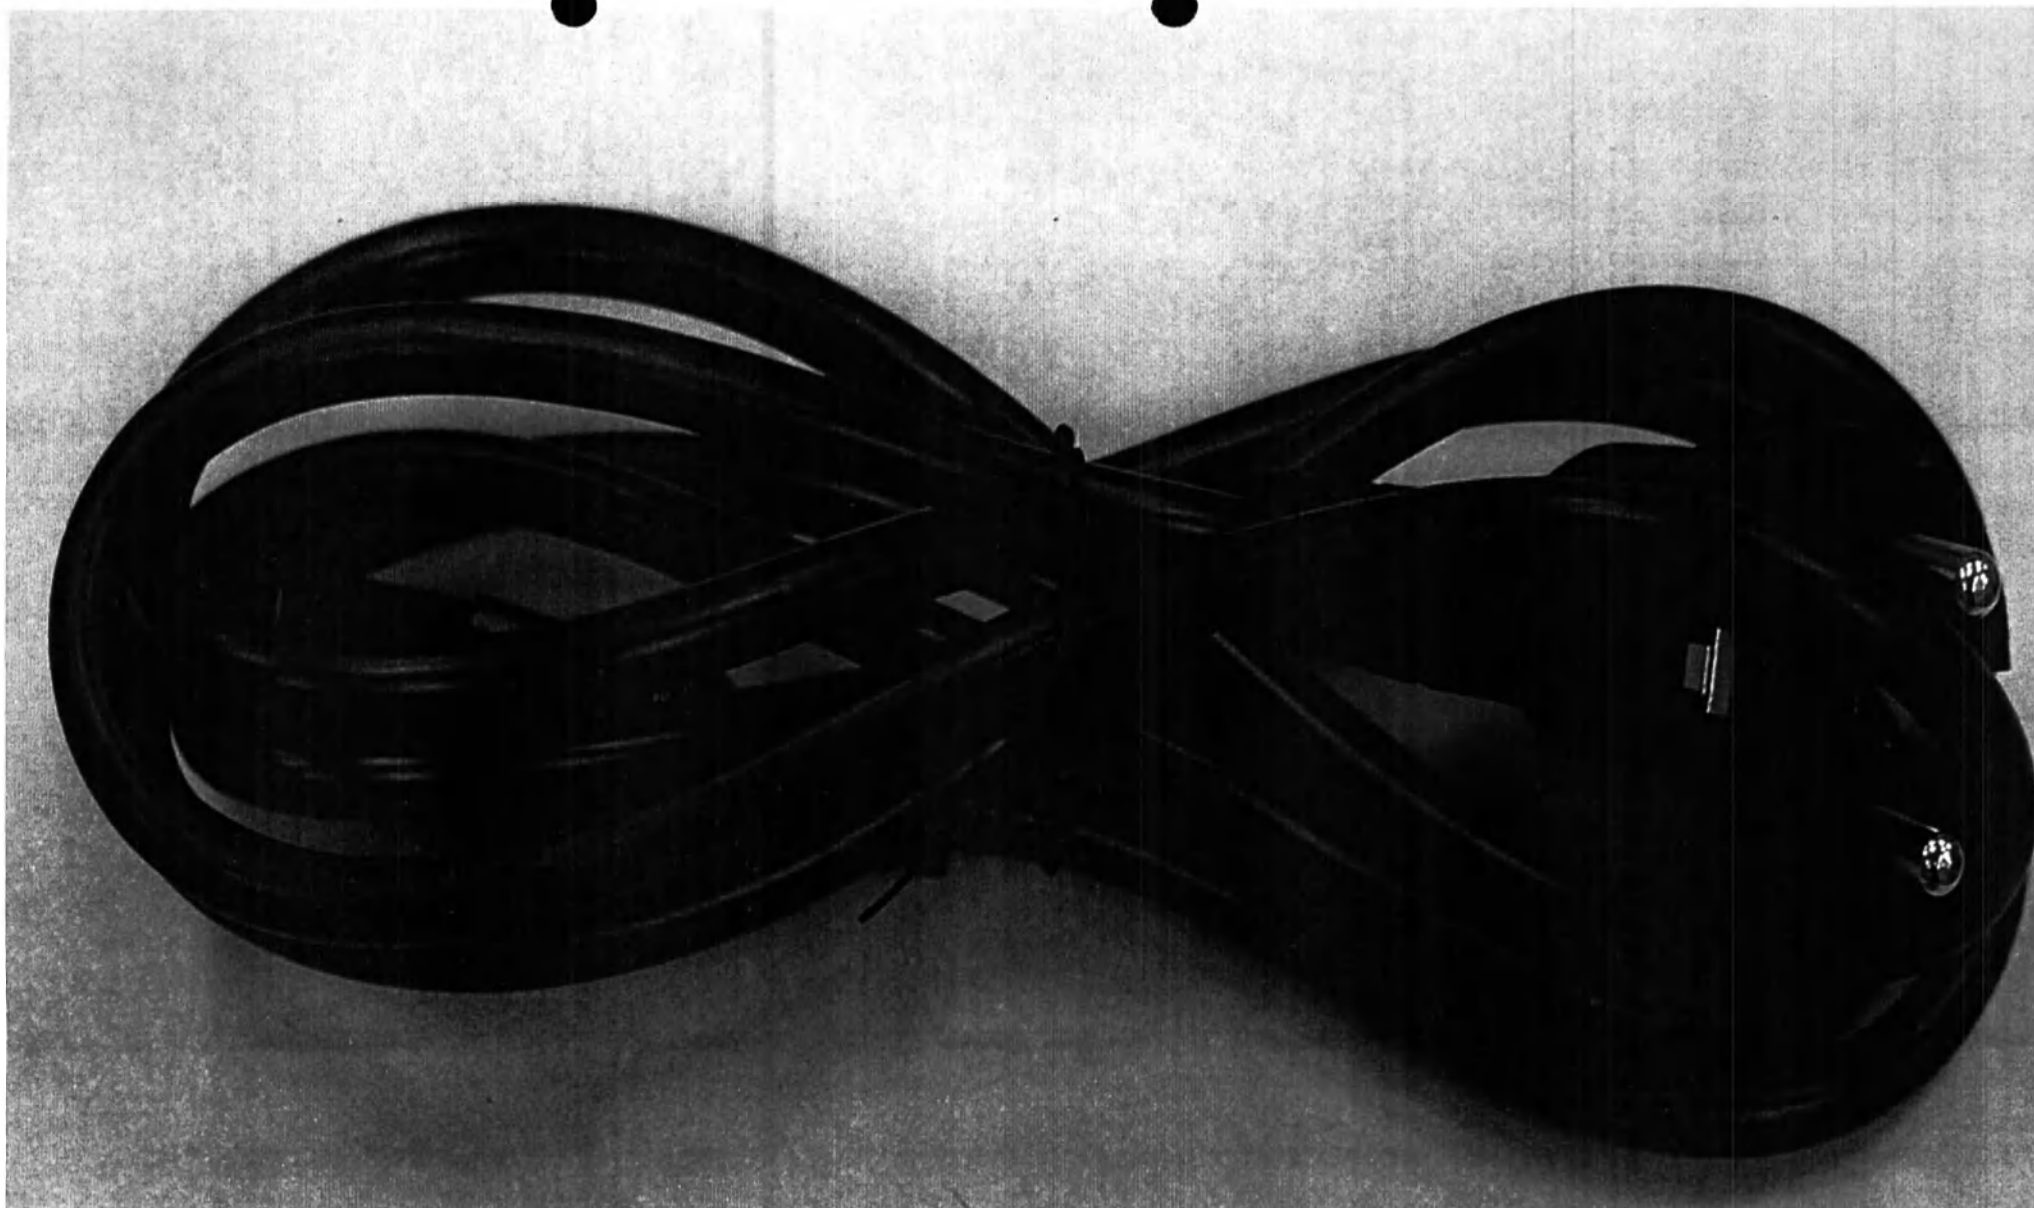


Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Кабель электропитания

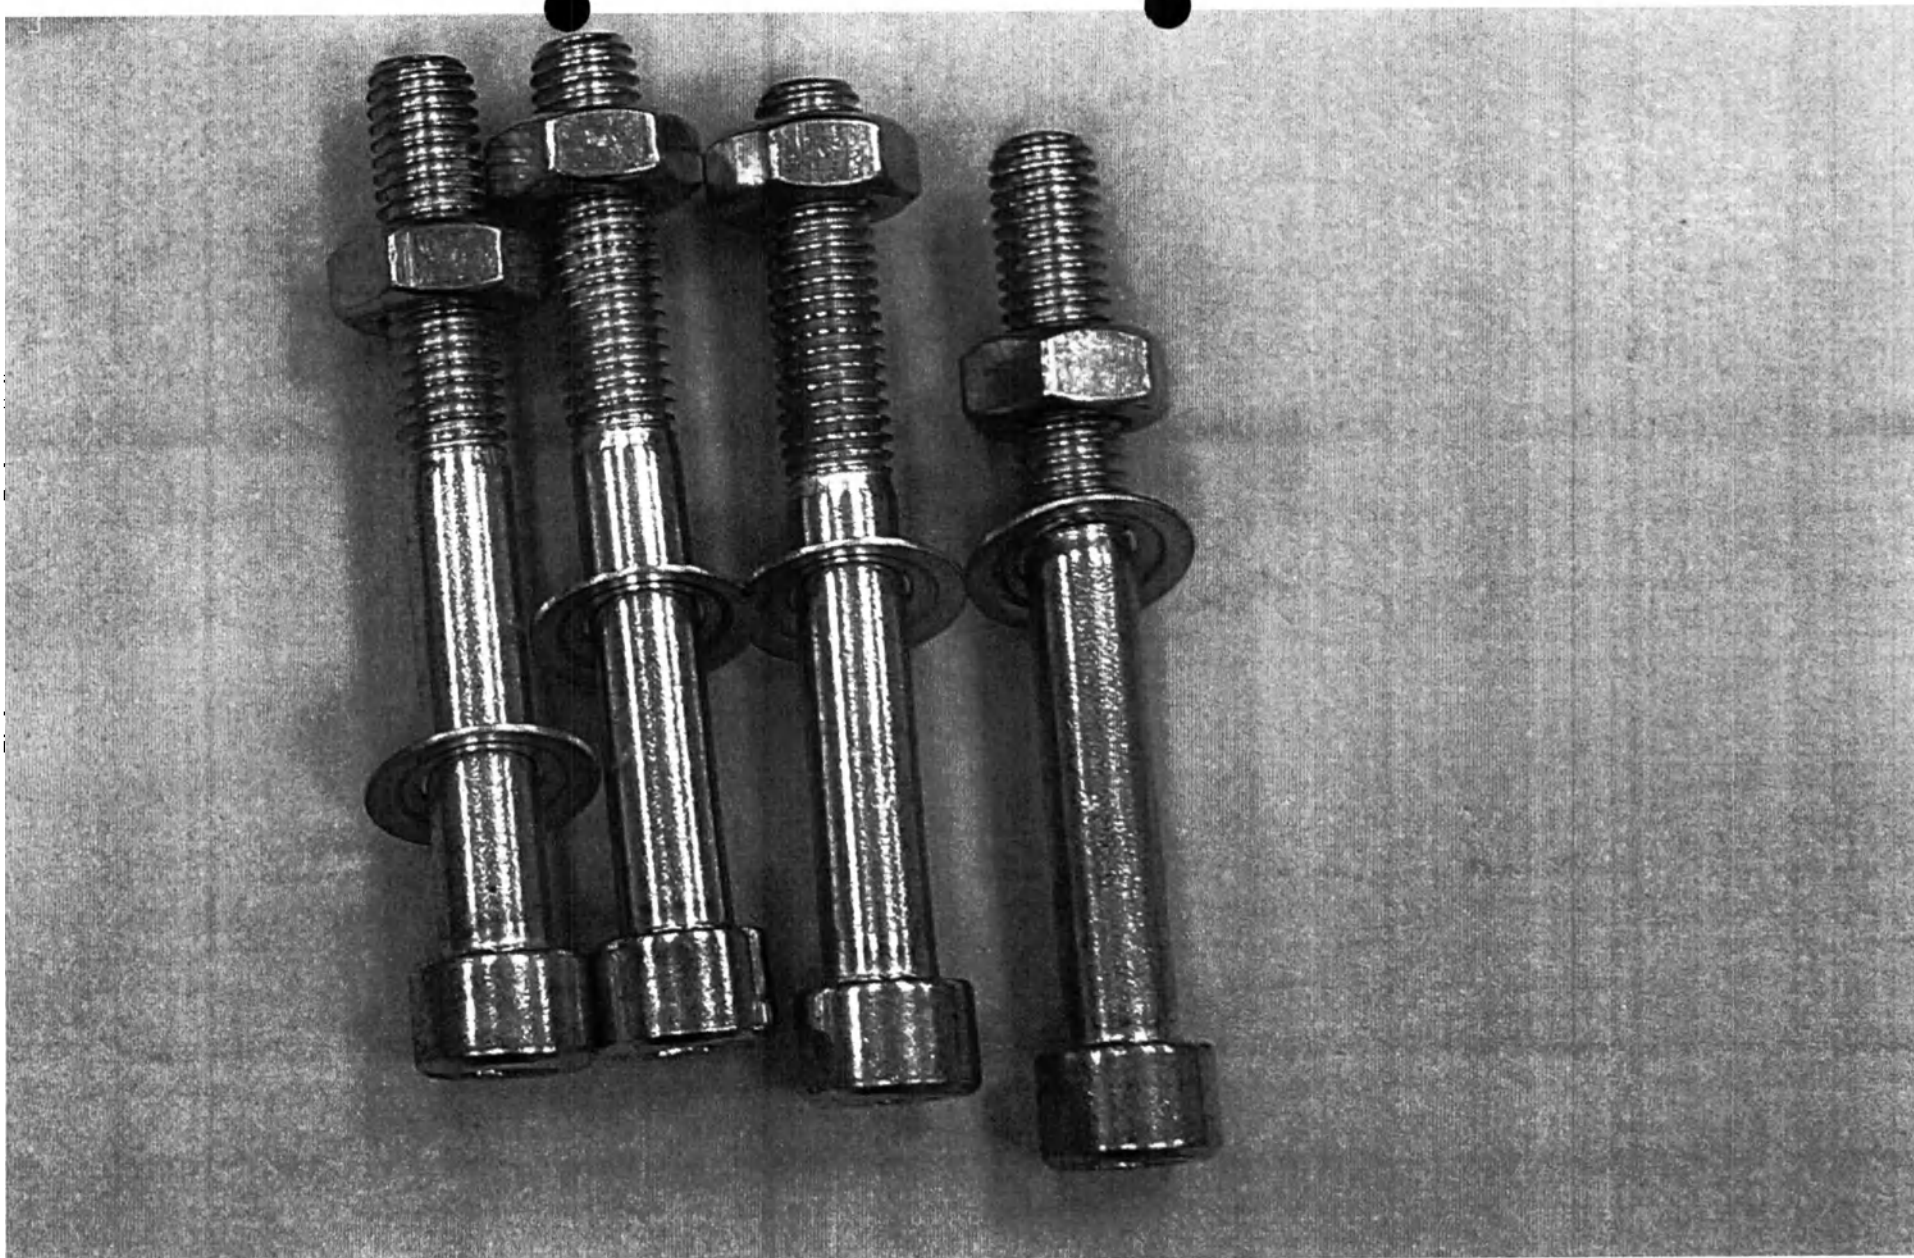


Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Принадлежности: болт (Ø8, L=65 мм) крепления опоры с шайбой и гайкой

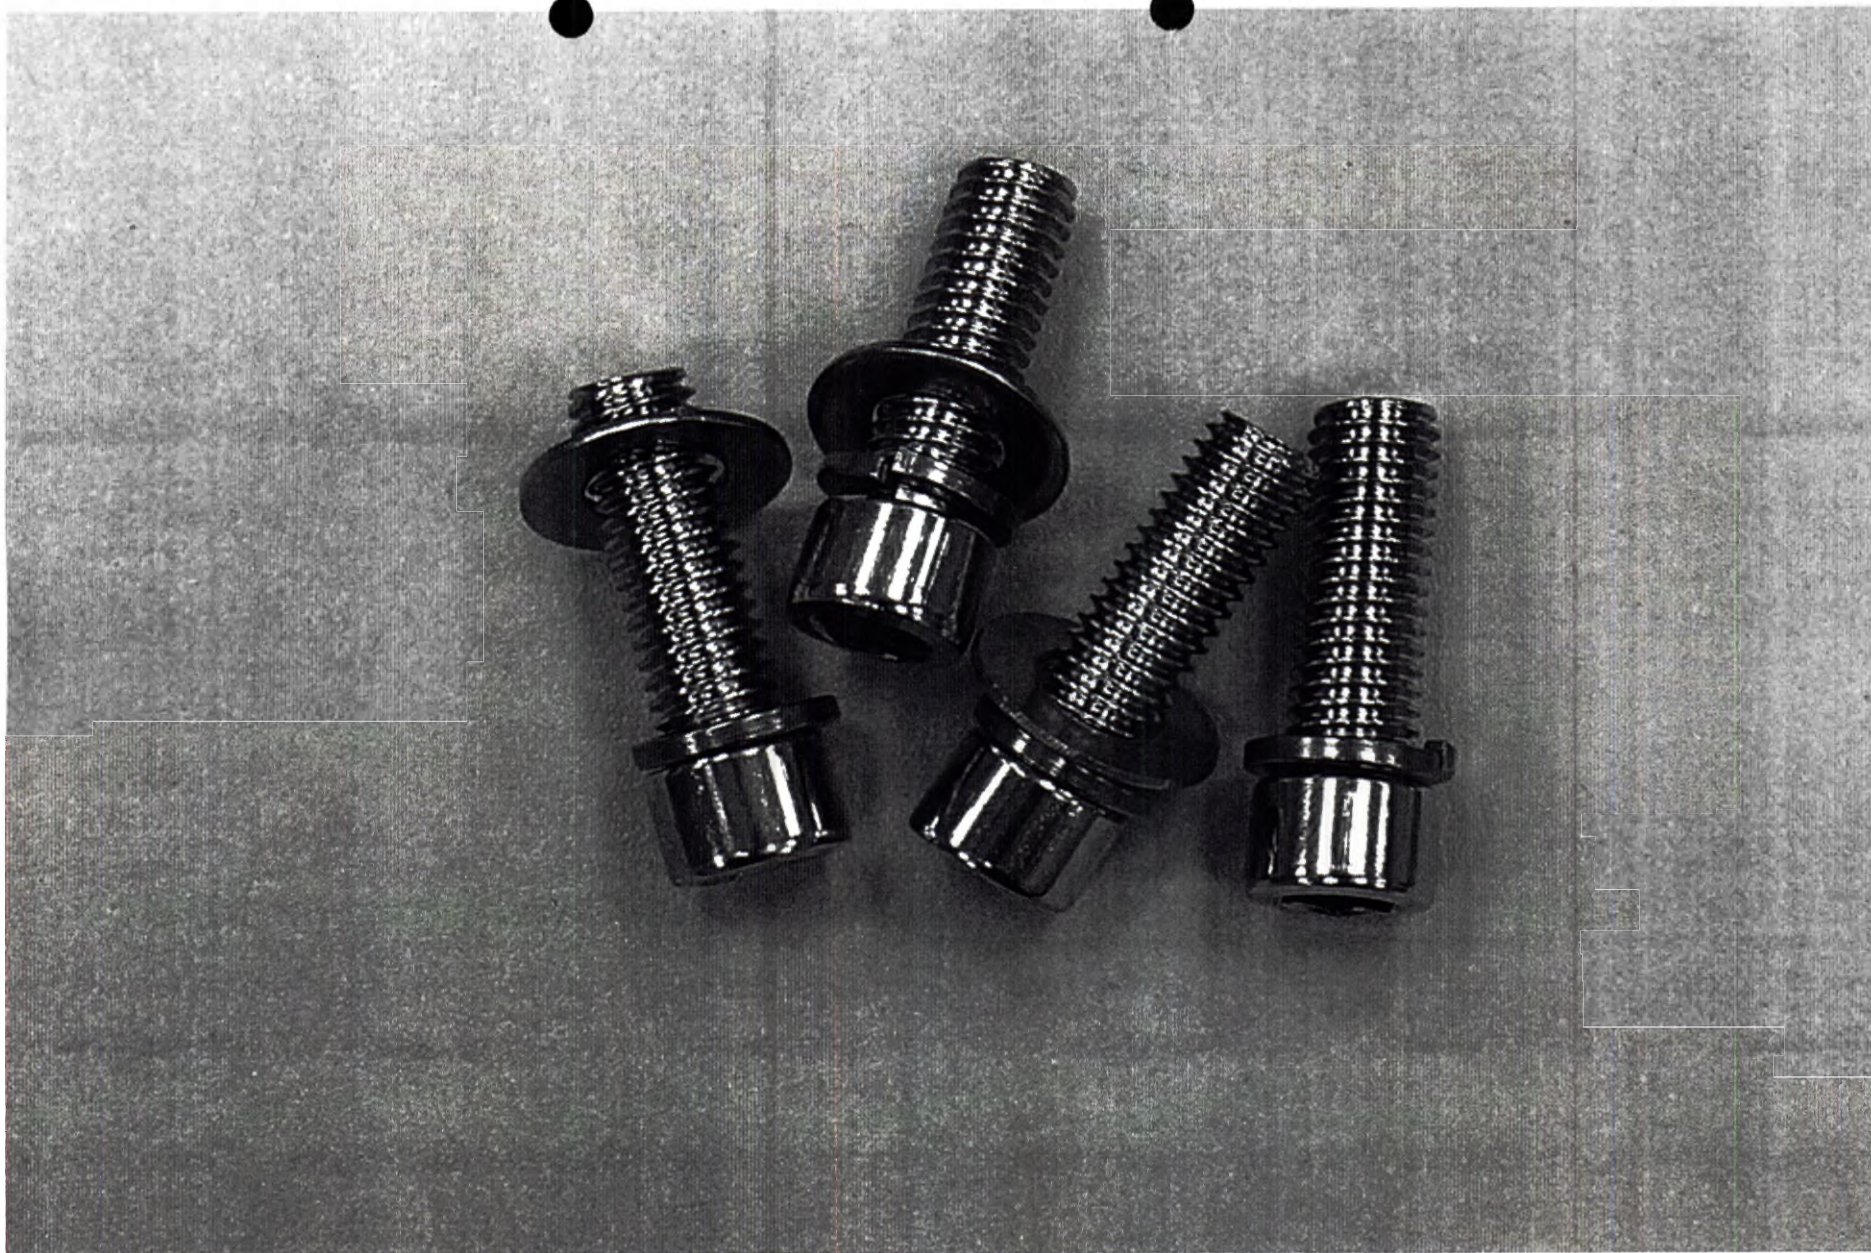

Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Принадлежности: болт (Ø8, L=24 мм) крепления столешницы с шайбой и гайкой

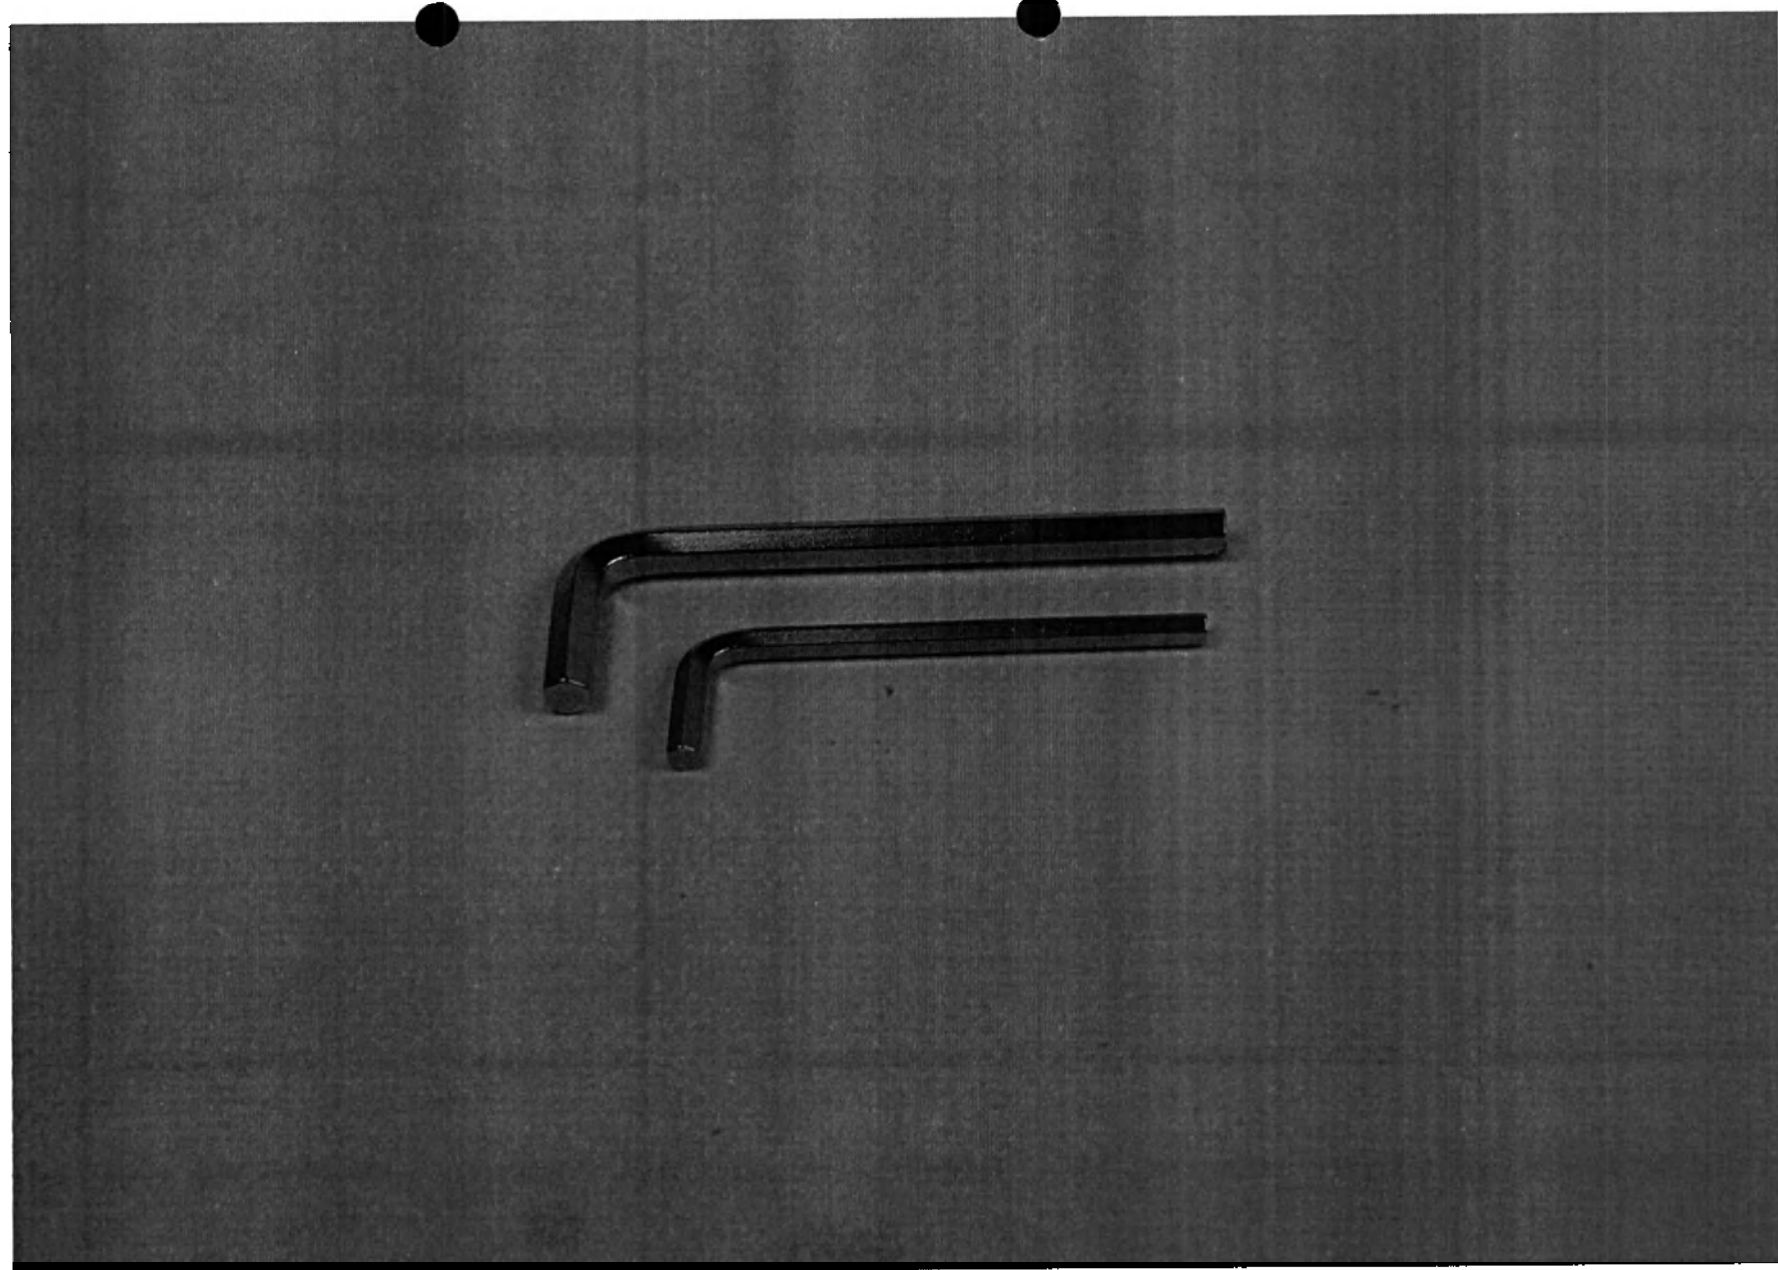

Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Принадлежности: набор ключей шестигранных

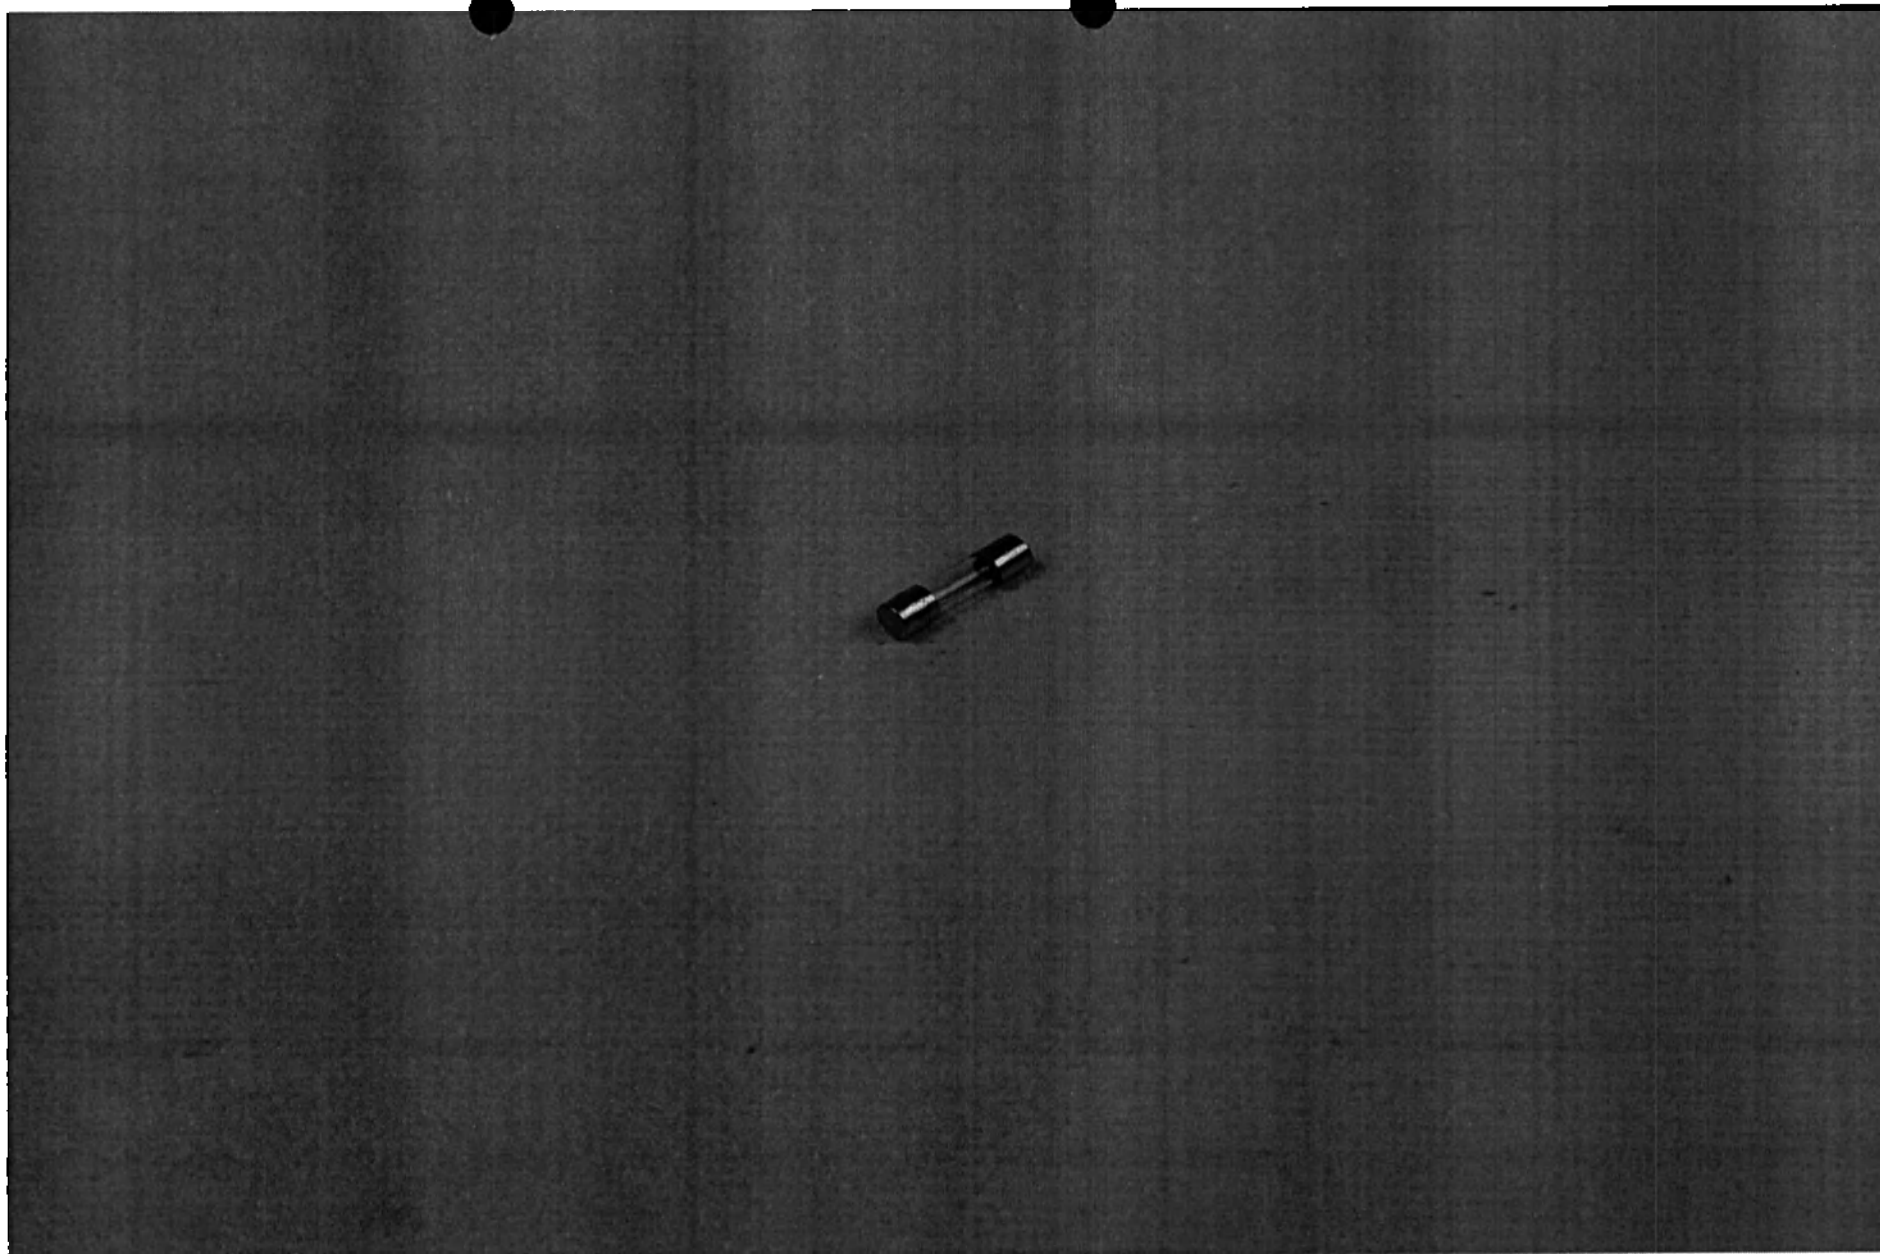

Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Принадлежности: предохранитель запасной F8AL250V (Ø5 x 20 мм, 8 А, 250 В)



Стол медицинский с электроприводом
СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021
с принадлежностями

Зав. № _____

Дата выпуска: ____ . ____ . 20 ____

Напряжение питания/частота

220В±10%/50Гц

Потребляемая мощность не более

120Вт

ТУ 32.50.30-008-01324118-2021

Рег. удостоверение: № _____

от _____

г. _____



ООО «ТАГЛЕР», Россия, 107076, г. Москва,
ул. Богородский вал, д.3, строение 29, эт.1,
пом. III, ком. 8,9



Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Маркировка на изделии



**Стол медицинский с электроприводом
СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021
с принадлежностями**

Зав. № _____

Дата выпуска: ____ . ____ . 20 ____

Комплект поставки:

1. Опора с регулируемыми ножками – 2 шт.
2. Основание стола с механизмом подъёма в сборе – 1 шт.
3. Столешница – 1 шт.
4. Кабель электропитания – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Принадлежности:

1. Болт (Ø8, L=65 мм) крепления опоры с шайбой и гайкой – 4 шт.
2. Болт (Ø8, L=24 мм) крепления столешницы с шайбой и гайкой – 4 шт.
3. Набор ключей шестигранных – 1 шт.
4. Предохранитель запасной F8AL250V (Ø5 x 20 мм, 8 А, 250 В) – 2 шт.

Условия хранения и эксплуатации: +5° до +40°, относительная влажность 80% относительная влажность – 80 % при температуре 25°С, атмосферное давление 70 – 106 кПа.

ТУ 32.50.30-008-01324118-2021

Рег. удостоверение: № _____ от _____ г.




ООО «ТАГЛЕР», Россия, 107076, г. Москва,
ул. Богородский вал, д.3, строение 29, эт.1,
пом. III, ком. 8,9




Стол медицинский с электроприводом СО-2 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Маркировка на потребительской упаковке




Стол медицинский с электроприводом CO-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Общий вид в сборе.

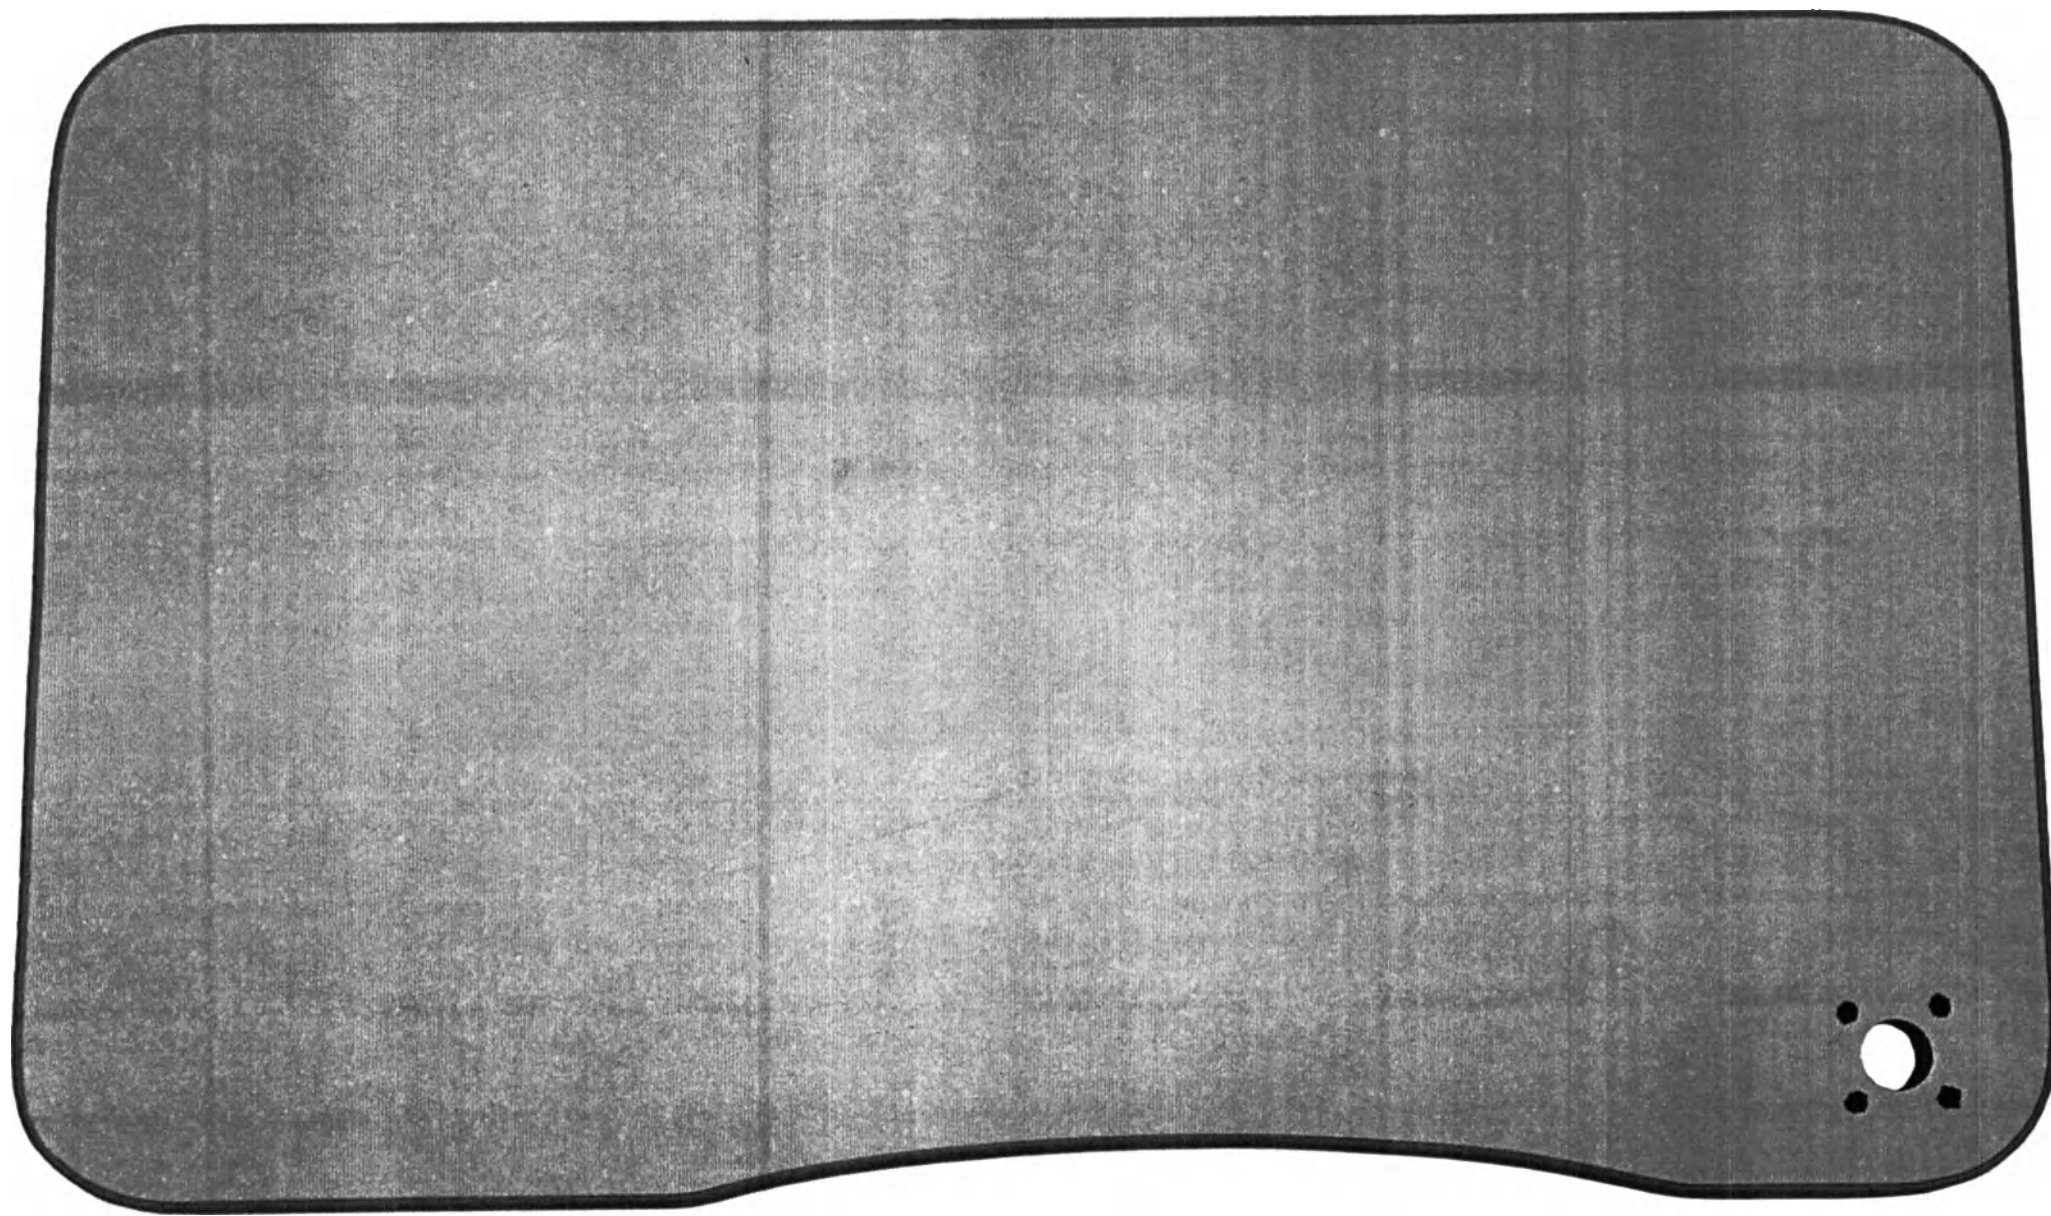


Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Столешница (вид сверху)

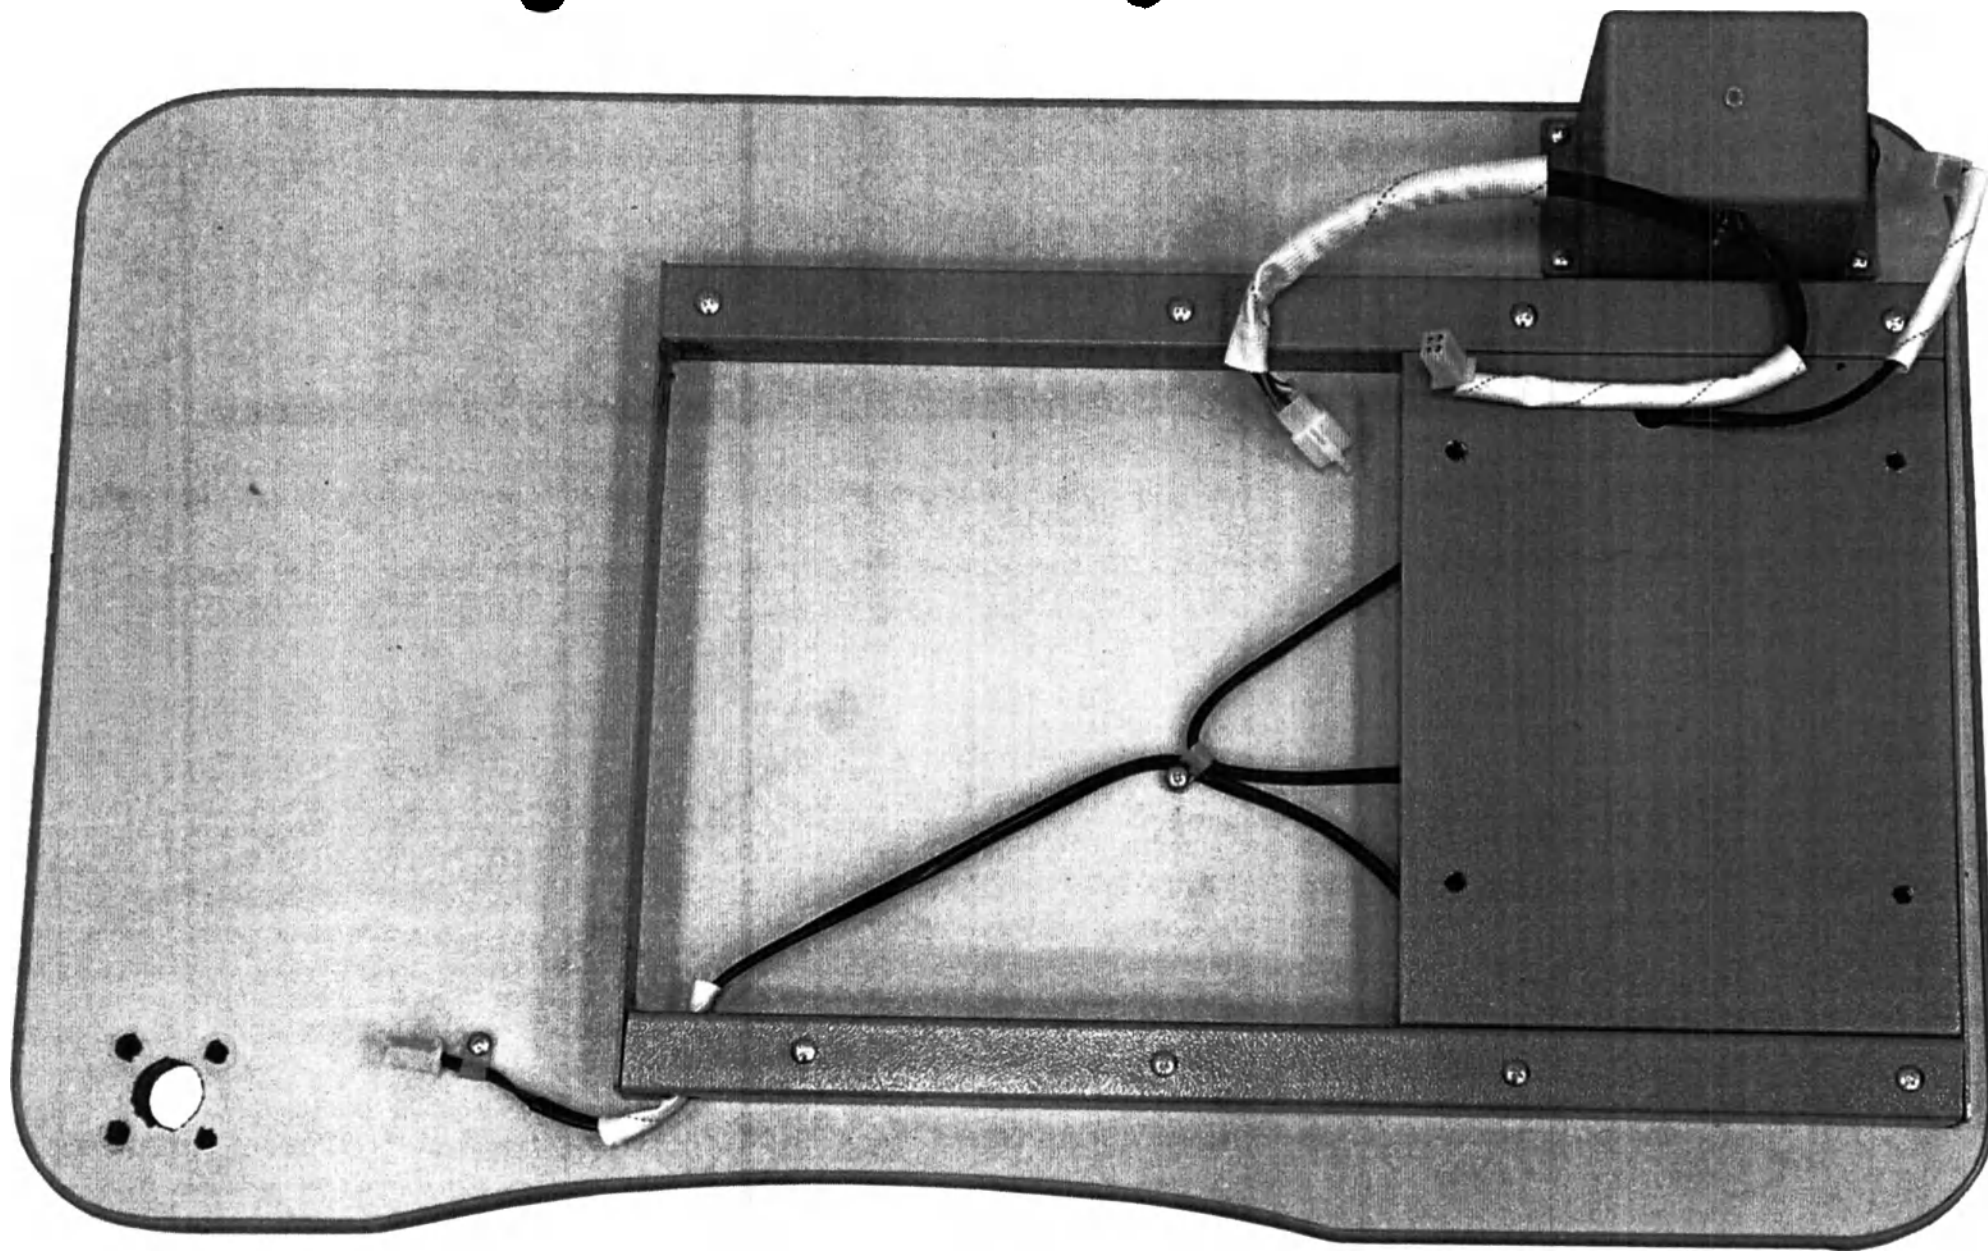


Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Столешница (вид снизу)

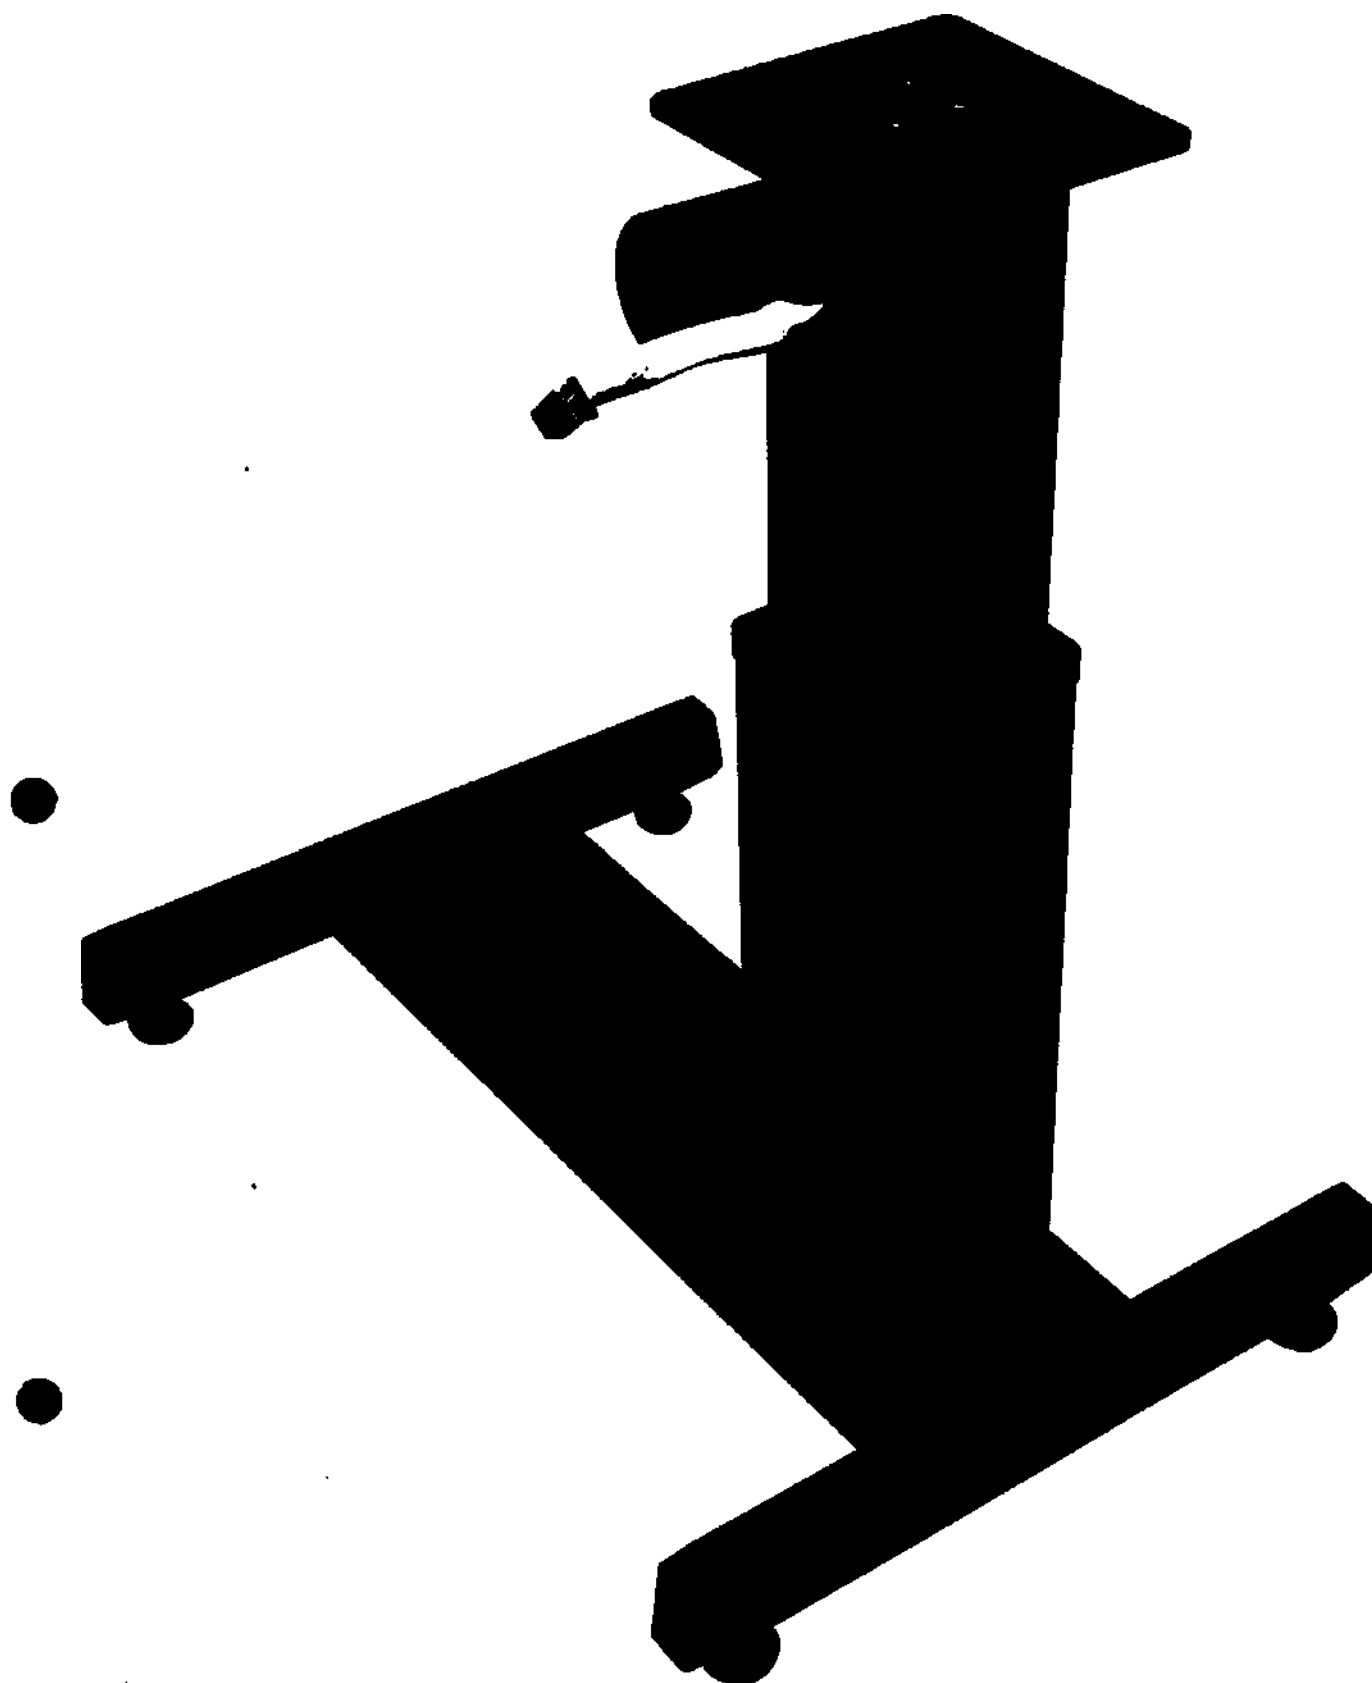

Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021с принадлежностями. Основание стола с механизмом подъема в сборе

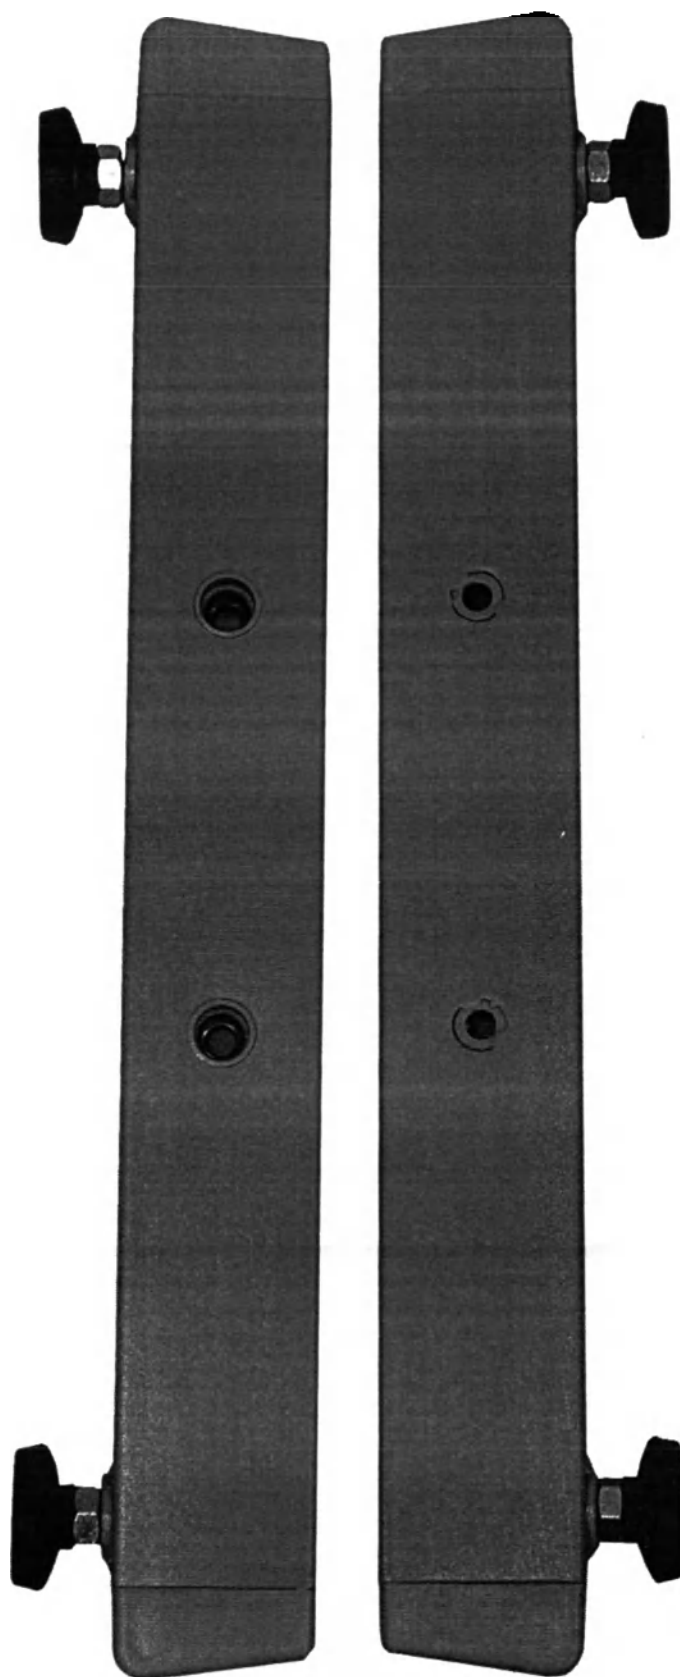


Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Опора с регулирующими ножками

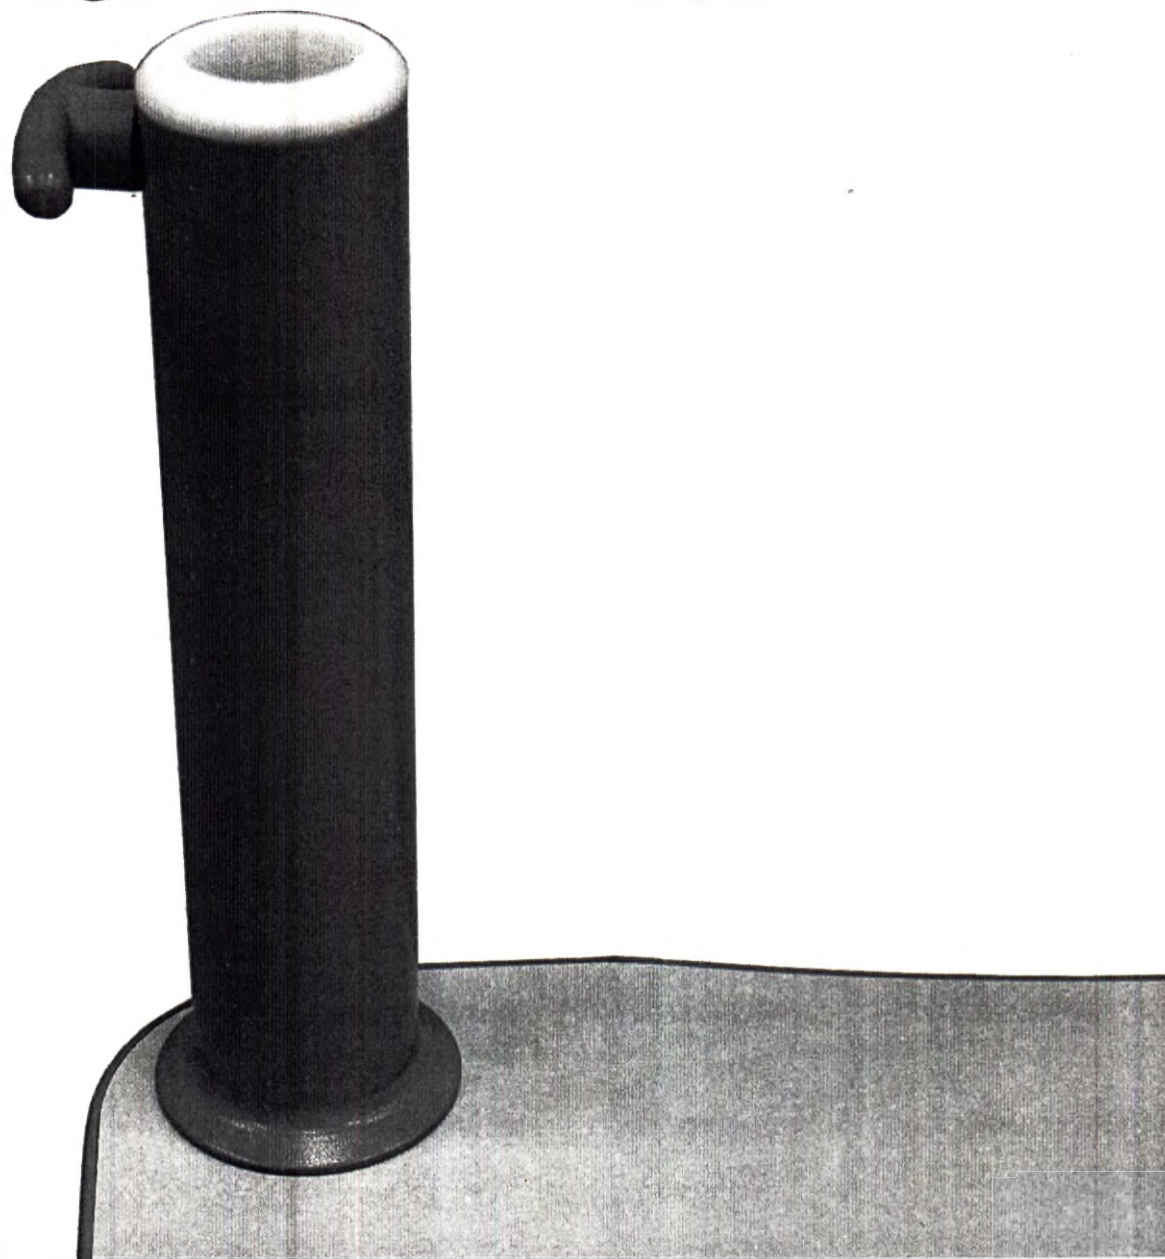

Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Трубка основание




Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Электrolампа освещения поворотная с кронштейном для фороптера

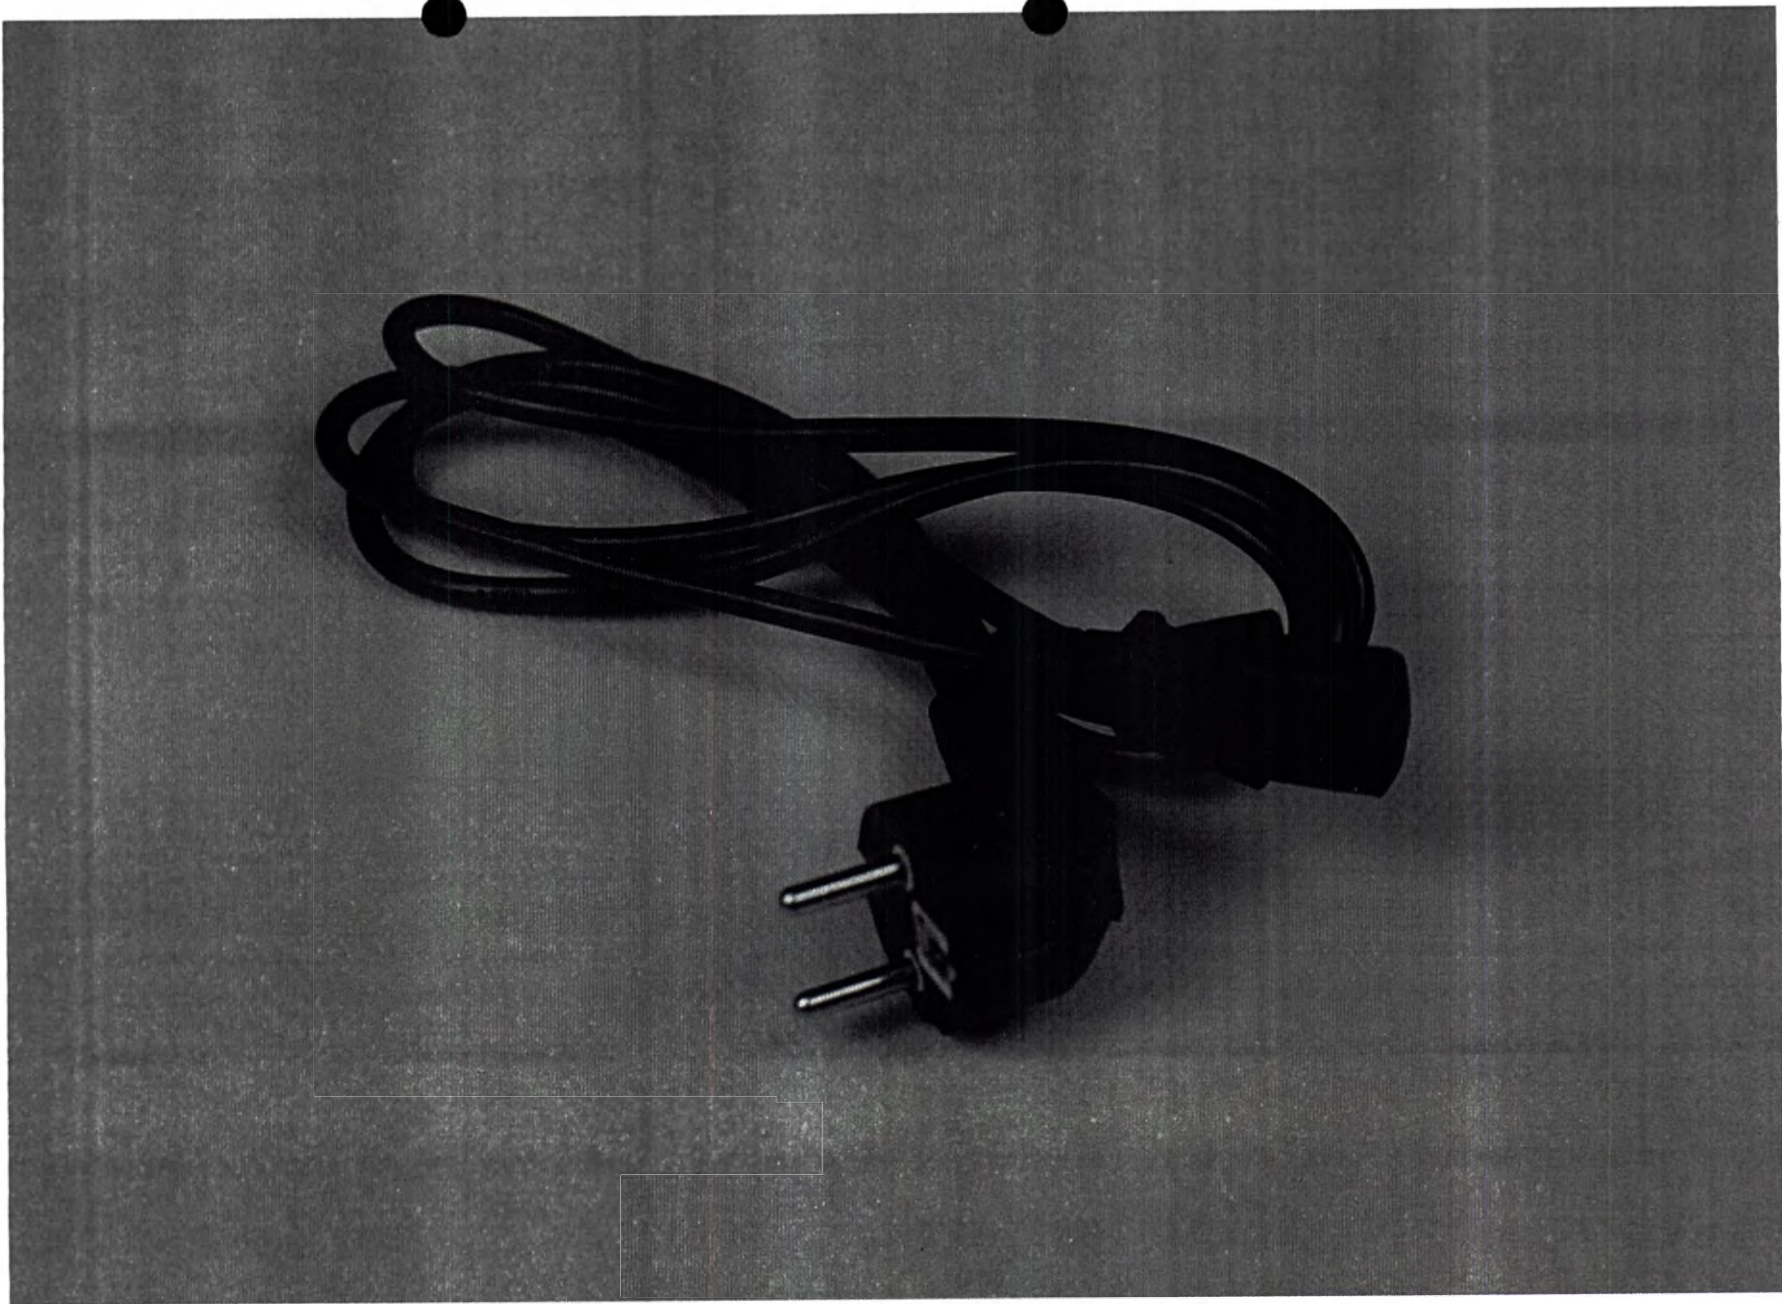


Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Кабель электропитания




Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Принадлежности: болт (Ø8, L=20) крепления опоры и столешницы к основанию стола

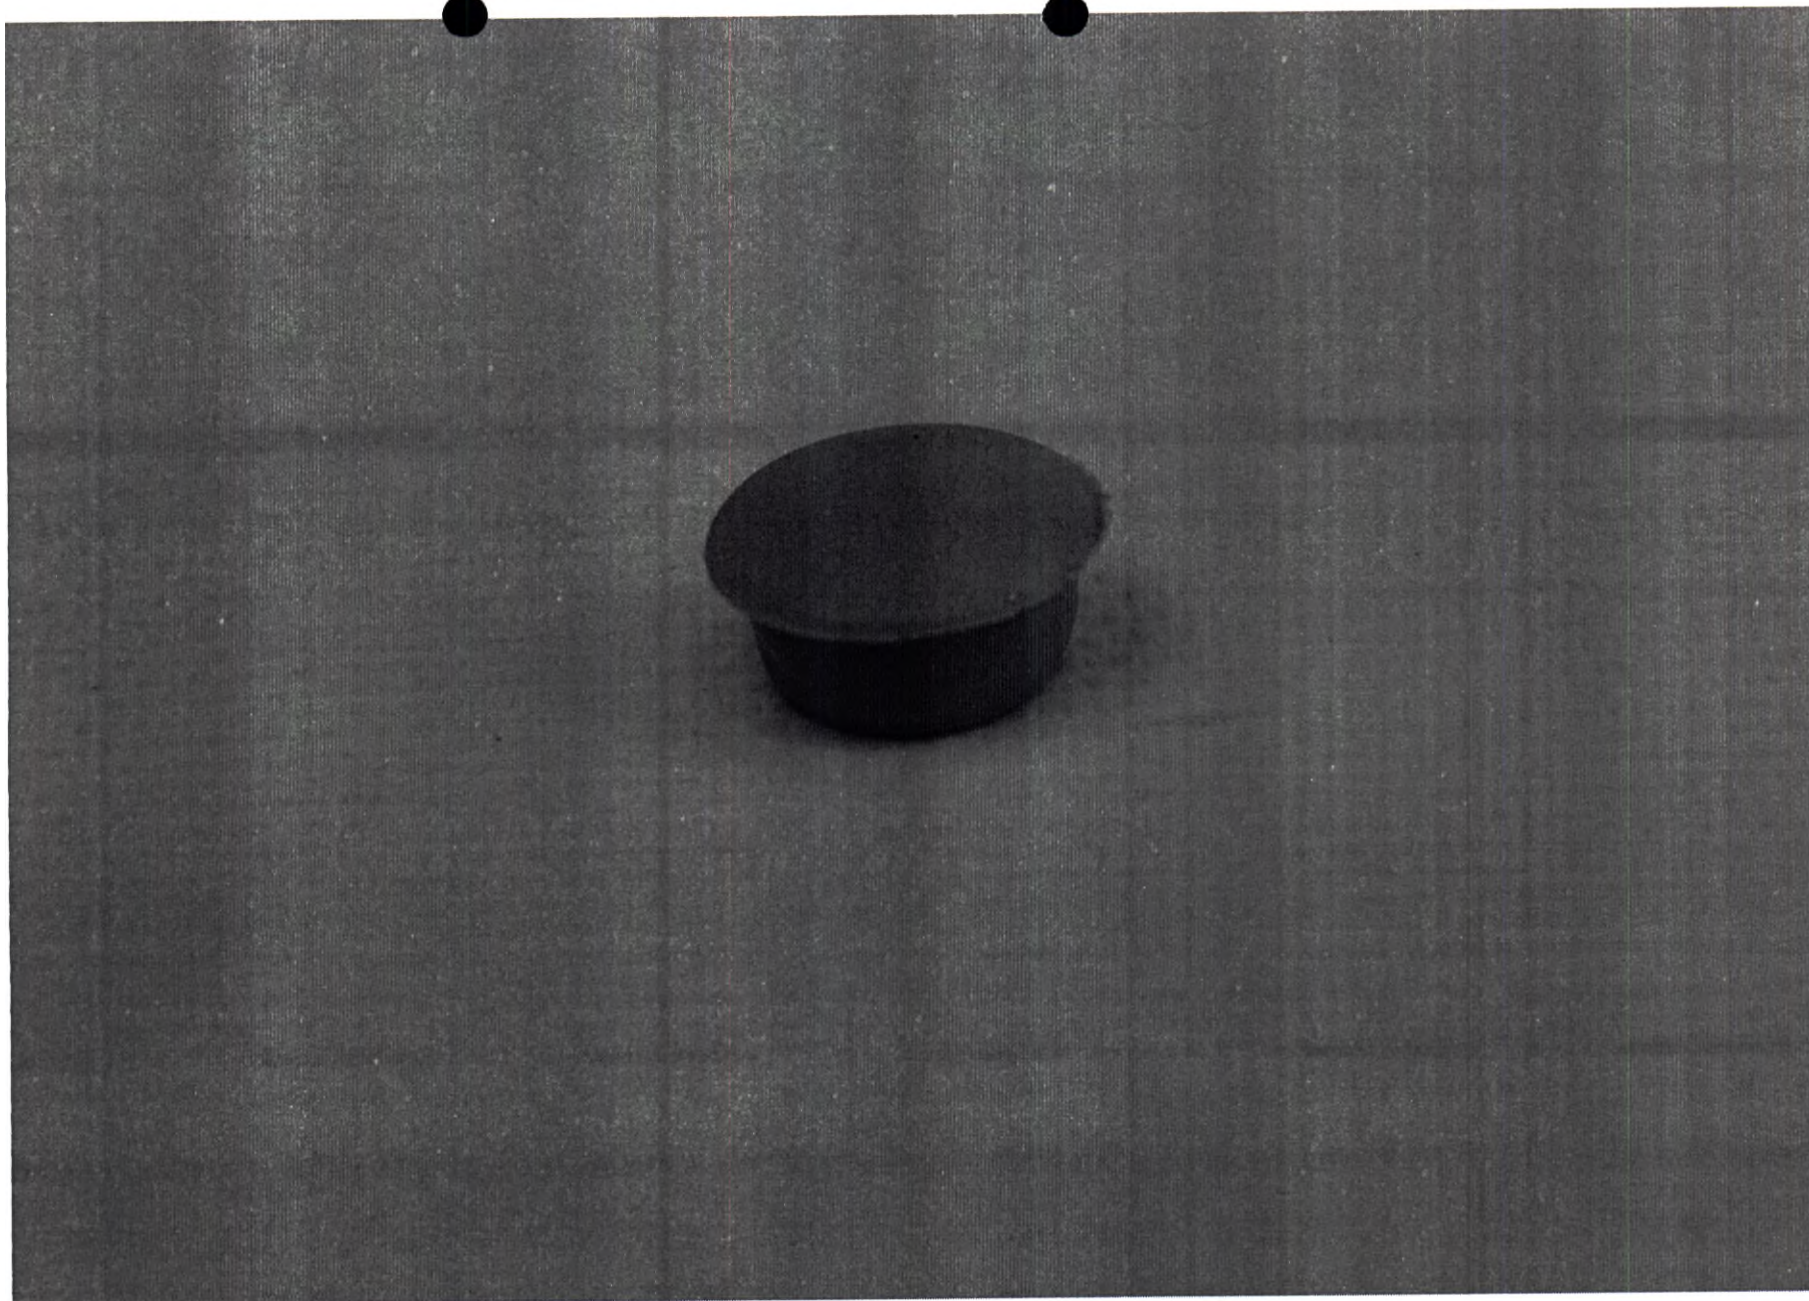


Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Принадлежности: заглушки резиновые

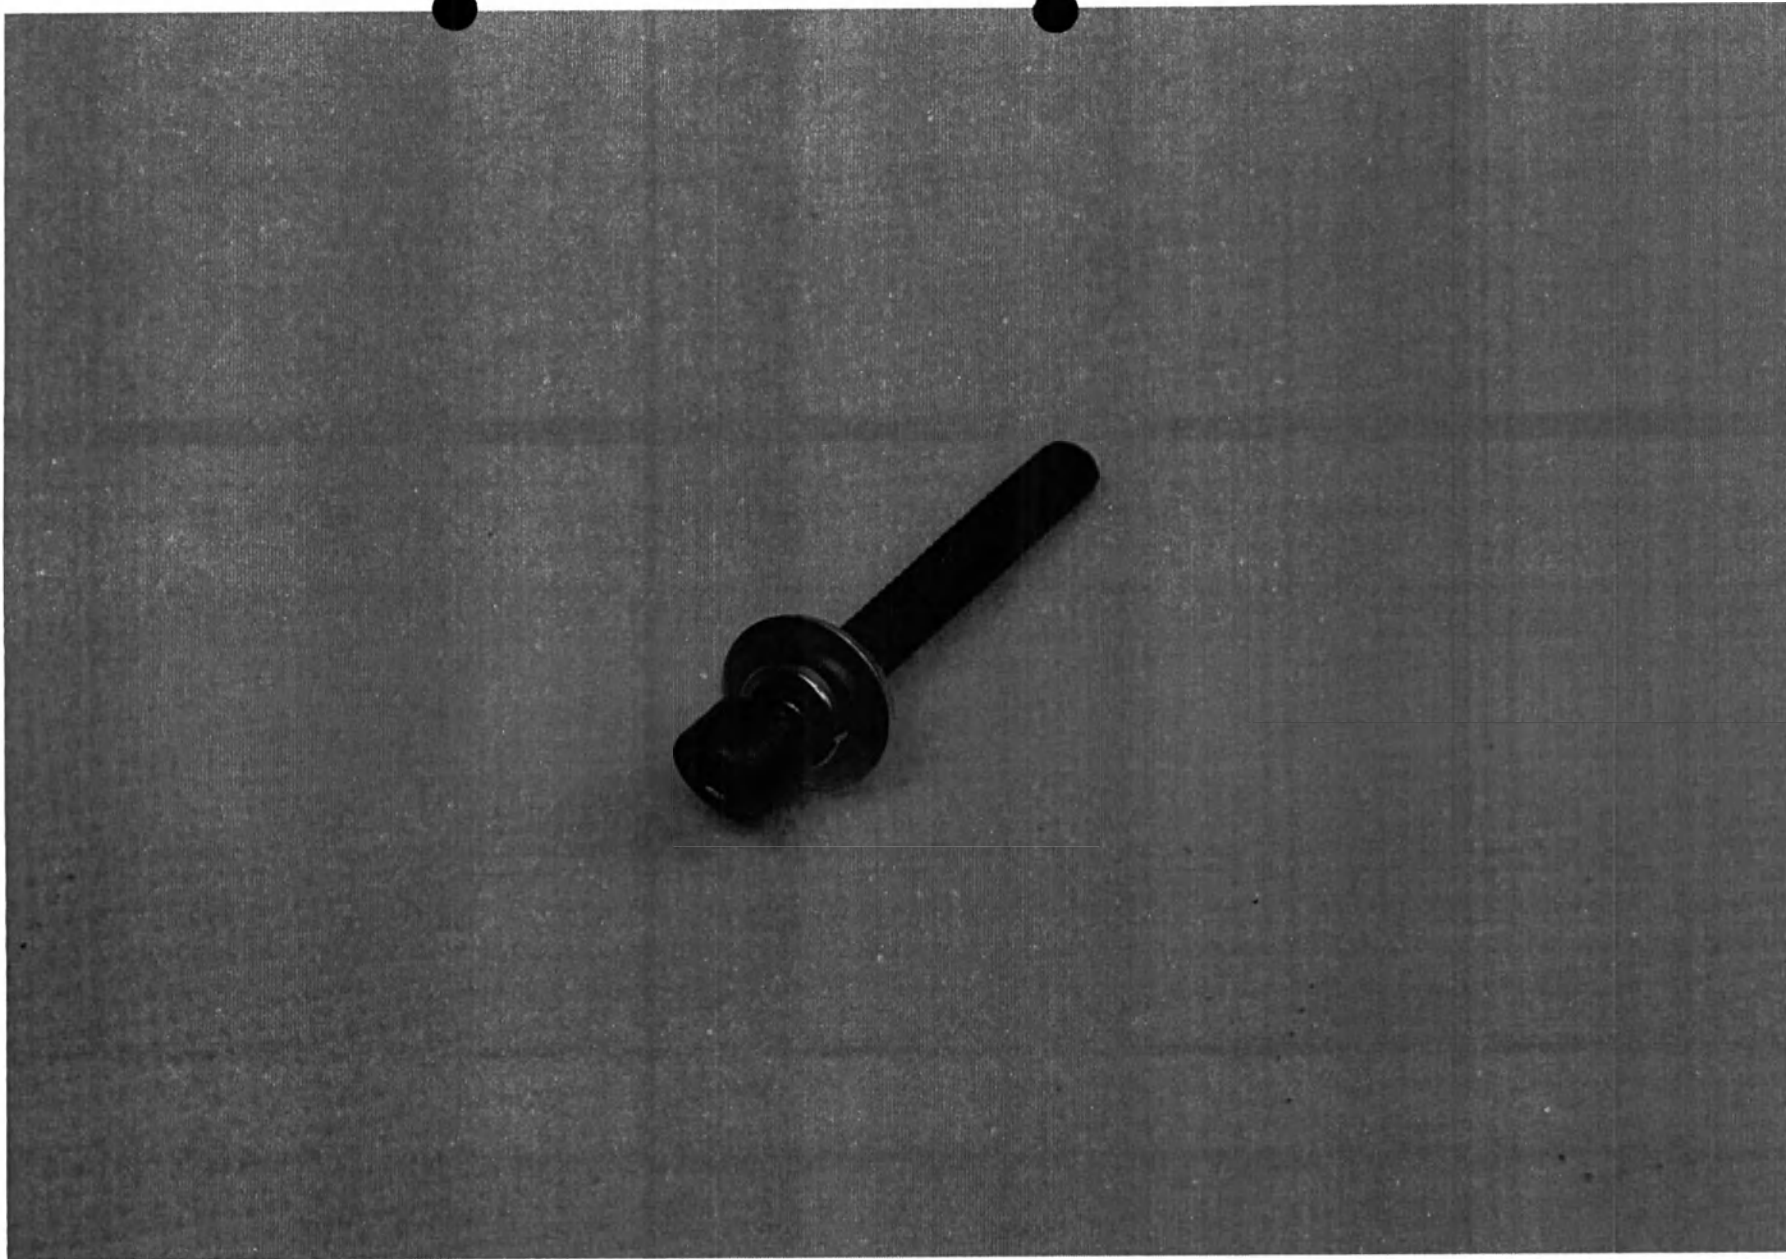


Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Принадлежности: болт (Ø6, L=40) крепления трубки-основания к столешнице с шайбой и гровером

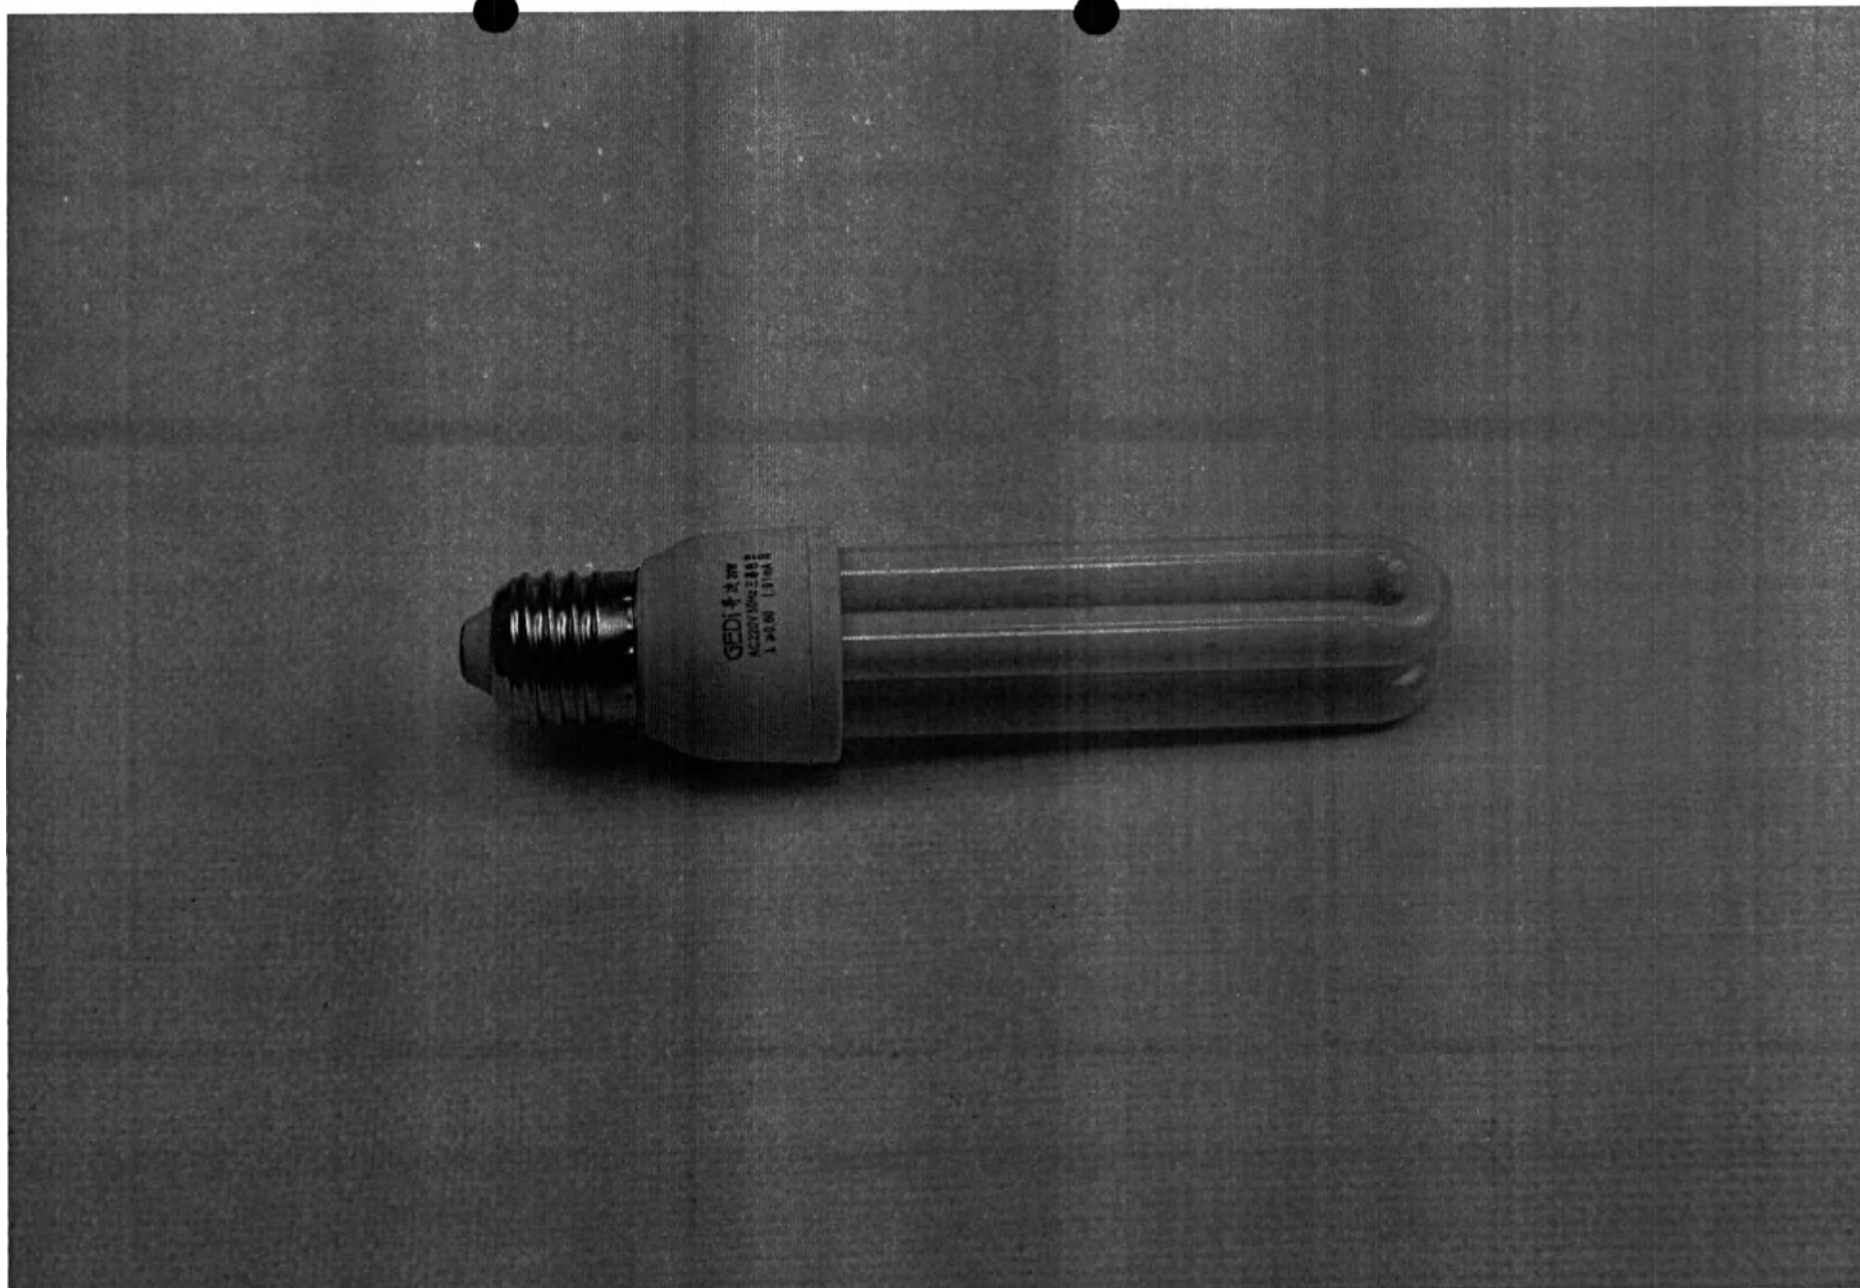

Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Лампа для электролампы

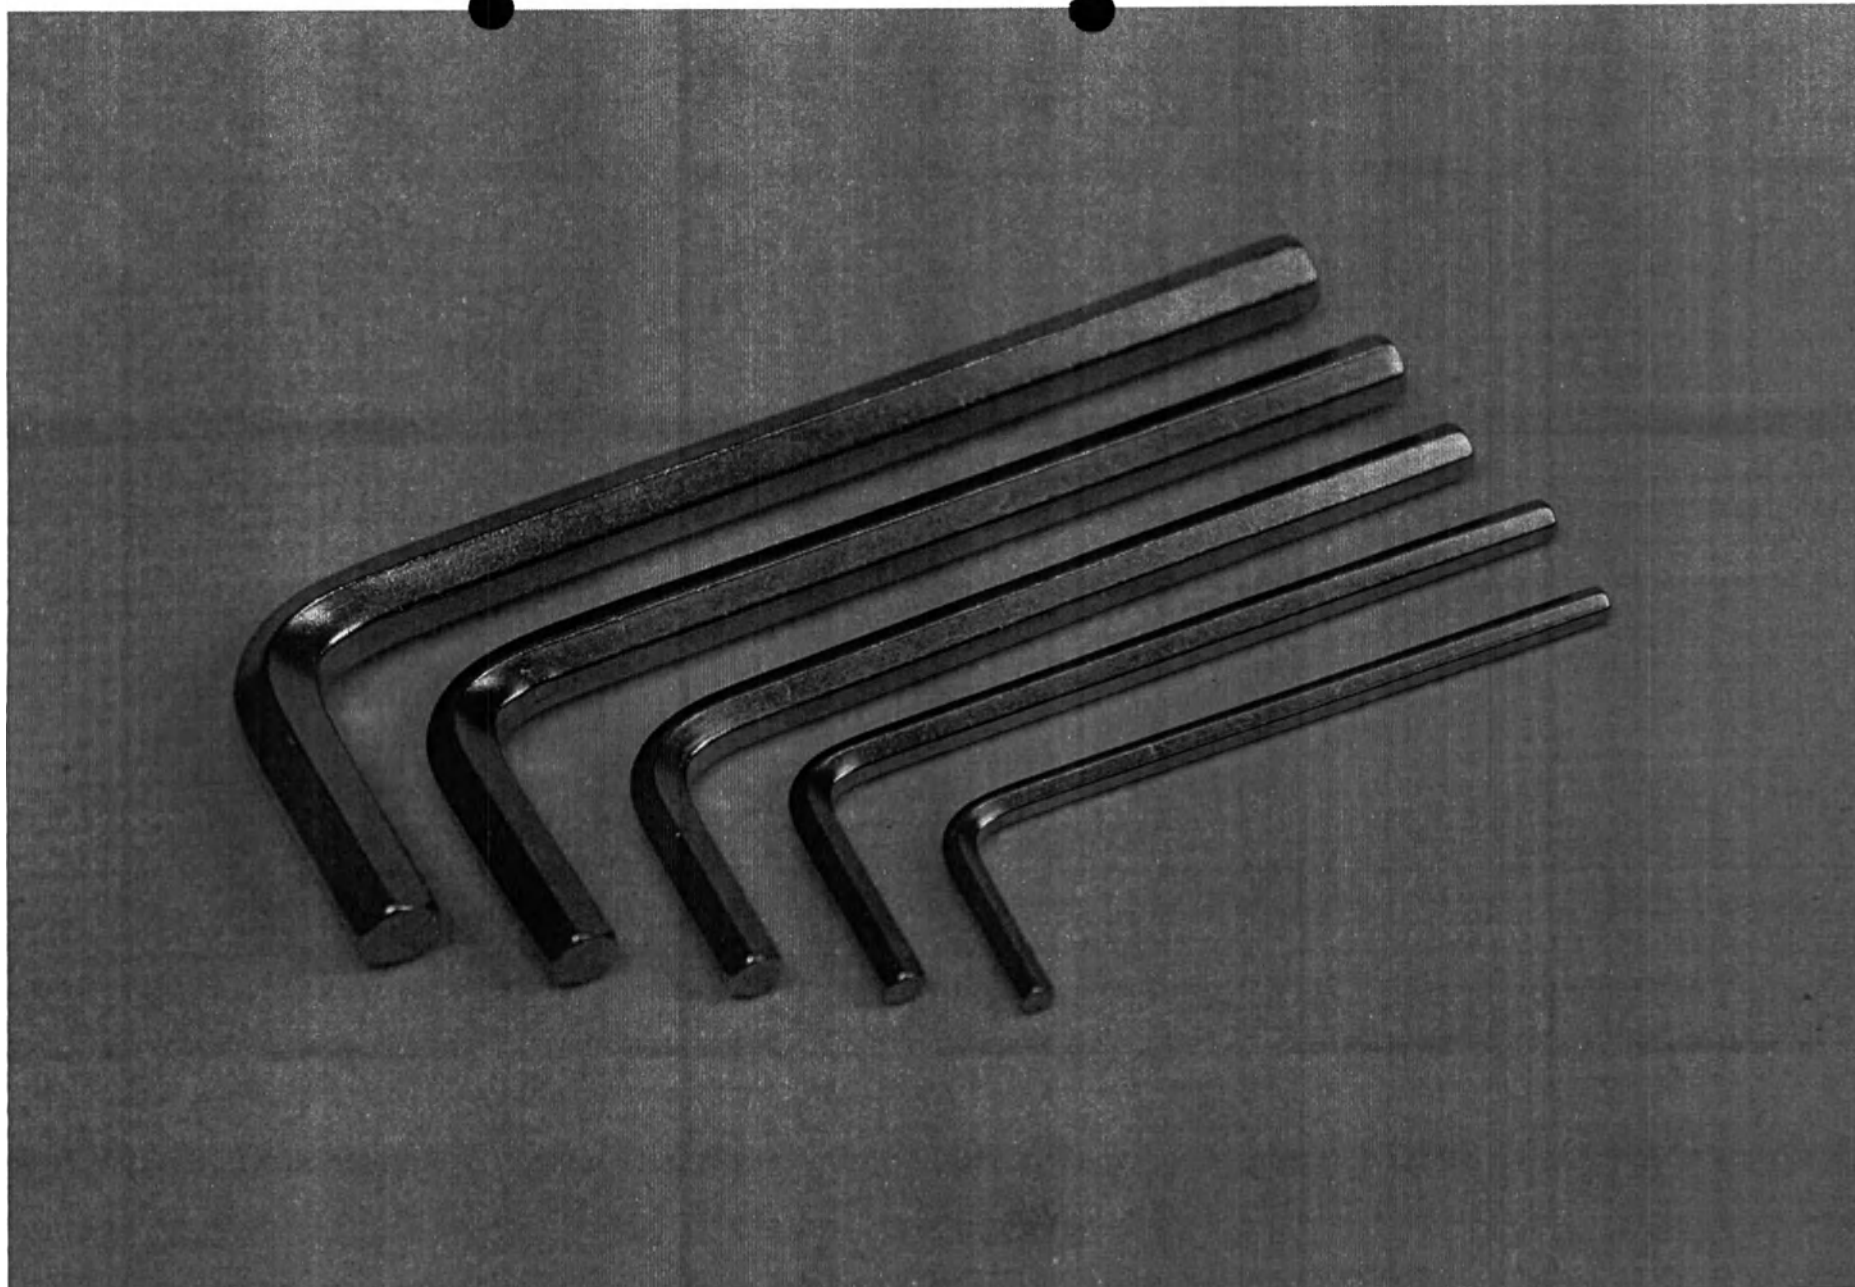

Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Набор ключей шестигранных

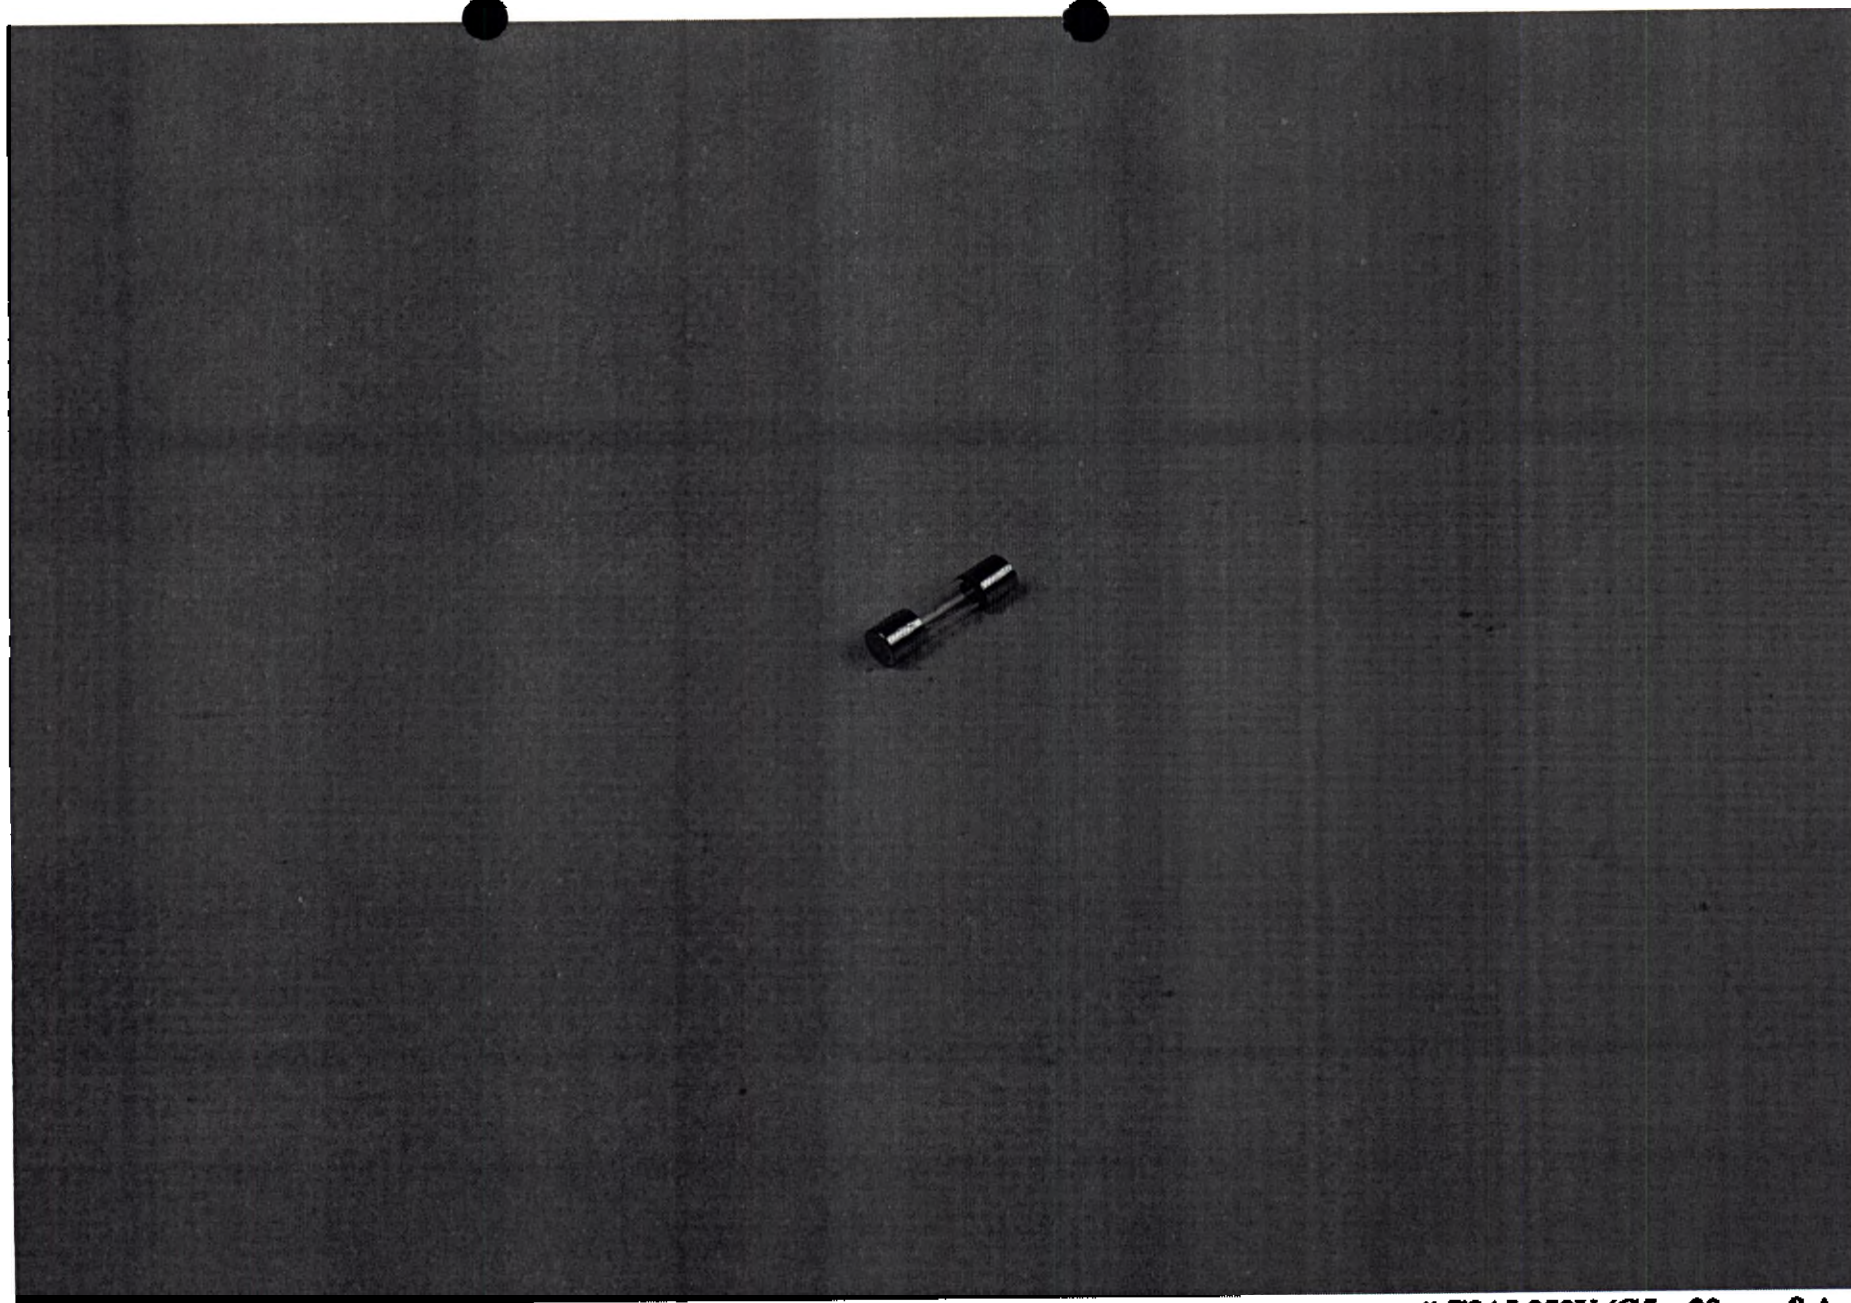

Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Предохранитель запасной F8AL250V (Ø5 x 20 мм, 8 А, 250 В)



Стол медицинский с электроприводом
СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021
с принадлежностями

Зав. № _____

Дата выпуска: _____. _____. 20____
220В±10%/50Гц
120Вт

Напряжение питания/частота
Потребляемая мощность не более
ТУ 32.50.30-008-01324118-2021

Рег. удостоверение: № _____

от _____

г. _____



ООО «ТАГЛЕР», Россия, 107076, г. Москва,
ул. Богородский вал, д.3, строение 29, эт.1,
пом. III, ком. 8,9



Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Маркировка на изделии.



Стол медицинский с электроприводом
СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021
с принадлежностями

Дата выпуска: _____. _____. 20__

Зав. № _____

Комплект поставки:

1. Опора с регулируемыми ножками – 2 шт.
2. Основание стола с механизмом подъема в сборе – 1 шт.
3. Столешница – 1 шт.
4. Трубка-основание – 1 шт.
5. Электролампа освещения поворотная с кронштейном для фороптера – 1 шт.
6. Кабель электропитания – 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Принадлежности:

1. Болт (Ø8, L=20) крепления опоры и столешницы к основанию стола – 8 шт.
 2. Заглушки резиновые – 4 шт.
 3. Болт (Ø6, L=40) крепления трубки-основания к столешнице с шайбой и гровером – 4 шт.
 4. Лампа для электролампы – 1 шт.
 5. Набор ключей шестигранных – 1 шт.
 6. Предохранитель запасной F8AL250V (Ø5 x 20 мм, 8 А, 250 В) – 2 шт.
- Условия хранения и эксплуатации: +5° до +40°, относительная влажность 80% относительная влажность – 80 % при температуре 25°C, атмосферное давление 70 – 106 кПа.

ТУ 32.50.30-008-01324118-2021

Рег. удостоверение: № _____

от

г. _____




ООО «ТАГЛЕР», Россия, 107076, г. Москва,
ул. Богородский вал, д.3, строение 29, эт.1,
пом. III, ком. 8,9




Стол медицинский с электроприводом СО-3 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Маркировка на потребительской упаковке




Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Общий вид

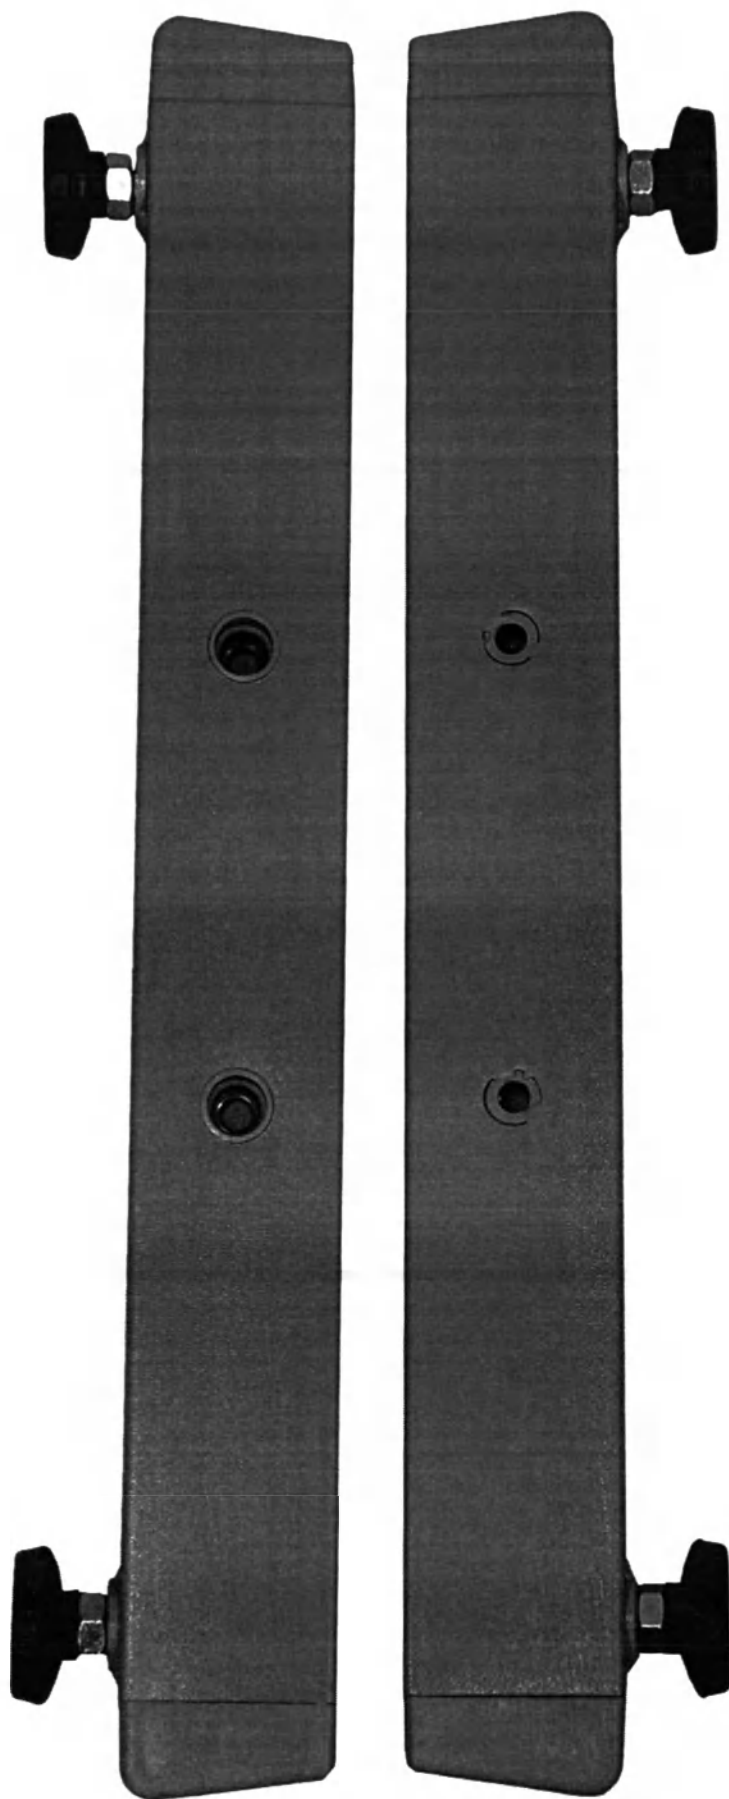


Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с
принадлежностями. Опора с регулируемыми ножками

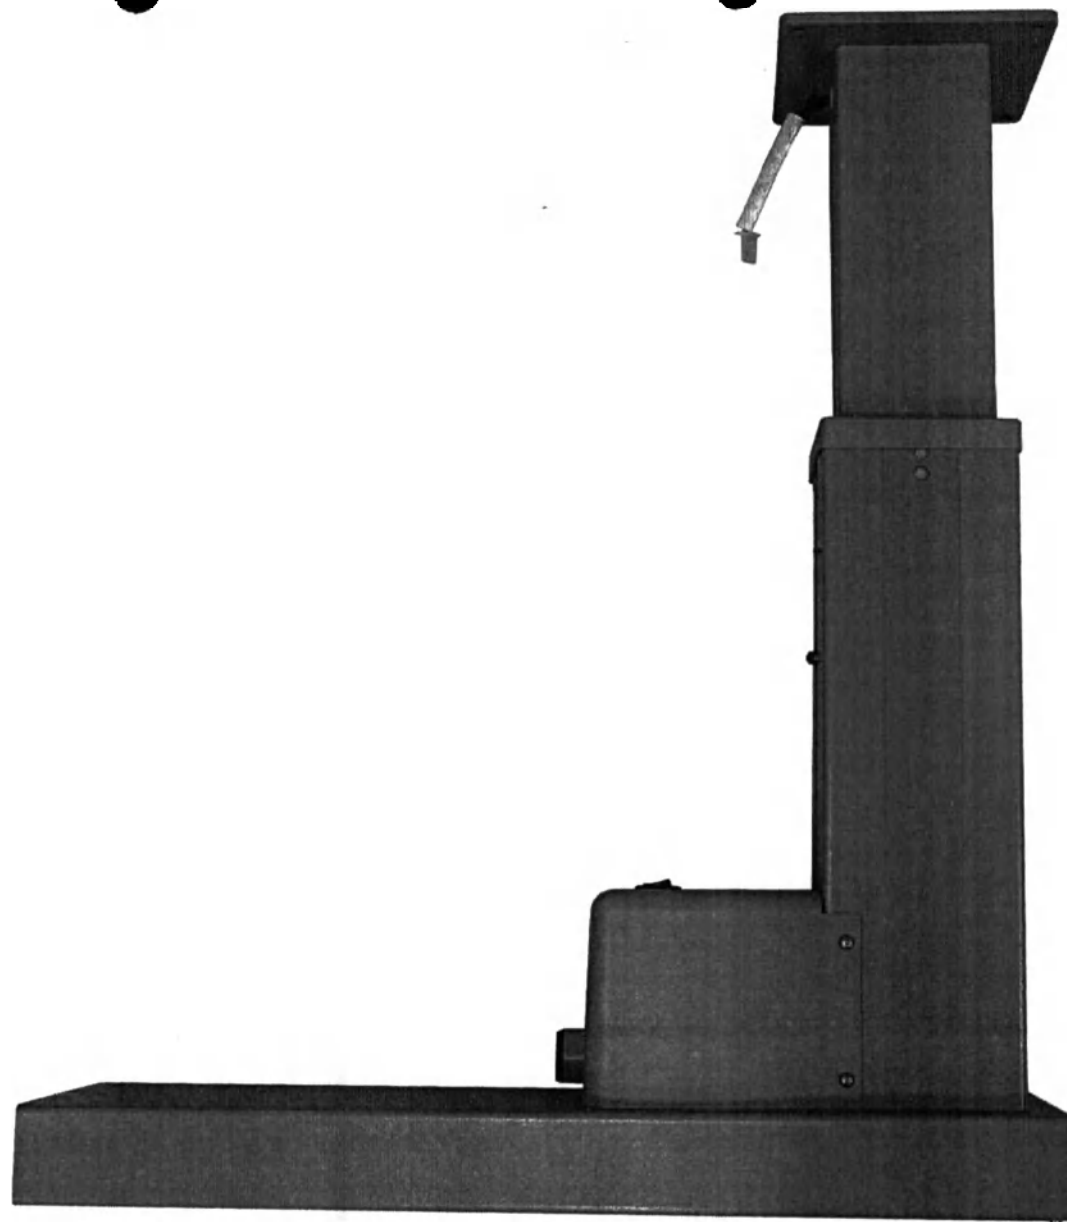


Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Основание стола с механизмом подъёма в сборе

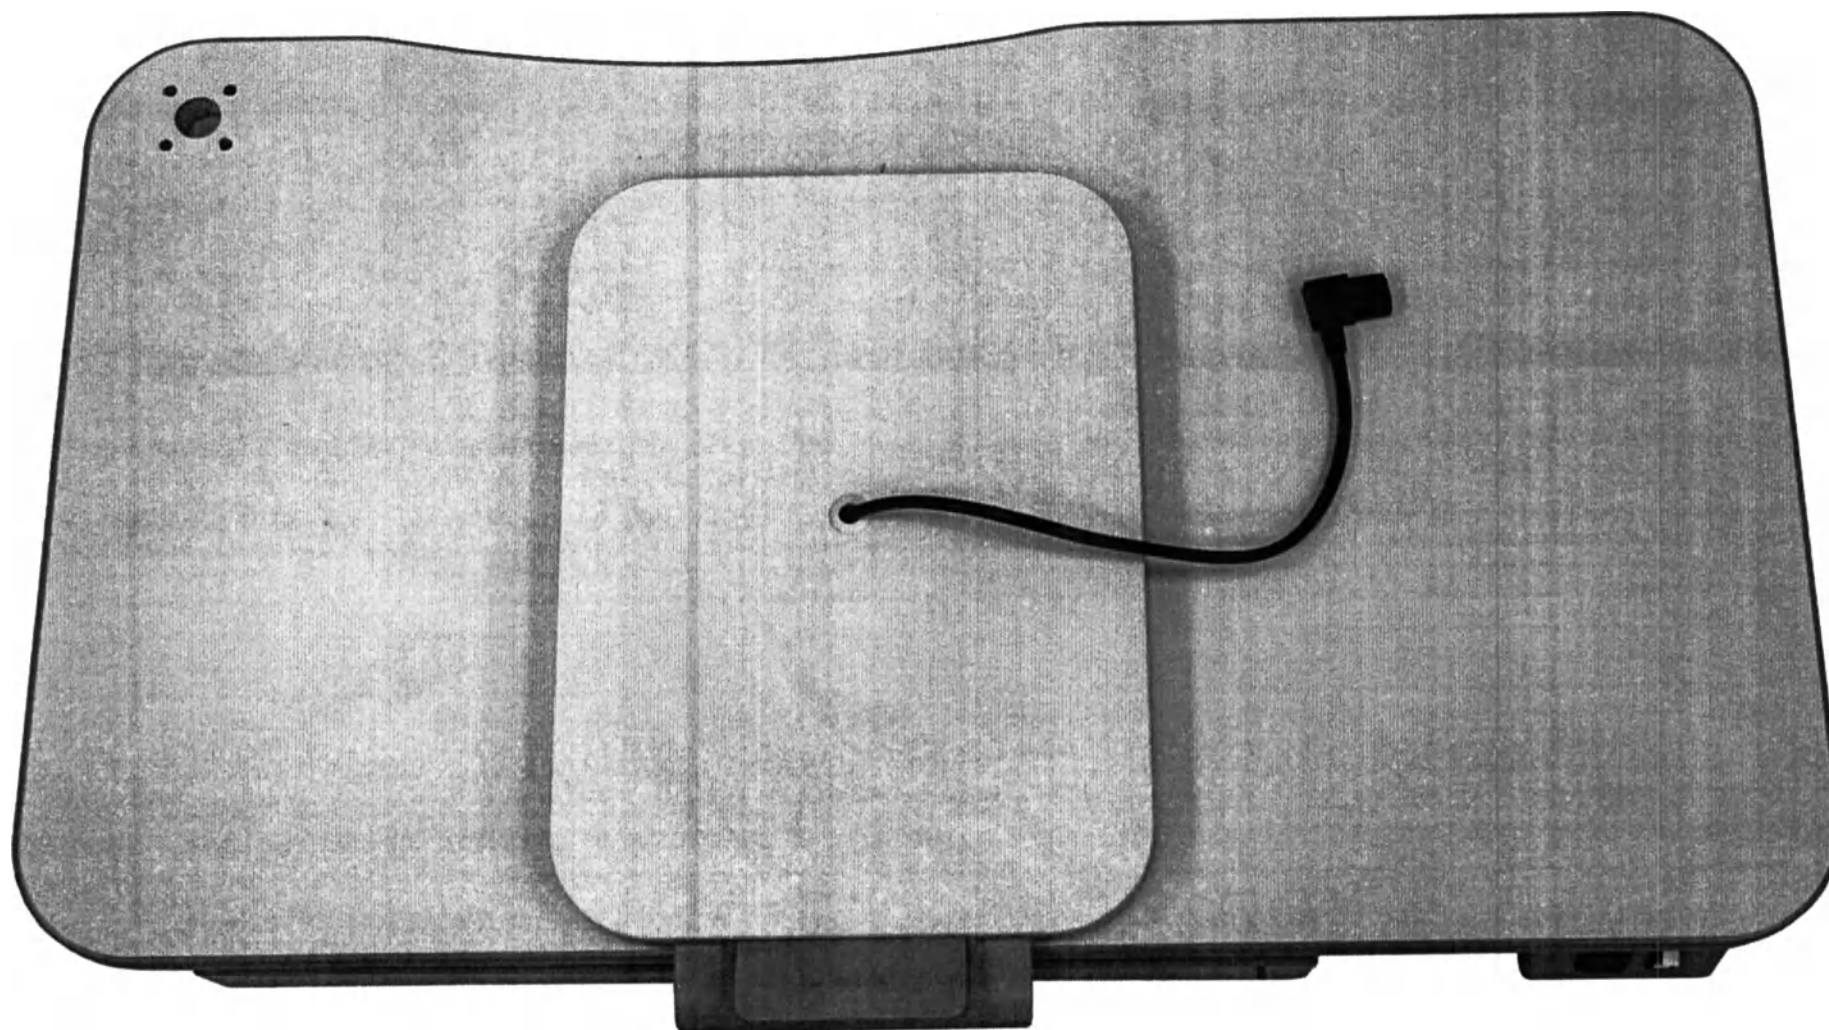

Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Столешница с подставкой для оборудования и внутренним ящиком в сборе (вид сверху)

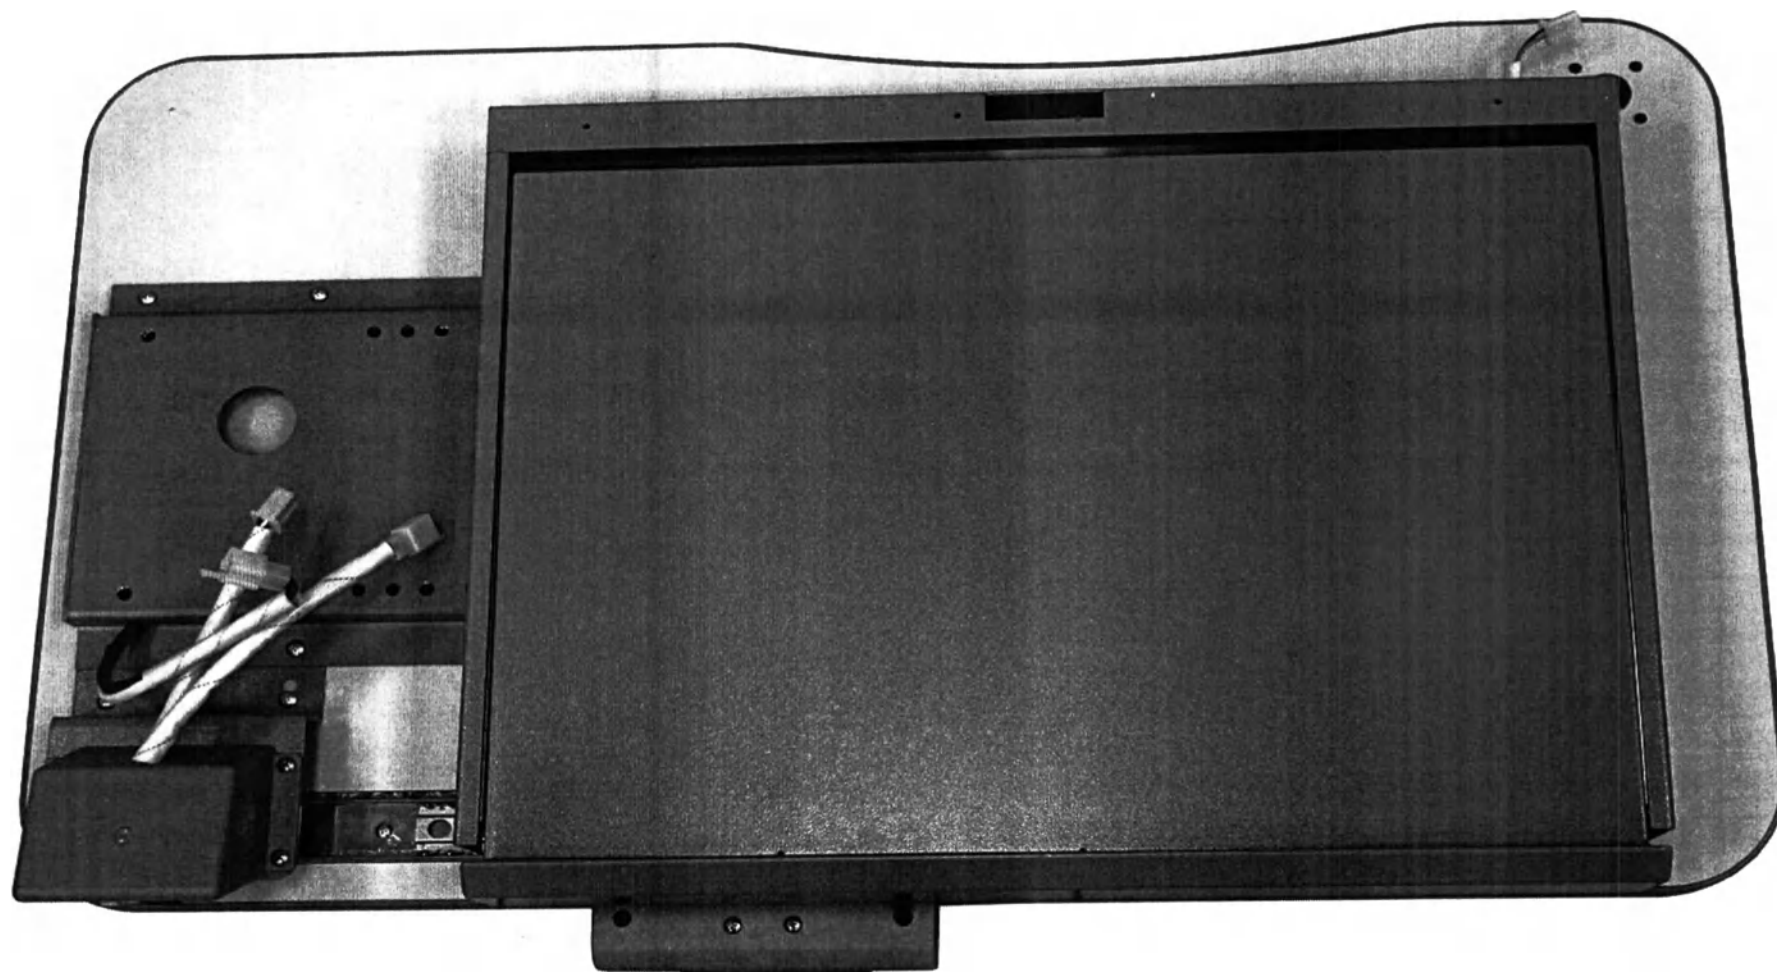


Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Столешница с подставкой для оборудования и внутренним ящиком в сборе (вид снизу)

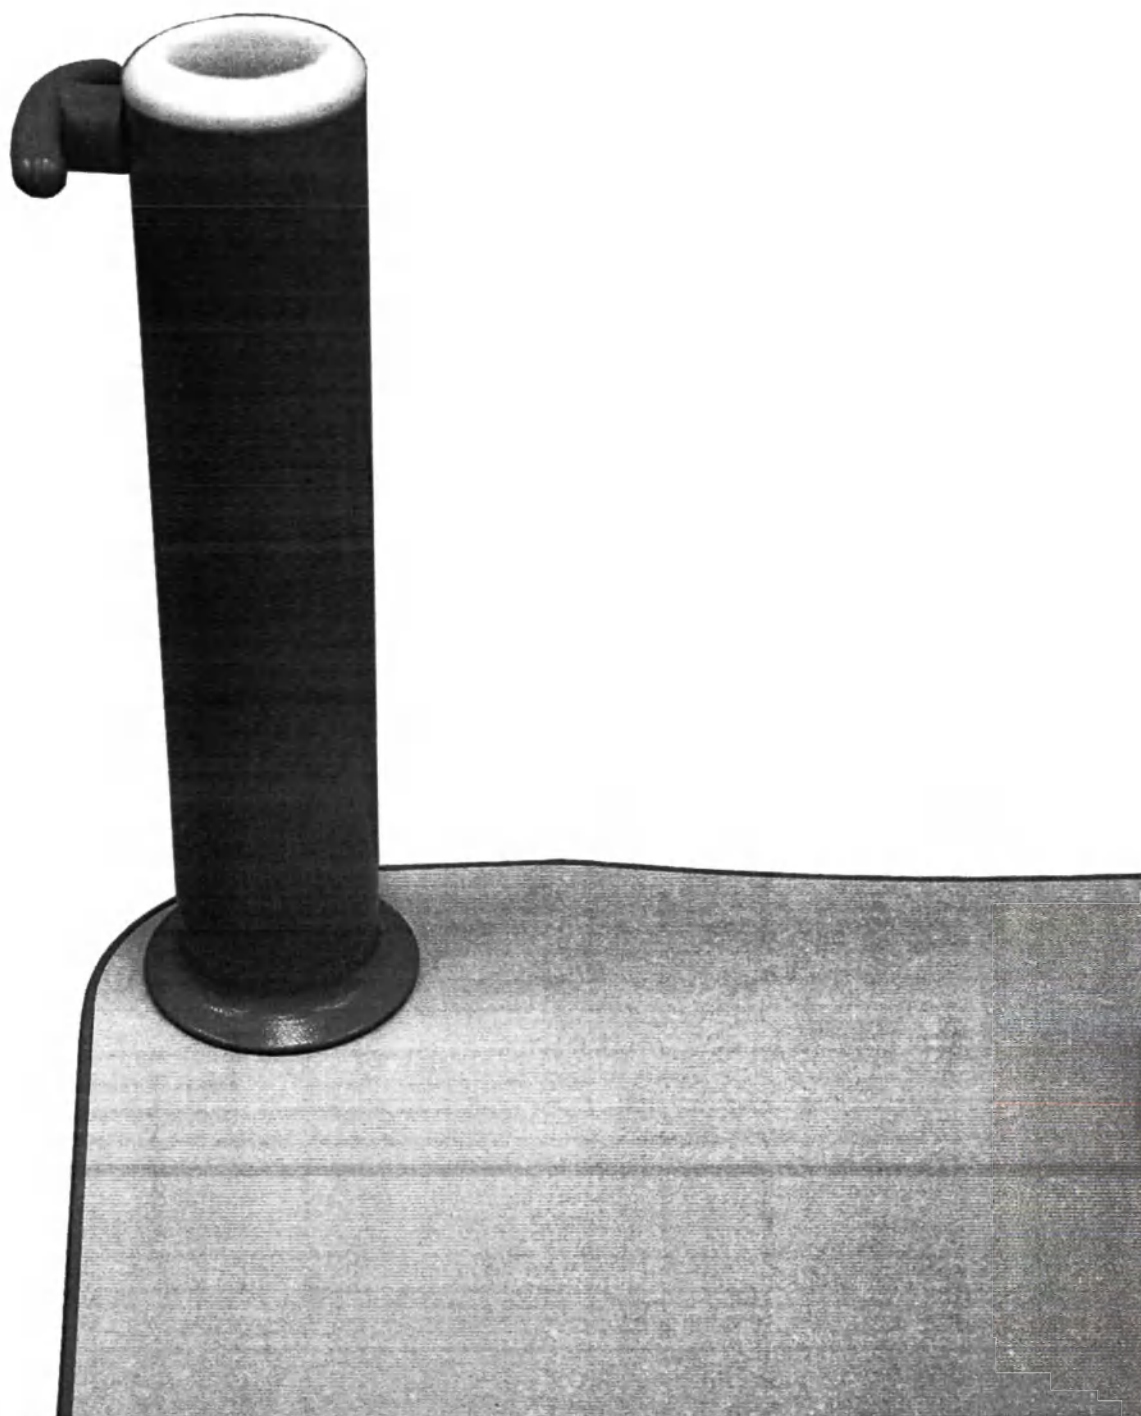


Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Трубка-основание




Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2020 с принадлежностями. Электролампа освещения поворотная с кронштейном для фороптера

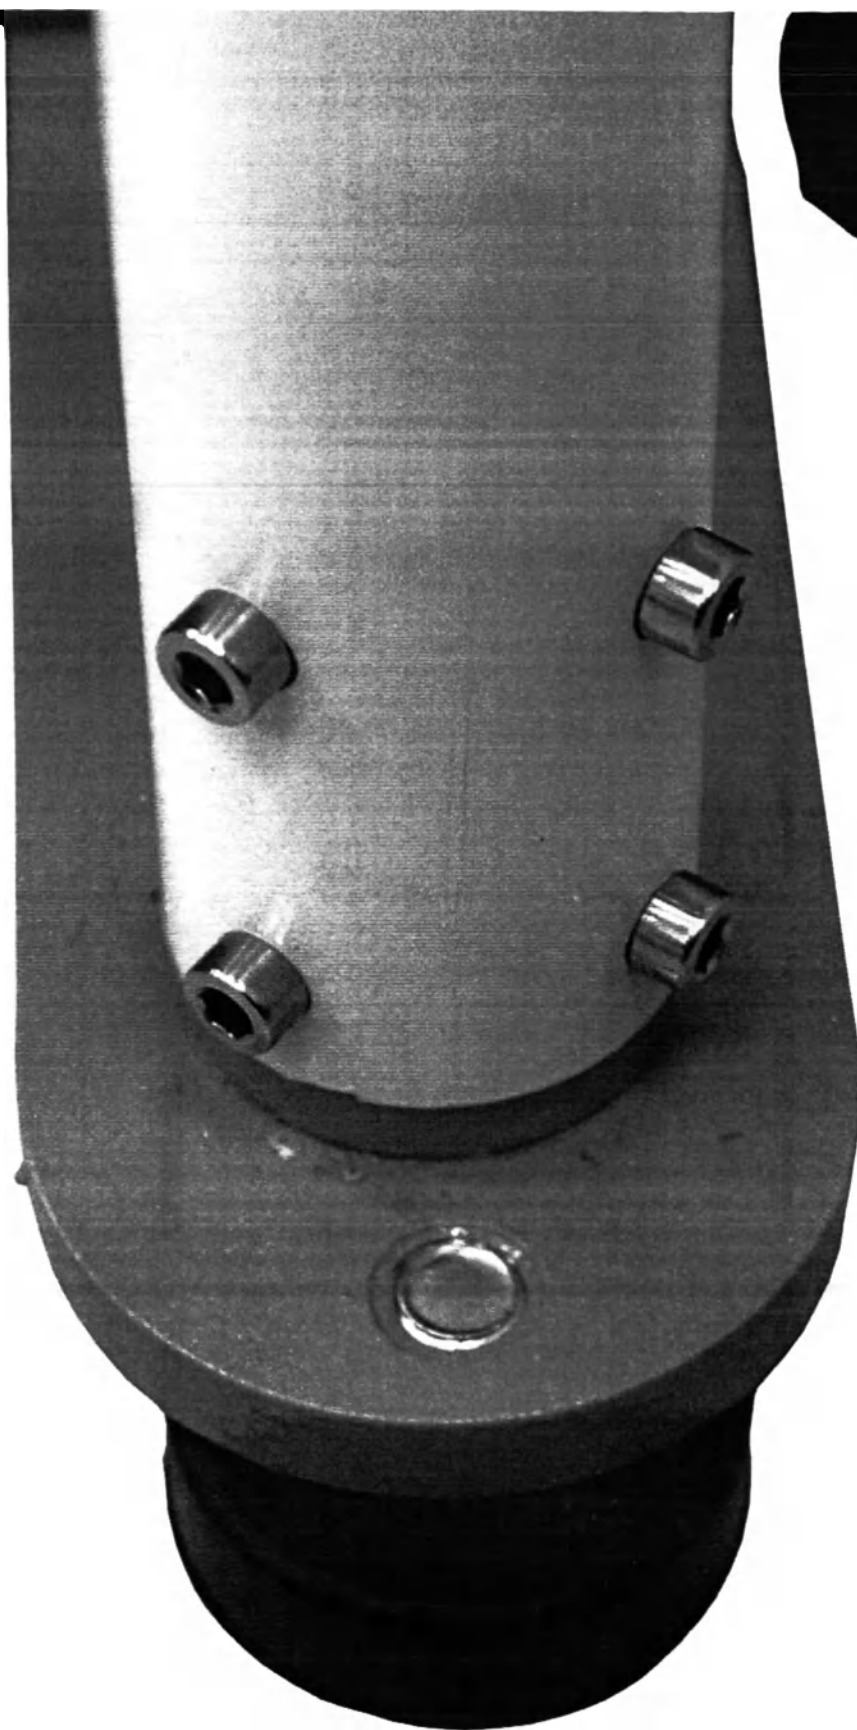

Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Кронштейн крепления разборной стойки

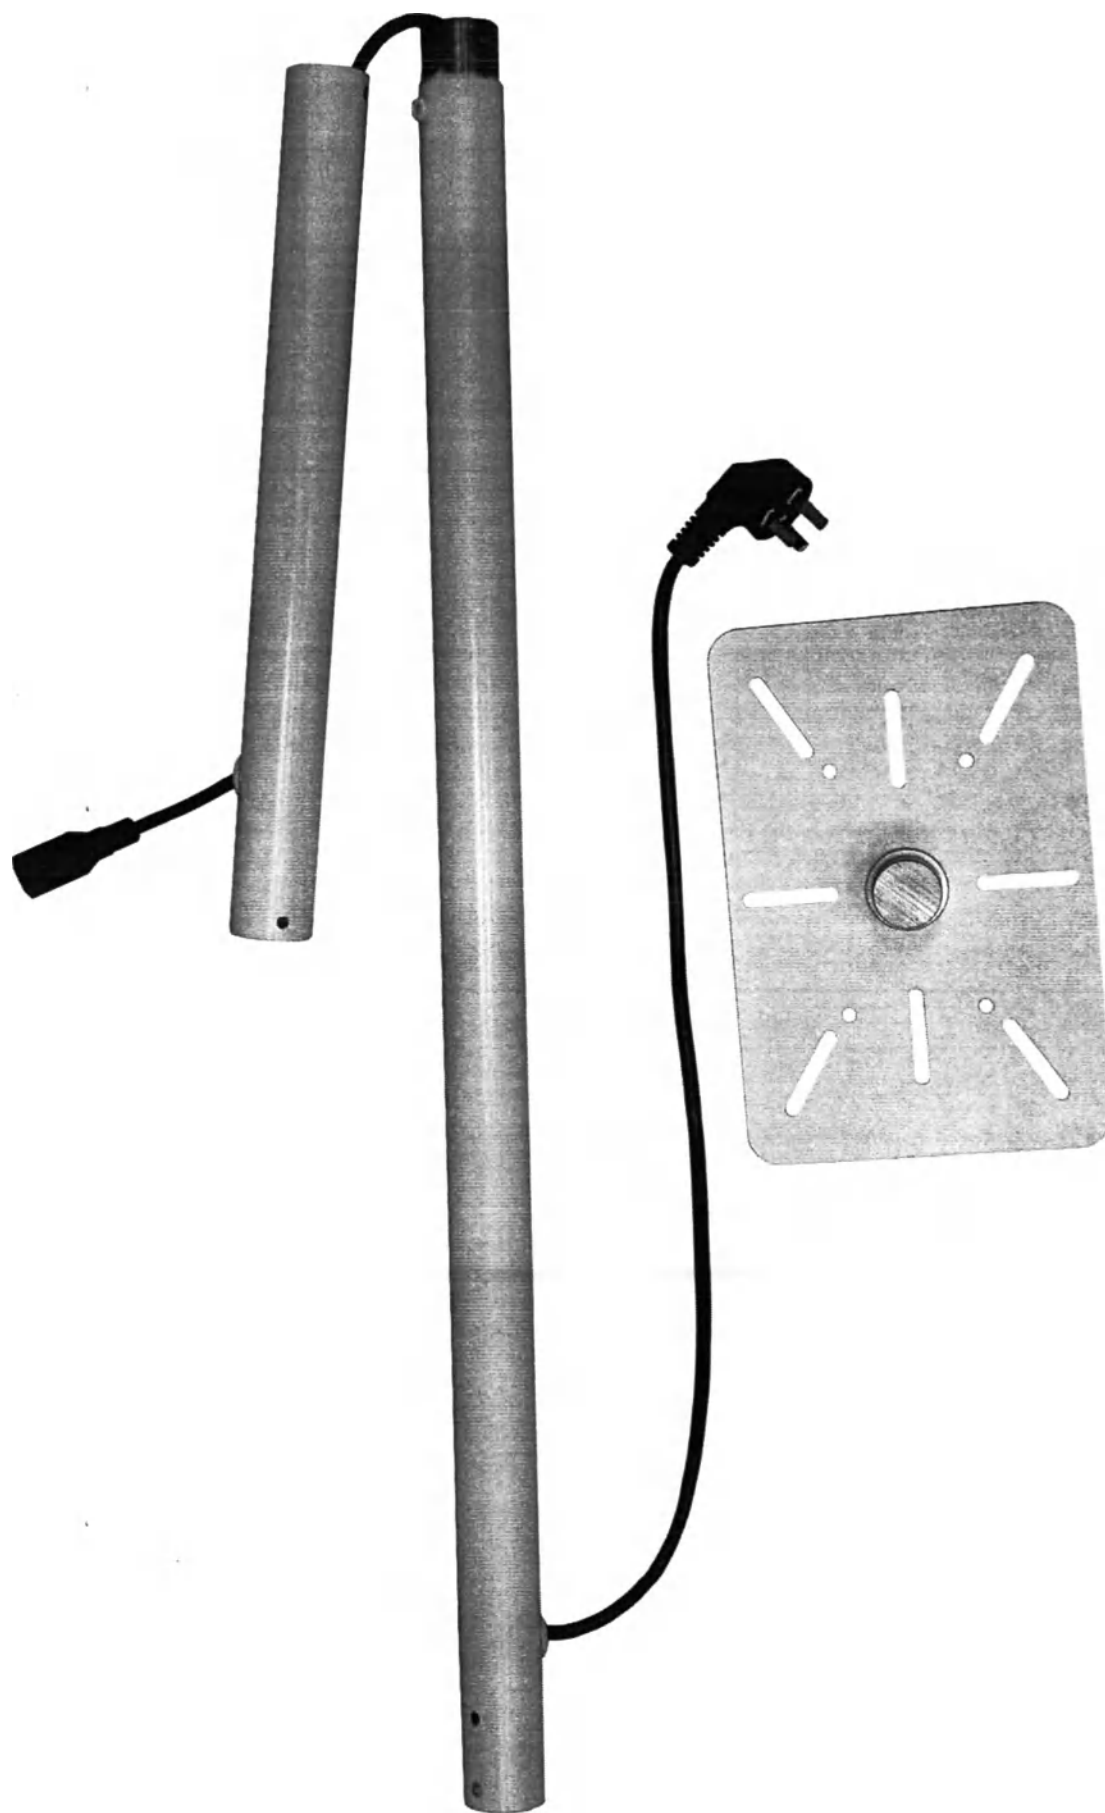


Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Стойка разборная (из 2 частей) и площадка

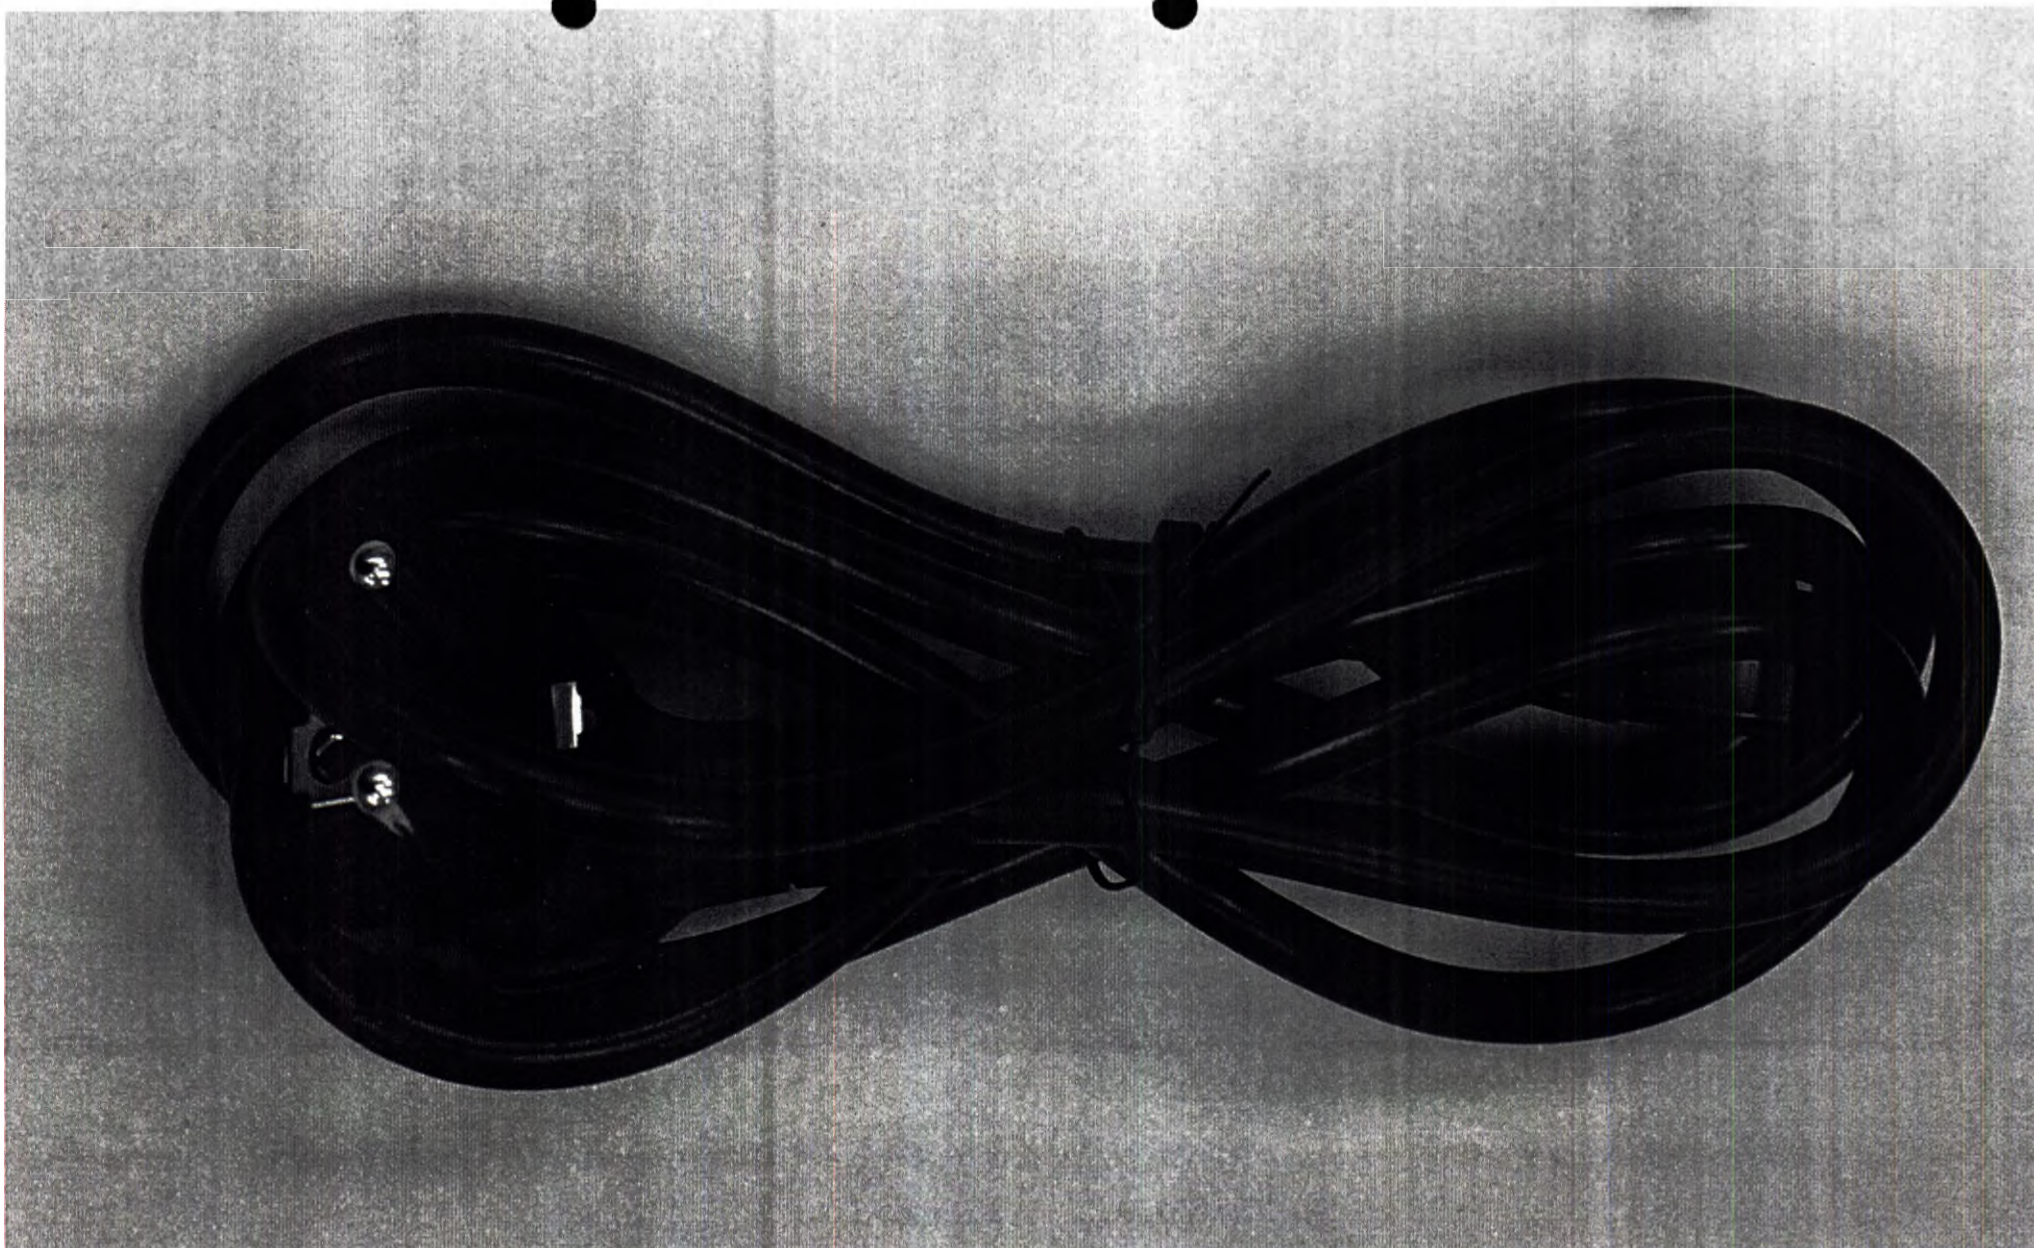


Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Кабель электропитания




Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Принадлежностями: болт (Ø8, L=20) крепления опоры и столешницы к основанию стола

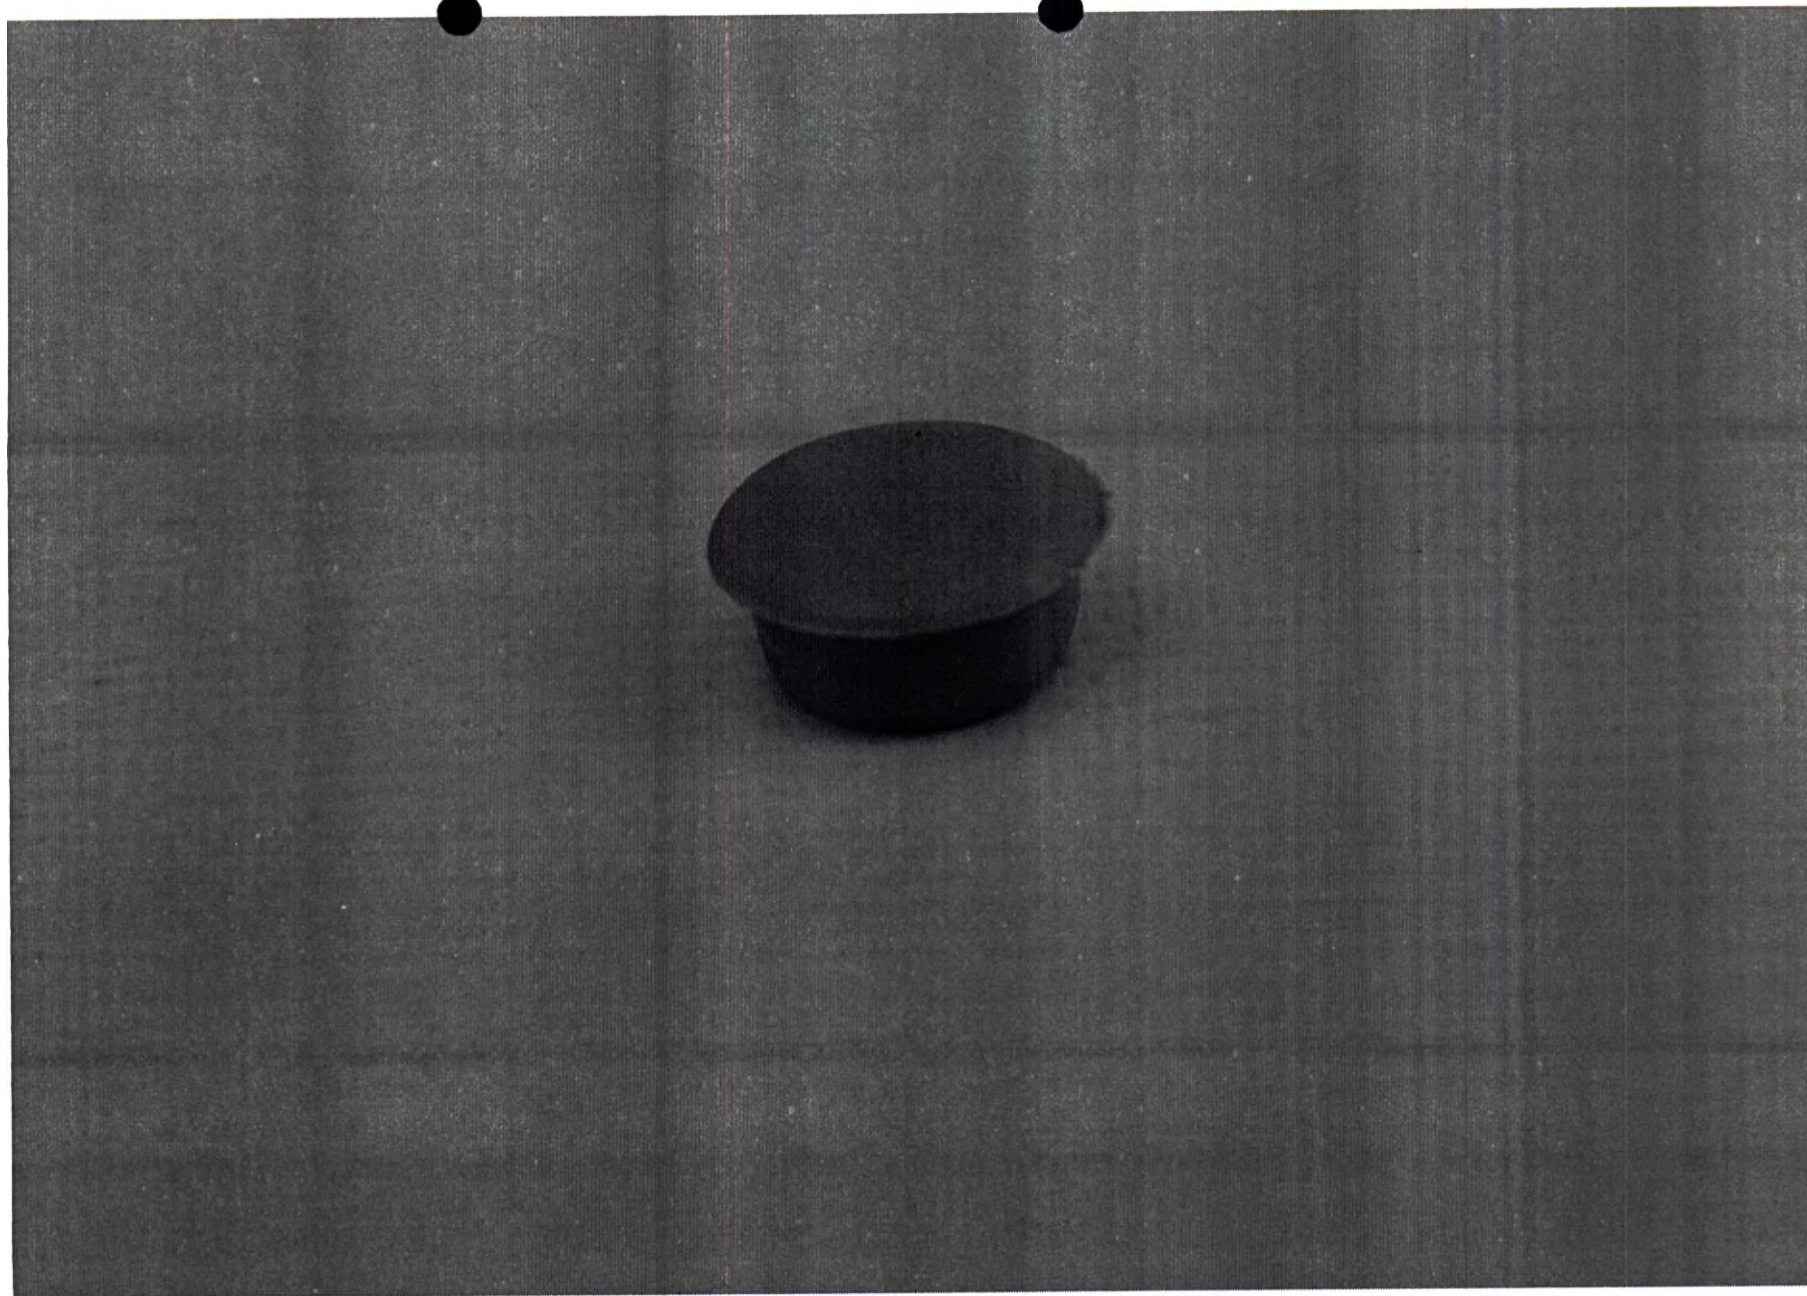


Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Заглушки резиновые

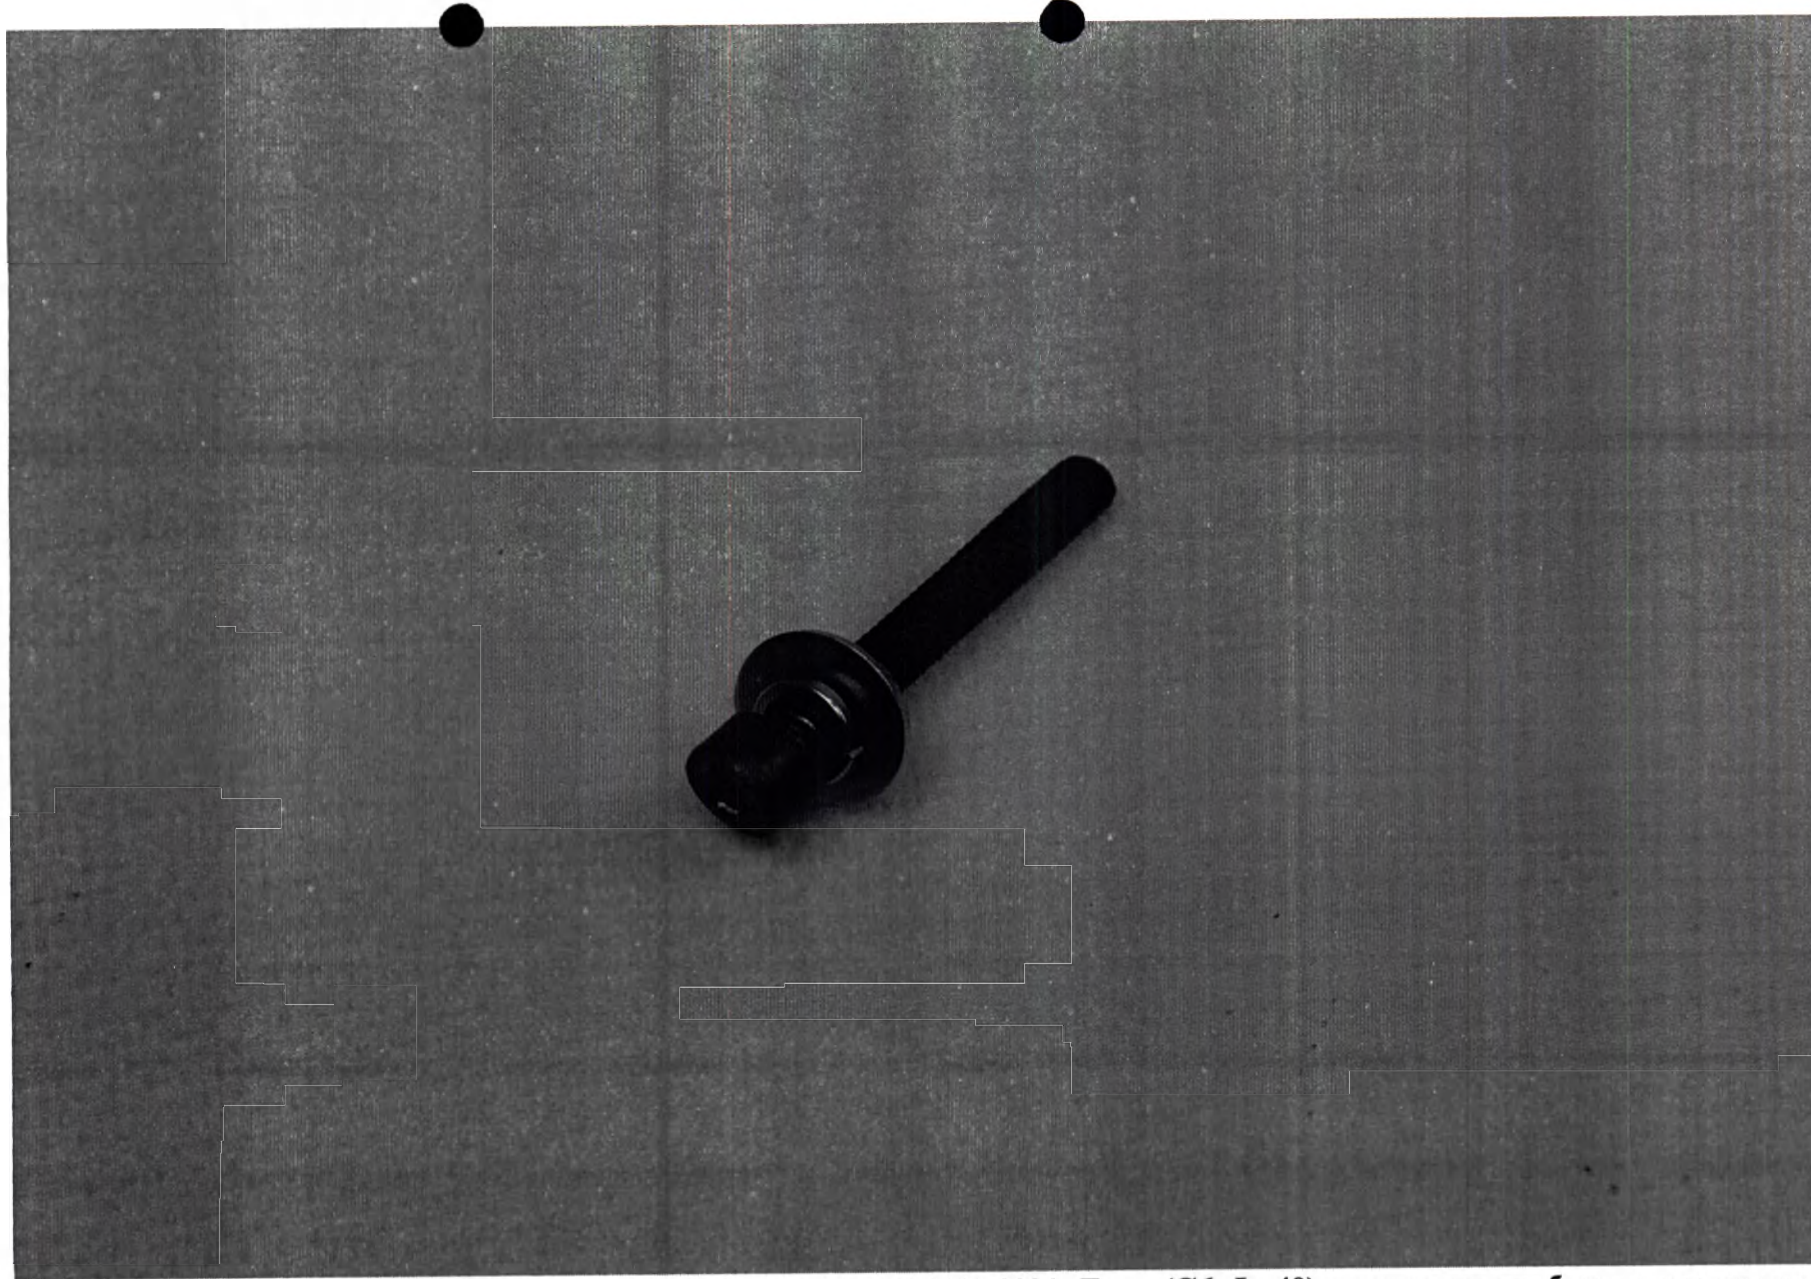

Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Болт (Ø6, L=40) крепления трубки-основания с шайбой и гровером

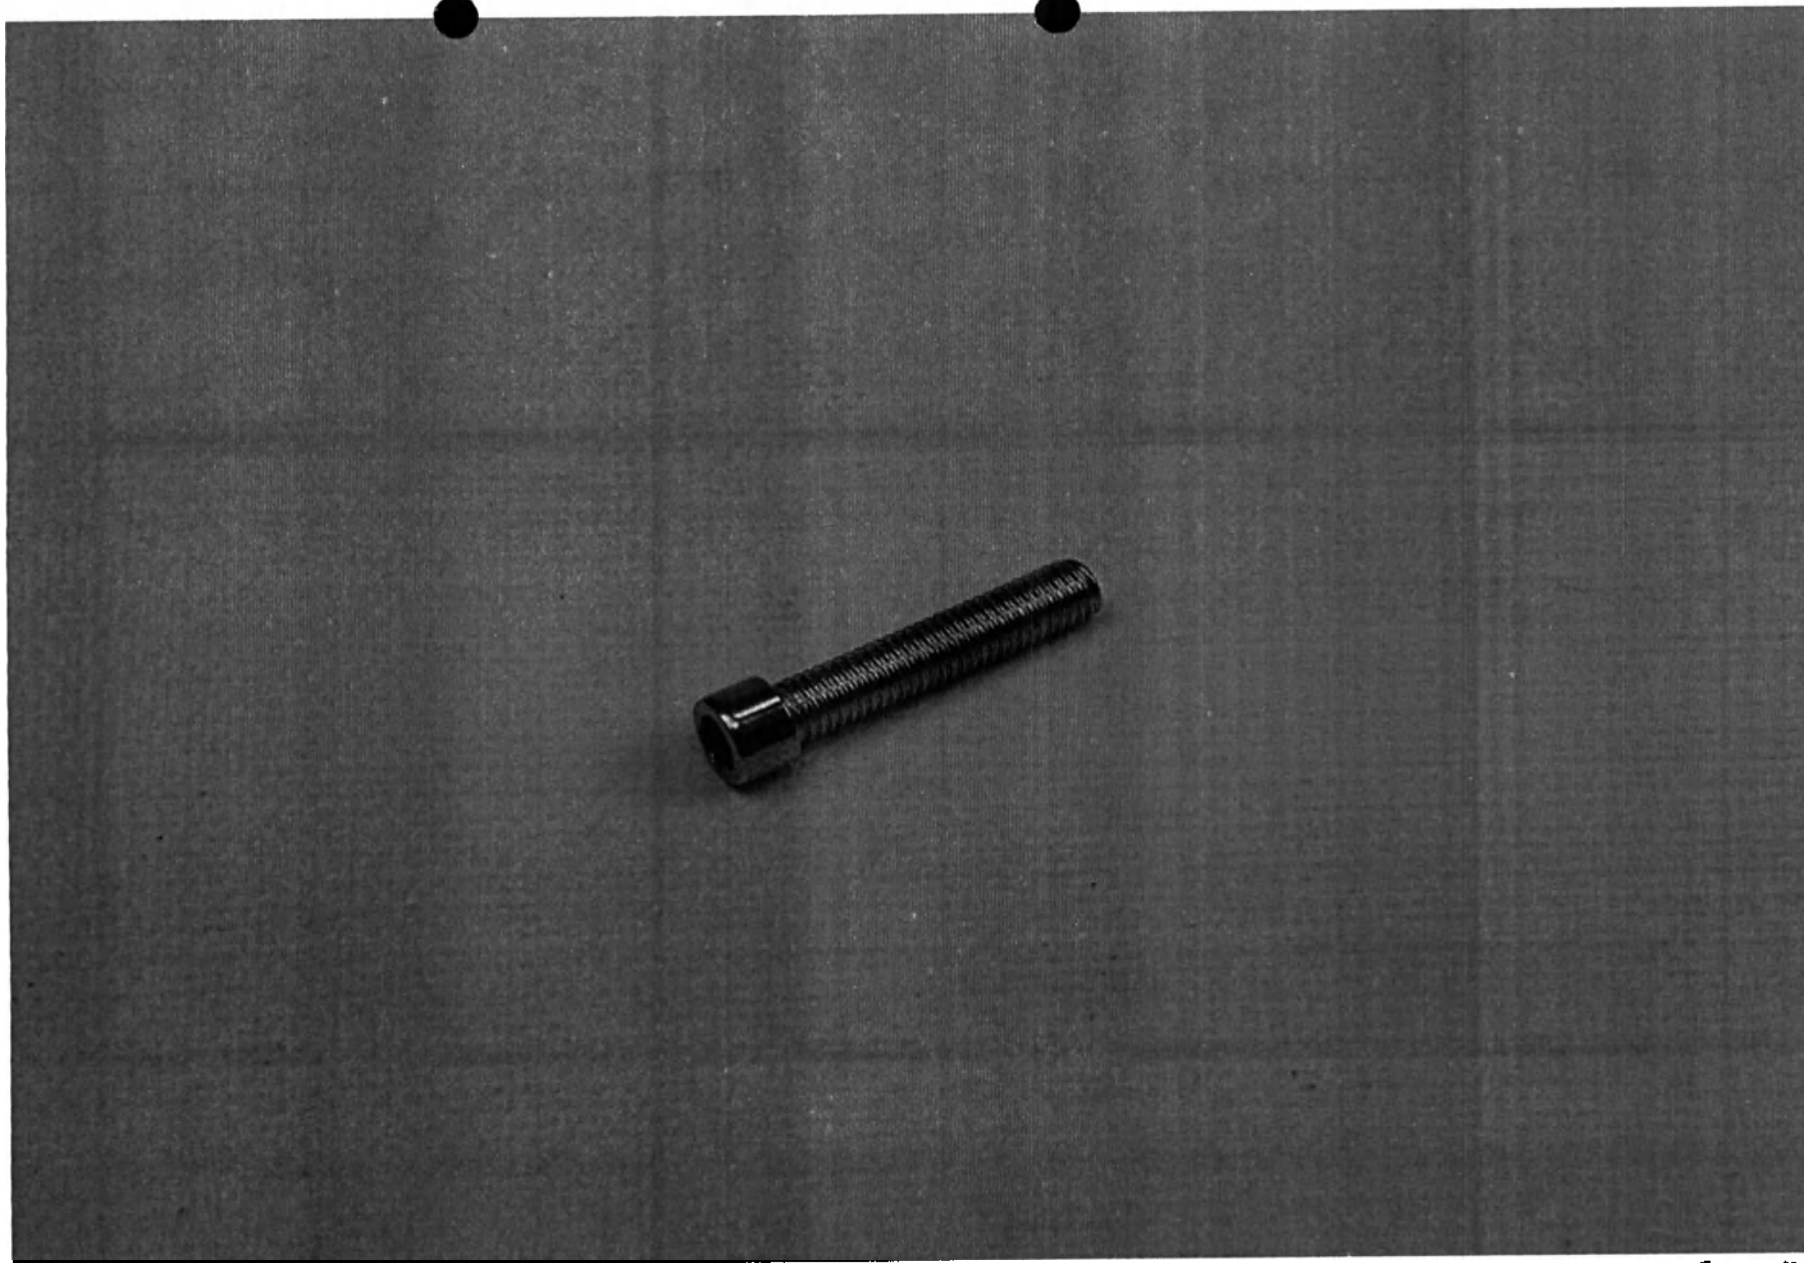


Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Болт ($\varnothing 8$, $L=40$) крепления кронштейна разборной стойки к опоре

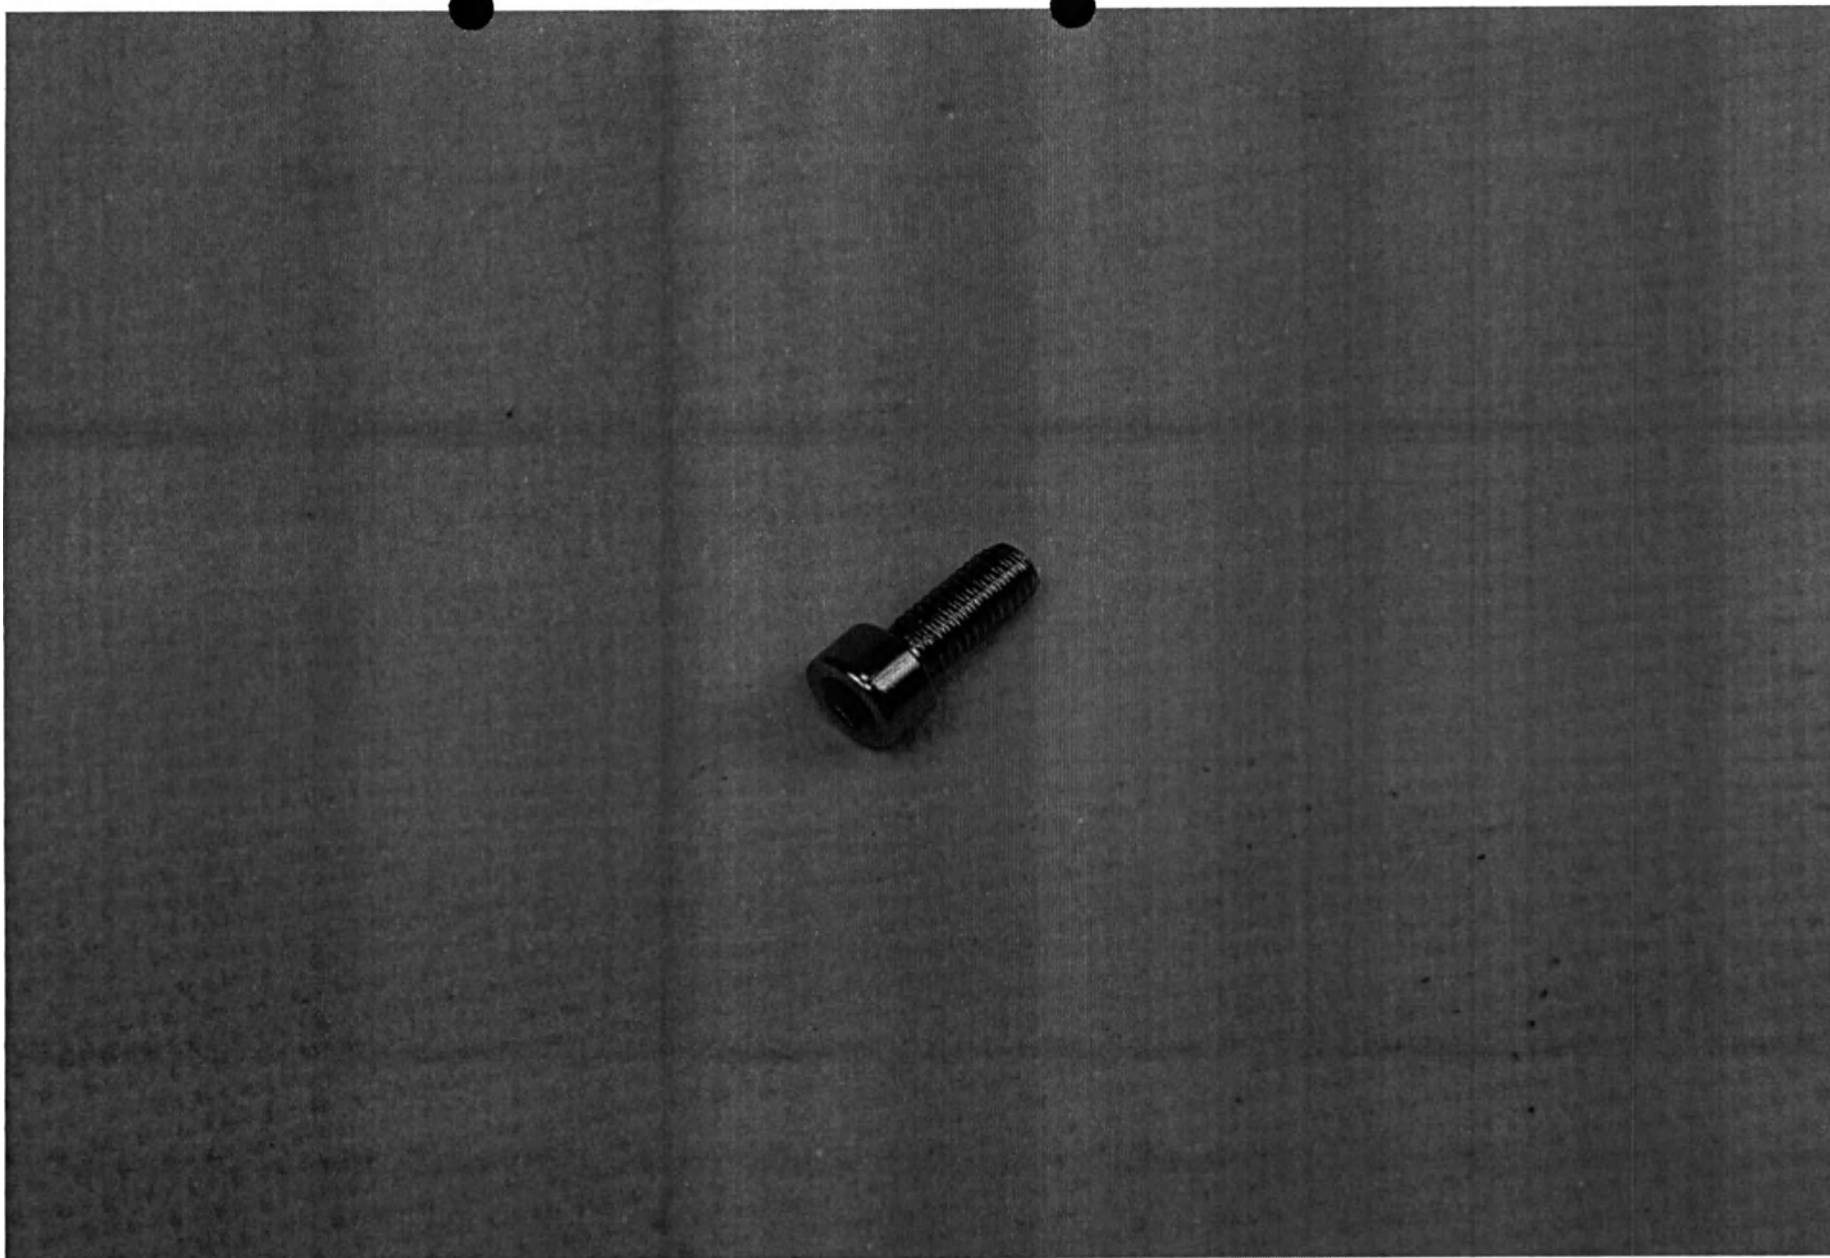


Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Болт (Ø4, L=12 мм) крепления разборной стойки к кронштейну на опоре



Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Болт ($\varnothing 5$, L=10 мм) крепления частей разборной стойки и площадки на разборную стойку

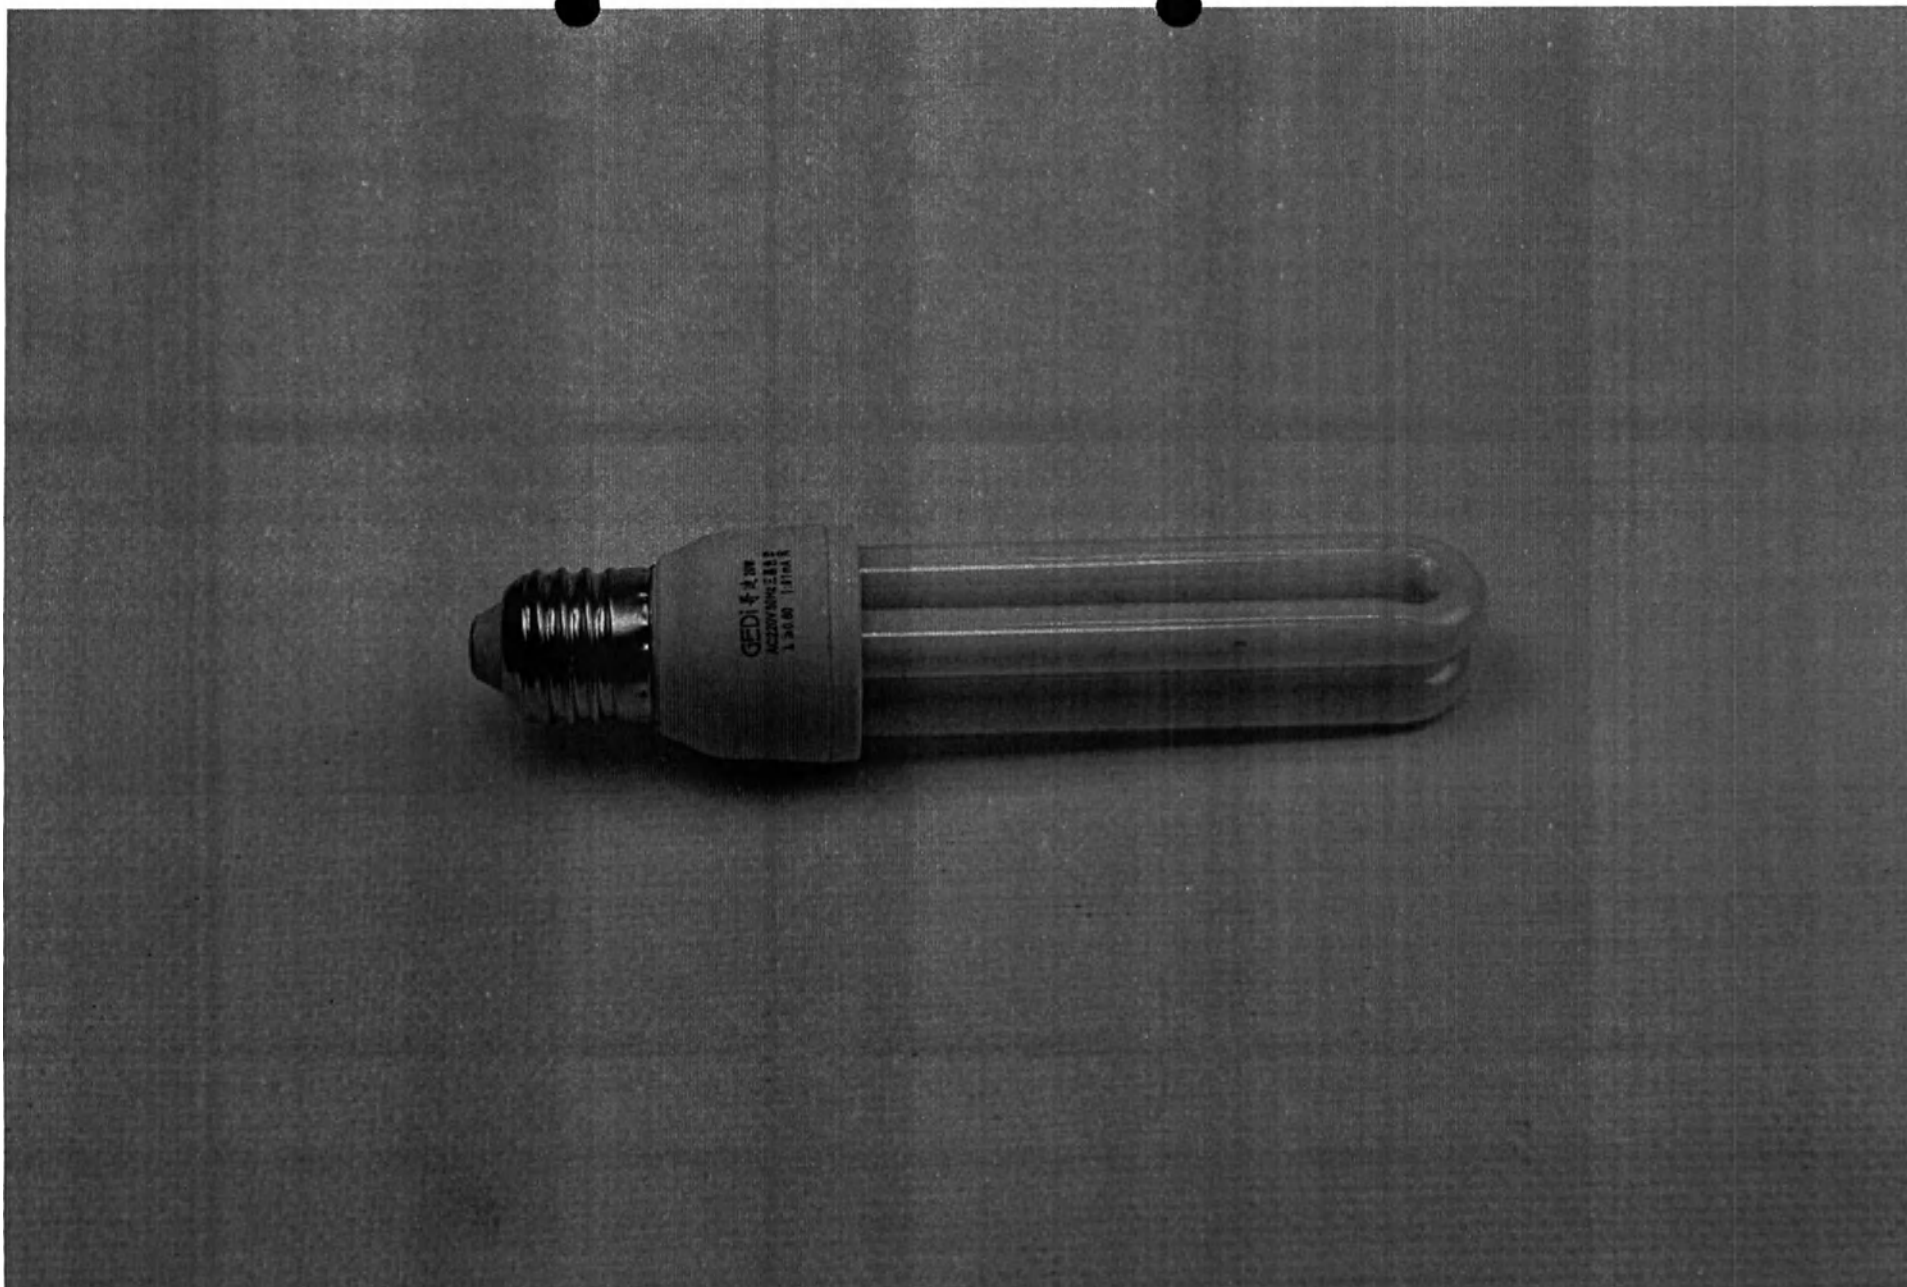

Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Лампа для электролампы

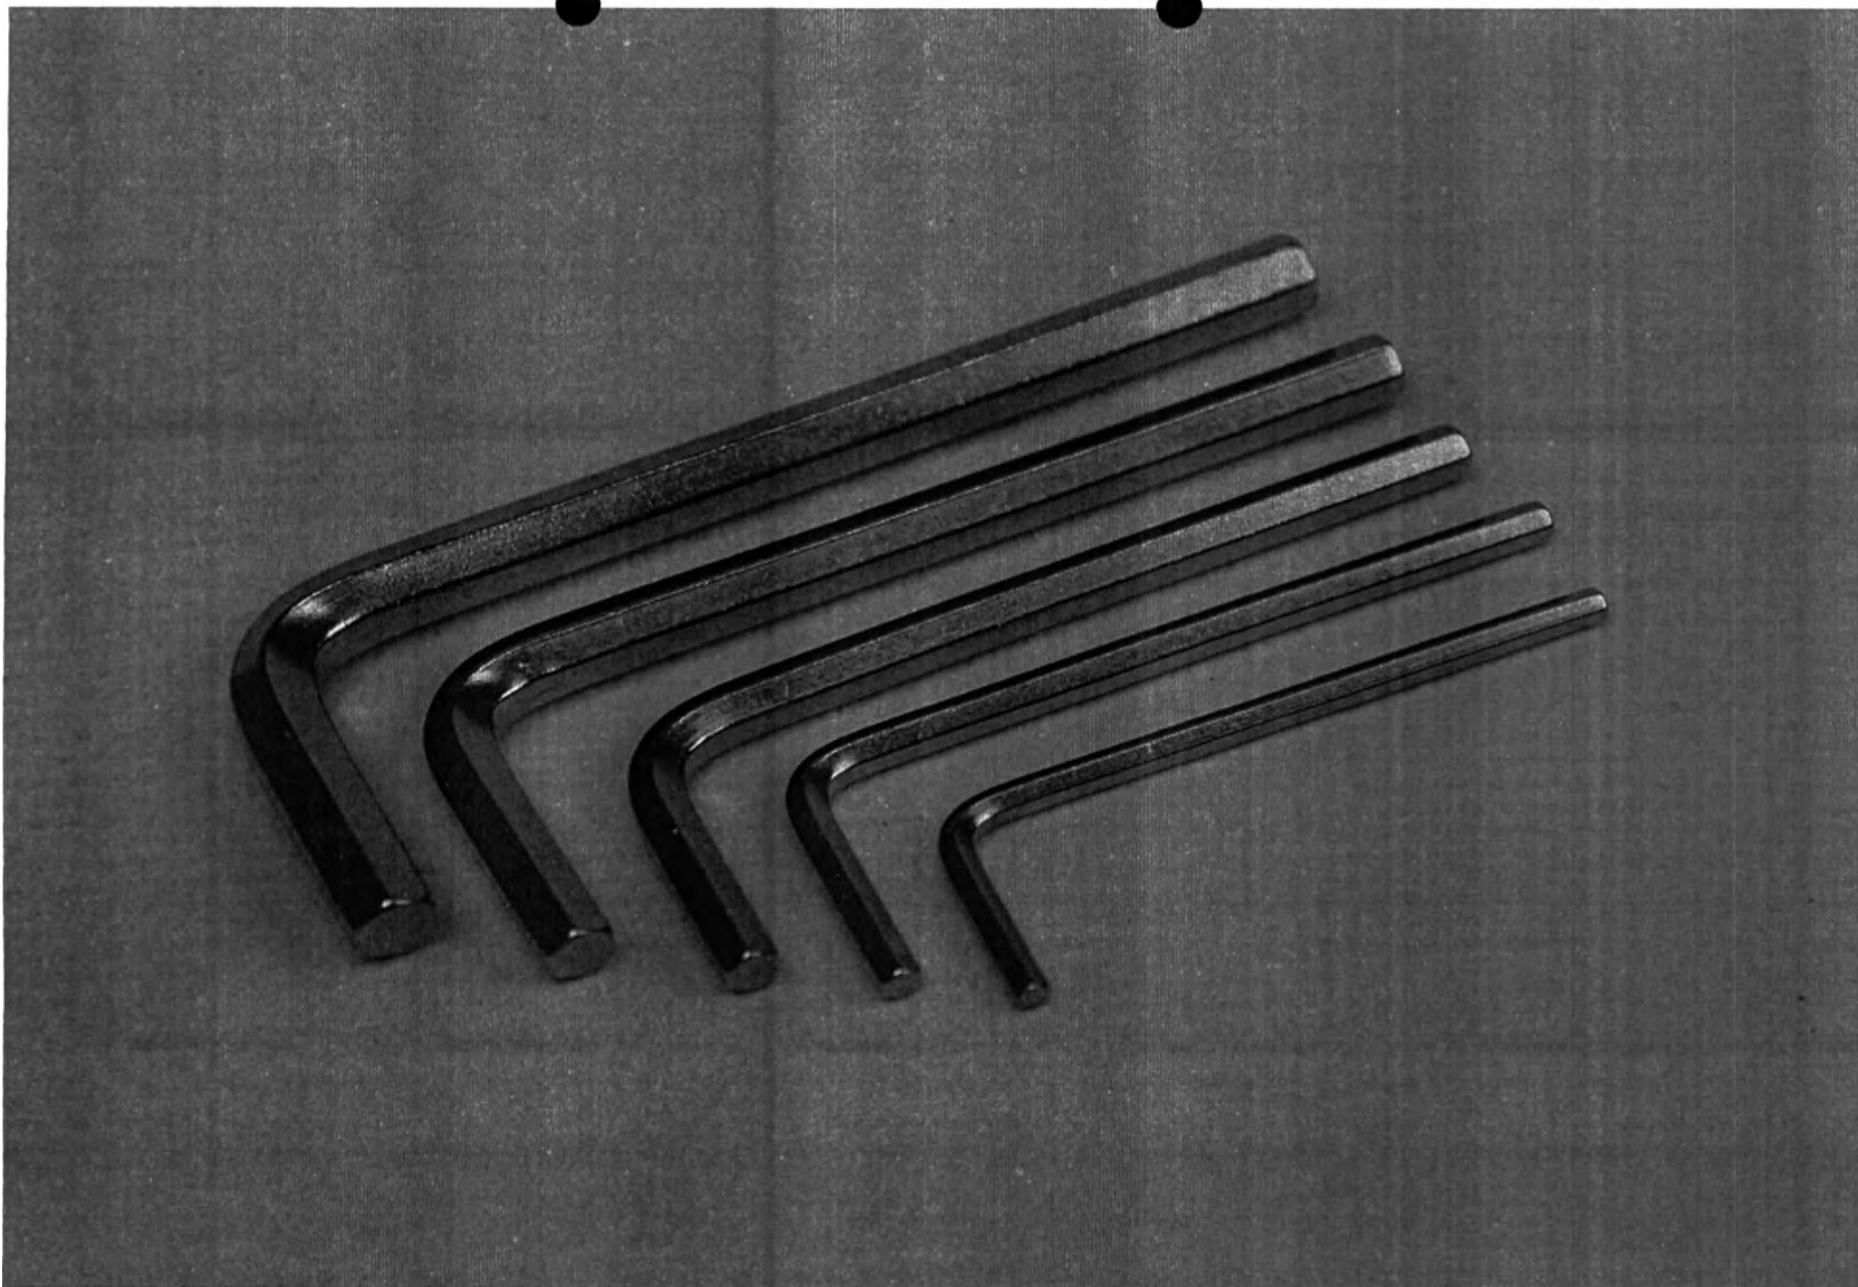

Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Набор ключей шестигранных



Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021. Предохранитель запасной F8AL250V (Ø5 x 20 мм, 8 А, 250 В)



Стол медицинский с электроприводом
СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021
с принадлежностями

Зав. № 001

Дата выпуска: 19.03.2021

Напряжение питания/частота

220В±10%/50Гц

Потребляемая мощность не более

320Вт

ТУ 32.50.30-008-01324118-2021

Рег. удостоверение: №

от

г.



ООО «ТАГЛЕР», Россия, 107076, г. Москва,
ул. Богородский вал, д.3, строение 29, эт. I,
пом. III, ком. 8,9



Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Маркировка на изделии



**Стол медицинский с электроприводом
СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021
с принадлежностями**

Зав. № _____

Дата выпуска: _____. _____. 20__

Комплект поставки:

1. Опора с регулируемыми ножками – 2 шт.
2. Основание стола с механизмом подъёма в сборе – 1 шт.
3. Столешница с подставкой для оборудования и внутренним ящиком в сборе – 1 шт.
4. Трубка-основание – 1 шт.
5. Электролампа освещения поворотная с кронштейном для фороптера – 1 шт.
6. Кронштейн крепления разборной стойки – 1 шт.
7. Стойка разборная (из 2 частей) -- 1 шт.
8. Кабель электропитания в стойке разборной – 1 шт.
9. Площадка на стойку разборную – 1 шт.
10. Кабель электропитания – 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Принадлежности:

1. Болт (Ø8, L=20) крепления опоры и столешницы к основанию стола – 8 шт.
2. Заглушки резиновые – 6 шт.
3. Болт (Ø6, L=40) крепления трубки-основания с шайбой и гровером – 4 шт.
4. Болт (Ø8, L=40) крепления кронштейна разборной стойки к опоре – 2 шт.
5. Болт (Ø4, L=12 мм) крепления разборной стойки к кронштейну на опоре – 4 шт.
6. Болт (Ø5, L=10 мм) крепления частей разборной стойки и площадки на разборную стойку – 4 шт.
7. Лампа для электролампы – 1 шт.
8. Набор ключей шестигранных – 1 шт.
9. Предохранитель запасной F8AL250V (Ø5 x 20 мм, 8 А, 250 В) – 2 шт.

Условия хранения и эксплуатации: +5° до +40°, относительная влажность 80% относительная влажность – 80 % при температуре 25°C, атмосферное давление 70 – 106 кПа.

ТУ 32.50.30-008-01324118-2021

Рег. удостоверение: № _____

от _____


г. _____



ООО «ТАГЛЕР», Россия, 107076, г. Москва,
ул. Богородский вал, д.3, строение 29, эт.1,
пом. III, ком. 8,9



Стол медицинский с электроприводом СО-4 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Маркировка на потребительской упаковке

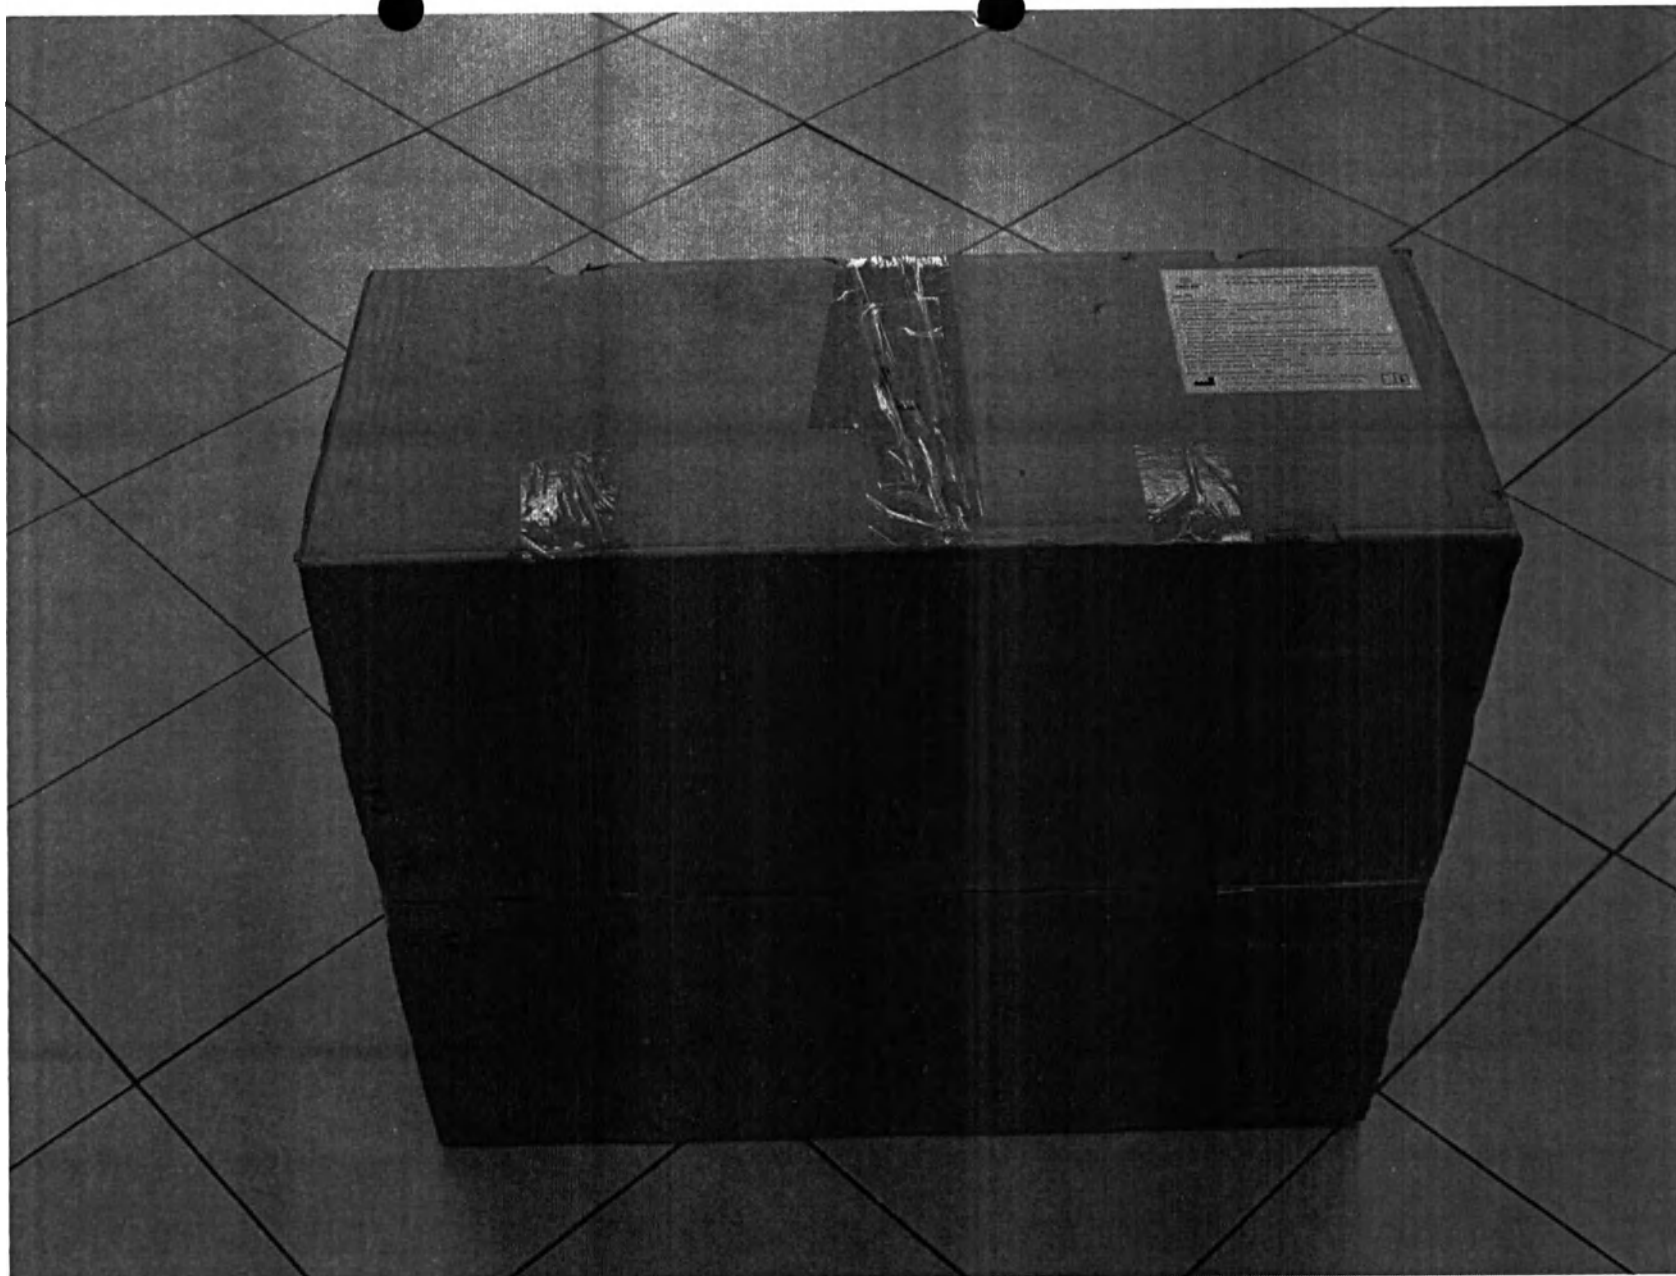

Стол медицинский с электроприводом СО-по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями. Потребительская упаковка

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью ВЗ листа(ов).

ЛН
(подпись) Ген. директор Ляпин А.Н.

Дата «26» ноября 2021 года

