



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Ормко Корпорэйшн»

А.А. Шавырин

А.А. Шавырин

21.09.2020

«21» сентября 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear

Ormco Corporation

(Ормко Корпорэйшн),

США

Оглавление

Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear (5 шт/уп), варианты исполнения:	3
1. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на правый центральный резец верхней челюсти, торк +17°/ангуляция +4°/ротация 0°, артикул 418-1110	3
2. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на левый боковой резец верхней челюсти, торк +10°/ангуляция +8°/ротация 0°, артикул 418-1211	6
3. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на правый клык верхней челюсти, торк 0°/ангуляция +8°/ротация 0°, артикул 418-1310	9
4. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на левый клык нижней челюсти, торк 0°/ангуляция +3°/ротация 2°, артикул 418-1411	12
5. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на 1-й и 2-й премоляры верхней челюсти универсальный, торк -7°/ангуляция 0°/ротация 0°, артикул 418-1510	15
6. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на 1-й премоляр нижней челюсти универсальный, торк -12°/ангуляция 0°/ротация 0°, артикул 418-1610	18
7. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на левый клык верхней челюсти с крючком, торк 0°/ангуляция +8°/ротация 0°, артикул 418-2311	21
8. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на левый 1-й премоляр нижней челюсти с крючком, торк -12°/ангуляция +2°/ротация 0°, артикул 418-2611	24
9. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на центральный и боковой резец нижней челюсти универсальный, торк -6°/ангуляция 0°/ротация 0°, артикул 419-1010	27
10. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый боковой резец верхней челюсти с низким профилем, торк +10°/ангуляция +8°/ротация 0°, артикул 419-1213	30
11. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на 2-й премоляр нижней челюсти универсальный, торк -17°/ангуляция 0°/ротация 0°, артикул 419-1710	33
12. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый клык верхней челюсти с крючком, торк 0°/ангуляция +8°/ротация 0°, артикул 419-2310	36
13. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый клык нижней челюсти с крючком, торк 0°/ангуляция +3°/ротация 2°, артикул 419-2411	39
14. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый 1-й и 2-й премоляры верхней челюсти с крючком, торк -7°/ангуляция 0°/ротация 0°, артикул 419-2511	42
15. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый 2-й премоляр нижней челюсти с крючком, торк -17°/ангуляция +2°/ротация 0°, артикул 419-2710	45

Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear (5 шт/уп), варианты исполнения:

1. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на правый центральный резец верхней челюсти, торк +17°/ ангуляция +4°/ ротация 0°, артикул 418-1110

Представлена синяя цветовая точка.



symetri
CLEAR

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

CE REP

European Union Representative
Karr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-41018 Scalfari (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish


BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikaloren (hvis relevant).



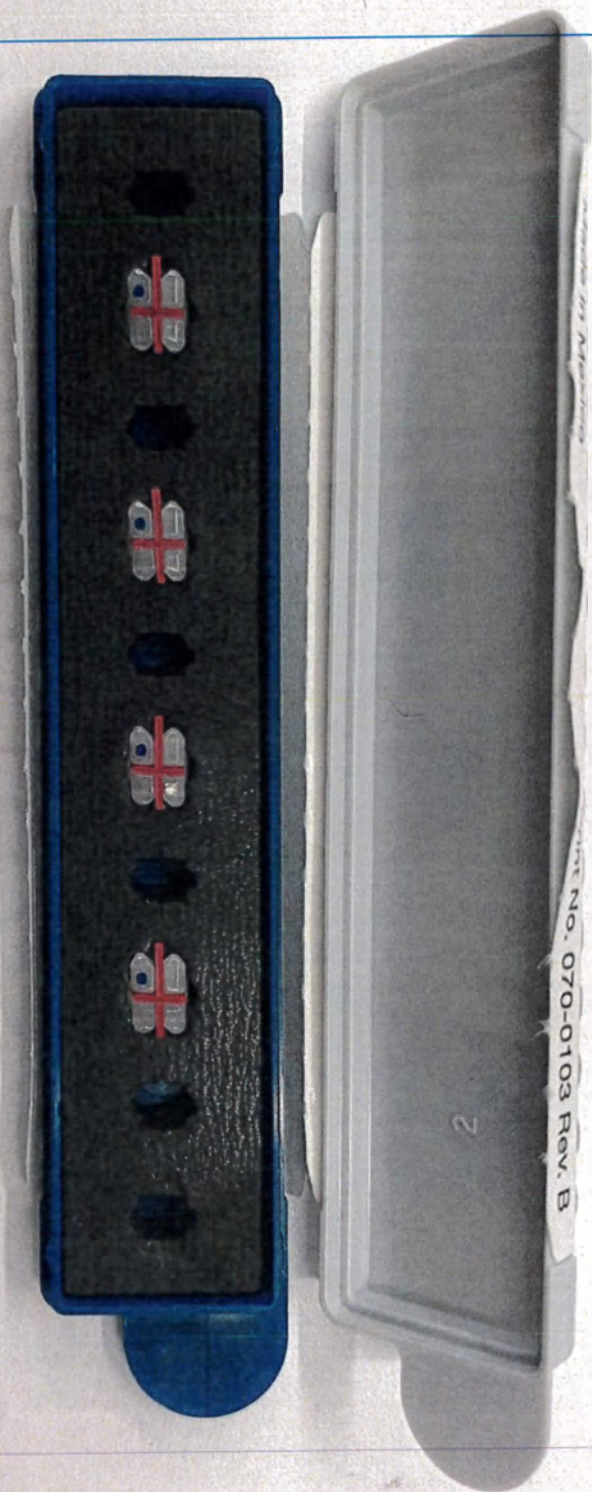

2. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на левый боковой резец верхней челюсти, торк +10°/ ангуляция +8°/ ротация 0°, артикул 418-1211
Представлена розовая цветовая точка.



symetri
CLEAR

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA) Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

**DO NOT
RE-USE**

CAUTION

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).

symetri
CLEAR



Ormco

McLaughlin, Bennett, Trevisi Rx

Manufactured by
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Ave.
Glendora, CA 91740 USA
Distribution Facility: Ormco PVTY LTD
Unit 10, 112-118 Mawana Road
North Ryde, NSW 2113 Australia
EC REP
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti 332
I-84018 Scafati (SA) Italy

symetri

CAUTION

**DO NOT
RE-USE**

MD
MEDICAL
DEVICE

CE
0086

REF

Part No. 418-1211

U2L

SLOT

.018

TQ

+10°

ANG

+8°

ROT

0°

QTY

5

LOT

012023782



Made in Mexico

Print No. 070-0103 Rev. B

3. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на правый клык верхней челюсти, торк 0°/ангуляция +8°/ротация 0°, артикул 4181310
Представлена зеленая цветовая точка.

symetri
CLEAR

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

**DO NOT
RE-USE**

CAUTION

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).



symetri
CLEAR

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).





4. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на левый клик нижней челюсти, торк 0° / ангуляция +3° / ротация 2° , артикул 418-1411
Представлена голубая цветовая точка.

symetri
CLEAR

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).


Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).



symetri

Rx ONLY
in accordance
with US law only

ECT/NEP

European Union Representative:
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 33
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility pier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (hvis relevant).

symetri
CLEAR

Ormco

McLaughlin, Bennett, Trevisi Rx

Manufactured by
Ormco Corporation
1392 South Lone Hill Ave.
Glendora, CA 91740 | USA
Distribution Facility | Ormco PTY LTD
Unit 10, 112-118 Tennyson Road
North Ryde, NSW 2113 | Australia
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 33
I-84018 Scafati (SA), Italy

symetri

CAUTION

DO NOT
RE-USE

MD
MEDICAL
DEVICE

Rx Only
The US law only

CE
0086

REF

Part No. 418-1411

L3L

SLOT

TQ

ANG

ROT

QTY

3

018

0°


+3°

+2°

5

LOT

012092289



5. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на 1-й и 2-й премоляры верхней челюсти универсальный, торк -7°/ангуляция 0°/ротация 0°, артикул 418-1510
Представлена фиолетовая цветовая точка (на обоих «крыльях», т.к. брекет универсальный).



symetri
CLEAR

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).



symetri

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Soriano (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).

symetri
CLEAR
Ormco



McLaughlin, Bennett, Trevisi Rx

Manufactured by
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Ave.
Glendora, CA 91740 / USA
Distributor: Purity Dental Pty Ltd
Unit 10, 913-118 Selwyn Road
North Ryde, NSW 2113 / Australia
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Soriano (SA), Italy

REF

MD

CE

0086

Part No. 418-1510

U4&5 Univ.

SLOT

TQ

ANG


ROT

QTY

5

LOT

121975927



6. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на 1-й премоляр нижней челюсти универсальный, торк -12°/ангуляция 0°/ ротация 0°, артикул 418-1610
Представлена белая цветовая точка (на обоих «крыльях», т.к. брекет универсальный).



Rx ONLY*
**In accordance with US law only*

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S r.L. Via Passanti, 332
I-64018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

**DO NOT
RE-USE**

CAUTION

English
INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (If applicable).

Danish
BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).

Огтсо
symetri
CLEAR

McLaughlin, B. Scott, Thomas R.



symetri
CLEAR

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Soriano (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (If applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).

symetri
CLEAR

Ormco

McLaughlin, Bennett, Trevisi Rx



Manufactured by
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Ave.
Glendora, CA 91740 | USA
Distributors: Ormco Pty Ltd
Unit 10, 115-117 Telford Road
South Park, NSW 2113 | Australia
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Soriano (SA), Italy

CAUTION

REF Part No. 418-1610

L4 Univ.

SLOT TQ ANG ROT QTY

.018 -12° 0° 0° 5

LOT 081976467



7. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на левый клык верхней челюсти с крючком, торк 0°/ ангуляция +8°/ ротация 0°, артикул 418-2311
Представлена зеленая цветовая точка.



symetri

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

EC/REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scarfati (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

**DO NOT
RE-USE**

CAUTION

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (hvis relevant).

symetri
CLEAR
Ormco



McLaughlin, Bennett, Trevisi Rx

Manufactured by
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Ave.
Glendora, CA 91740 | USA
Distribution Facility | Ormco PTY LTD
Unit 10, 112-118 Talsers Road
North Ryde, NSW 2113 | Australia
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Scarfati (SA), Italy

symetri

CAUTION

**DO NOT
RE-USE**

MD
MEDICAL
DEVICE

CE
0086

Rx Only*
*For US law only

REF

Part No. 418-2311

U3L HOOK

SLOT

TQ

ANG

ROT

QTY

3

018

0°


+8°

0°

5

LOT

121975930



8. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на левый 1-й премоляр нижней челюсти с крючком, торк -12°/ ангуляция +2°/ ротация 0°, артикул 418-2611
Представлена белая цветовая точка.



symetri
CLEAR

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klæmmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).

symetri
CLEAR

Ormco

McLaughlin, Bennett, Trevisi Rx

Manufactured by
Ormco Corporation
1332 South Lone Lane Ave.
Glendora, CA 91740 USA
Distribution Facility | Ormco PTY LTD
Unit 10, 112-118 Talavera Road
North Ryde, NSW 2113 Australia
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

symetri

CAUTION

DO NOT
RE-USE

MD
MEDICAL
DEVICE

CE
0086

Rx Only*


*For US law only

REF Part No. 418-2611

L4L HOOK

SLOT	TQ	ANG	ROT	QTY
.018	-12°	+2°	0°	5

LOT 012007995



9. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .022 на центральный и боковой резец нижней челюсти универсальный, торк -6°/ангуляция 0°/ротация 0°, артикул 419-1010
Представлена желтая цветовая точка (на обоих «крыльях», т.к. брекет универсальный).



symetri
CLEAR

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).

symetri

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-34018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).

symetri
CLEAR

Ormco

McLaughlin, Bennett, Trevisi Rx

Manufactured by
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Ave.
Glendora, CA 91740 | USA
Distribution Facility | Ormco PTY LTD
Unit 10, 112-118 Tabvera Road
North Ryde, NSW 2113 | Australia
EC REP
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-34018 Scafati (SA), Italy

symetri

CAUTION

DO NOT
RE-USE

MD
MEDICAL
DEVICE

Rx Only*
*For US law only

CE
0086

REF Part No. 419-1010

L1&2 UNIV

SLOT TQ ANG ROT QTY

.022 -6° 0° 0° 5

LOT 032054137



10. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .022 на левый боковой резец верхней челюсти с низким профилем, торк +10°/ ангуляция +8°/ ротация 0°, артикул 419-1213
Представлена розовая цветовая точка.



symetri
CLEAR

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. - Via Passanti, 332
I-84018 Soriano (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

Rx ONLY
For use only
with US law only

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WAFAIR - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).

symetri
CLEAR

Ormco

McLaughlin, Bennett, Trevisi Rx

Manufactured by
Ormco Corporation
1330 South Lone Hill Ave
Gardenia, CA 91740 USA
Distribution Facility | Ormco PTY LTD
Unit 10, 112-118 Melrose Road
North Ryde, NSW 2113 Australia
Kerr Italia S.r.l. - Via Passanti, 332
I-84018 Soriano (SA), Italy

symetri

CLEAR

CAUTION

DO NOT RE-USE

MD MEDICAL DEVICE

CE 0086 For US use only

REF Part No. 419-1213

U2L SLIM IN/OUT


SLOT TQ ANG

.022 +10° +8°

LOT 022049116

ROT QTY

0° 5



Print No. 070-0103 Rev. B

8

11. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на 2-й премоляр нижней челюсти универсальный, торк -17°/ ангуляция 0°/ ротация 0°, артикул 419-1710
Представлена красная цветовая точка (на обоих «крыльях», т.к. брекет универсальный).



symetri
CLEAR

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Soriano (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - For montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).

symetri
CLEAR

Ormco

McLaughlin, Bennett, Travis Rx

Manufactured by
Ormco Corporation
1332 South Lorne Hill Ave.
Glendora, CA 91740 | USA
Distribution Facility | Ormco PTY LTD
Unit 10, 112-118 Talavera Road
North Ryde, NSW 2113 | Australia
Kerr, Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Soriano (SA), Italy

CE
0086

DO NOT
RE-USE

CAUTION

MD
MEDICAL
DEVICE

Rx Only
*For US law only


REF Part No. 419-1710

L5 Univ.

SLOT TO ANG ROT QTY

.022 -17° 0° 0° 5

LOT 032087055



12. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый клык верхней челюсти с крючком, торк 0°/ ангуляция +8°/ ротация 0°, артикул 419-2310

Представлена зеленая цветовая точка.



symetri
CLEAR

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

**DO NOT
RE-USE**

CAUTION

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish


BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).





13. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый клык нижней челюсти с крючком, торк 0° ангуляция +3°/ ротация 2°, артикул 419-2411

Представлена голубая цветовая точка.



symetri
CLEAR

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l. Via Passanti, 332
I-84018 Soriano (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish


BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemidlet ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (hvis relevant).





Made in Mexico

Print No. 070-0103 Rev. B

6

14. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый 1-й и 2-й премоляры верхней челюсти с крючком, торк -7°/ ангуляция 0°/ ротация 0°, артикул 419-2511
Представлена фиолетовая цветовая точка.



symetri
CLEAR

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

DO NOT
RE-USE

CAUTION

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (If applicable).

Danish

BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en val- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).

symetri
CLEAR

Ormco

McLaughlin, Bennett, Trevisi Rx

Manufactured by
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Ave.
Glendora, CA 91740 | USA
Distribution Facility | Ormco PTY LTD
Unit 10, 112-118 Talavera Road
North Ryde, NSW 2113 | Australia
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

symetri

CAUTION

DO NOT
RE-USE

MD
MEDICAL
DEVICE

CE
0086

Rx Only*

*For US law only

REF

Part No. 419-2511

45

U4&5L HOOK

SLOT

TQ

ANG

ROT

QTY

022

-7°


0°

0°


5

LOT

022060096



15. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .022 на правый 2-й премоляр нижней челюсти с крючком, торк -17°/ангуляция +2°/ротация 0°, артикул 419-2710
Представлена красная цветовая точка.



symetri
CLEAR

Rx ONLY*
*In accordance
with US law only

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

MD
MEDICAL
DEVICE

**DO NOT
RE-USE**

CAUTION

English

INDICATIONS FOR USE - This device is intended for the orthodontic movement of teeth. It is used temporarily and is removed after Orthodontic treatment has been completed.

ENAMEL WARNING - Prior to bonding orthodontic brackets, consideration must be given to enamel health, bonding cement and position on the tooth.

BONDING TIPS

- Prepare enamel surface using standard protocol
- Using an instrument, press adhesive into the base of the bracket
- Place bracket firmly on the tooth, expressing excess adhesive
- Remove adhesive flash from bracket & tooth junction
- Polymerize adhesive following manufacturer's instructions
- Use a cotton or utility plier to remove Axis Indicator (if applicable).

Danish


BRUGSANVISNINGER - Denne enhed er beregnet til ortodontisk tandflytning. Den bruges midlertidigt og fjernes, når den ortodontiske behandling er afsluttet.

EMALJEADVARSEL - Før montering af ortodontiske lås skal der tages hensyn til emaljens sundhed, cement og placering på tanden.

MONTERINGSTIPS

- Forbered emaljeoverfladen iht. standardprotokol
- Pres klæbemiddel ind i låsens fod vha. et instrument
- Placer låsen solidt på tanden, hvilket klemmer overskydende klæbemiddel ud
- Fjern overskydende klæbemiddel, hvor lås og tand mødes
- Polymeriser klæbemidlet ifølge producentens anvisninger
- Anvend en vat- eller standardtang til at fjerne akseindikatoren (Hvis relevant).





В фотофайле представлены изображения артикулов с всеми возможными вариантами цветовых точек и особенностями конструкции брекетов (с крючком, без крючка, с низким профилем, универсальные), остальные варианты исполнения медицинского изделия идентичны представленным ввиду симметрии зубного ряда, отличие заключается в размерах и величине паза.

Прошито и пронумеровано

Всего 47 (сорок семь) листов

Представитель по доверенности от 21.10.2019

Специалист по сертификации и регистрации

ООО «Ормко» [подпись] /Драчкова О.О./

