

Фотографии медицинского изделия

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ

ШЭ-22-«Я-ФП»


по ТУ 9451-022-55307168-2013

производства ООО «Ферропласт Медикал»,Россия,


152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский

Рециркулятор УФ-бактерицидный
двухламповый с принудительной
циркуляцией воздушного потока для
обеззараживания воздуха помещений
в присутствии людей РБ-07-«Я-ФП» с
принадлежностями


Емкость пластиковая
для сбора дезинфектанта

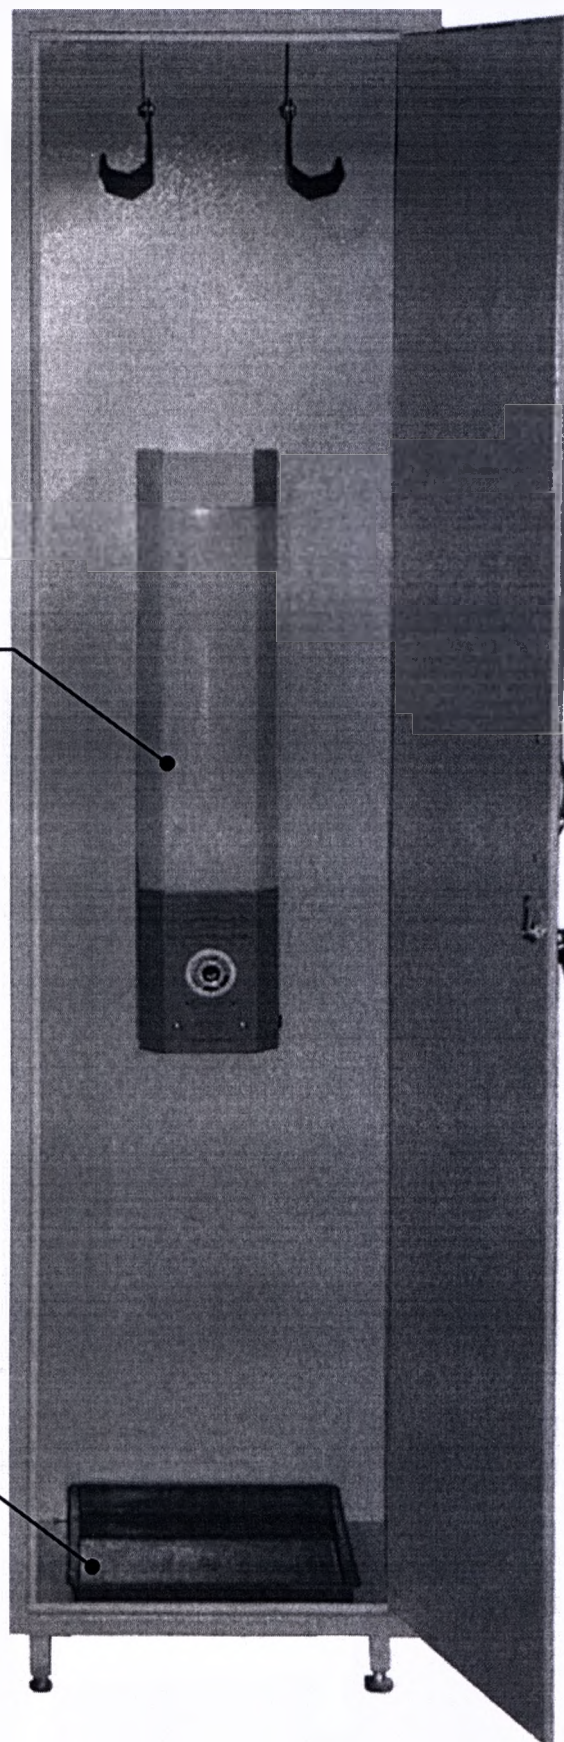

Фотография 1. Общий вид. Дверь открыта.
«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП» -01-1, ТУ 9451-022-55307168-2013

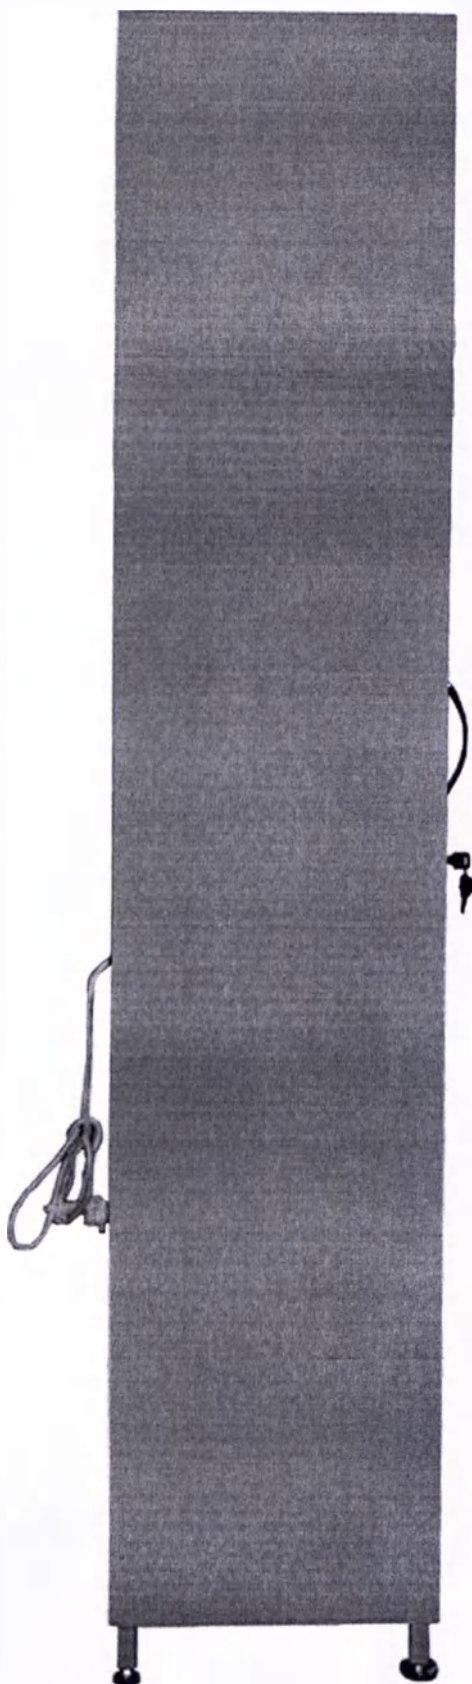


**Фотография 2. Общий вид сбоку.
«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП» -01-1, ТУ 9451-022-55307168-2013**

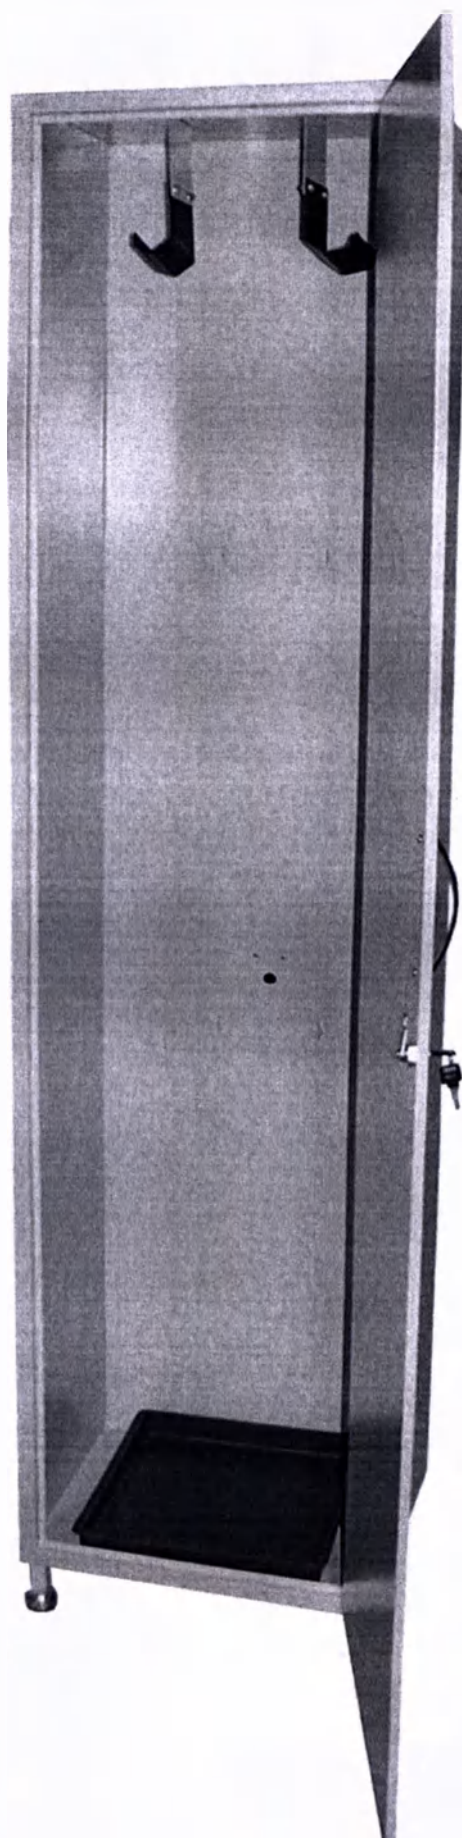


**Фотография 3. Общий вид. Дверь открыта. С креплением для рециркулятора бактерицидного и емкостью пластиковой для сбора дезинфектанта (поддоном).
«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП», исполнение ШЭ-22-«Я-ФП» -01-1, ТУ 9451-022-55307168-2013**

Рециркулятор УФ-бактерицидный
двухламповый с принудительной
циркуляцией воздушного потока для
обеззараживания воздуха помещений
РБ-18-«Я-ФП»-02


Емкость пластиковая
для сбора дезинфектанта

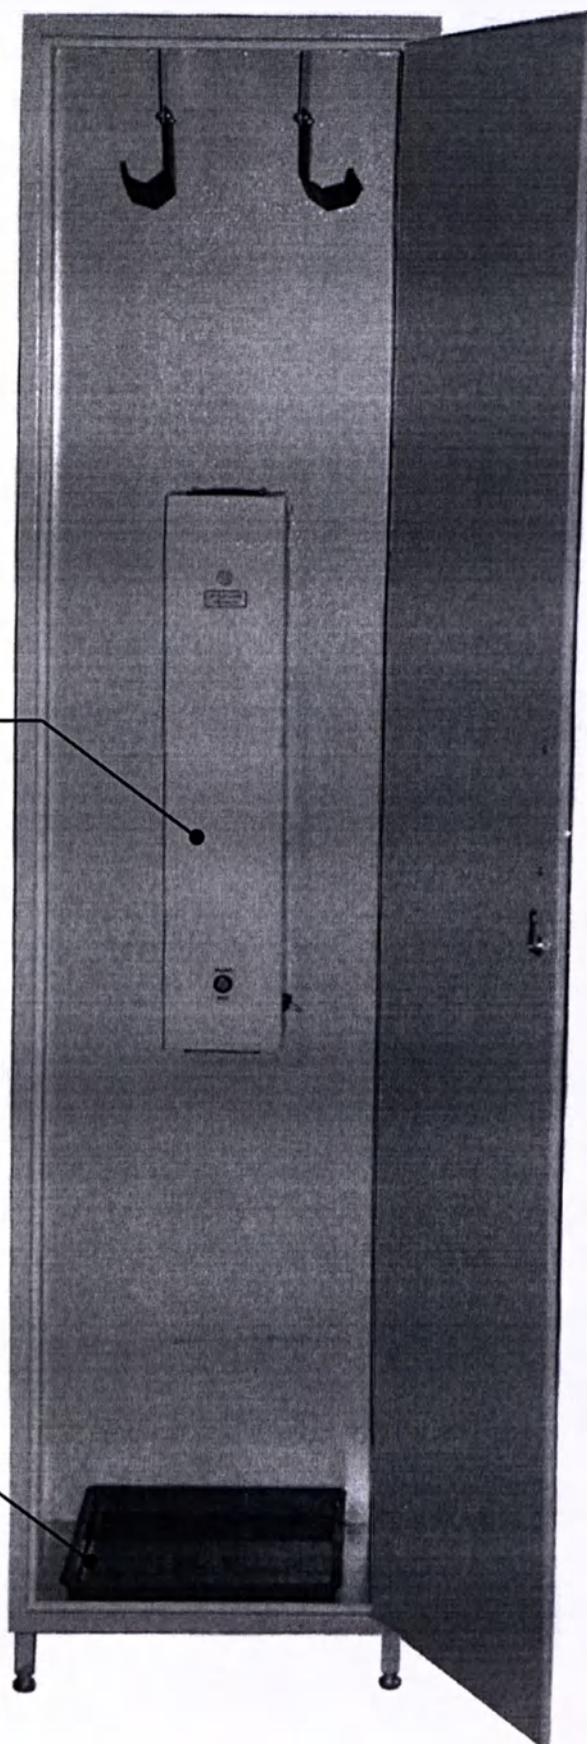

Фотография 4. Общий вид. Дверь открыта.
«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-01-2, ТУ 9451-022-55307168-2013

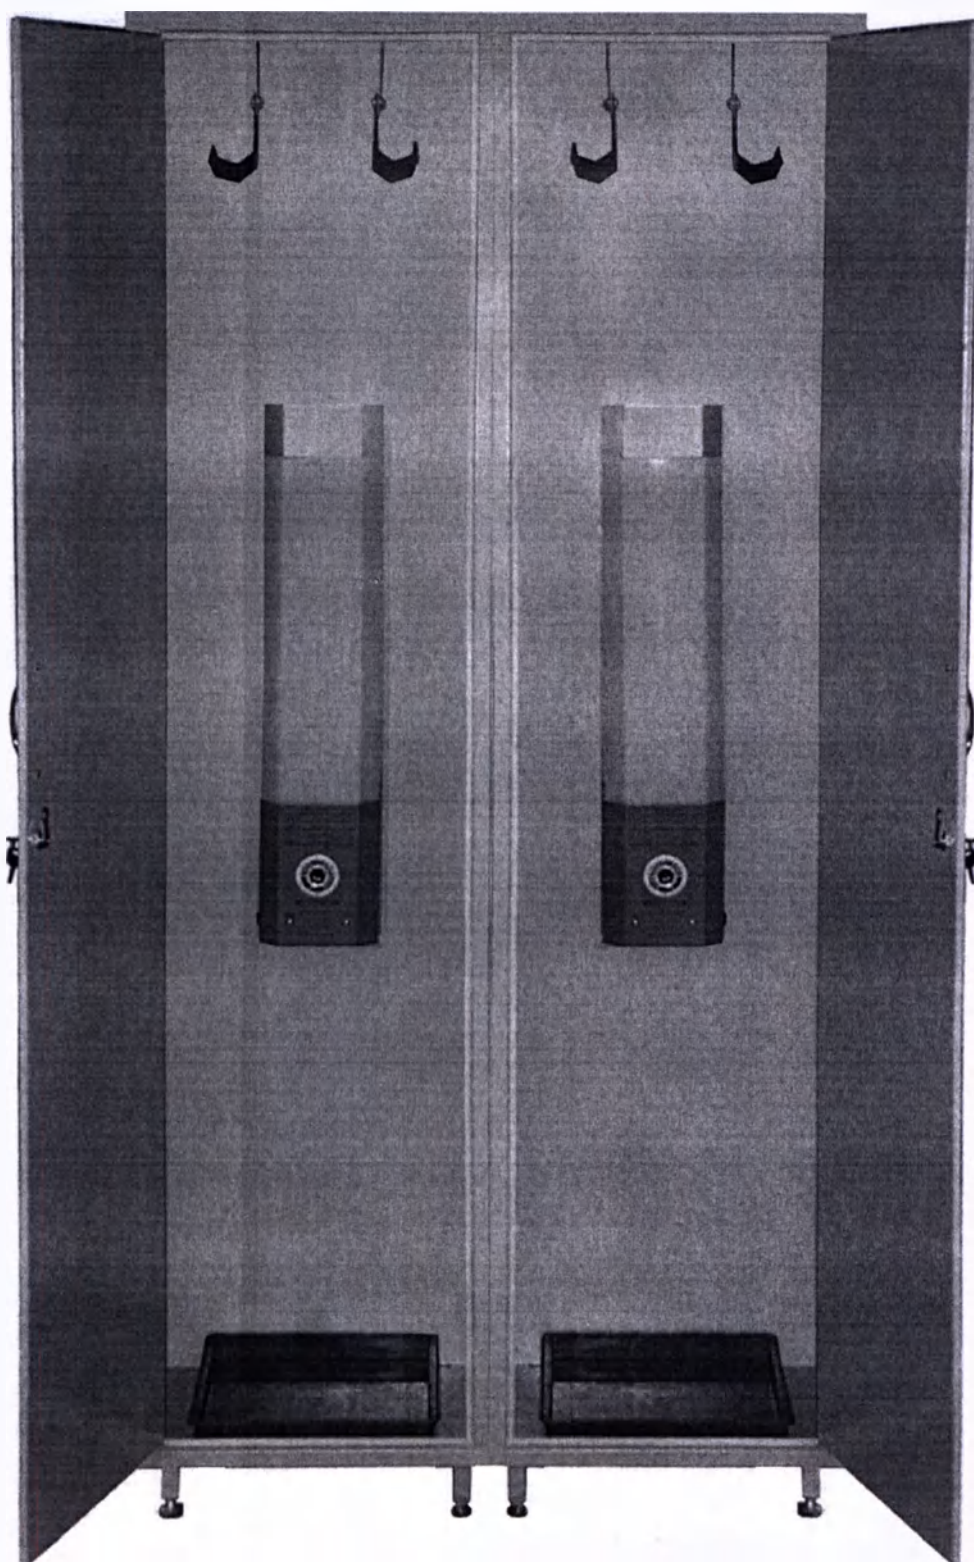


Фотография 5. Общий вид. Двери открыты.
«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-02-1, ТУ 9451-022-55307168-2013

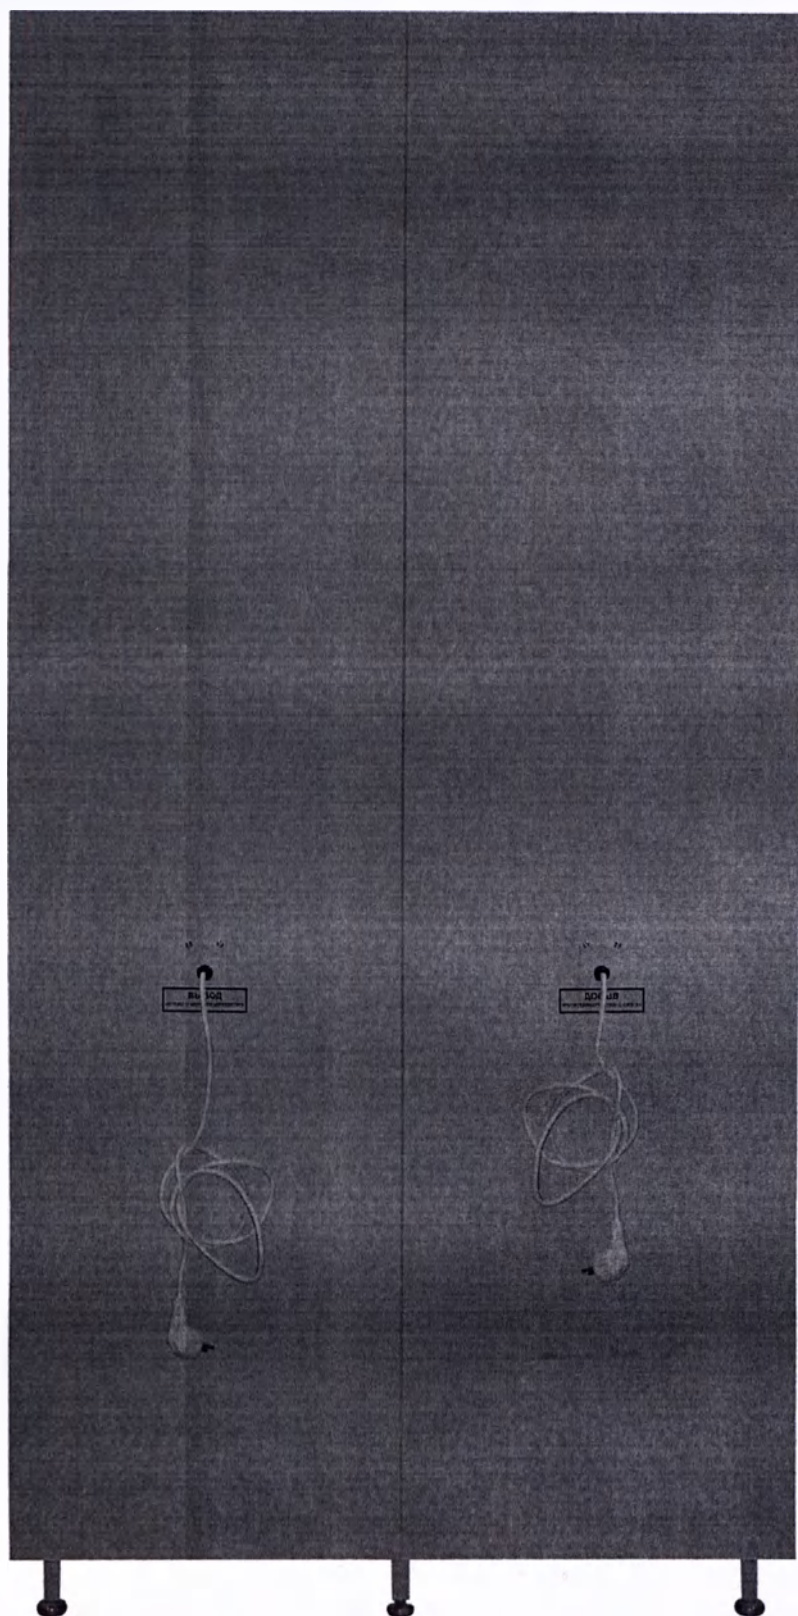


Фотография 6. Общий вид сзади.

**«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП» -02-1, ТУ 9451-022-55307168-2013**

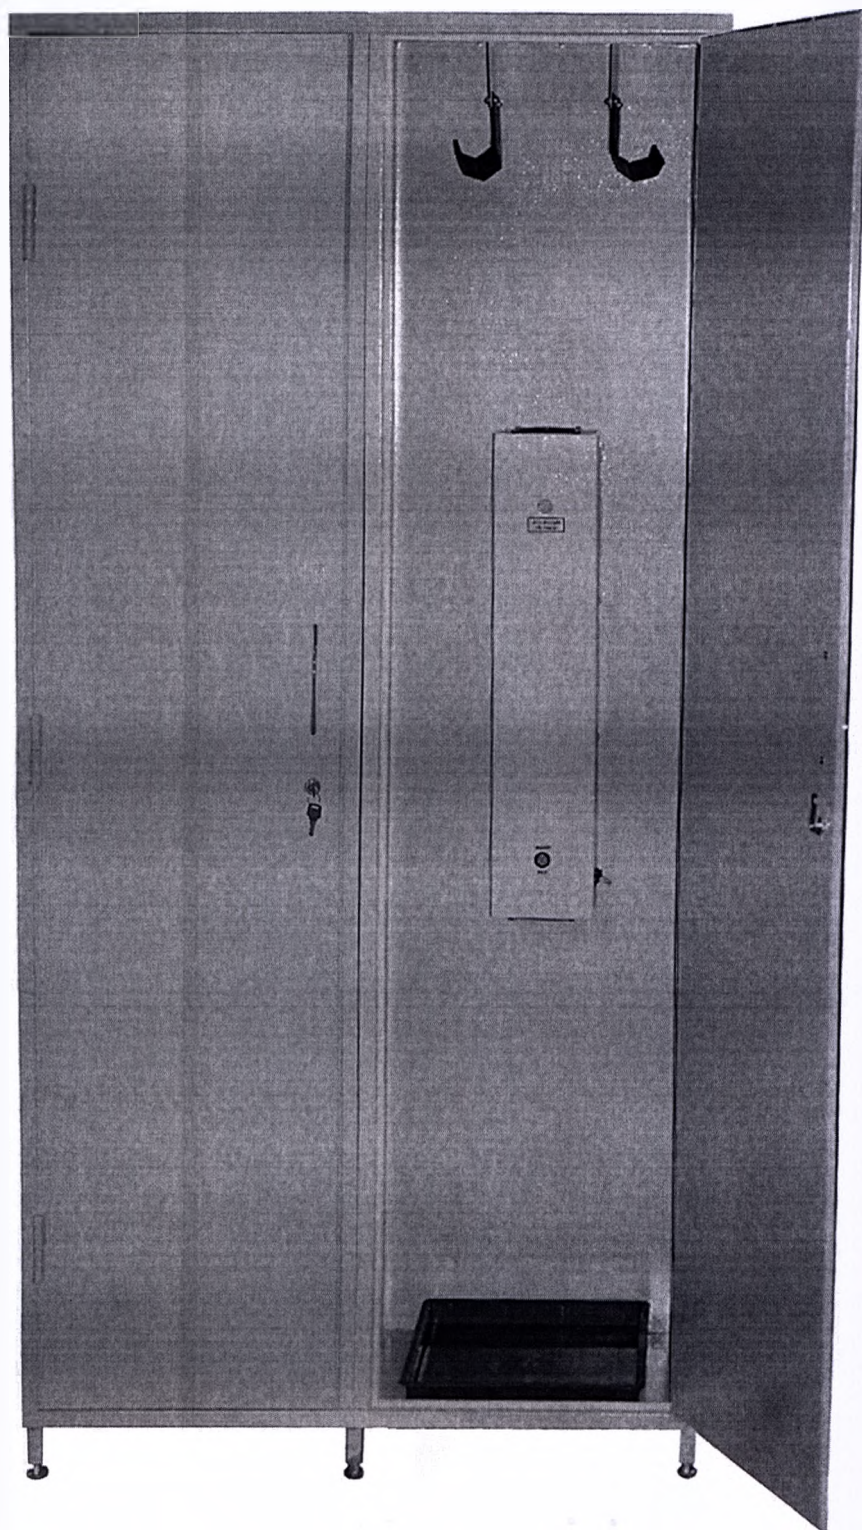


**Фотография 7. Общий вид. Одна дверь открыта.
«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП» -02-2, ТУ 9451-022-55307168-2013**

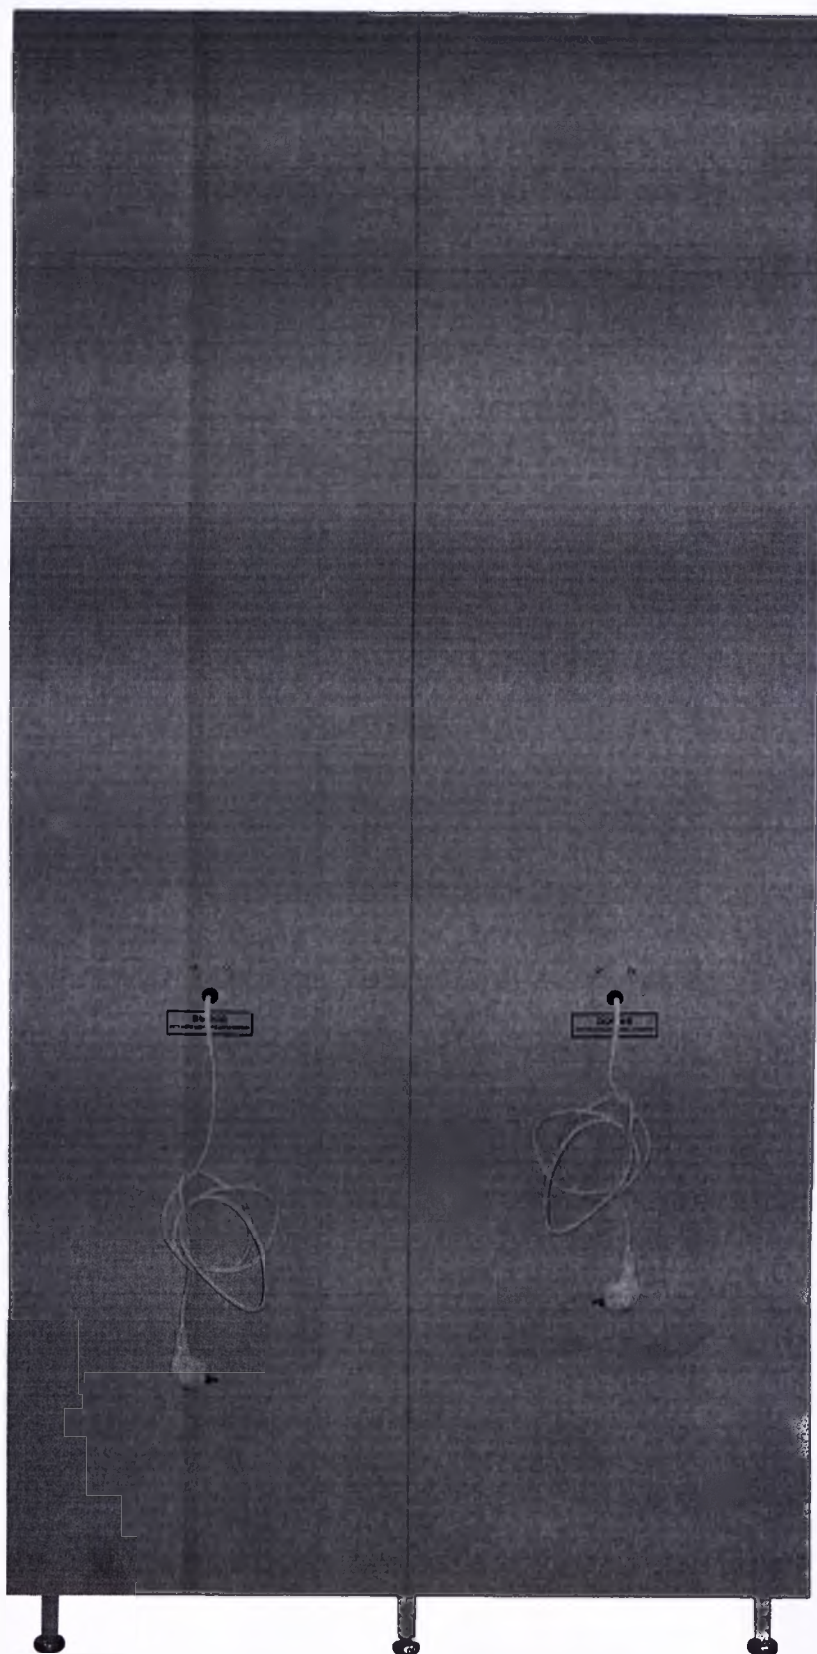


Фотография 8. Общий вид сзади.

**«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП» -02-2, ТУ 9451-022-55307168-2013**

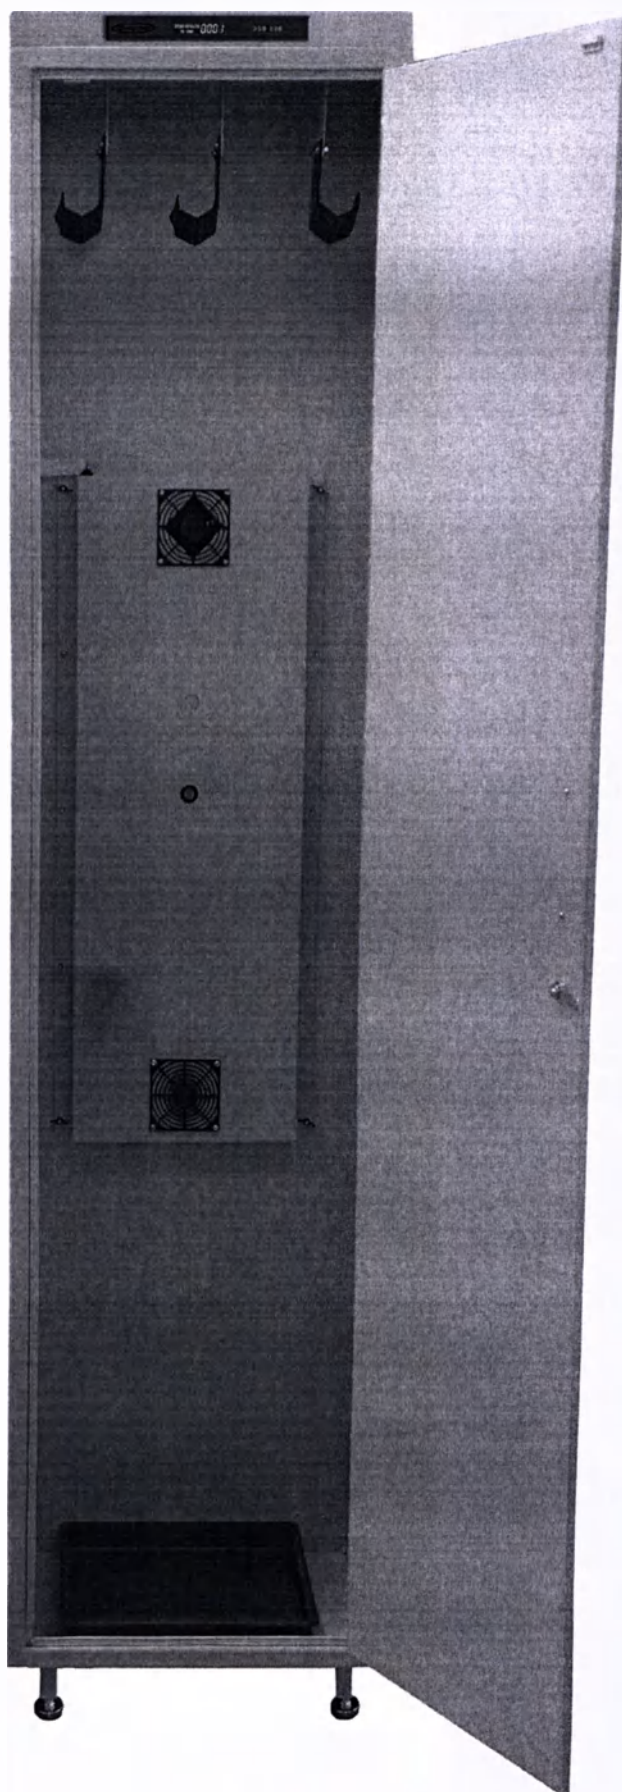


Фотография 9. Общий вид. Дверь открыта.

«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП», исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-03, ТУ 9451-022-55307168-2013 (Со встроенной системой обеззараживания воздуха.)

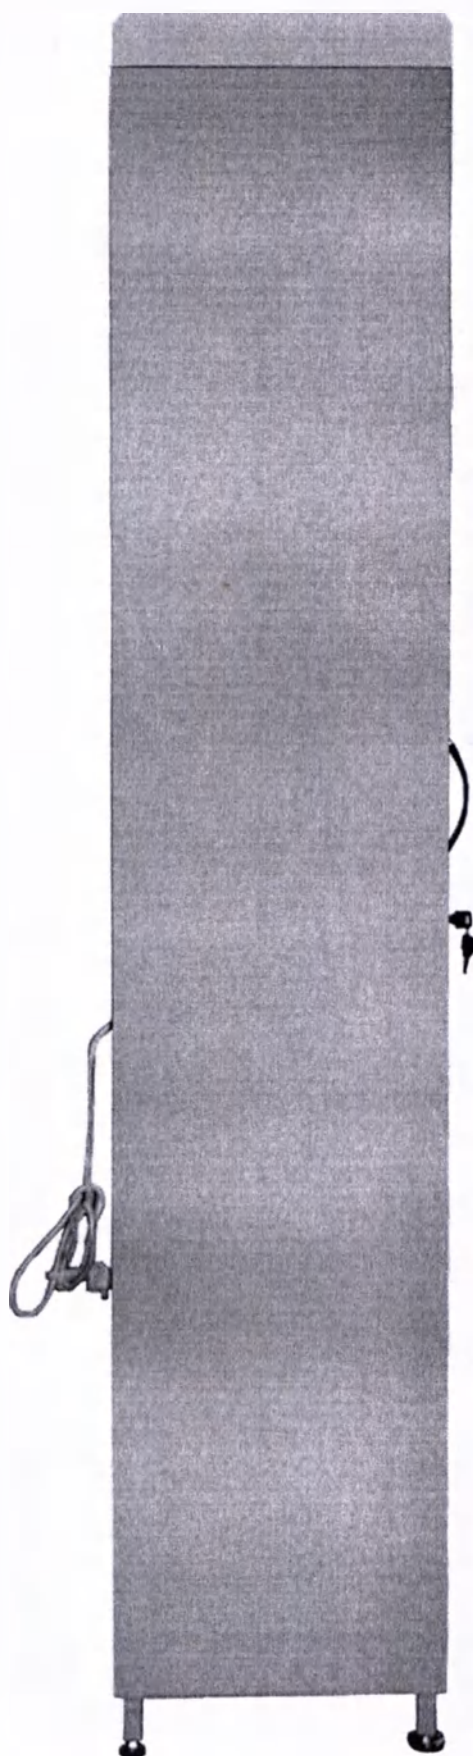


**Фотография 10. Общий вид сбоку.
«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-03, ТУ 9451-022-55307168-2013**

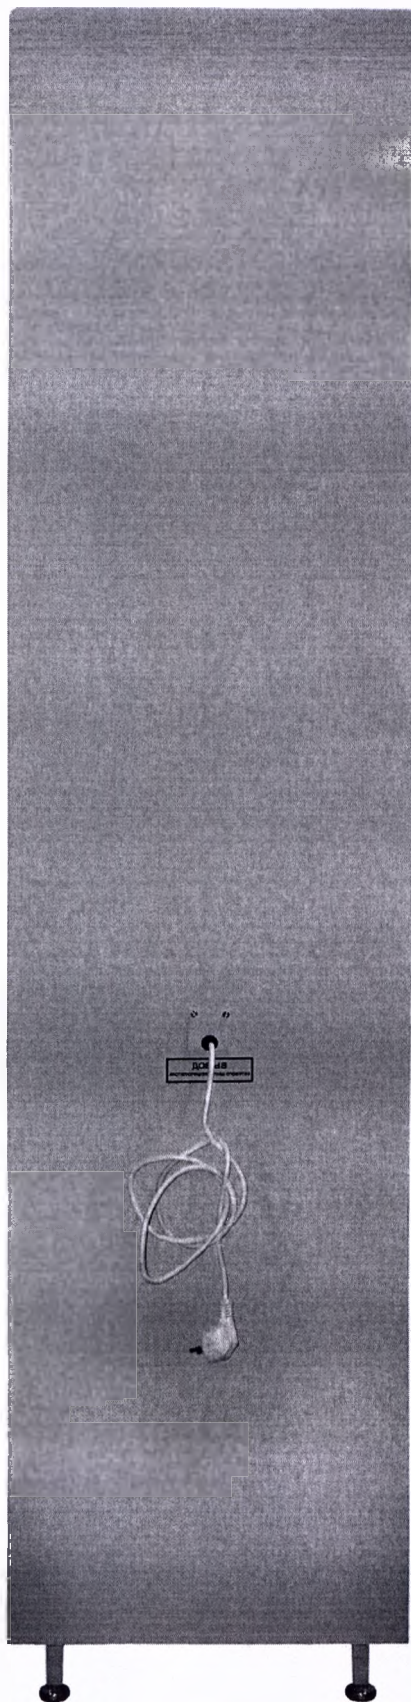


Фотография 11. Общий вид сзади.


**«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП» -03, ТУ 9451-022-55307168-2013**

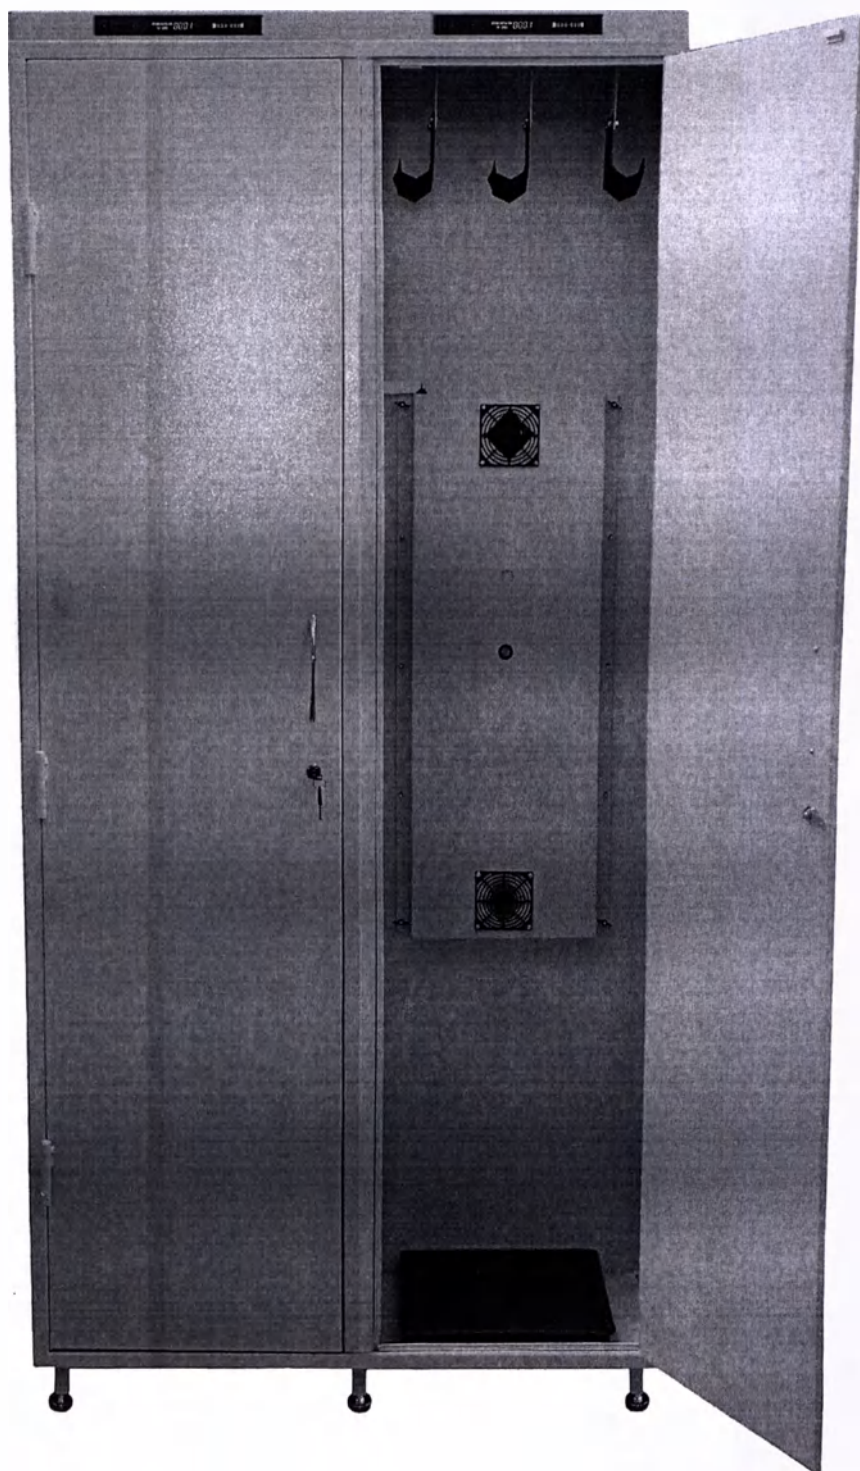

Фотография 12. Общий вид. Одна дверь открыта.
«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-04, ТУ 9451-022-55307168-2013
(Со встроенной системой обеззараживания воздуха)

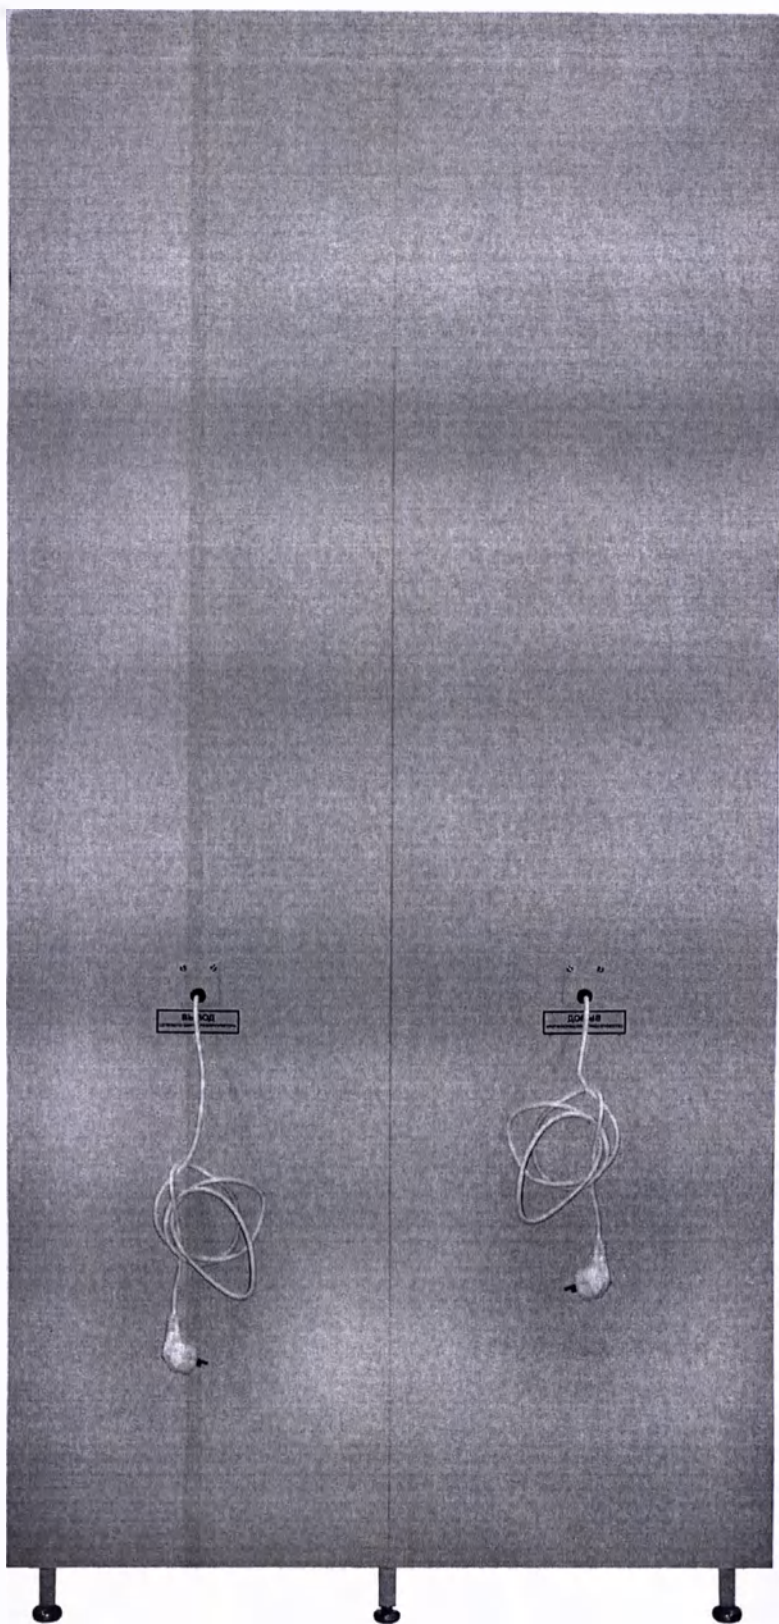


**Фотография 13. Общий вид сзади.
«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП» -04, ТУ 9451-022-55307168-2013**

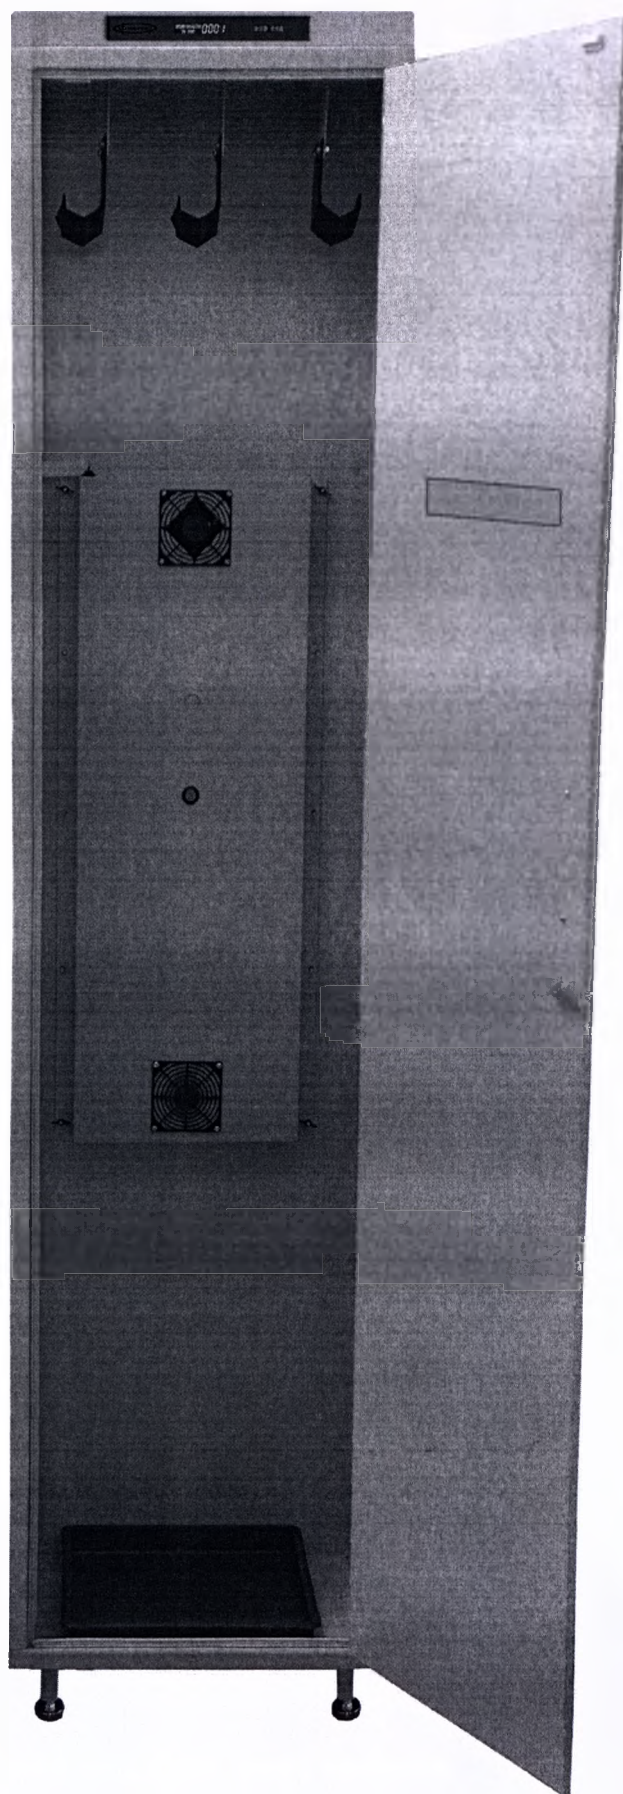


Фотография 14. Общий вид. Дверь открыта.

**«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-05, ТУ 9451-022-55307168-2013**

(Со встроенной системой обеззараживания воздуха и смотровым окном)

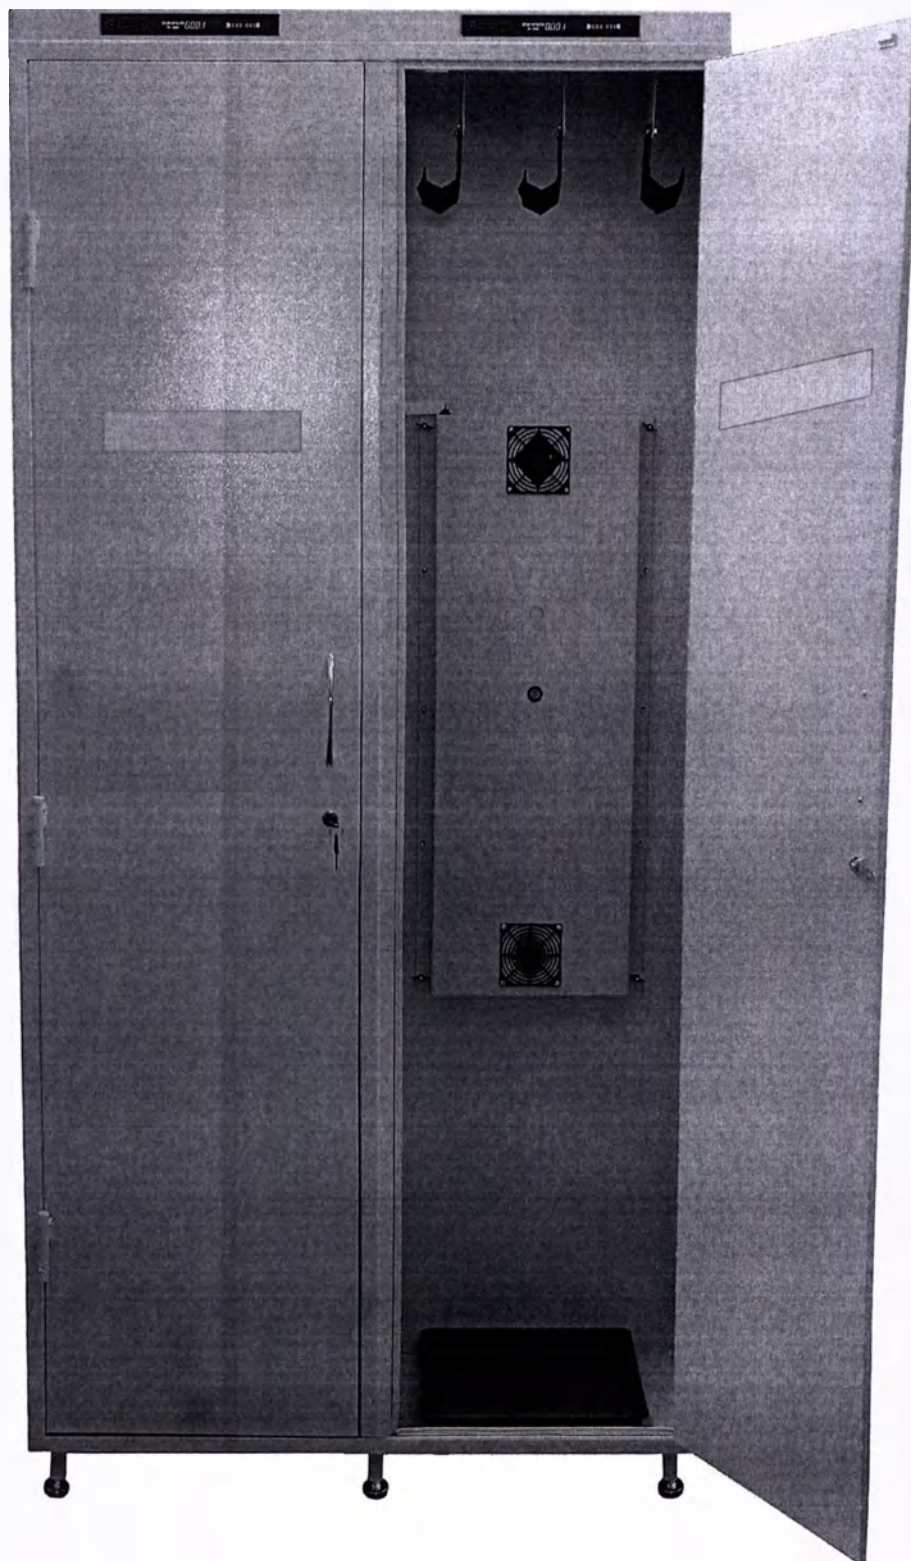


**Фотография 15. Общий вид. Одна дверь открыта.
«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-06, ТУ 9451-022-55307168-2013
(Со встроенной системой обеззараживания воздуха и смотровым окном)**

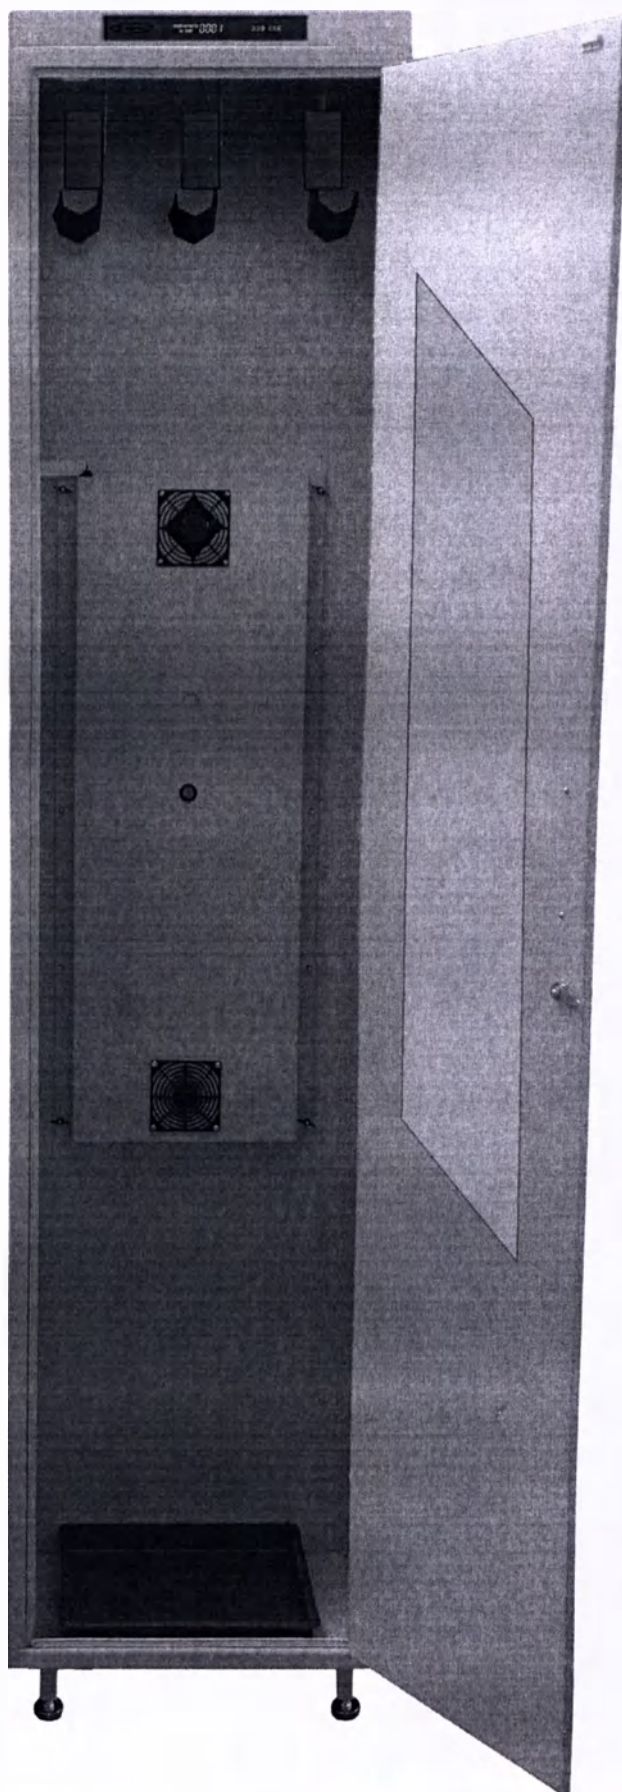

Фотография 16. Общий вид. Дверь открыта.

**«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-07, ТУ 9451-022-55307168-2013**

(Со встроенной системой обеззараживания воздуха, воздушной обработкой каналов)

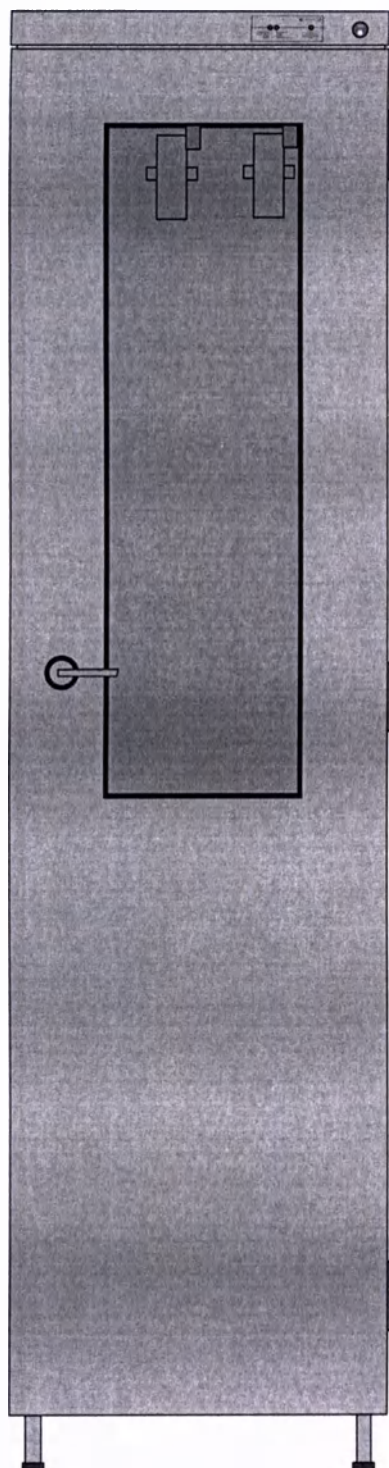

Фотография 17. Общий вид. Дверь закрыта.

**«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-07, ТУ 9451-022-55307168-2013**


**(Со встроенной системой обеззараживания воздуха, воздушной обработкой каналов
смотровым окном)**



Фотография 18. Вид сбоку.

**«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-07, ТУ 9451-022-55307168-2013**


**(Со встроенной системой обеззараживания воздуха, воздушной обработкой каналов
смотровым окном)**

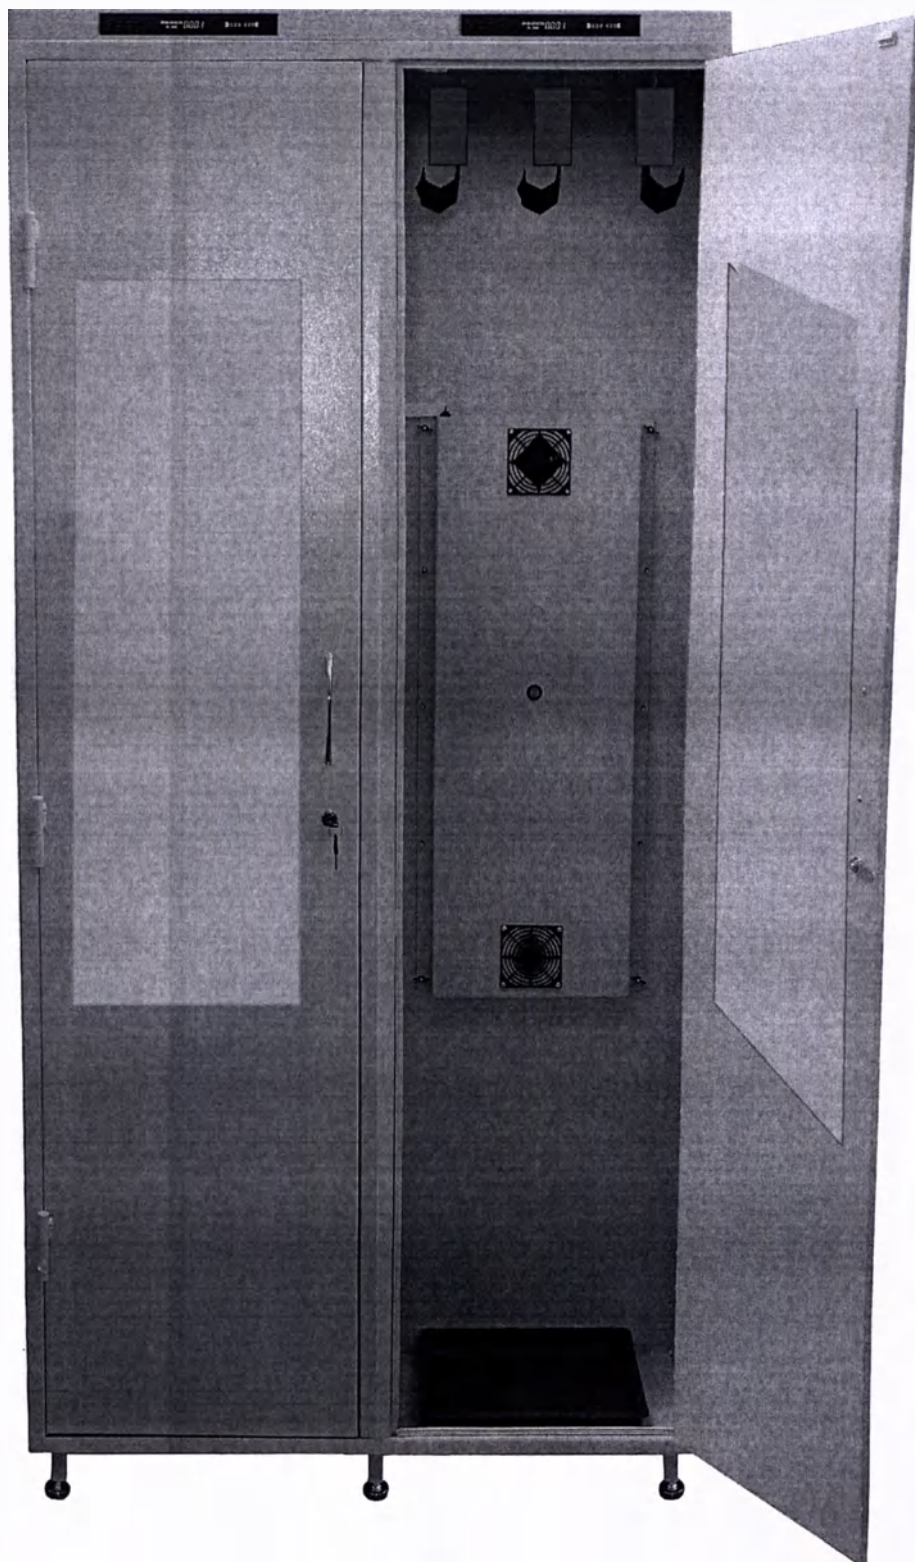

Фотография 19. Общий вид. Одна дверь открыта.

**«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-08, ТУ 9451-022-55307168-2013**


**(Со встроенной системой обеззараживания воздуха, воздушной обработкой каналов и
смотровым окном)**

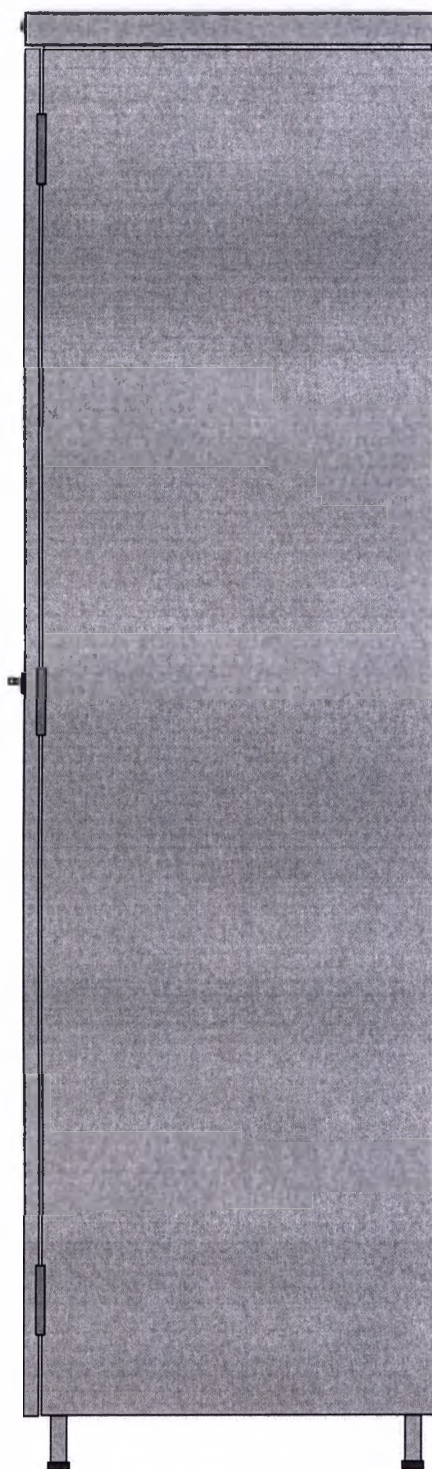


Фотография 20. Вид сбоку.

**«Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП»,
исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-08, ТУ 9451-022-55307168-2013**

**(Со встроенной системой обеззараживания воздуха, воздушной обработкой каналов и
смотровым окном)**

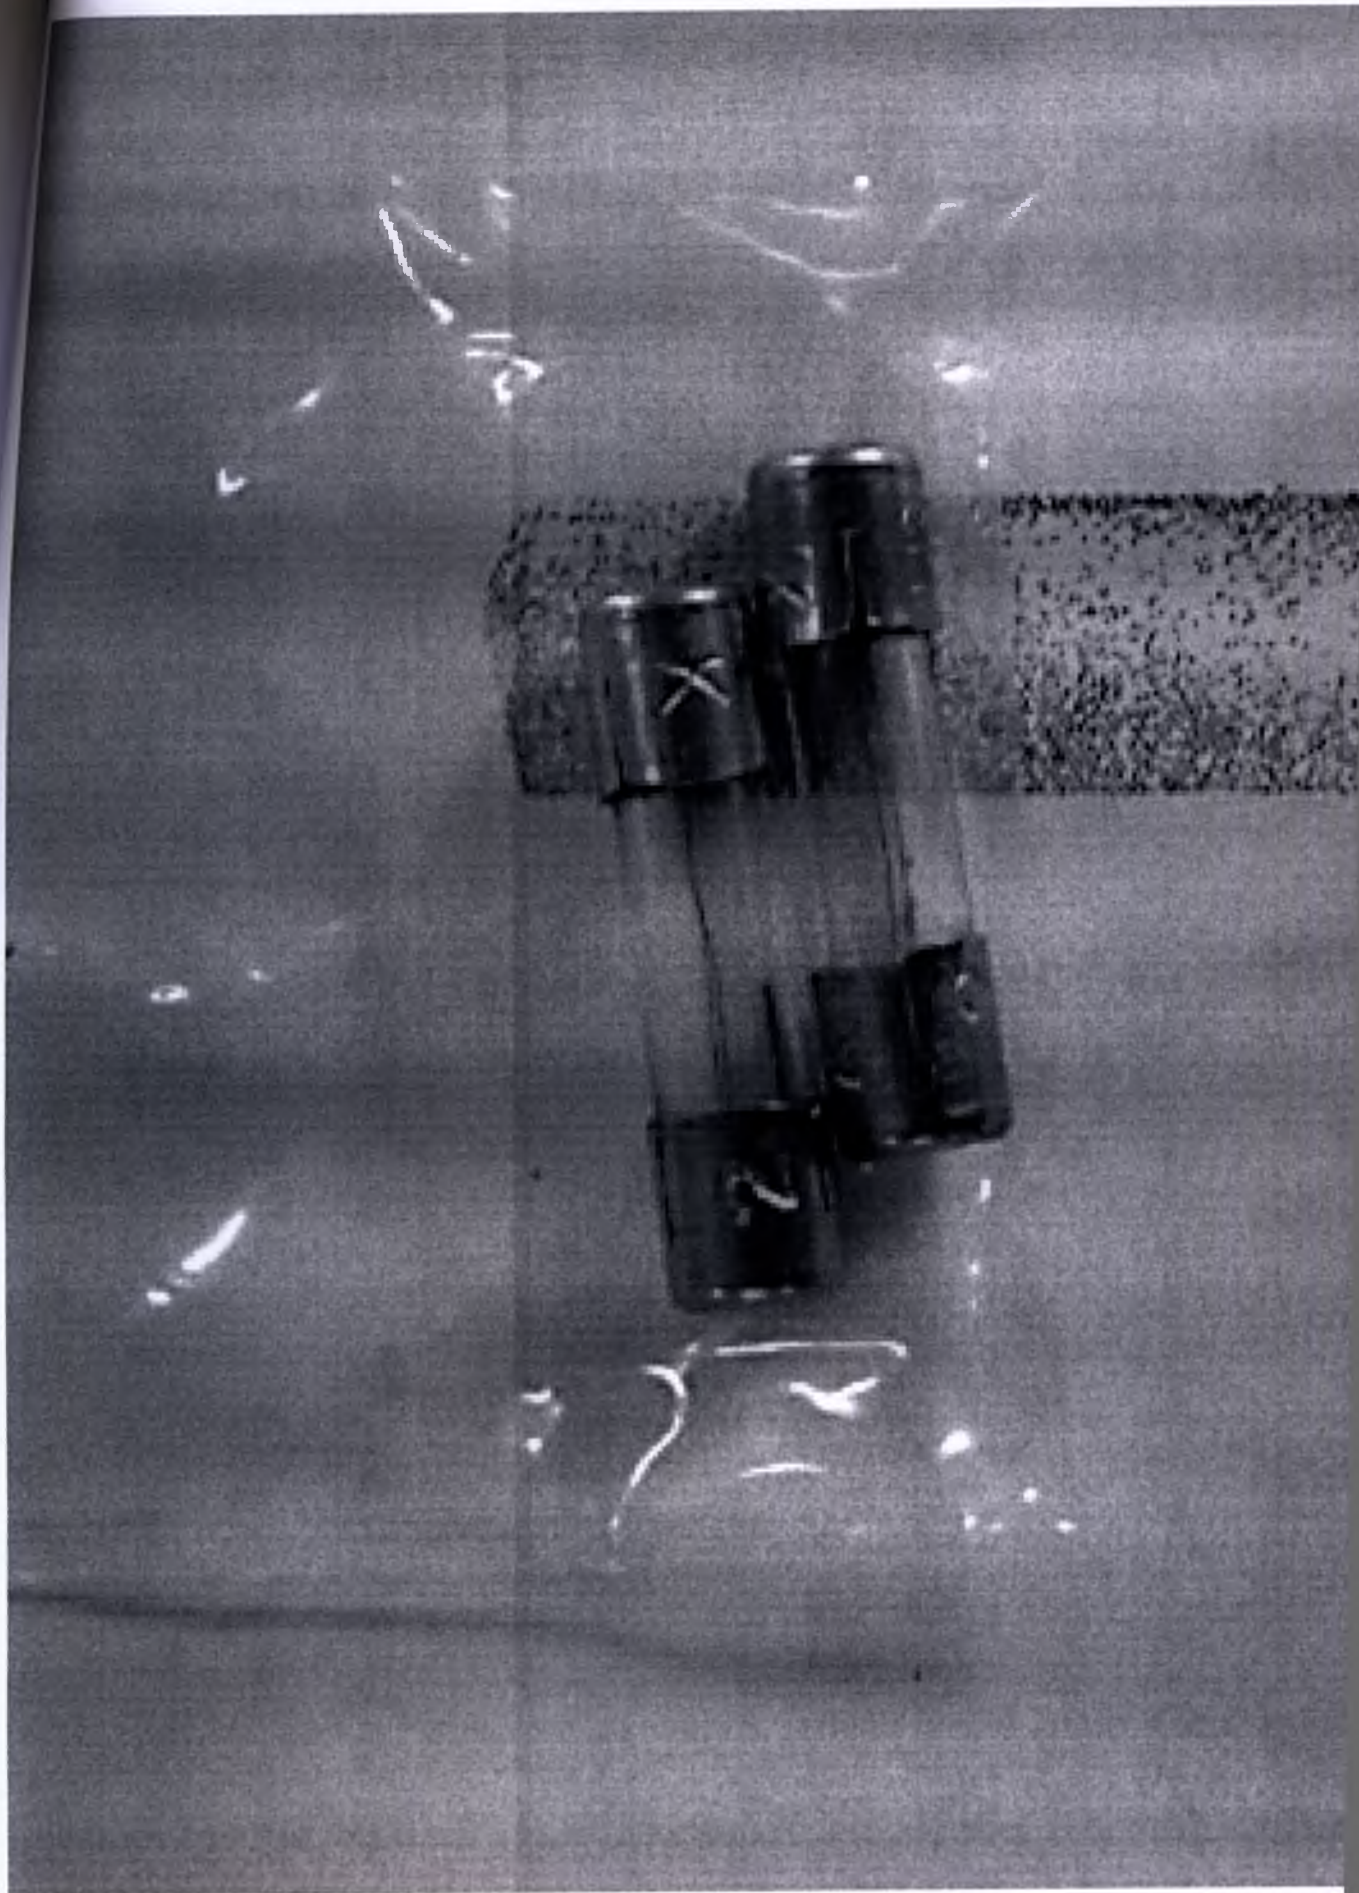

Фотография 21. Принадлежности: вставка плавкая.
(вставка плавкая, тип ВП1-2-3.15А)

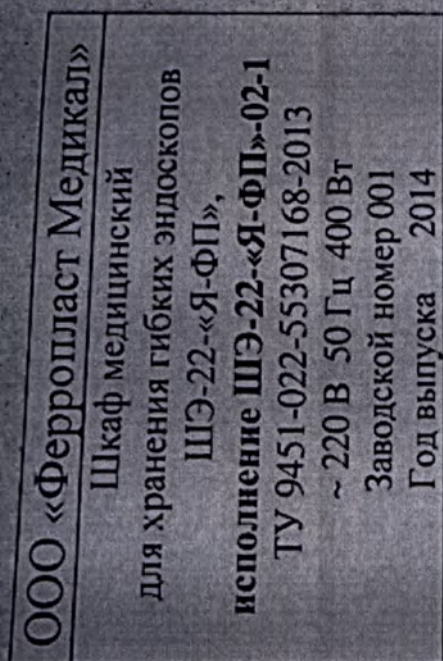

Фотография 22. Пример маркировки медицинского изделия «Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП», ТУ 9451-022-55307168-2013

(представлена маркировка (шильдик) медицинского изделия «Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП», исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-02-1, ТУ 9451-022-55307168-2013

ООО «Ферропласт Медикал»

Шкаф медицинский
для хранения гибких эндоскопов
ШЭ-22-«Я-ФП»,

исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-04

ТУ 9451-022-55307168-2013

~ 220 В 50 Гц 80 Вт

Заводской номер 001

Год выпуска 2014

Фотография 23. Пример маркировки медицинского изделия «Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП», ТУ 9451-022-55307168-2013 (представлена маркировка (шильдик) медицинского изделия «Шкаф медицинский для хранения гибких эндоскопов ШЭ-22-«Я-ФП», исполнение ШЭ-22-«Я-ФП»-04, ТУ 9451-022-55307168-2013

Директор ООО «Цирми» А.В. Присталов

Прошито и пронумеровано 24

(двадцать четыре) листа (ов)

