

«Утверждаю»
Общество с Ограниченной Ответственностью
«Системы Медицинского Мониторинга»
Генеральный директор
Плушков И.А.



Фотографические изображения медицинского изделия

«Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max»

Общий вид комплекта изделия

Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, вариант исполнения I



Общий вид комплектации изделия

Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, вариант исполнения II-XIII



Общий вид комплекта изделия

Потребительская упаковка системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1
Max, вариант исполнения I



Общий вид комплекта изделия

Потребительская упаковка системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, вариант исполнения I



Общий вид комплекта изделия

Потребительская упаковка системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1
Max, вариант исполнения I



Общий вид комплекта изделия

Потребительская упаковка системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, вариант исполнения I



Общий вид изделия

Руководство по эксплуатации системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix
GS1 Max



Общий вид изделия

Передатчик системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max



Общий вид изделия

Индивидуальная упаковка передатчика системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, варианты исполнения I-XIII




Общий вид изделия

Индивидуальная упаковка передатчика системы непрерывного мониторинга глюкозы
Hematonix GS1 Max, варианты исполнения I-XIII



Общий вид изделия

Индивидуальная упаковка передатчика системы непрерывного мониторинга глюкозы
Hematonix GS1 Max, варианты исполнения I-XIII

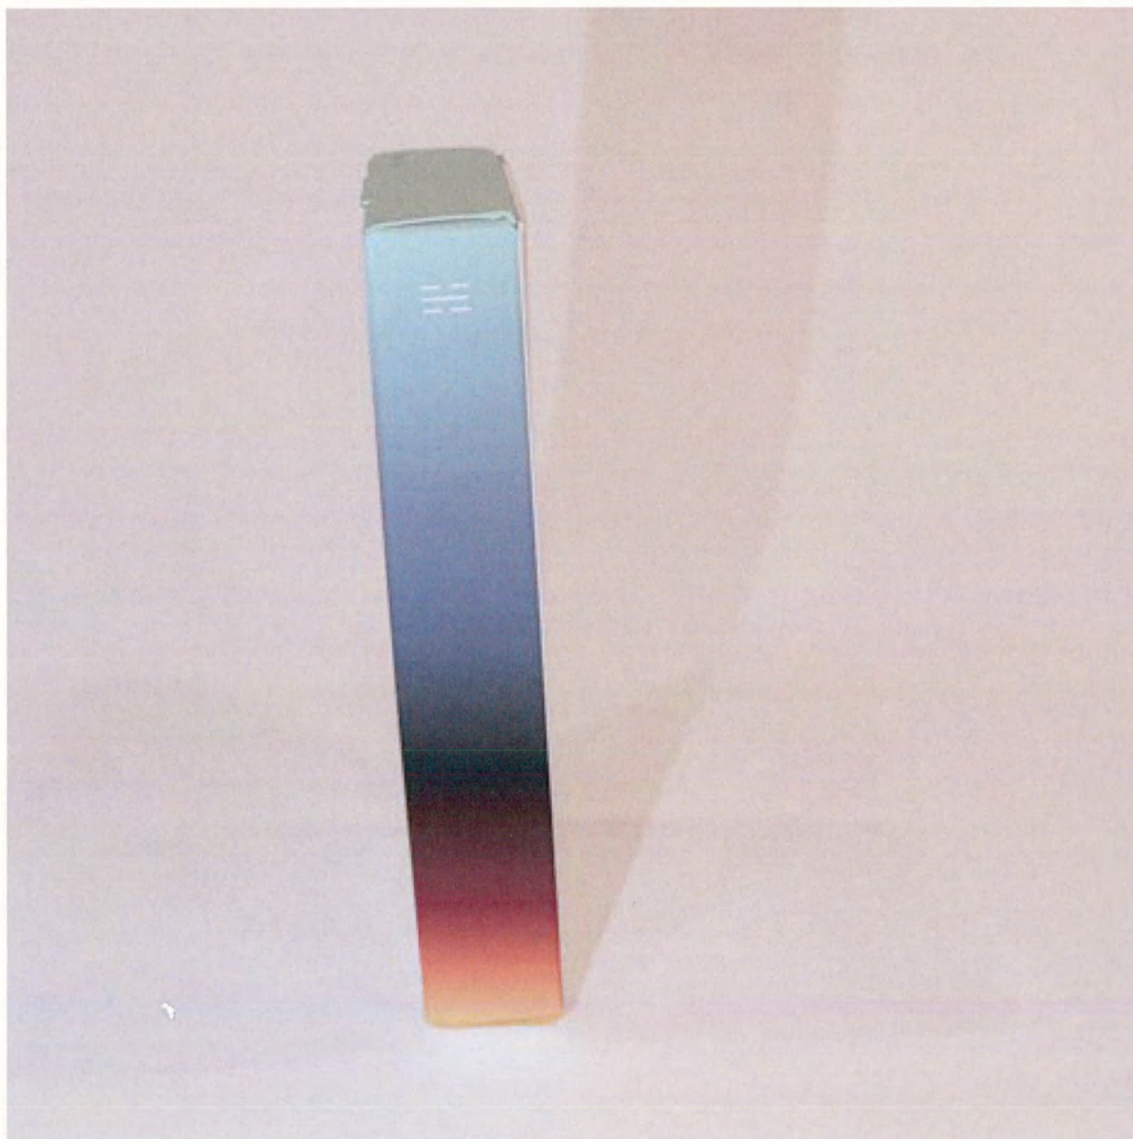


Общий вид изделия

Индивидуальная упаковка передатчика системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, варианты исполнения I-XIII



Общий вид изделия

Индивидуальная упаковка передатчика системы непрерывного мониторинга глюкозы
Hematonix GS1 Max, варианты исполнения I-XIII

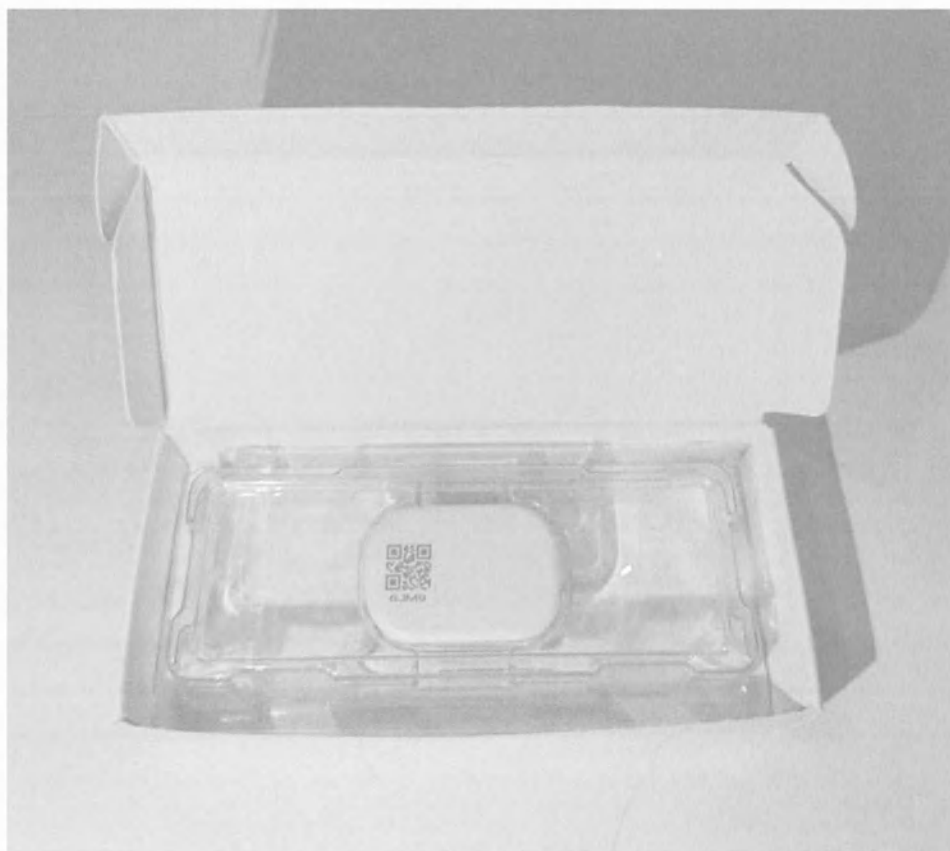

Общий вид изделия

Батарейка системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max



Общий вид изделия

Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max



Общий вид изделия

Стерильная упаковка сенсора системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix
GS1 Max, варианты исполнения I-XIII




Общий вид изделия

Индивидуальная упаковка сенсора системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, варианты исполнения II-XIII



Общий вид удерживающего пластыря изделия

Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max

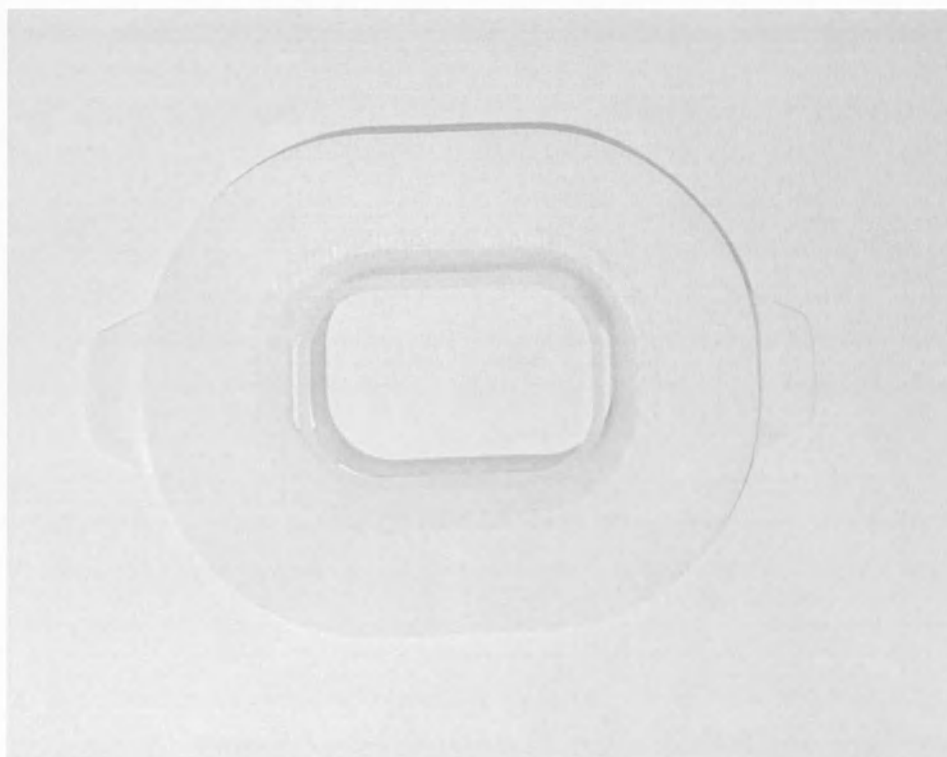

Общий вид групповой упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 1 месяц



Общий вид групповой упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 2 месяца



Общий вид потребительской упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 3 месяца



Общий вид потребительской упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 4 месяца



Общий вид потребительской упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 5 месяцев



Общий вид потребительской упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 6 месяцев



Общий вид потребительской упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 7 месяцев



Общий вид потребительской упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 8 месяцев



Общий вид потребительской упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 9 месяцев



Общий вид потребительской упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 10 месяцев



Hematonix

Система непрерывного мониторинга глюкозы
Hematonix GS1MAX комплект на 14 дней

GS1MAX

Комплектация:

Аппаратный компонент	1 шт.
Платформа	1 шт.
Набор электродов	2 шт.
Батарейки	2 шт.
Кабель USB-C	1 шт.
Паспорт пользователя	1 шт.
Паспорт на гарантийный ремонт	1 шт.

Место производства:
Shenzhen Hematonix Co., Ltd. (Floor 15, Building No. 12, Shennan Road, Minhang District, Shanghai, China)
Shenzhen Hematonix Co., Ltd. (Floor 15, Building No. 12, Shennan Road, Minhang District, Shanghai, China)

Barcode: 6 972301 641470


QR Code: [QR Code]

Logos: Apple App Store, Google Play

Общий вид потребительской упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 12 месяцев




Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max

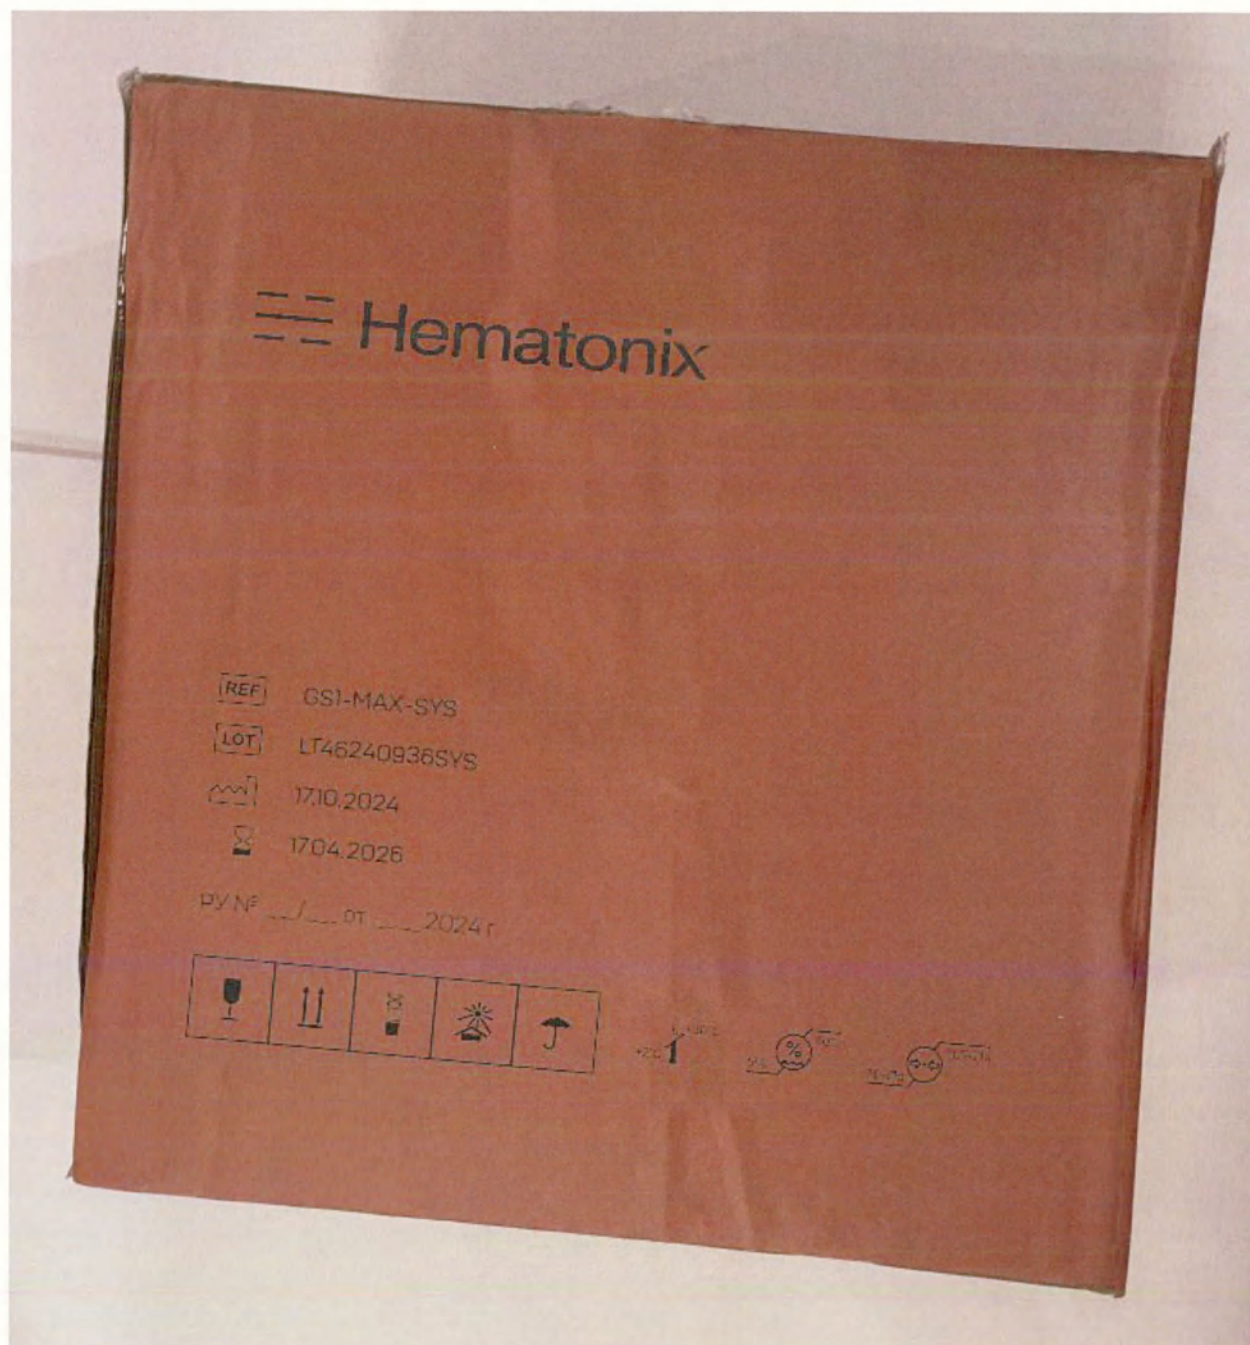


Общий вид транспортной упаковки изделия


Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max

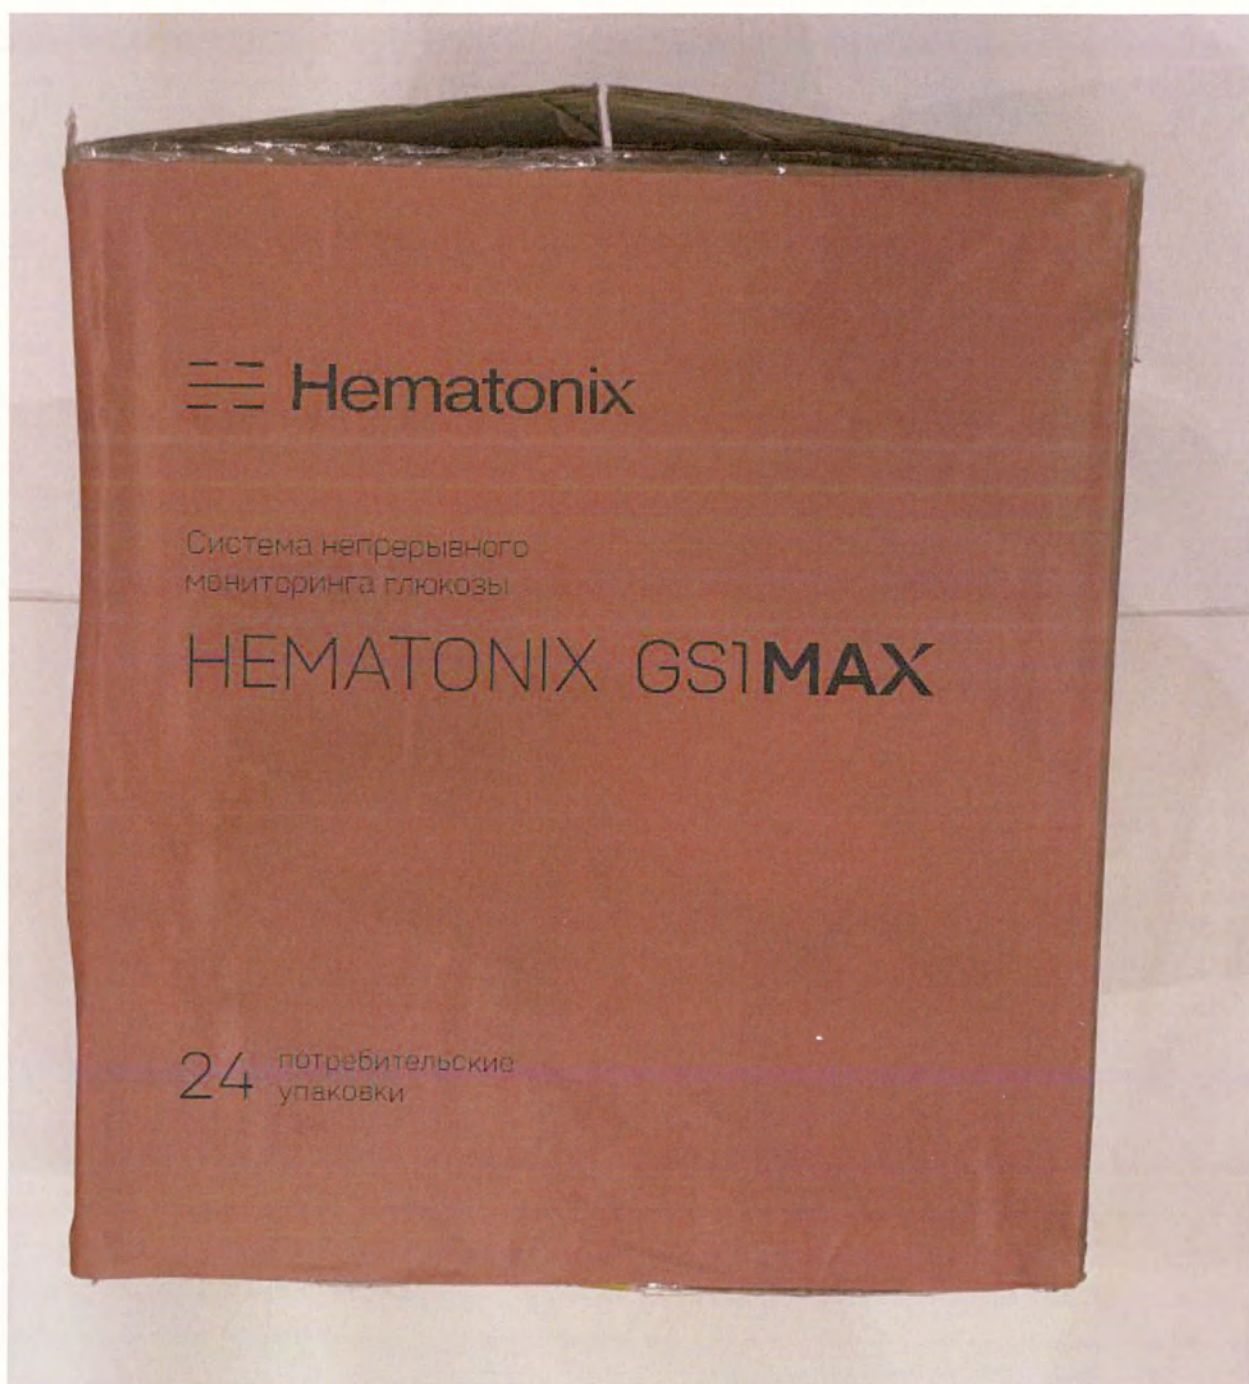


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max

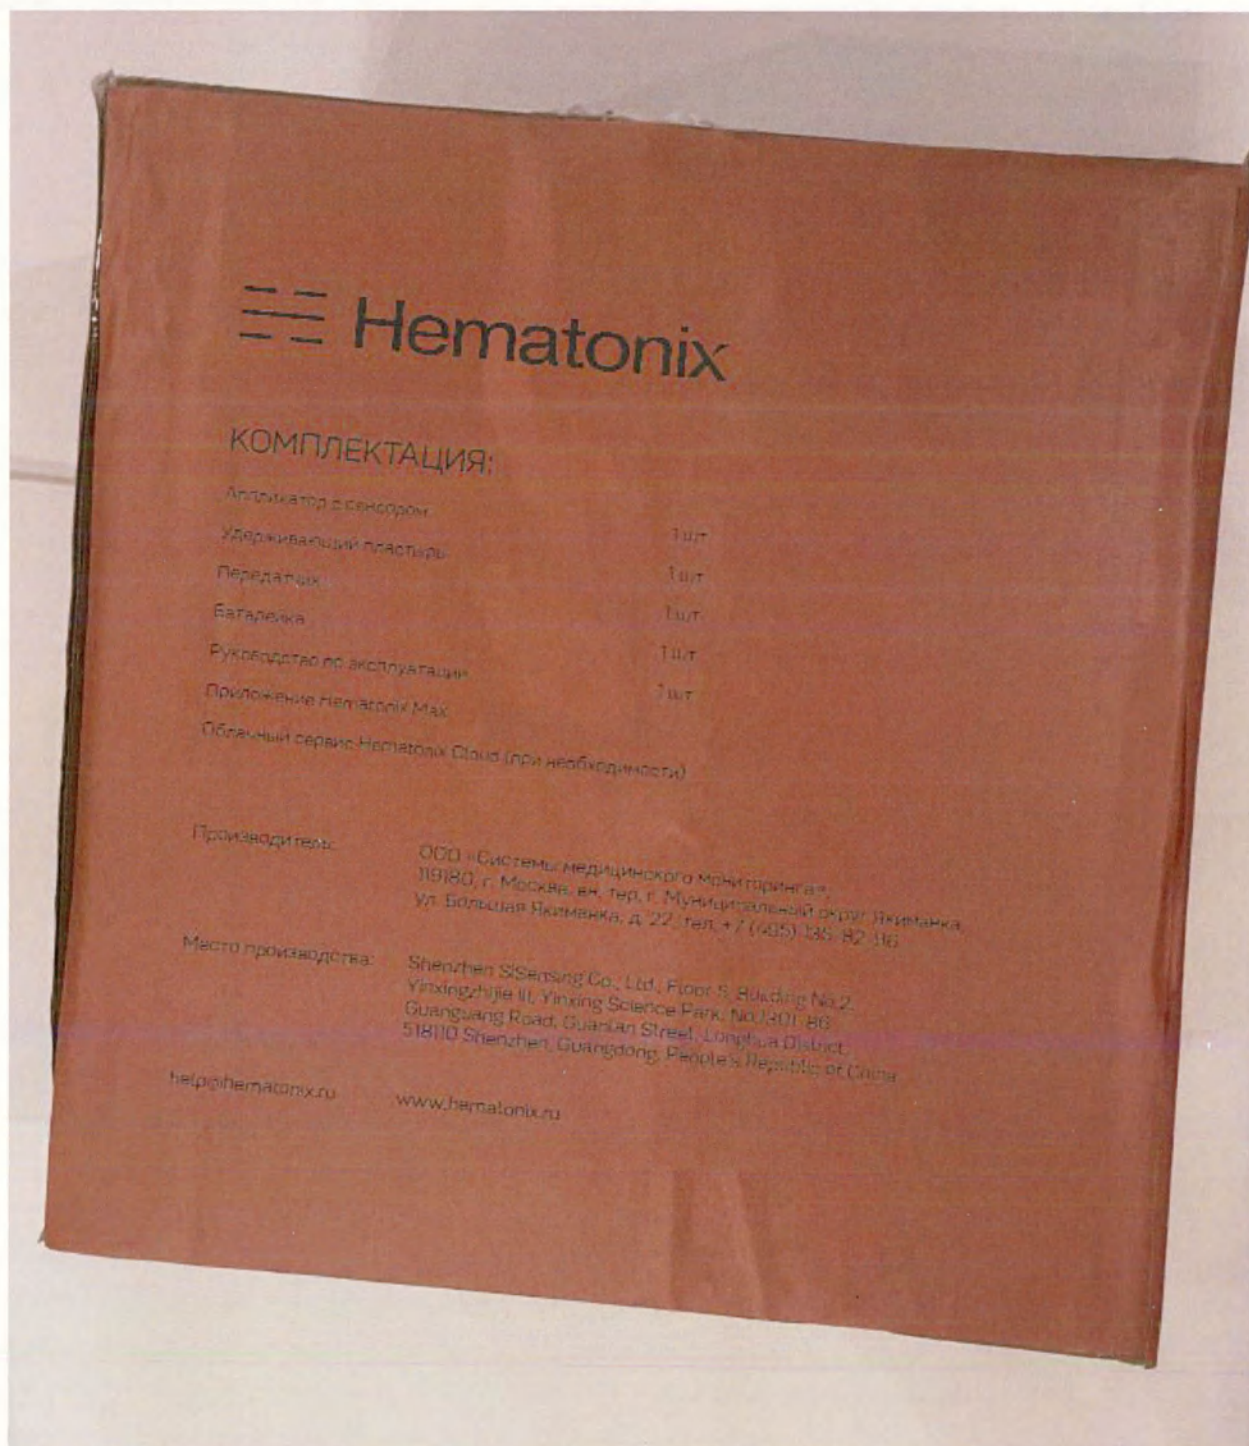


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 1 месяц

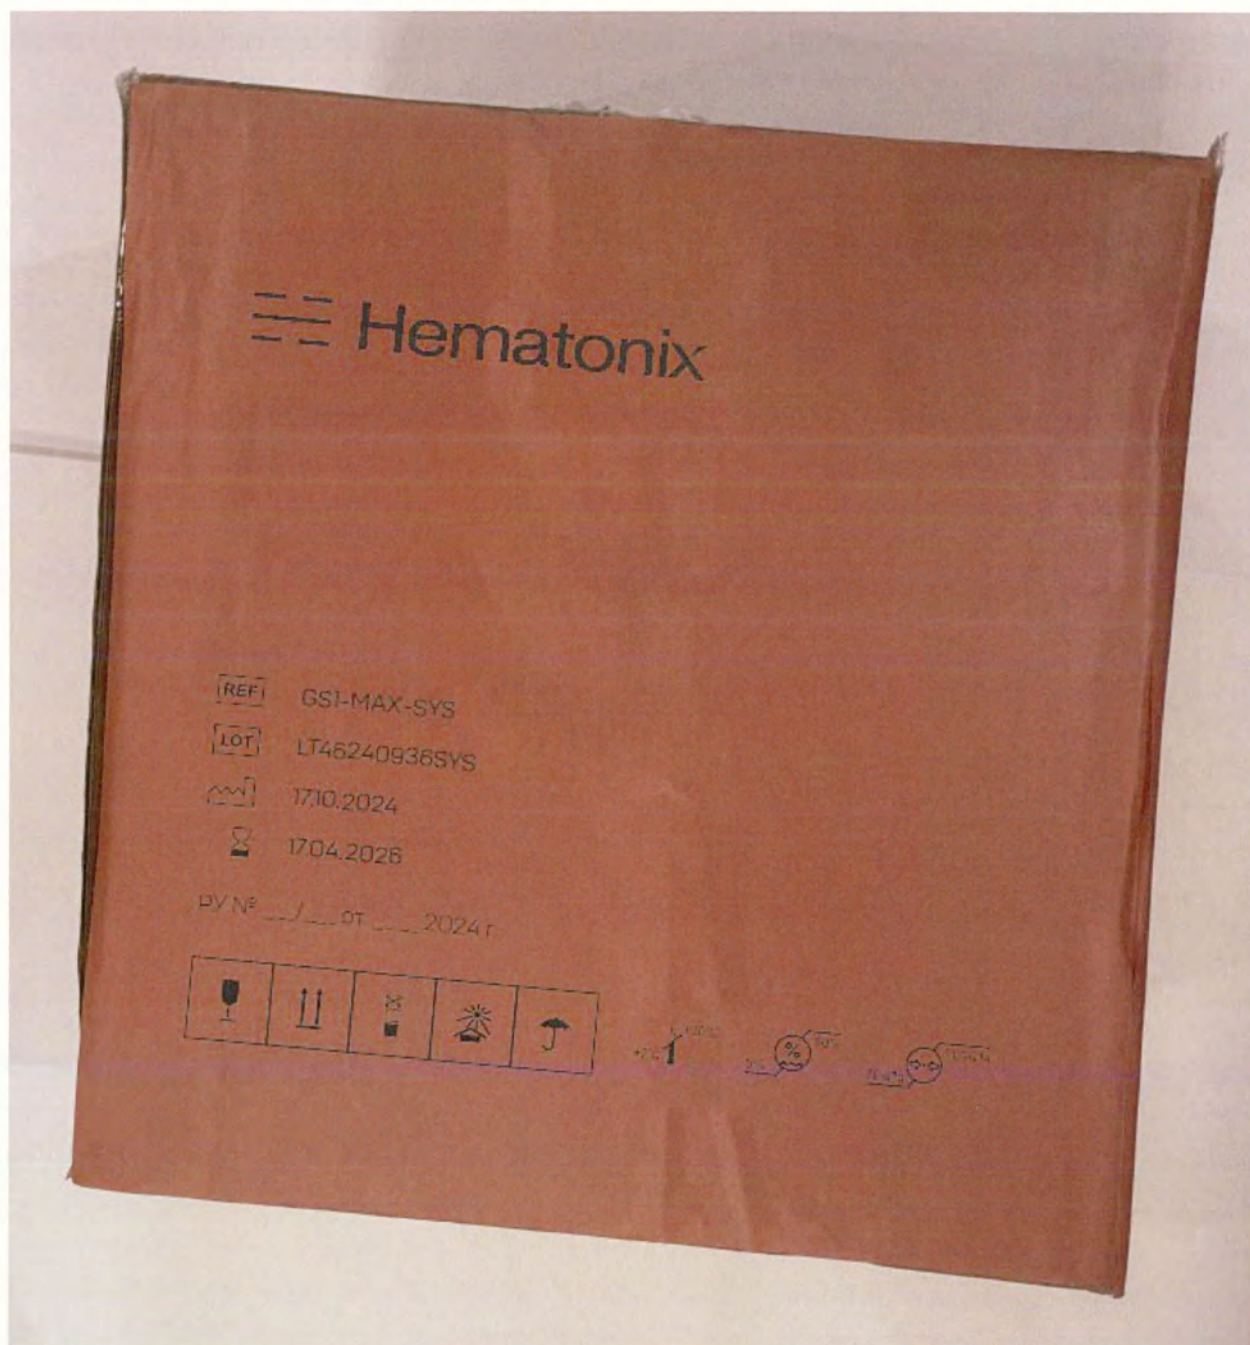


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 1 месяц

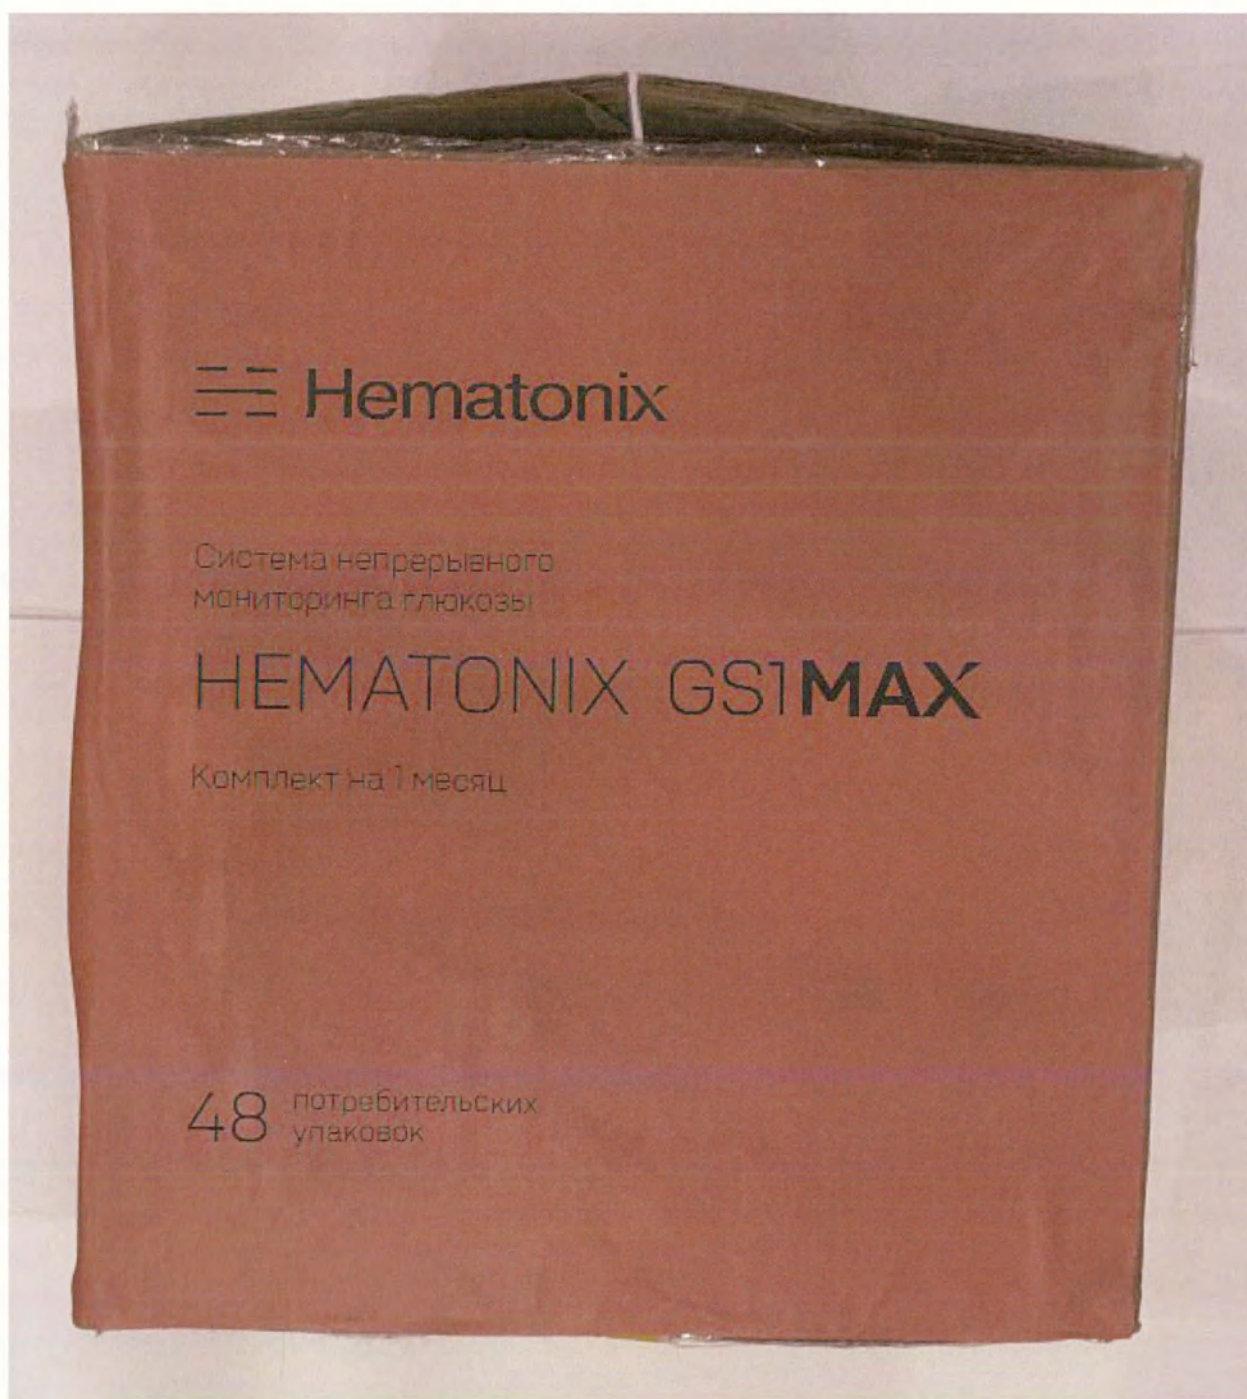


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 1 месяц

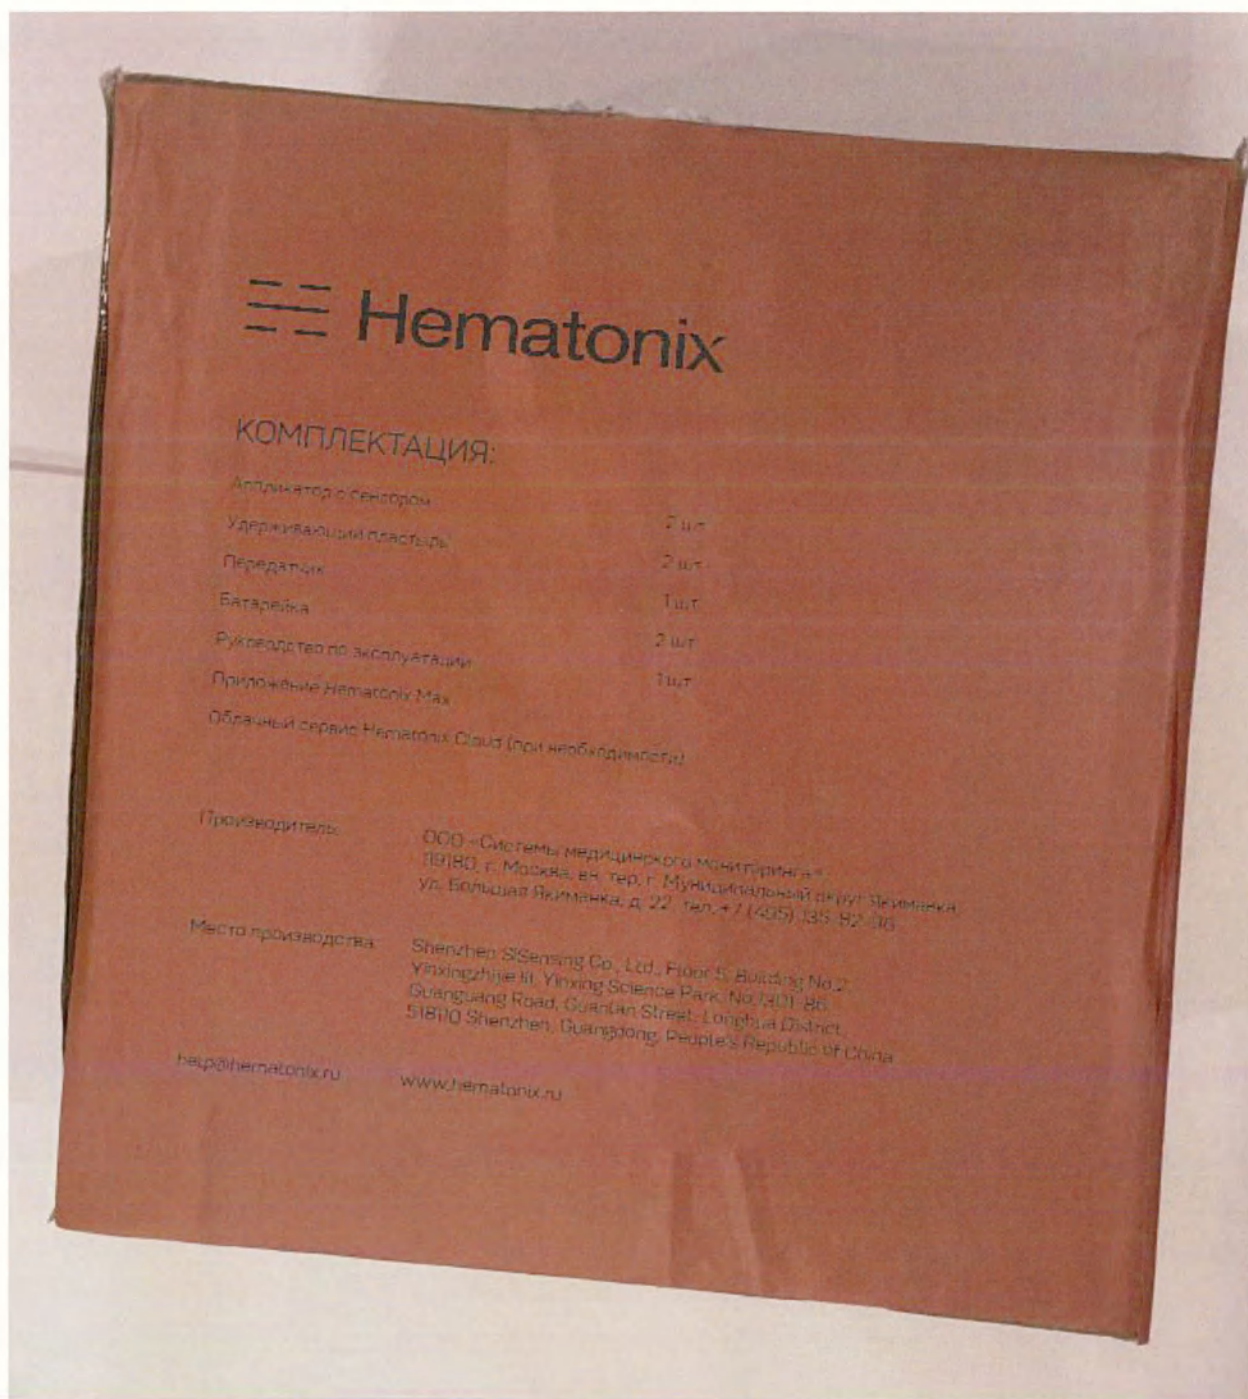


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 2 месяца

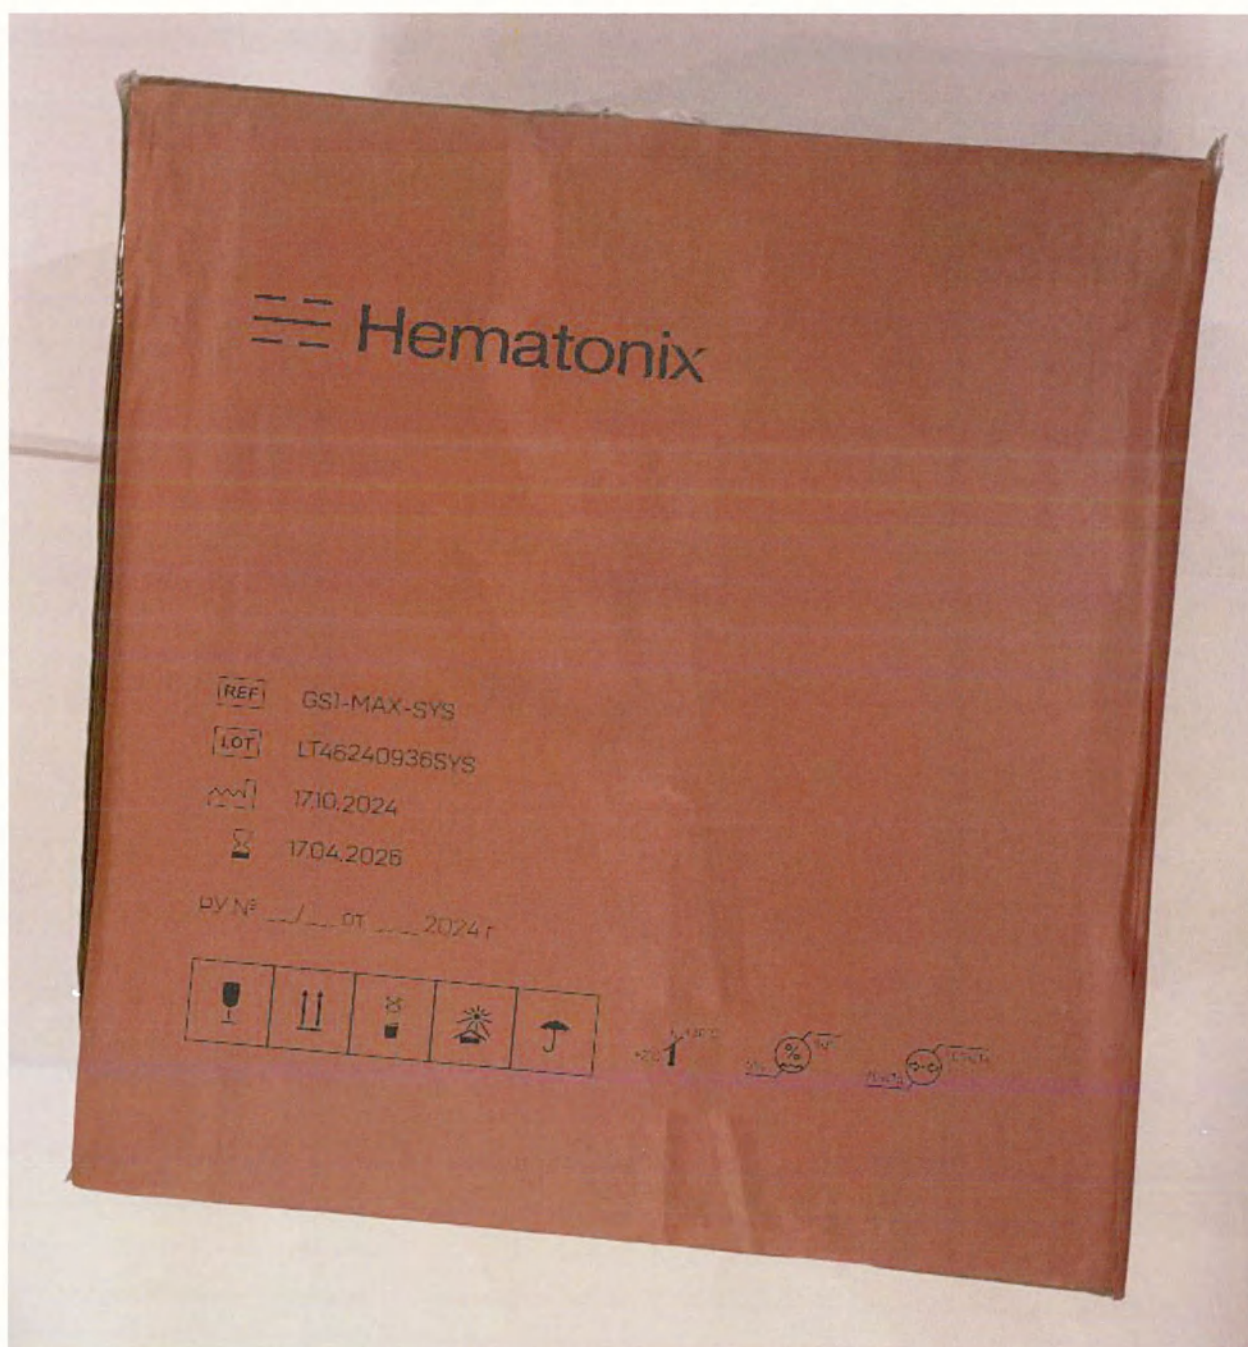


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 2 месяца

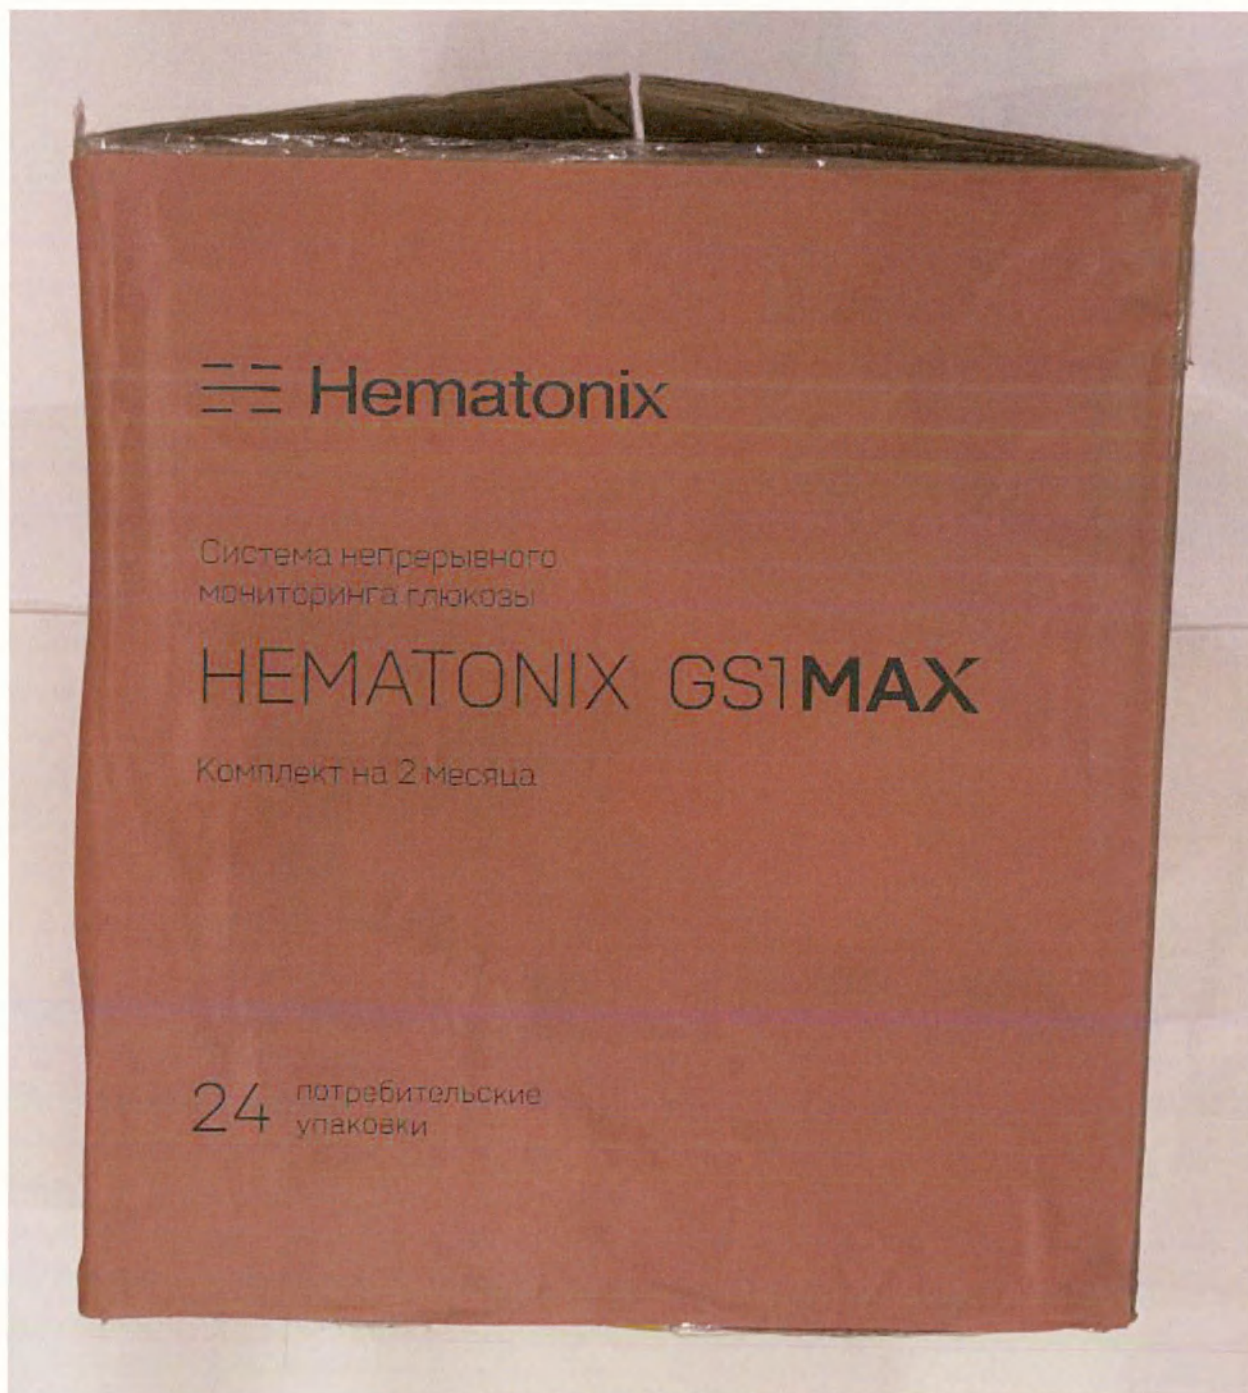


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 2 месяца

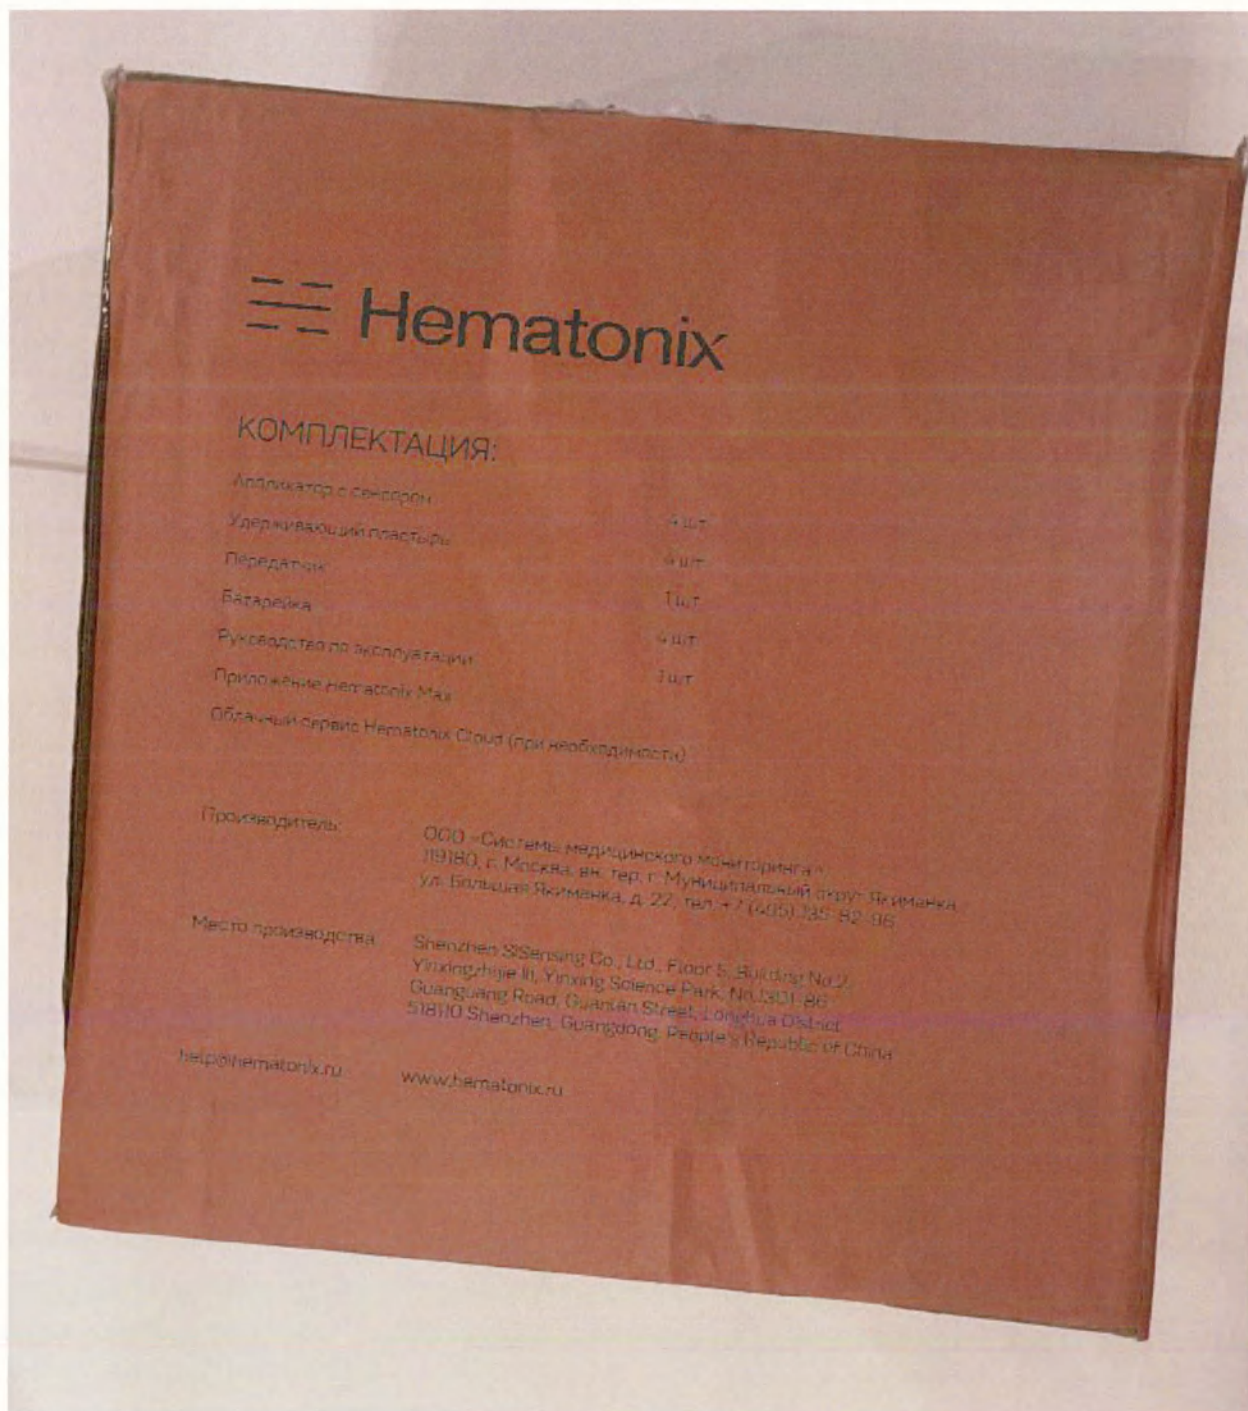


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 3 месяца

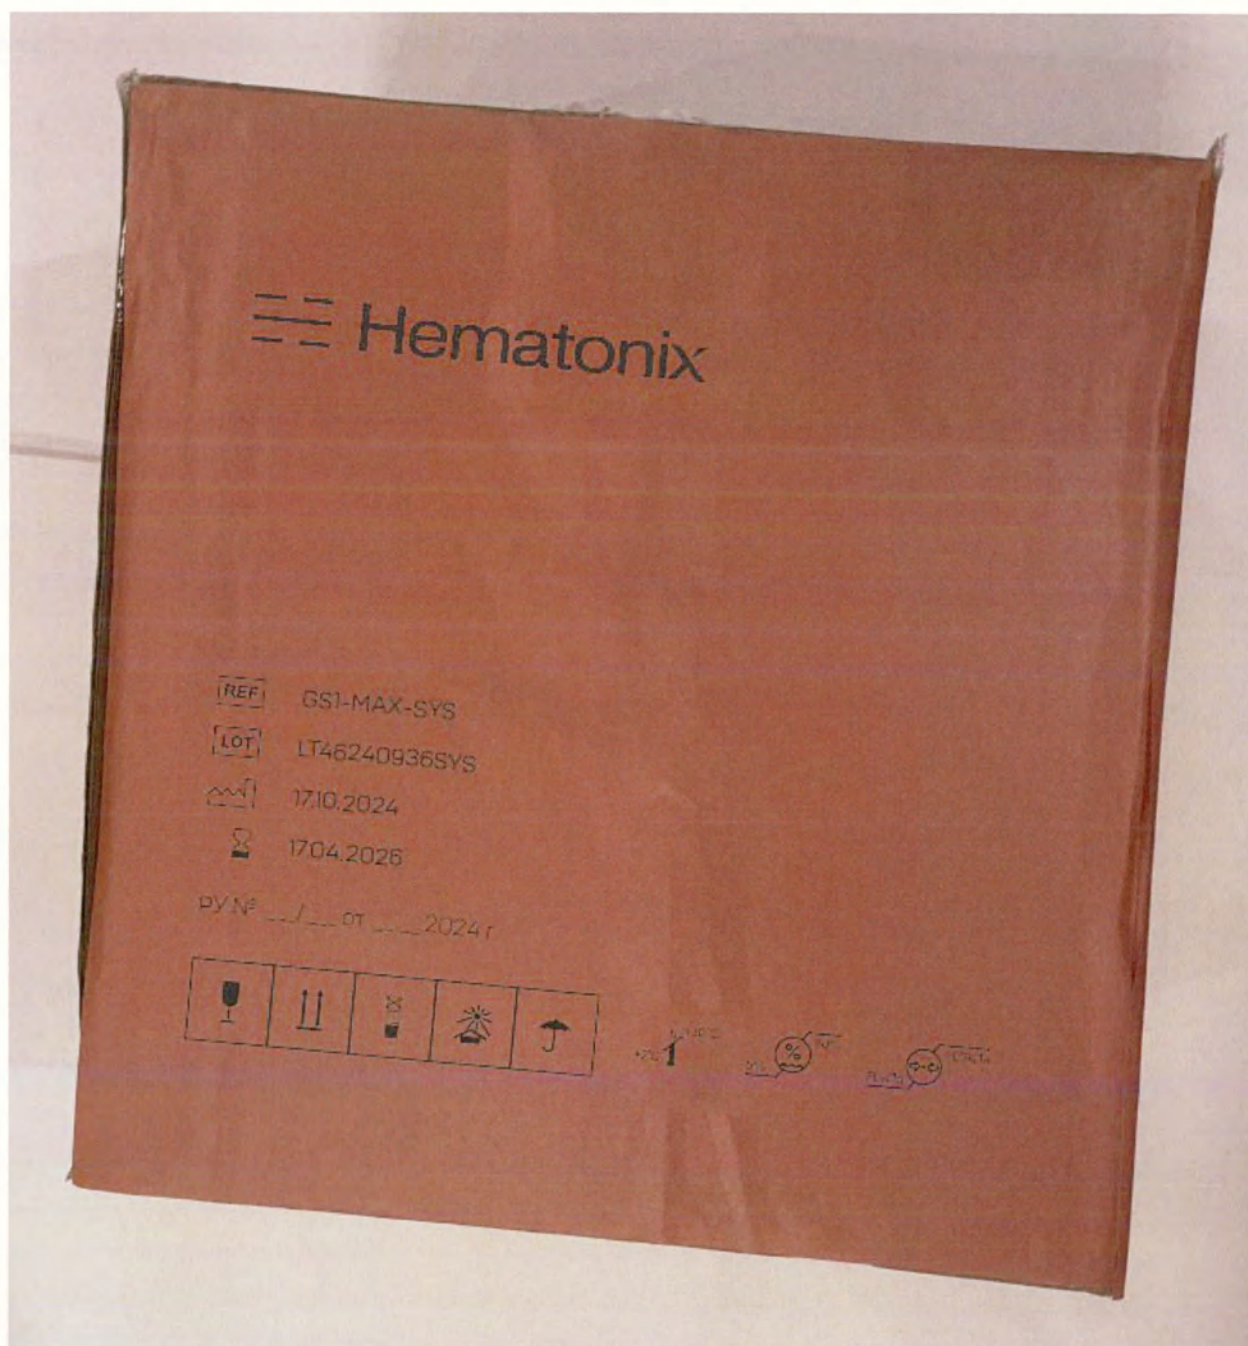


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 3 месяца

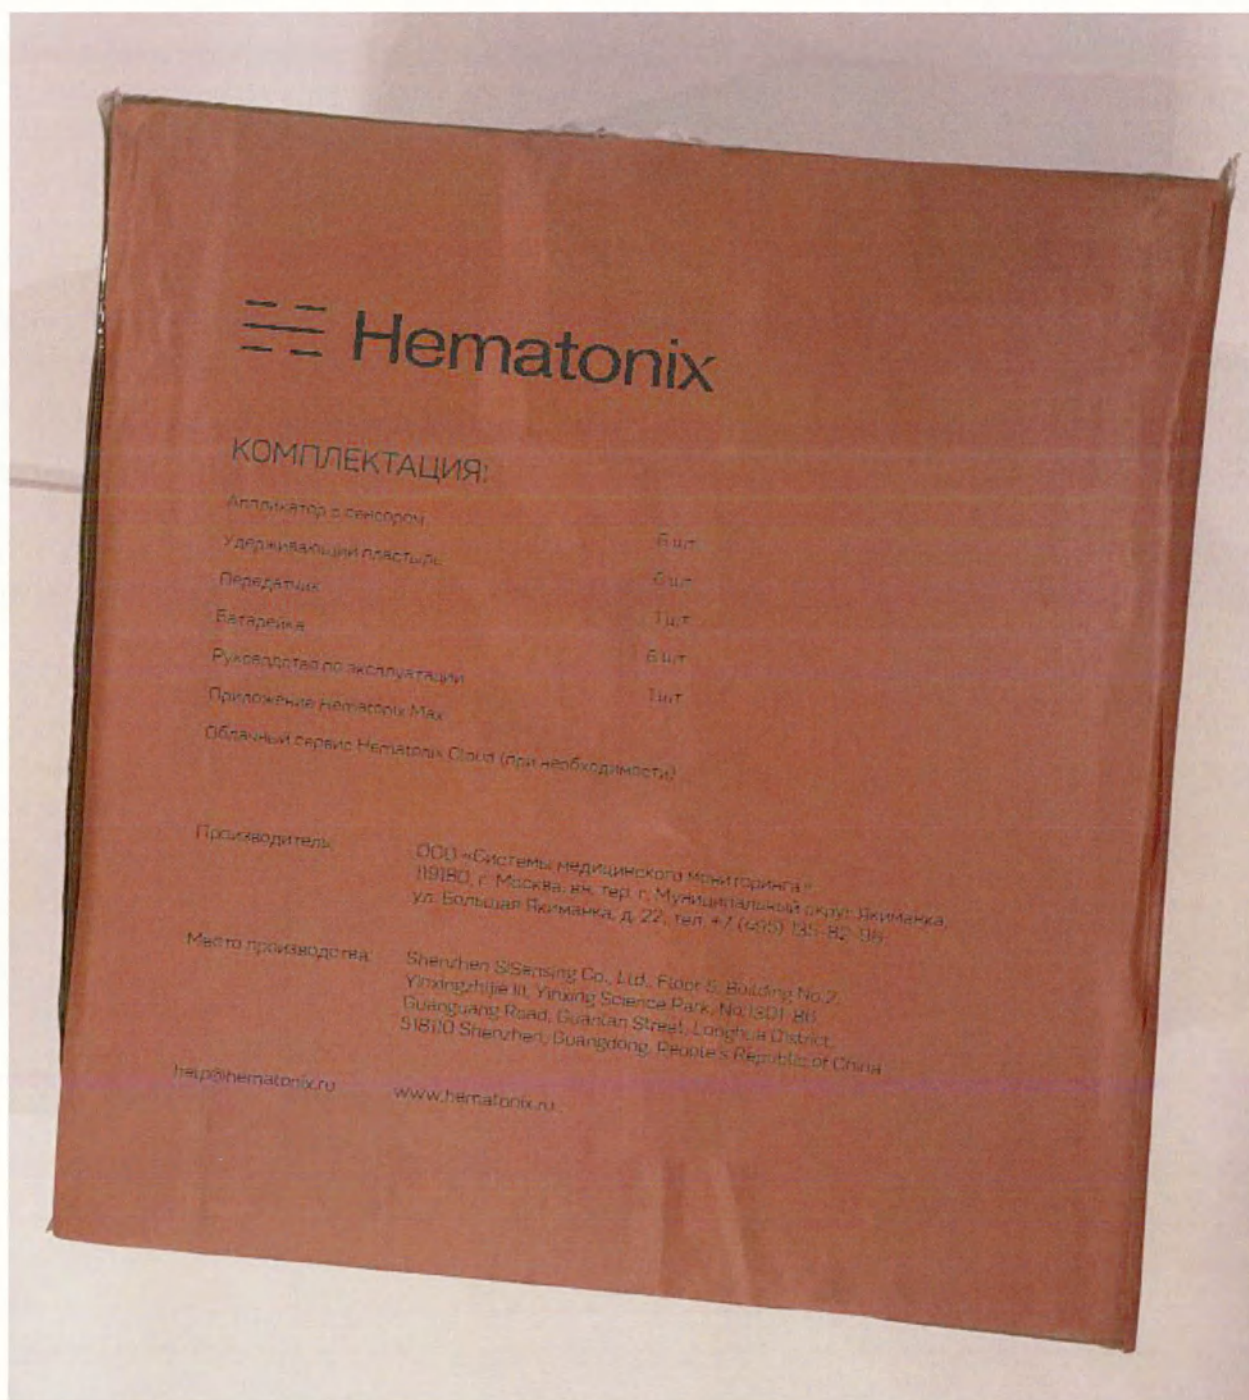


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 3 месяца

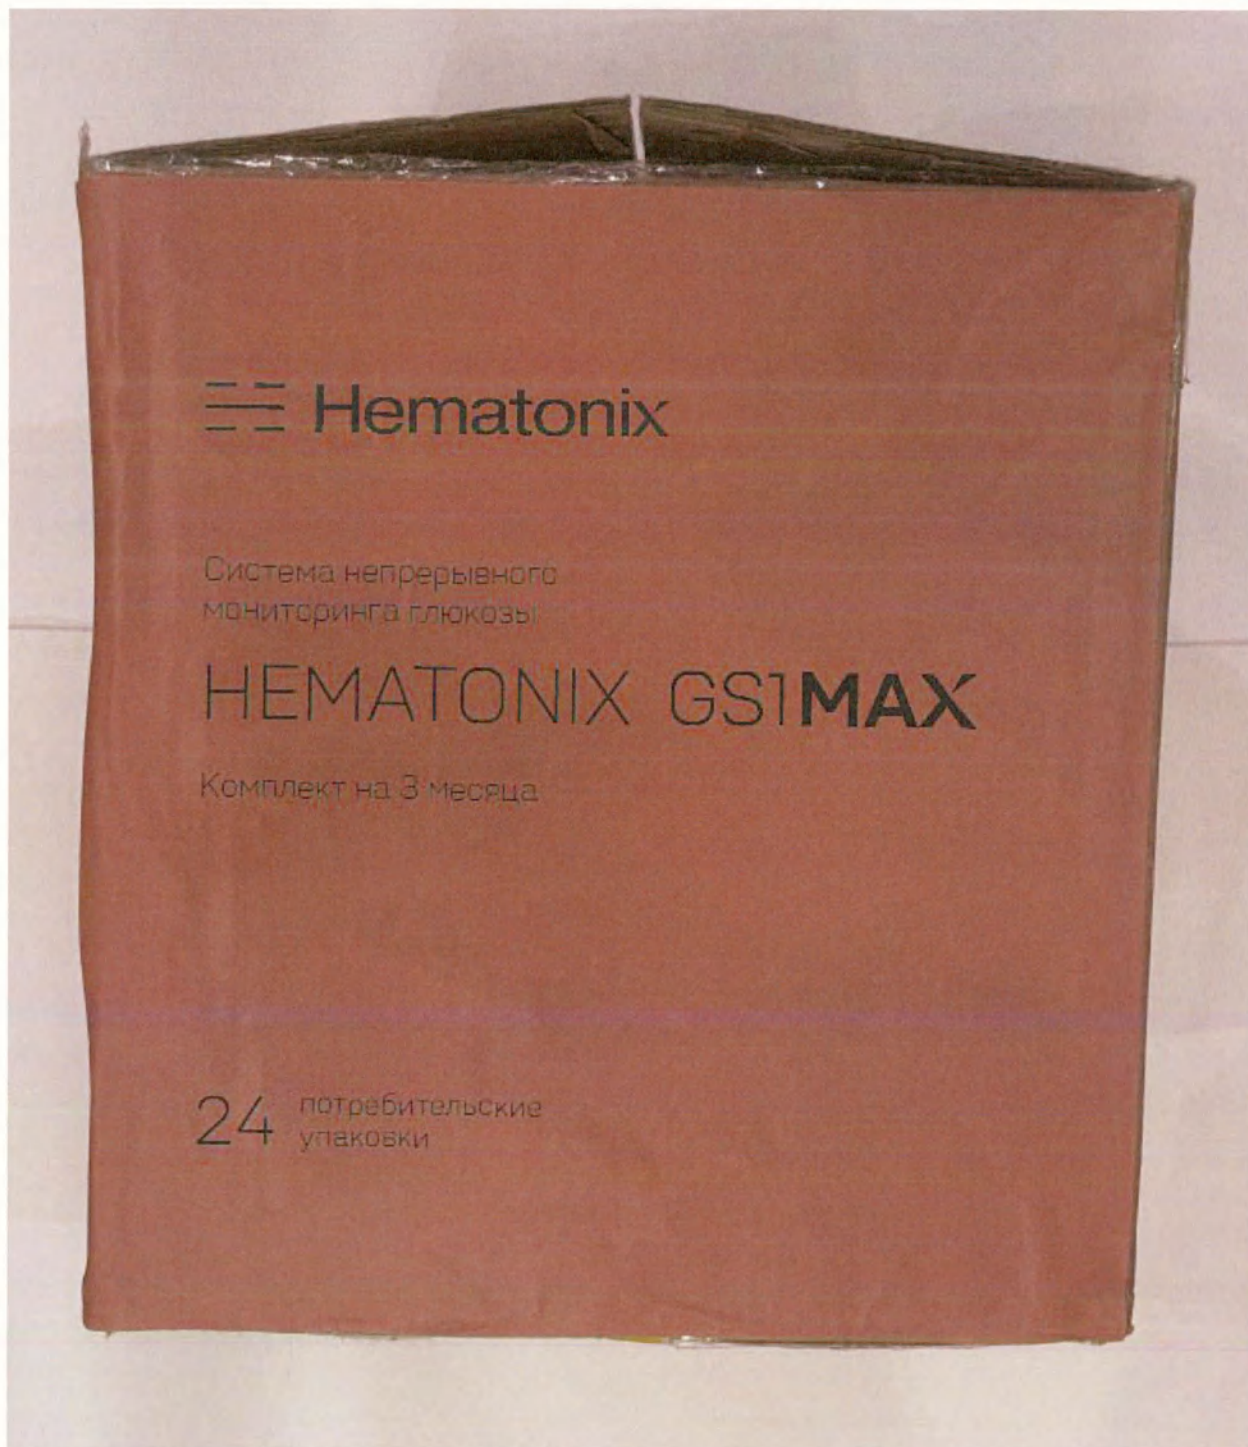


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 4 месяца

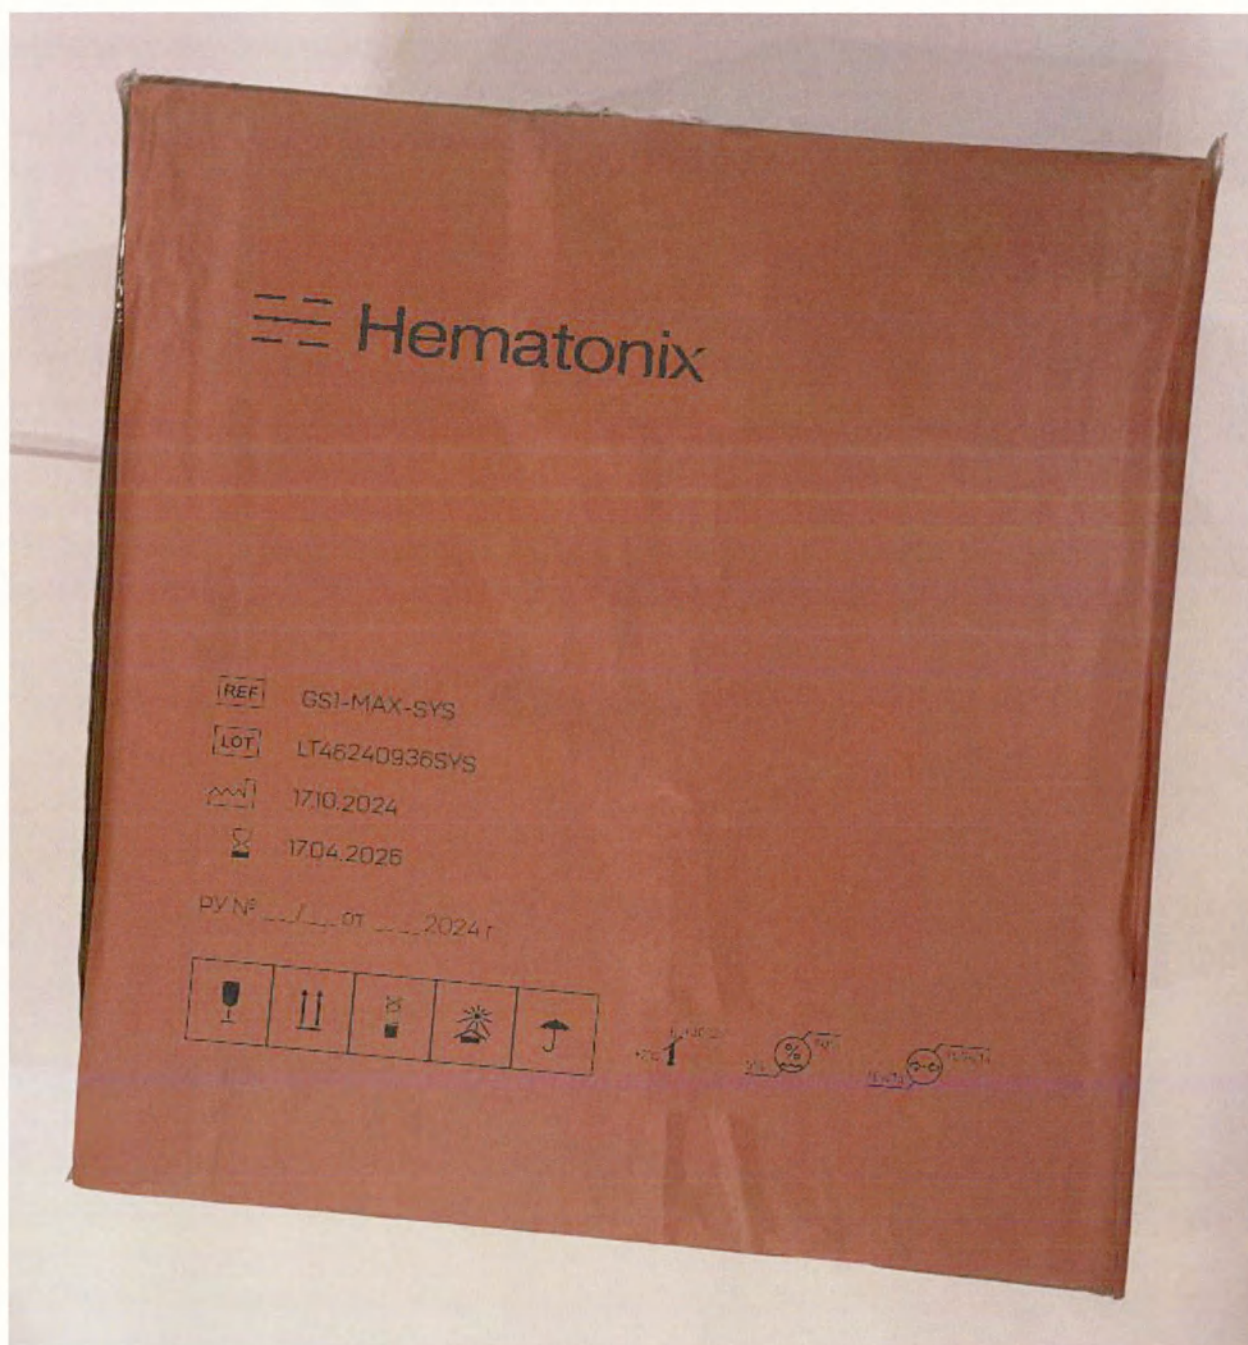


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 4 месяца

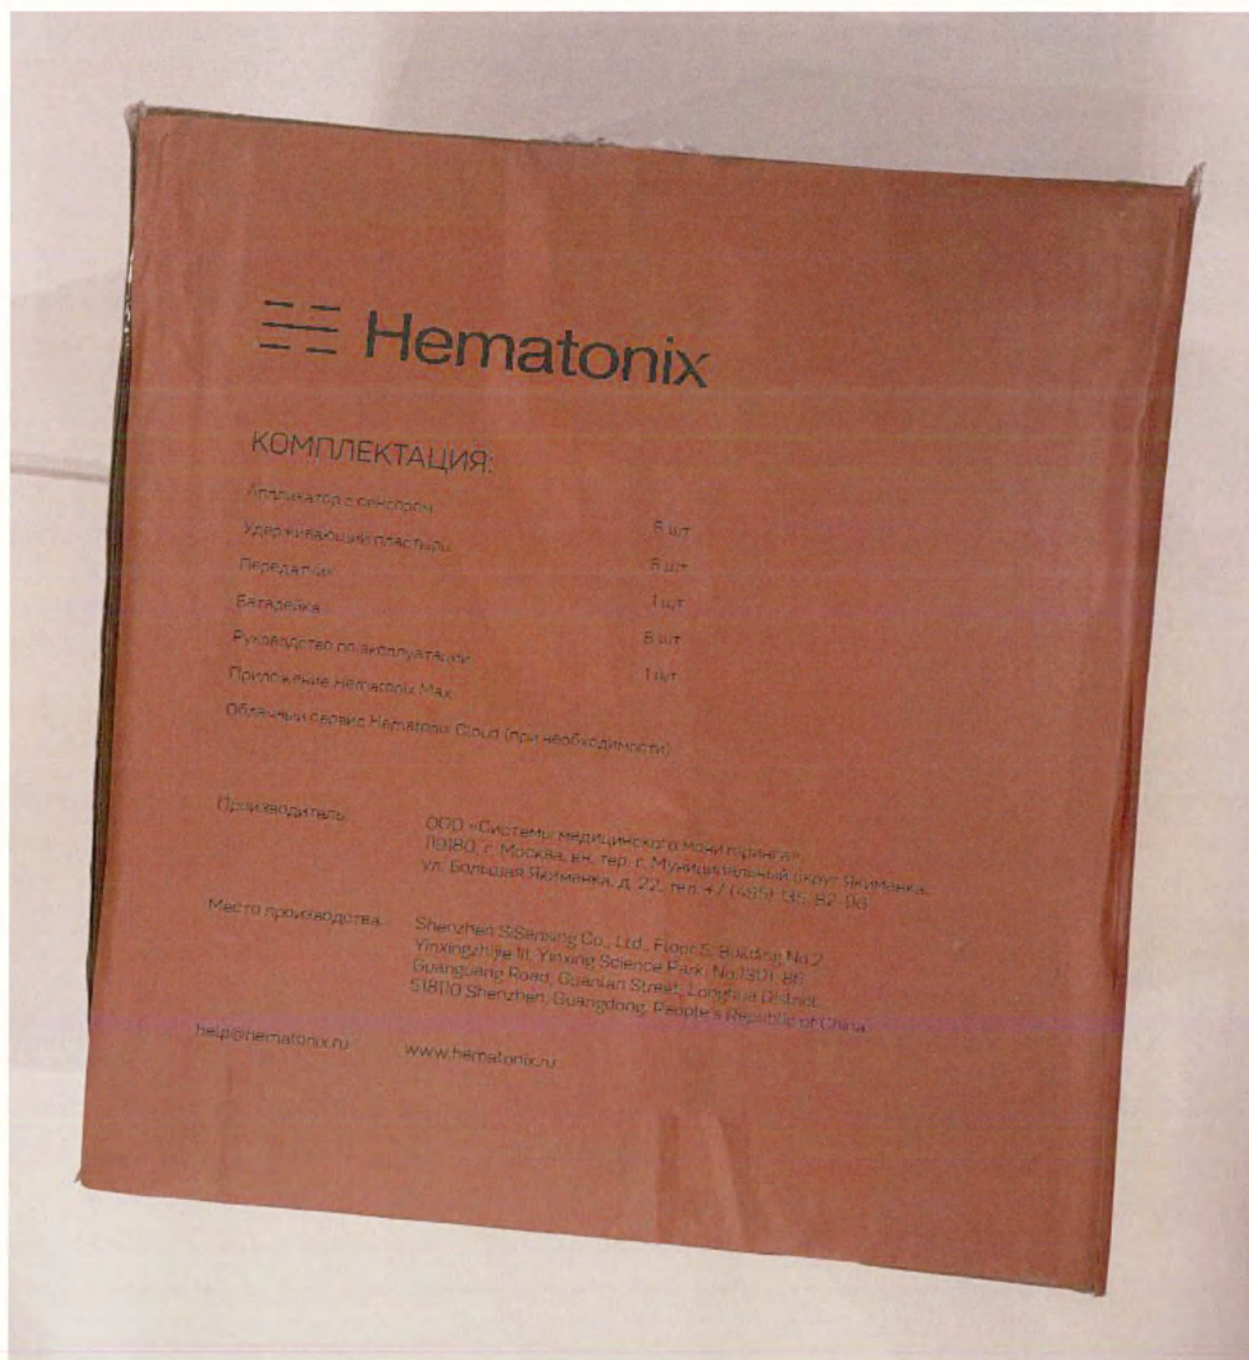


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 4 месяца

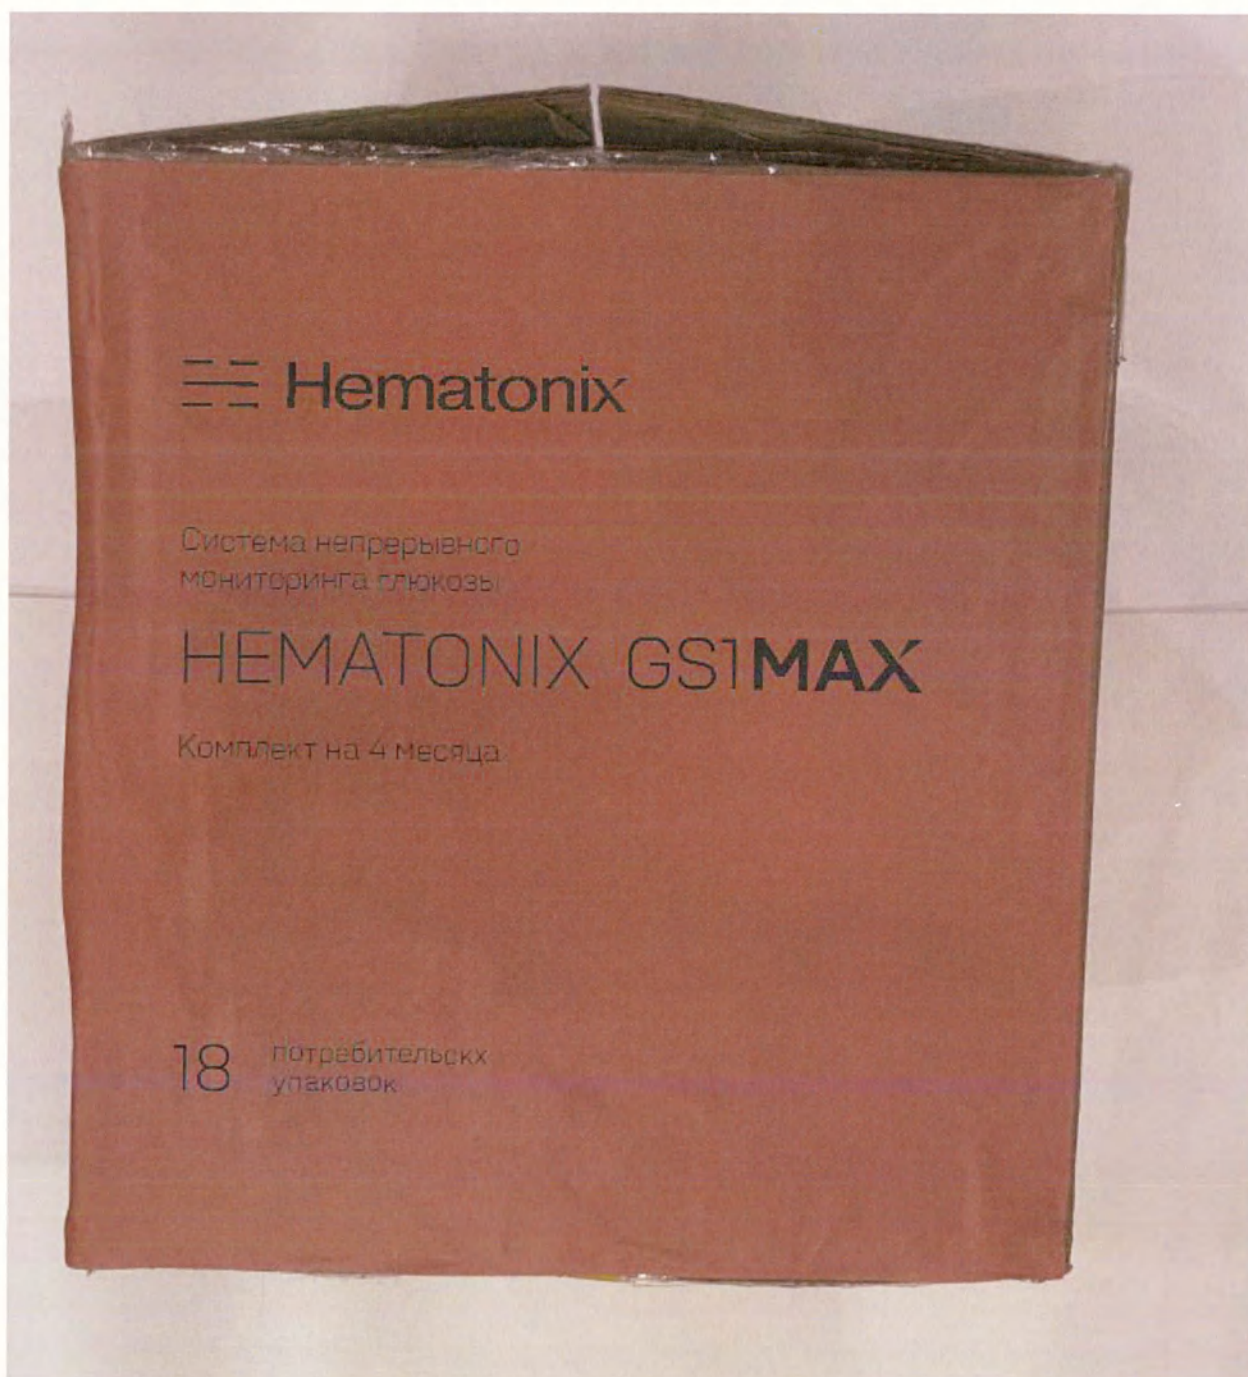

Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 5 месяцев

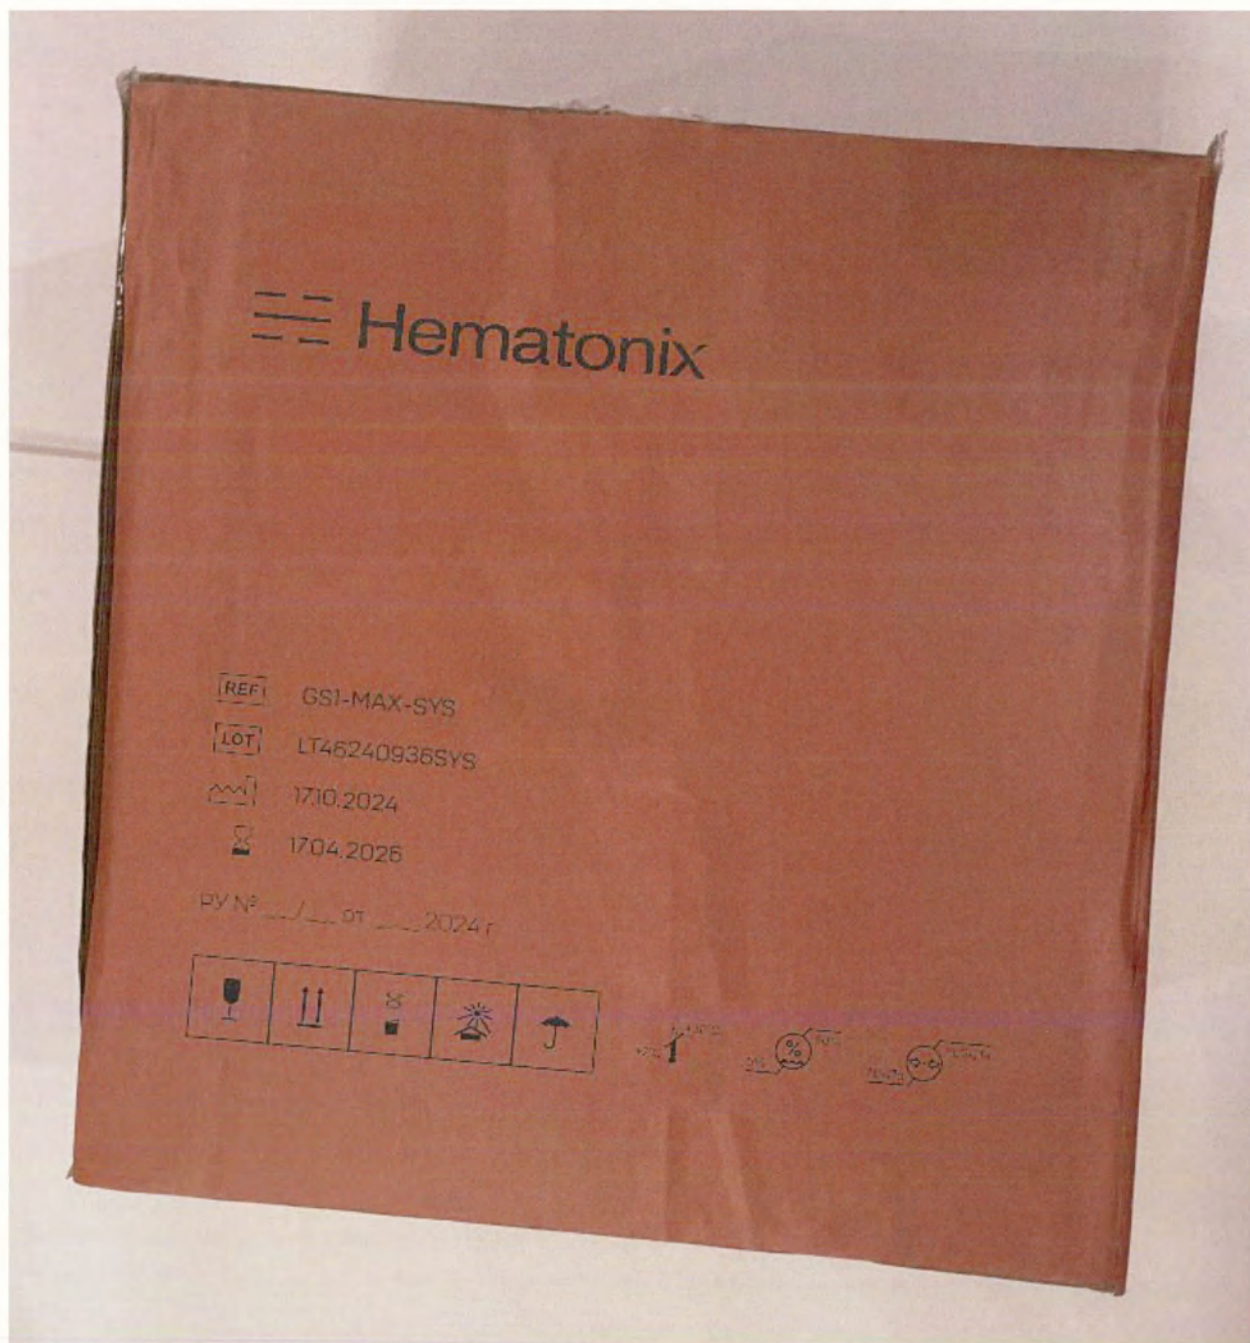


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 5 месяцев

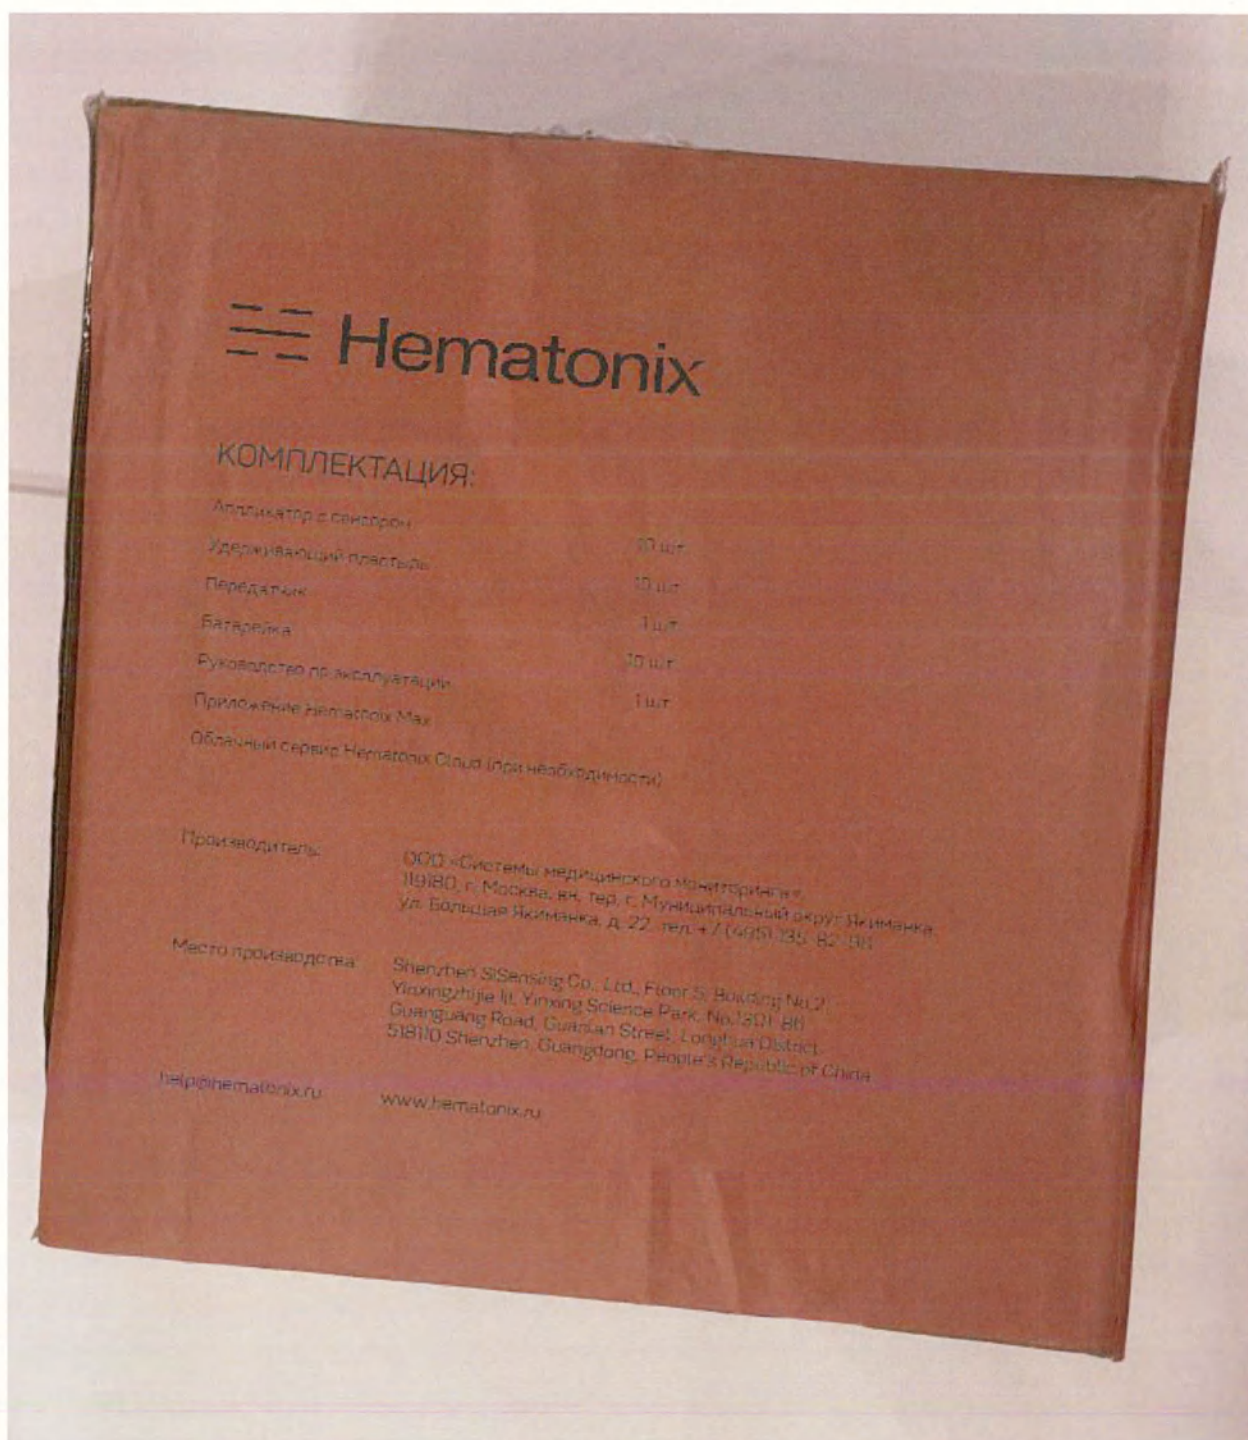


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GSI Max, комплект на 5 месяцев




Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 6 месяцев

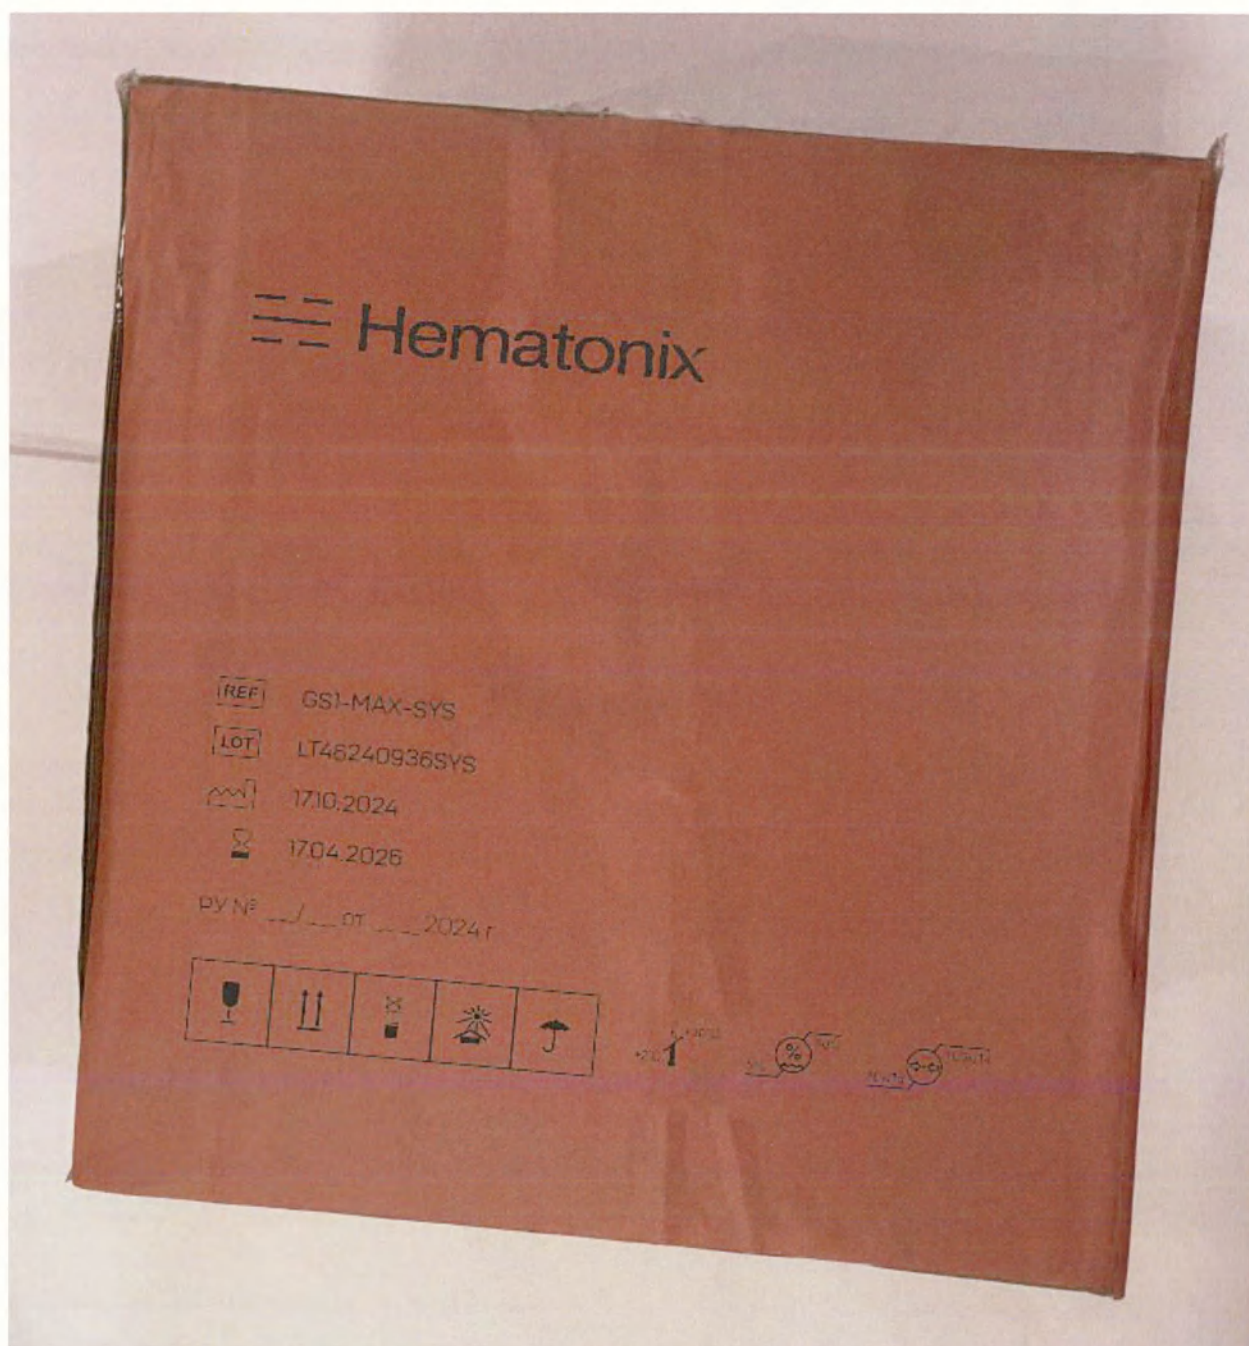


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 6 месяцев

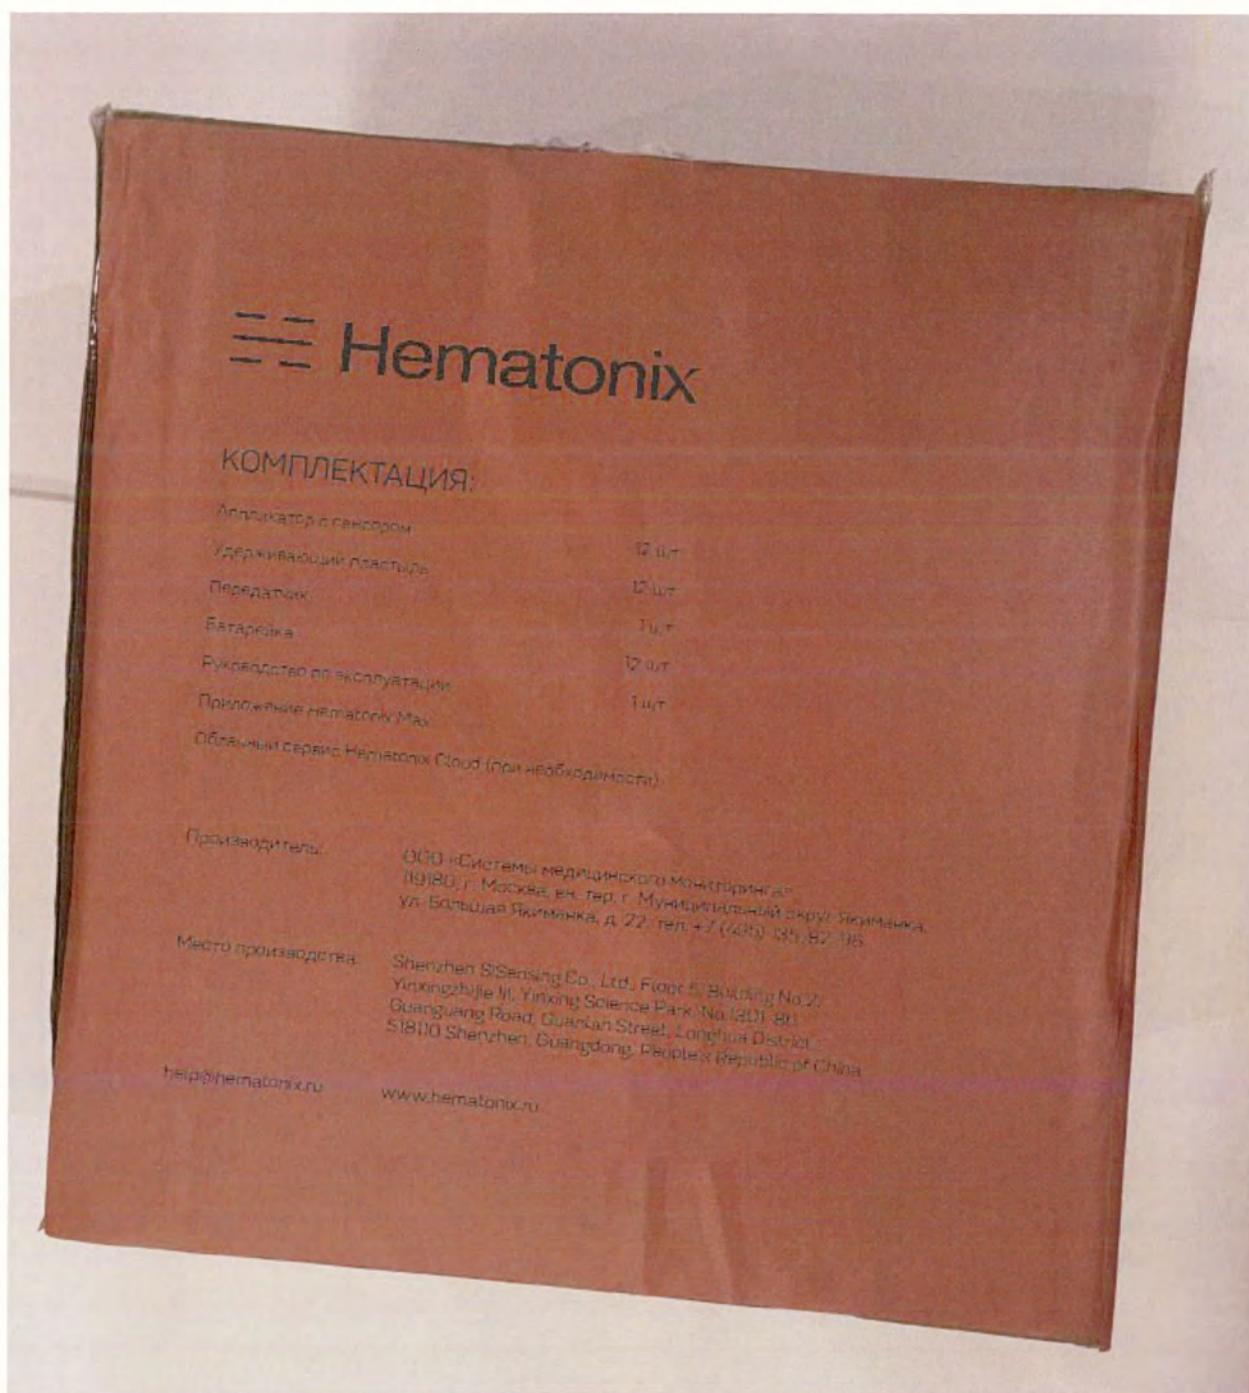


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 6 месяцев

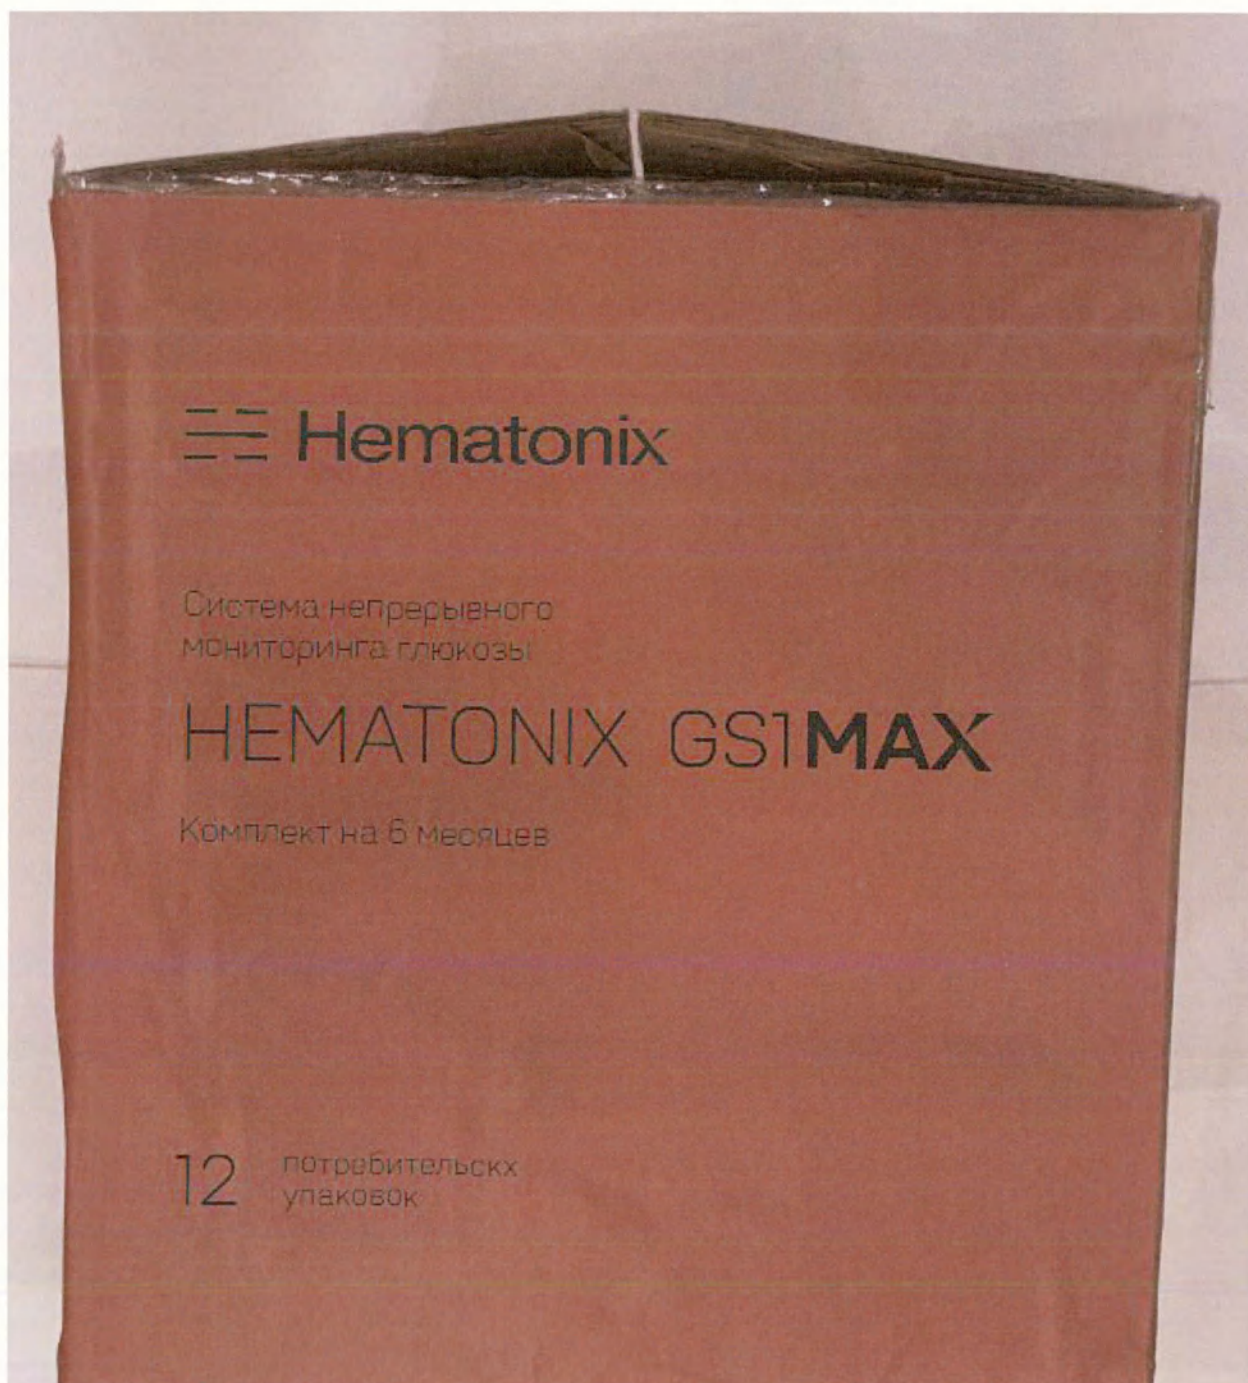


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 7 месяцев

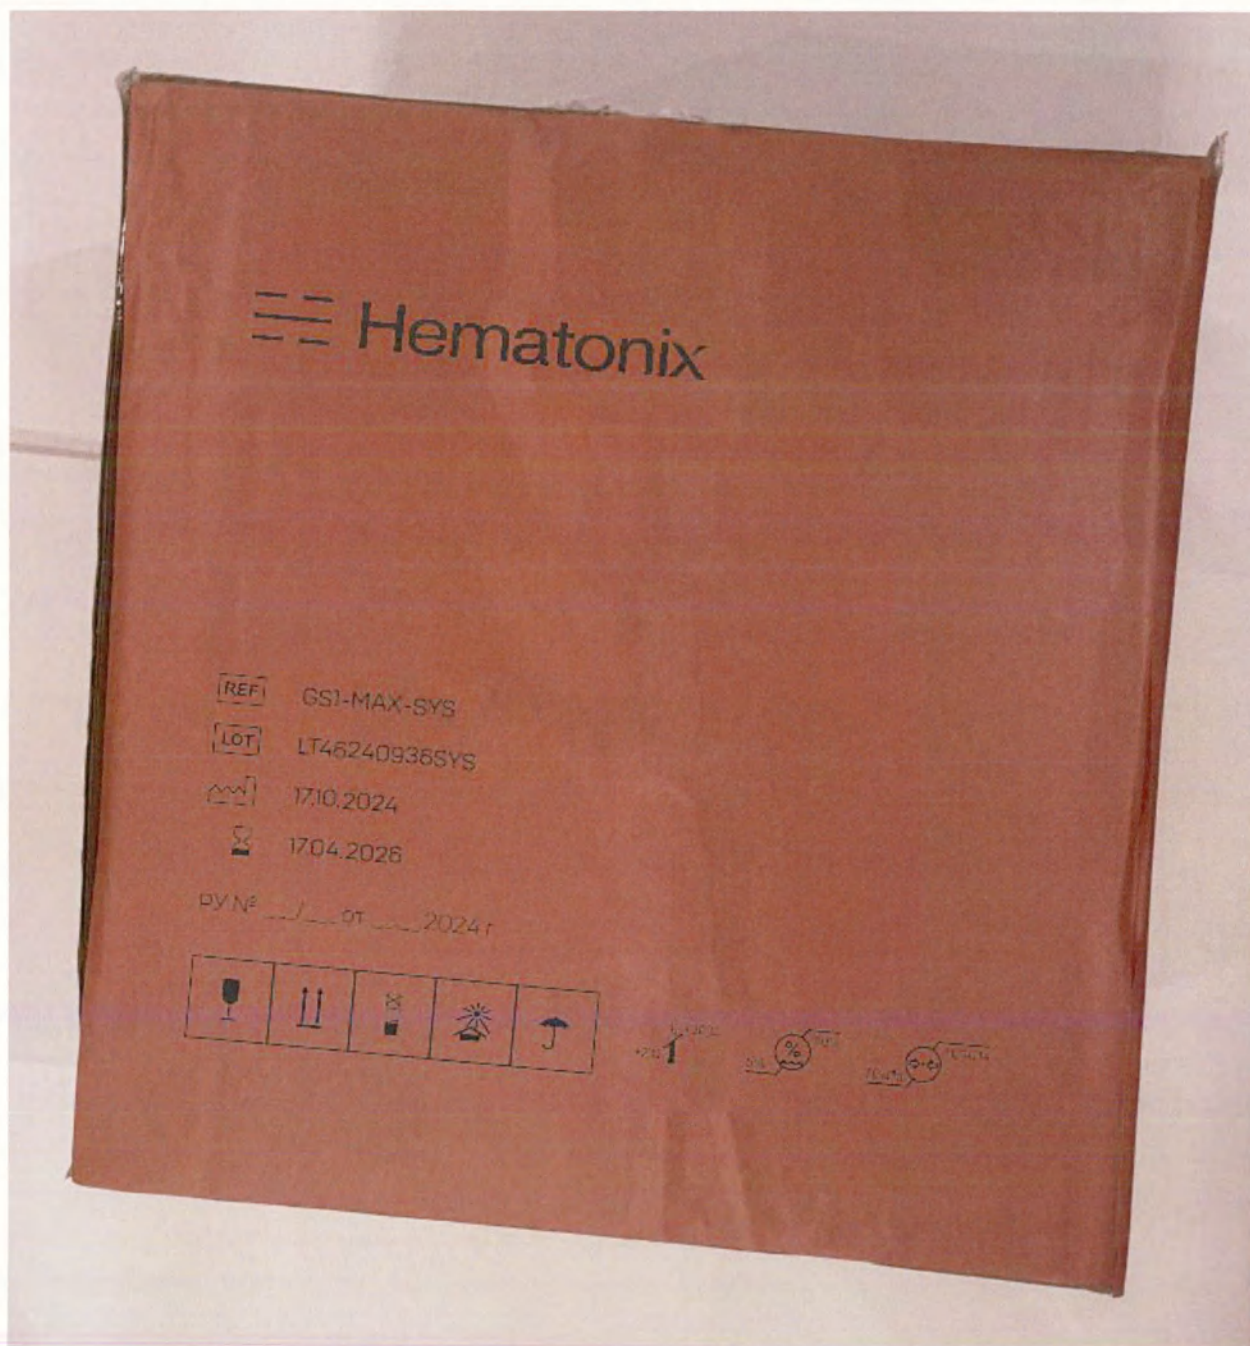


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 7 месяцев

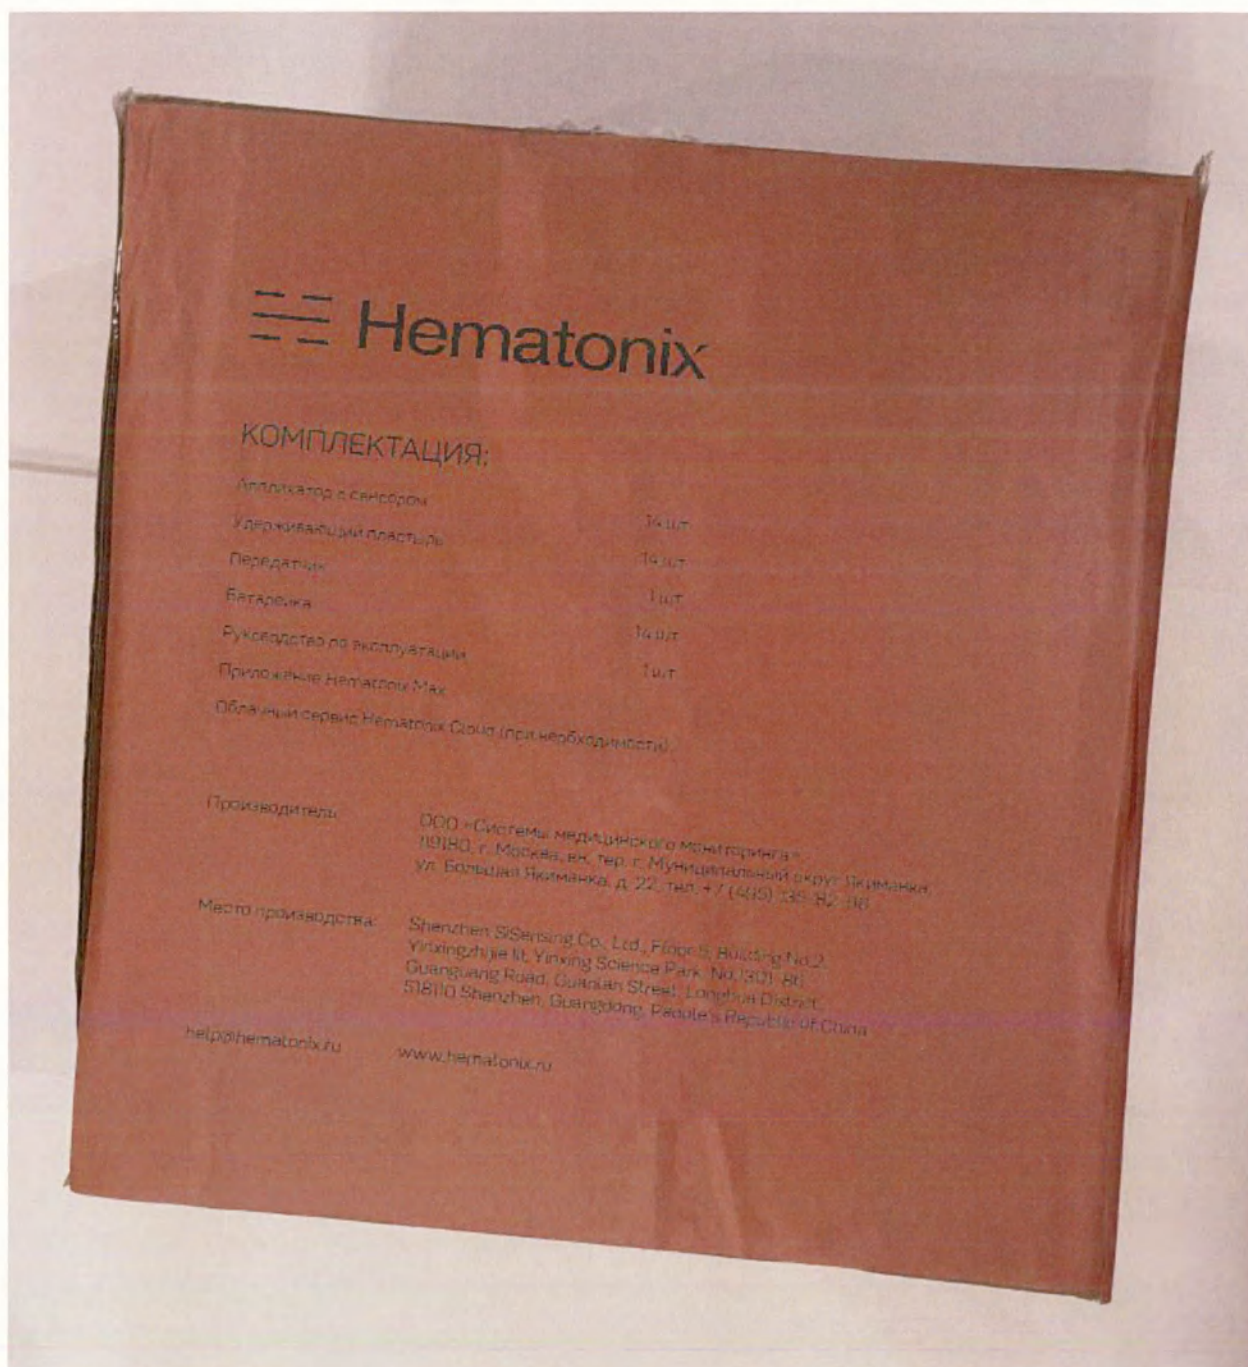


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 7 месяцев

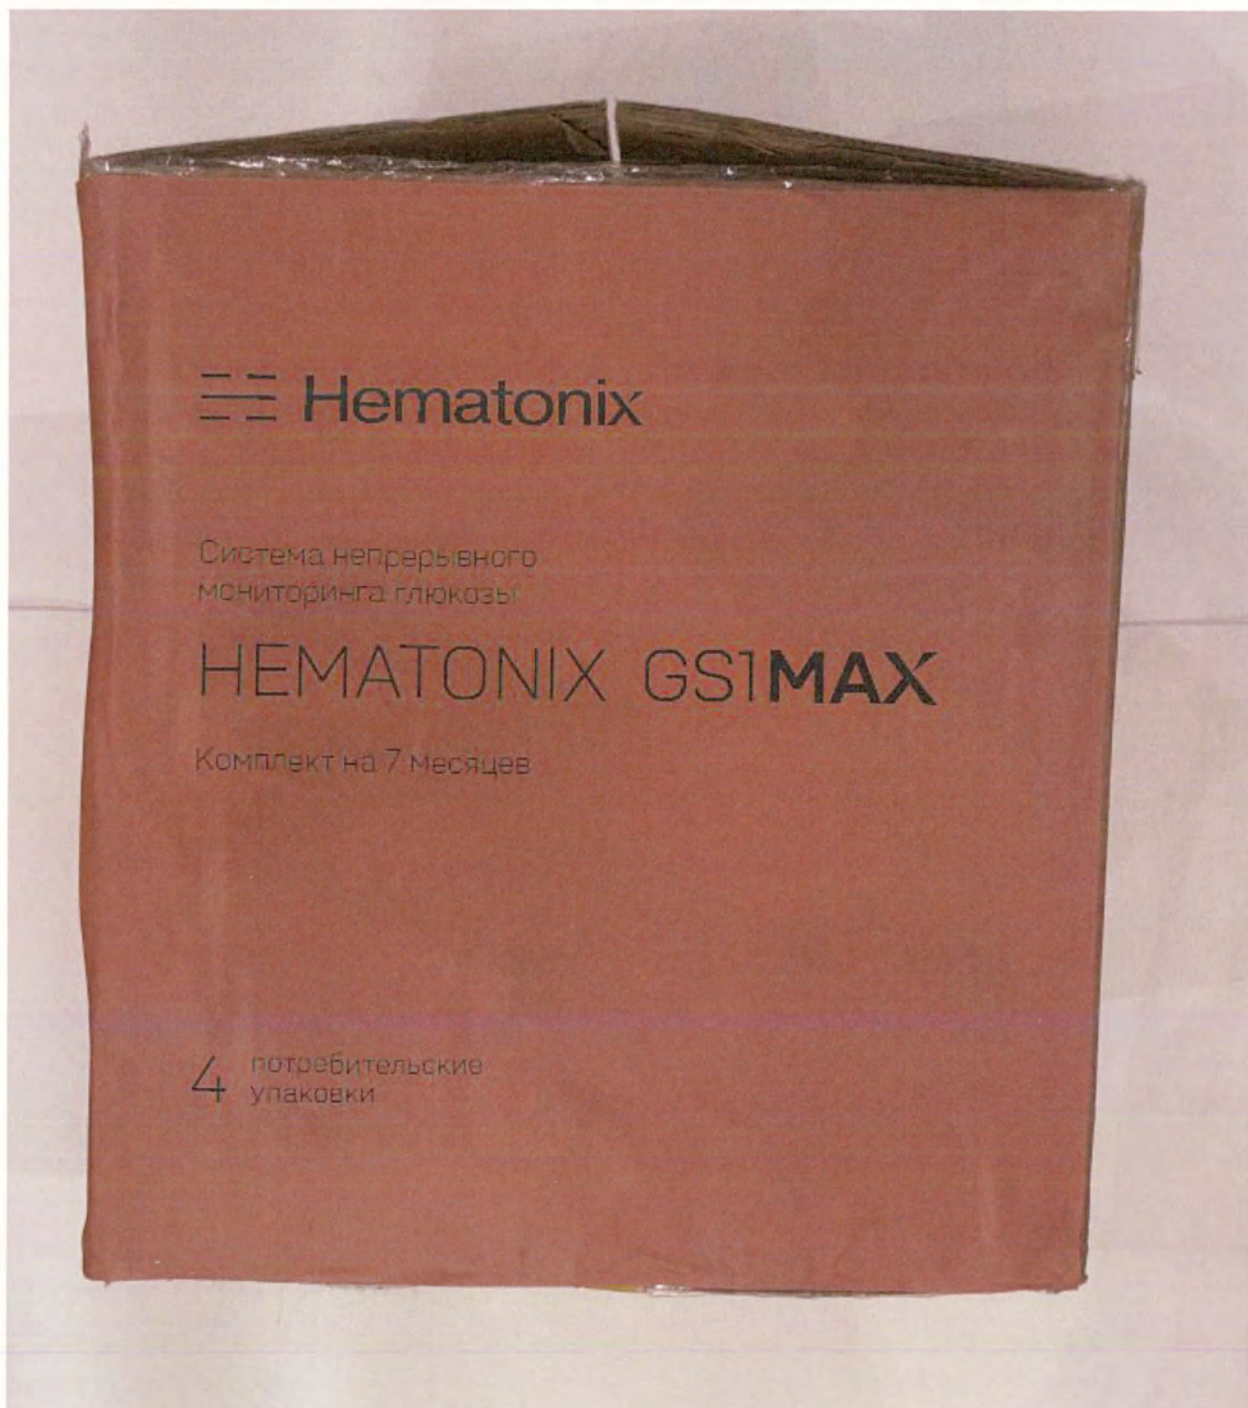


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 8 месяцев

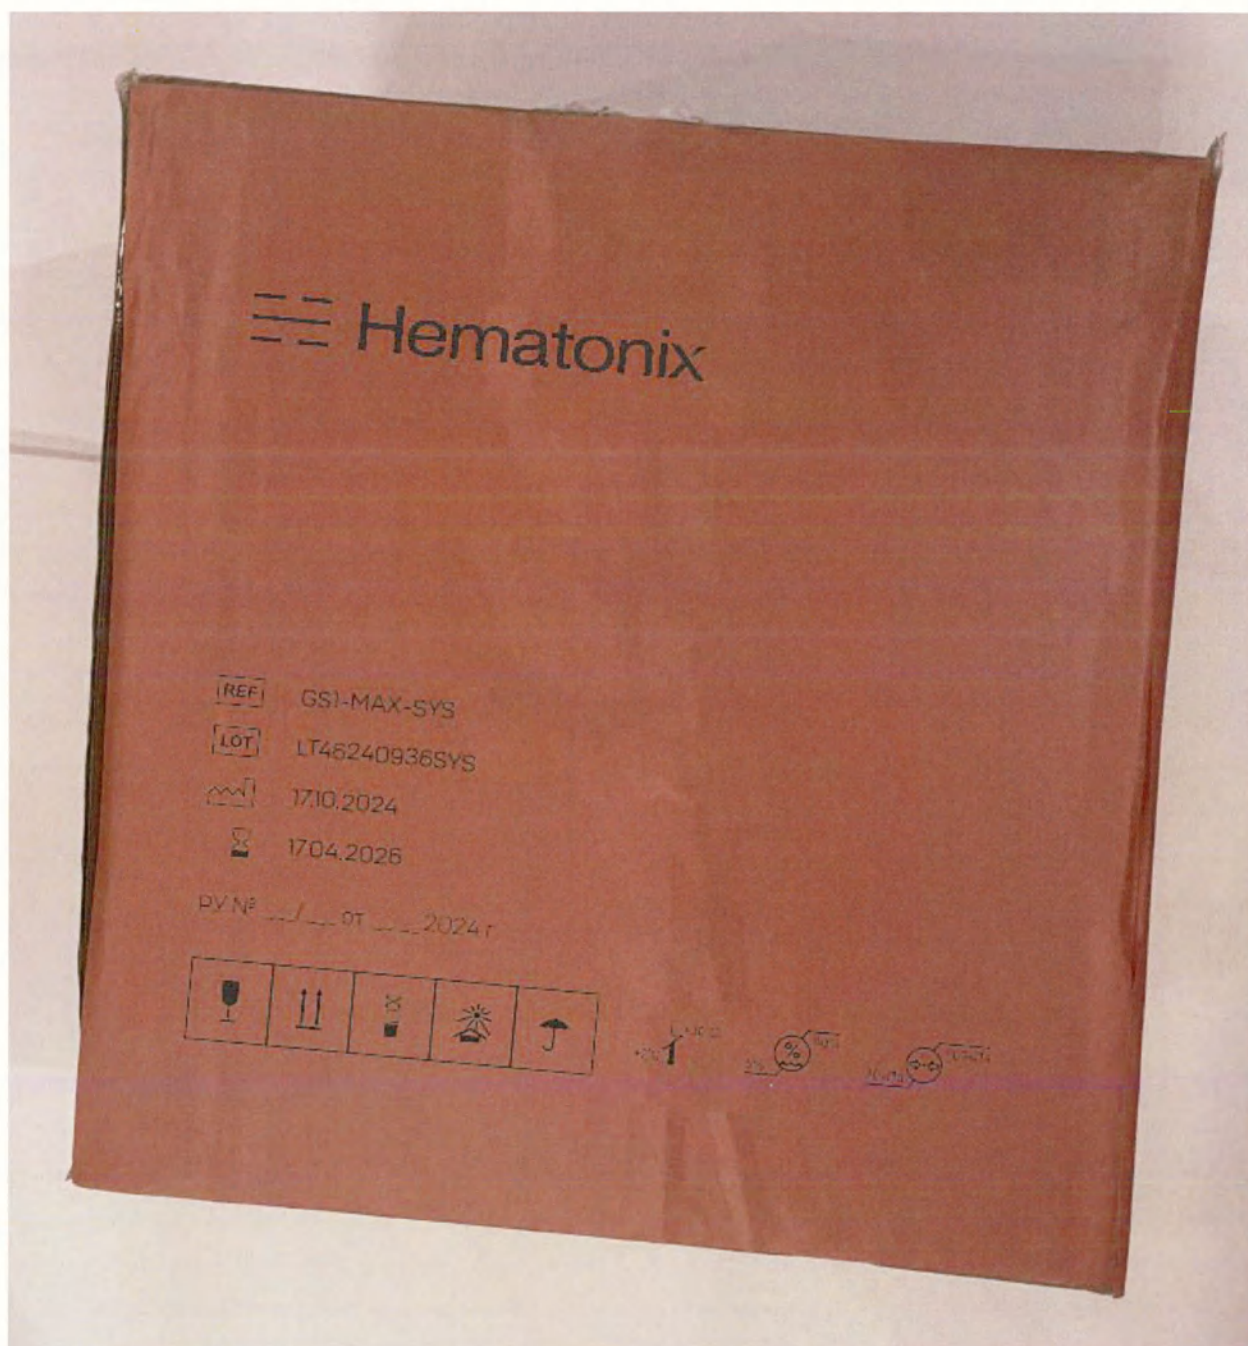


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 8 месяцев

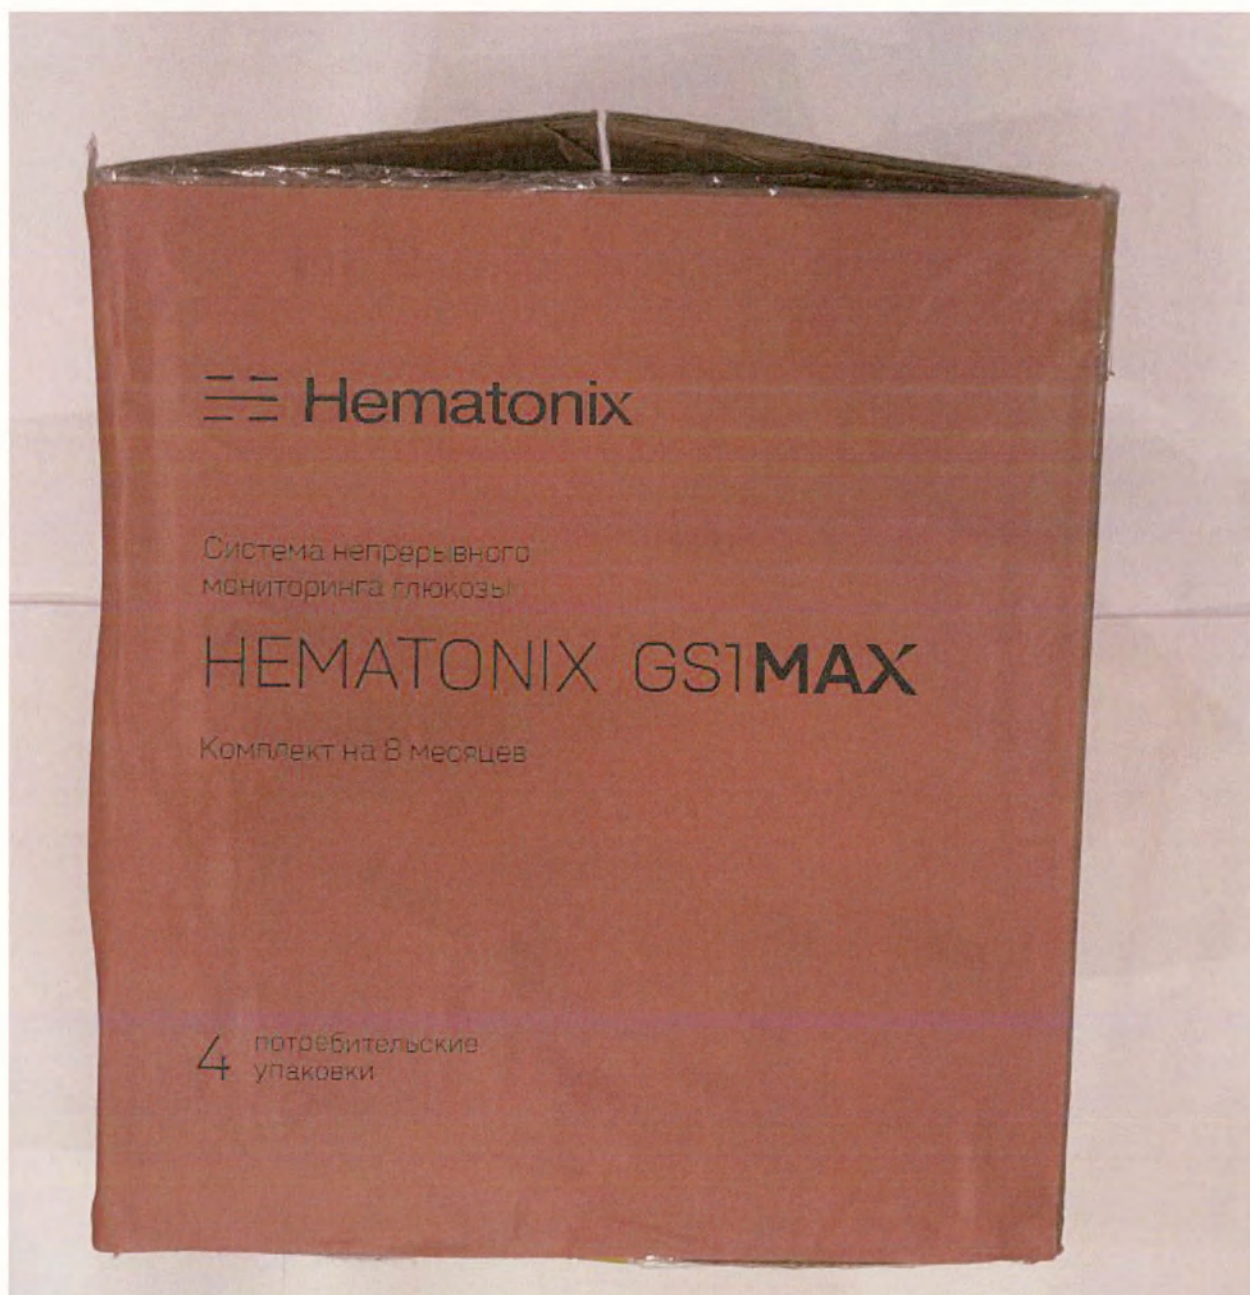


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 8 месяцев

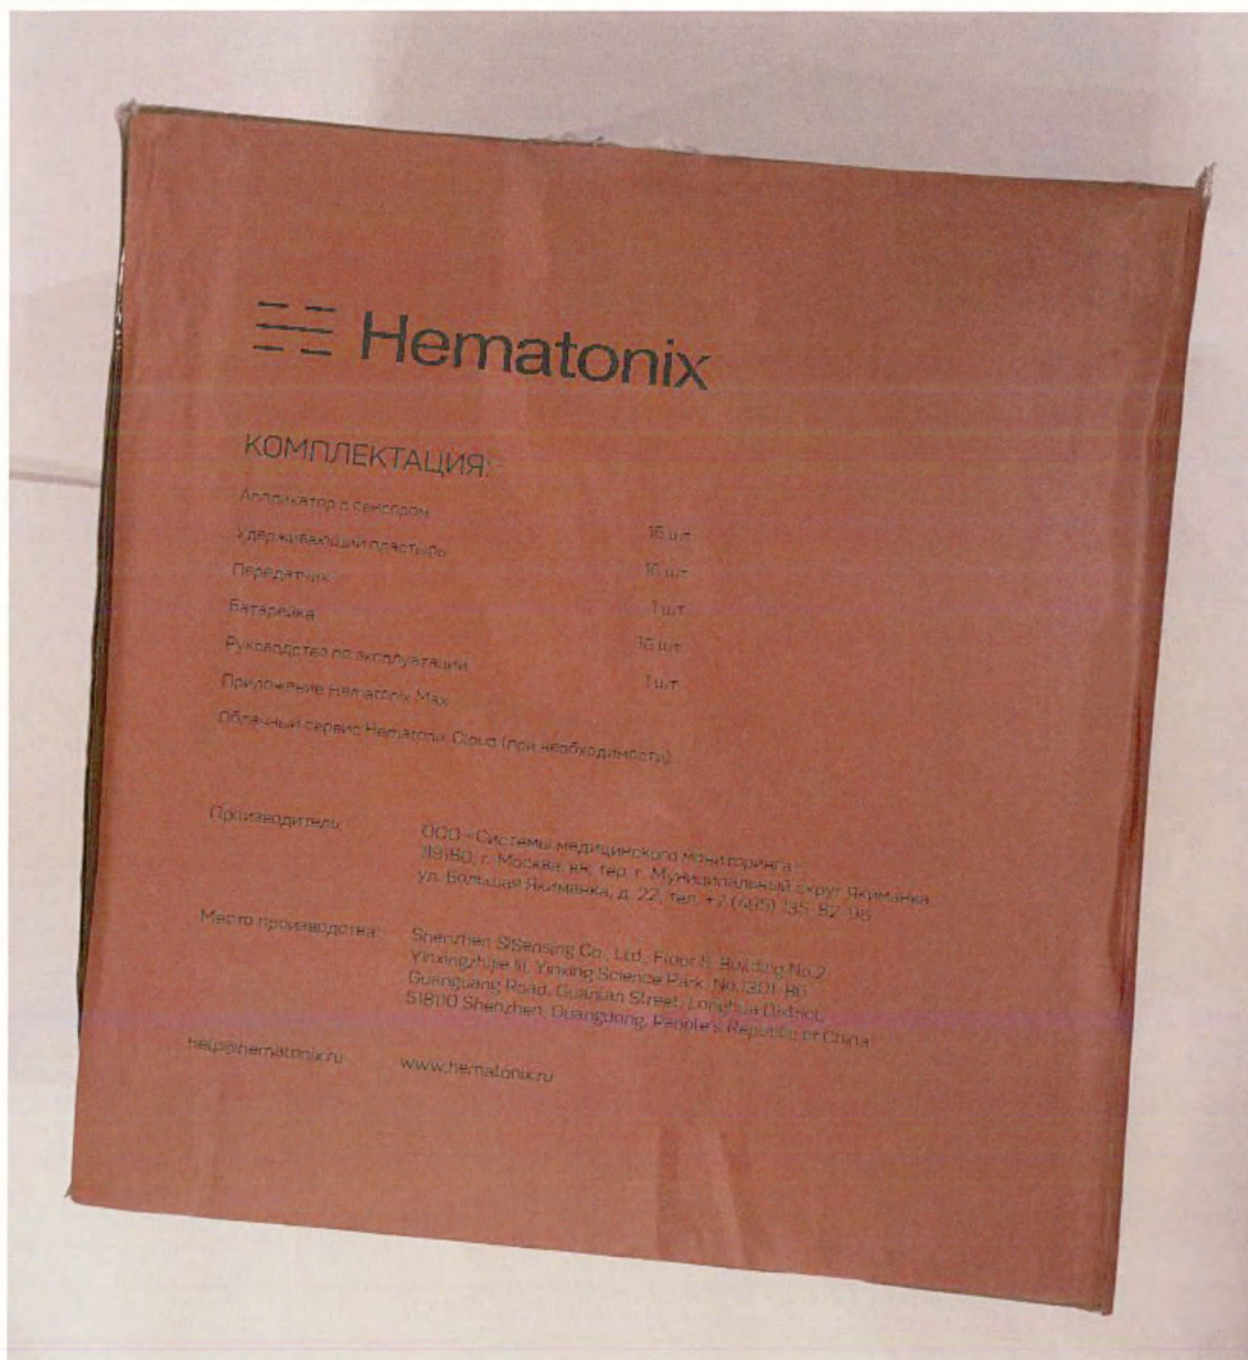


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 9 месяцев

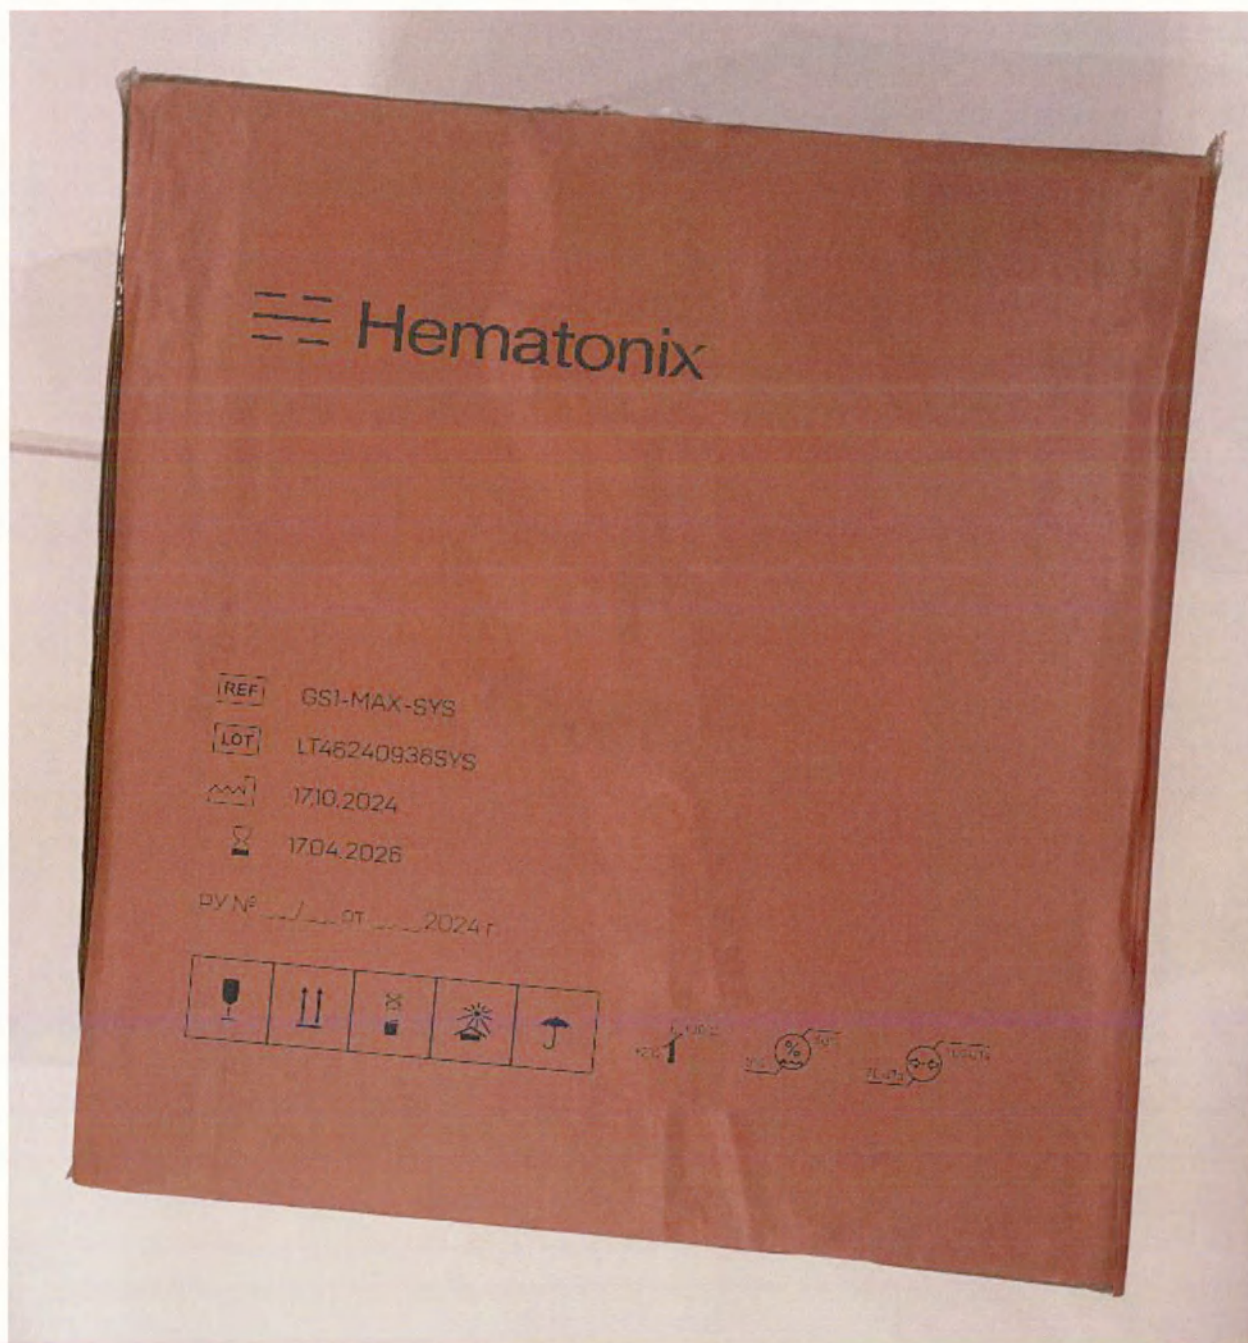


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 9 месяцев

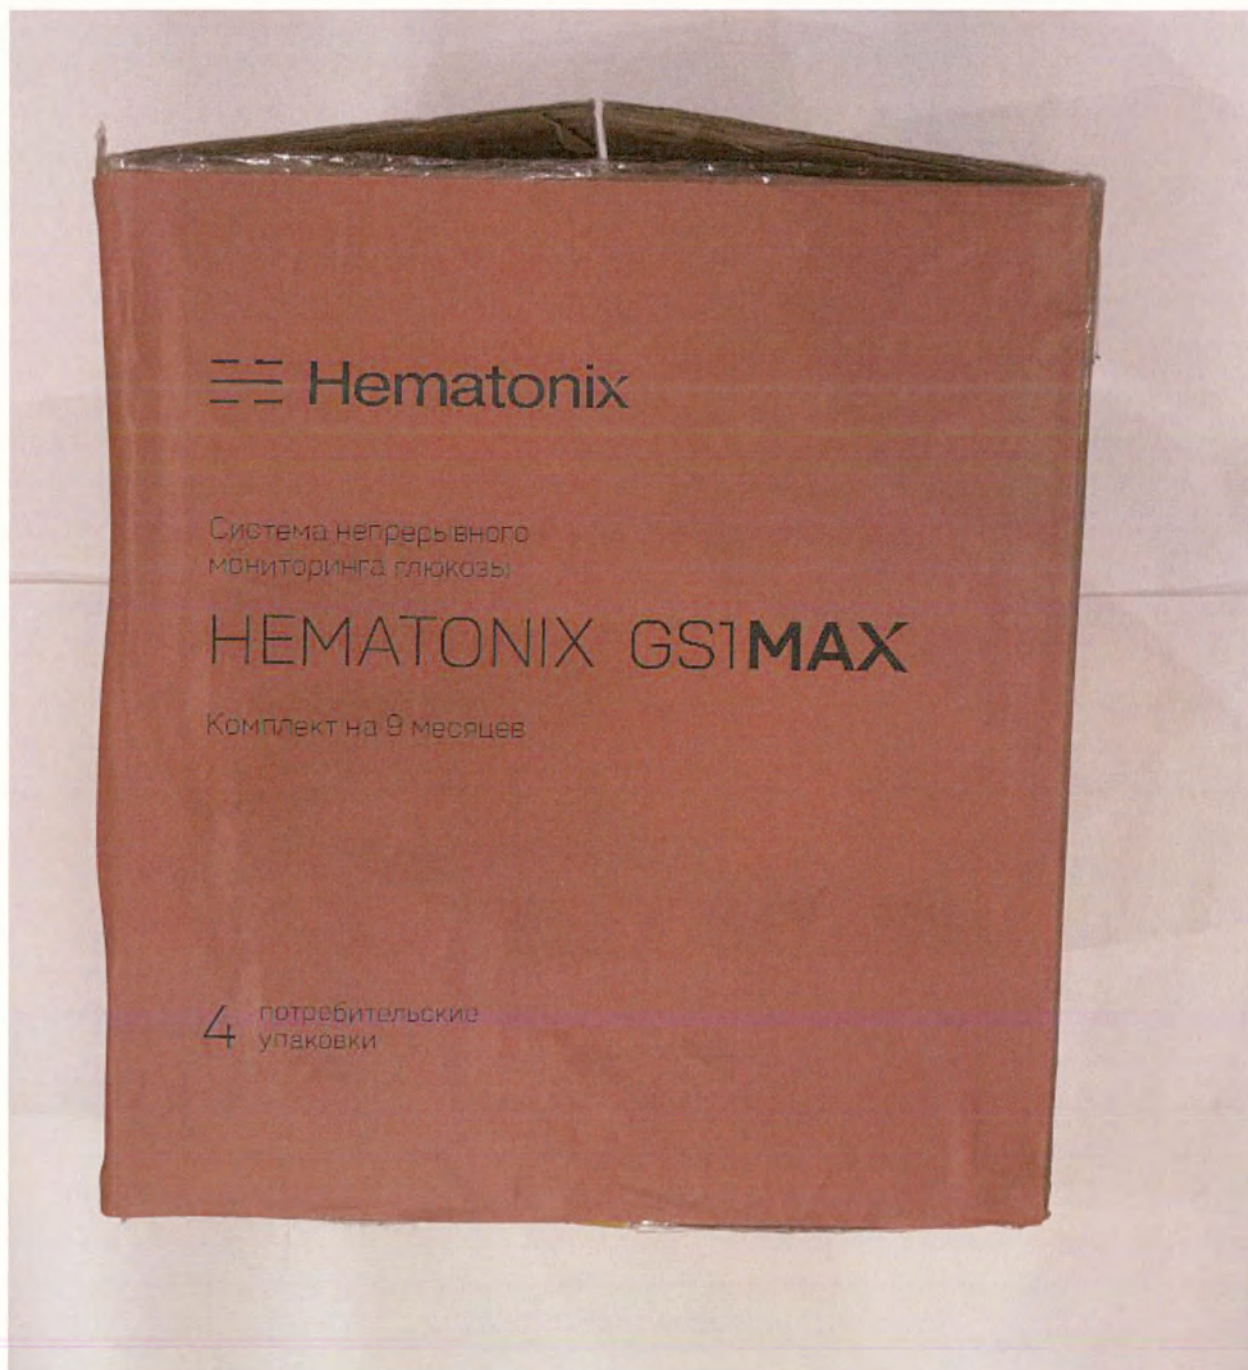


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 9 месяцев

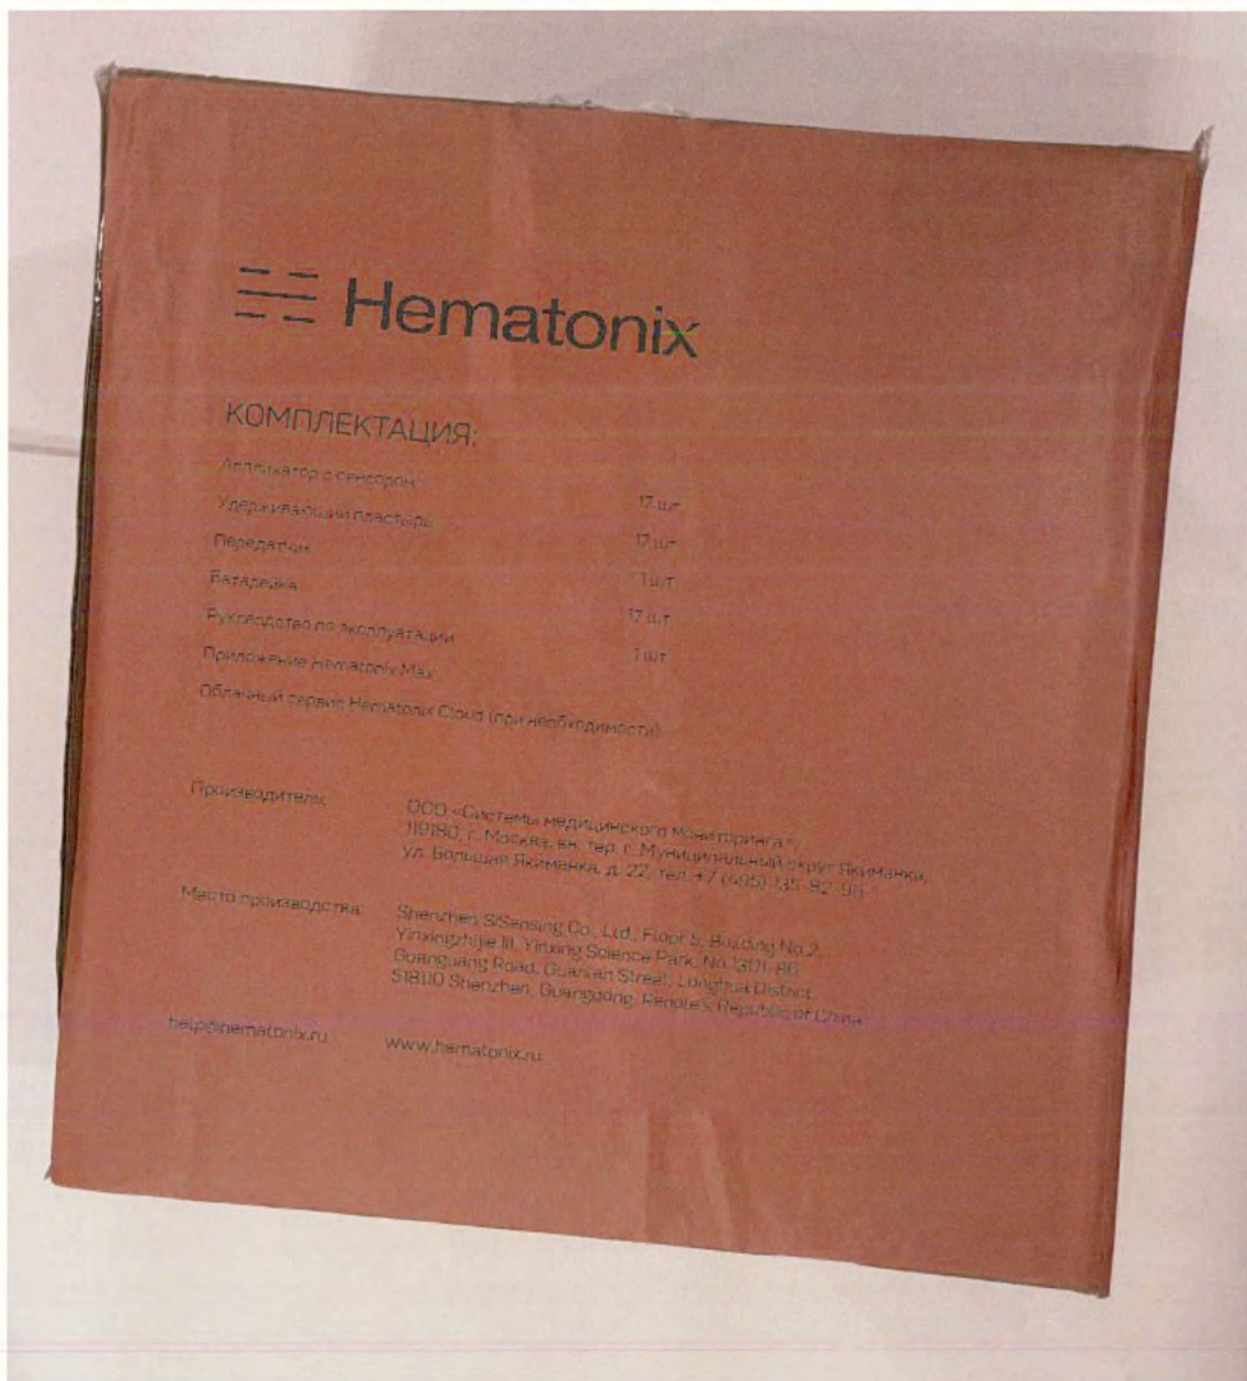


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 10
месяцев

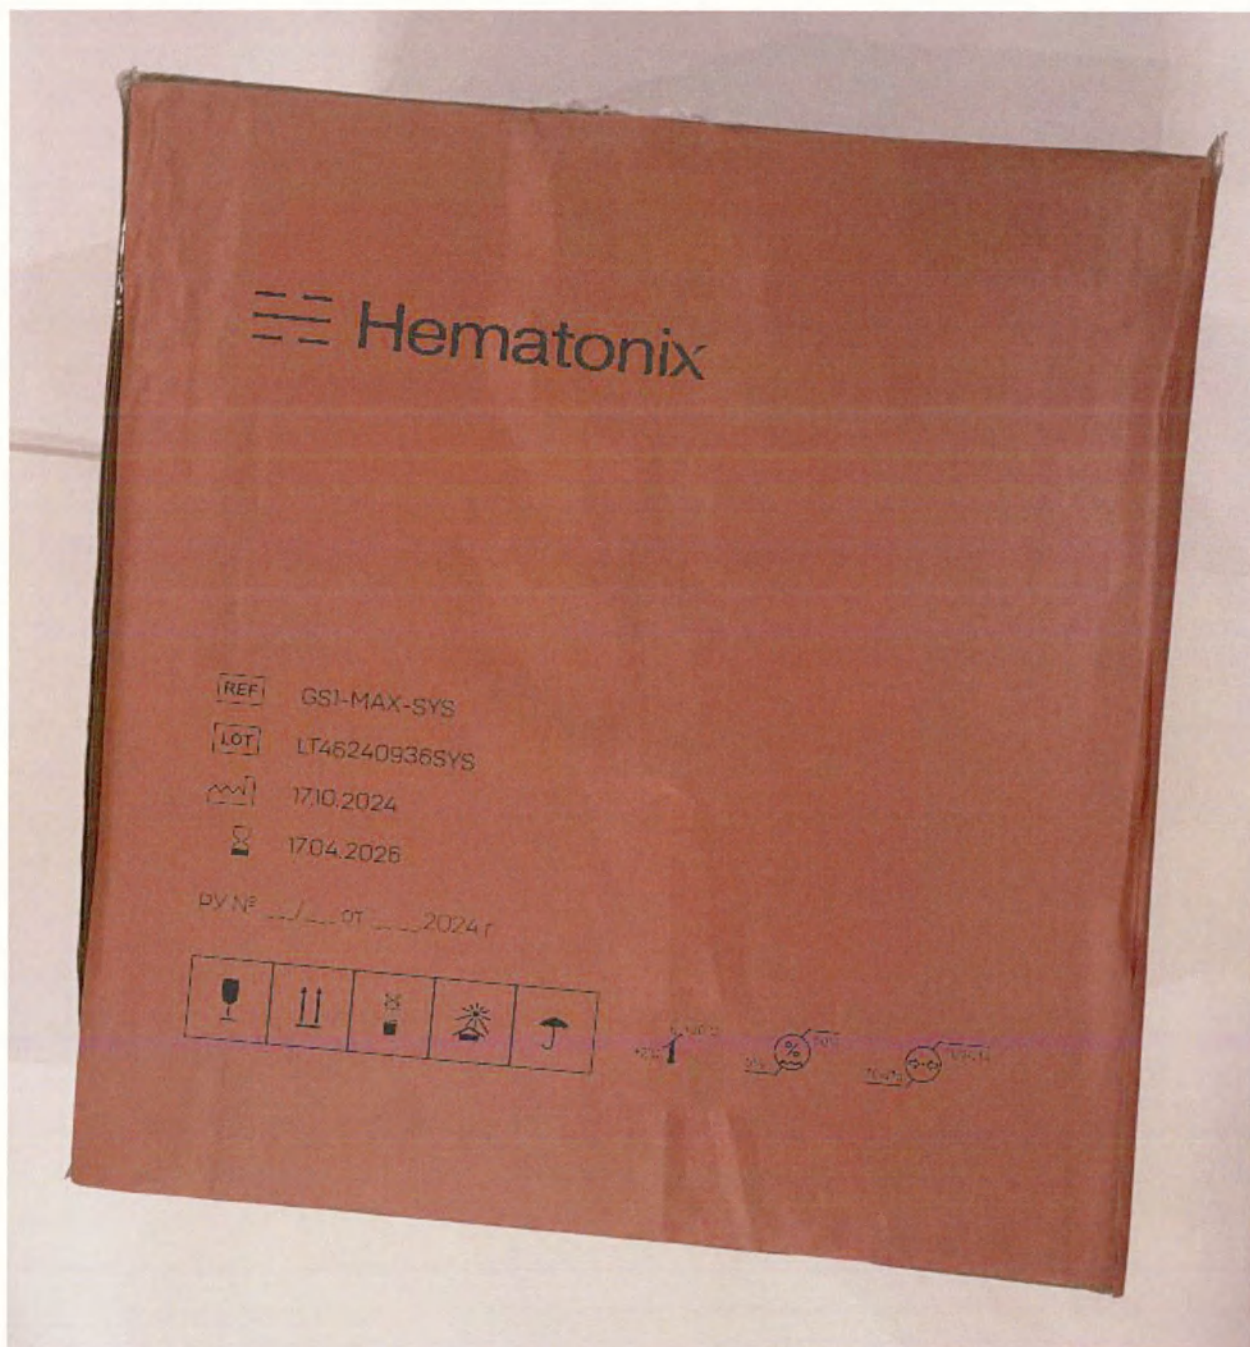


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 10
месяцев

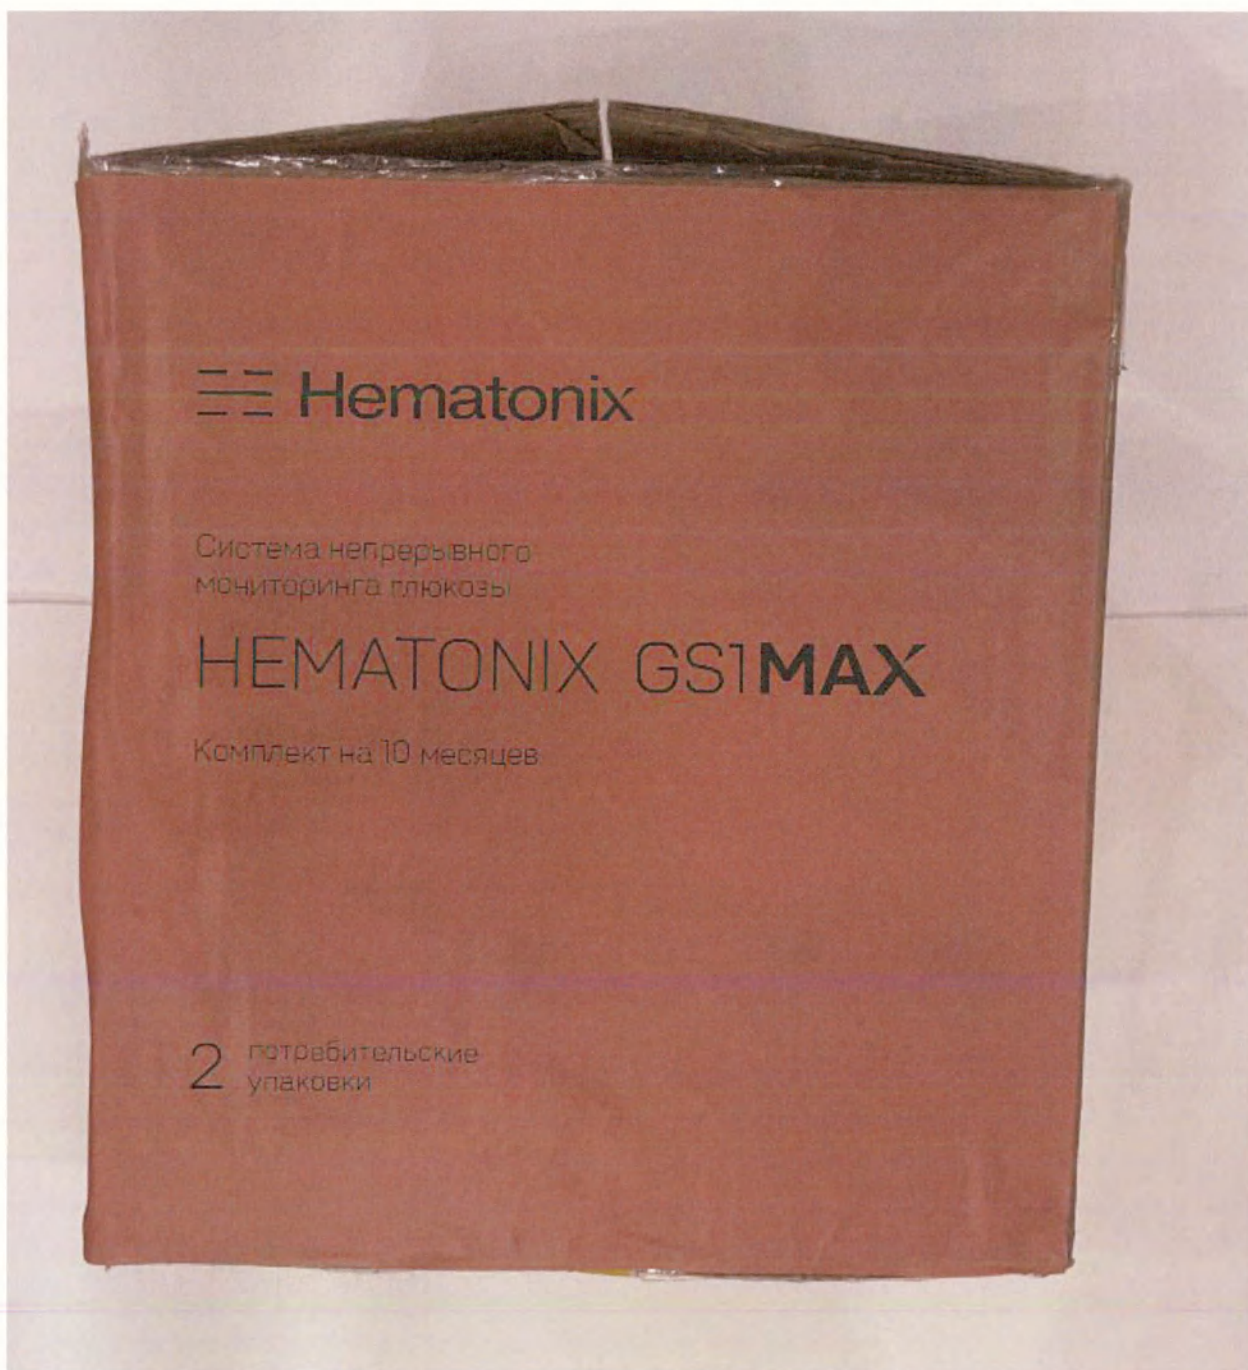


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 10
месяцев

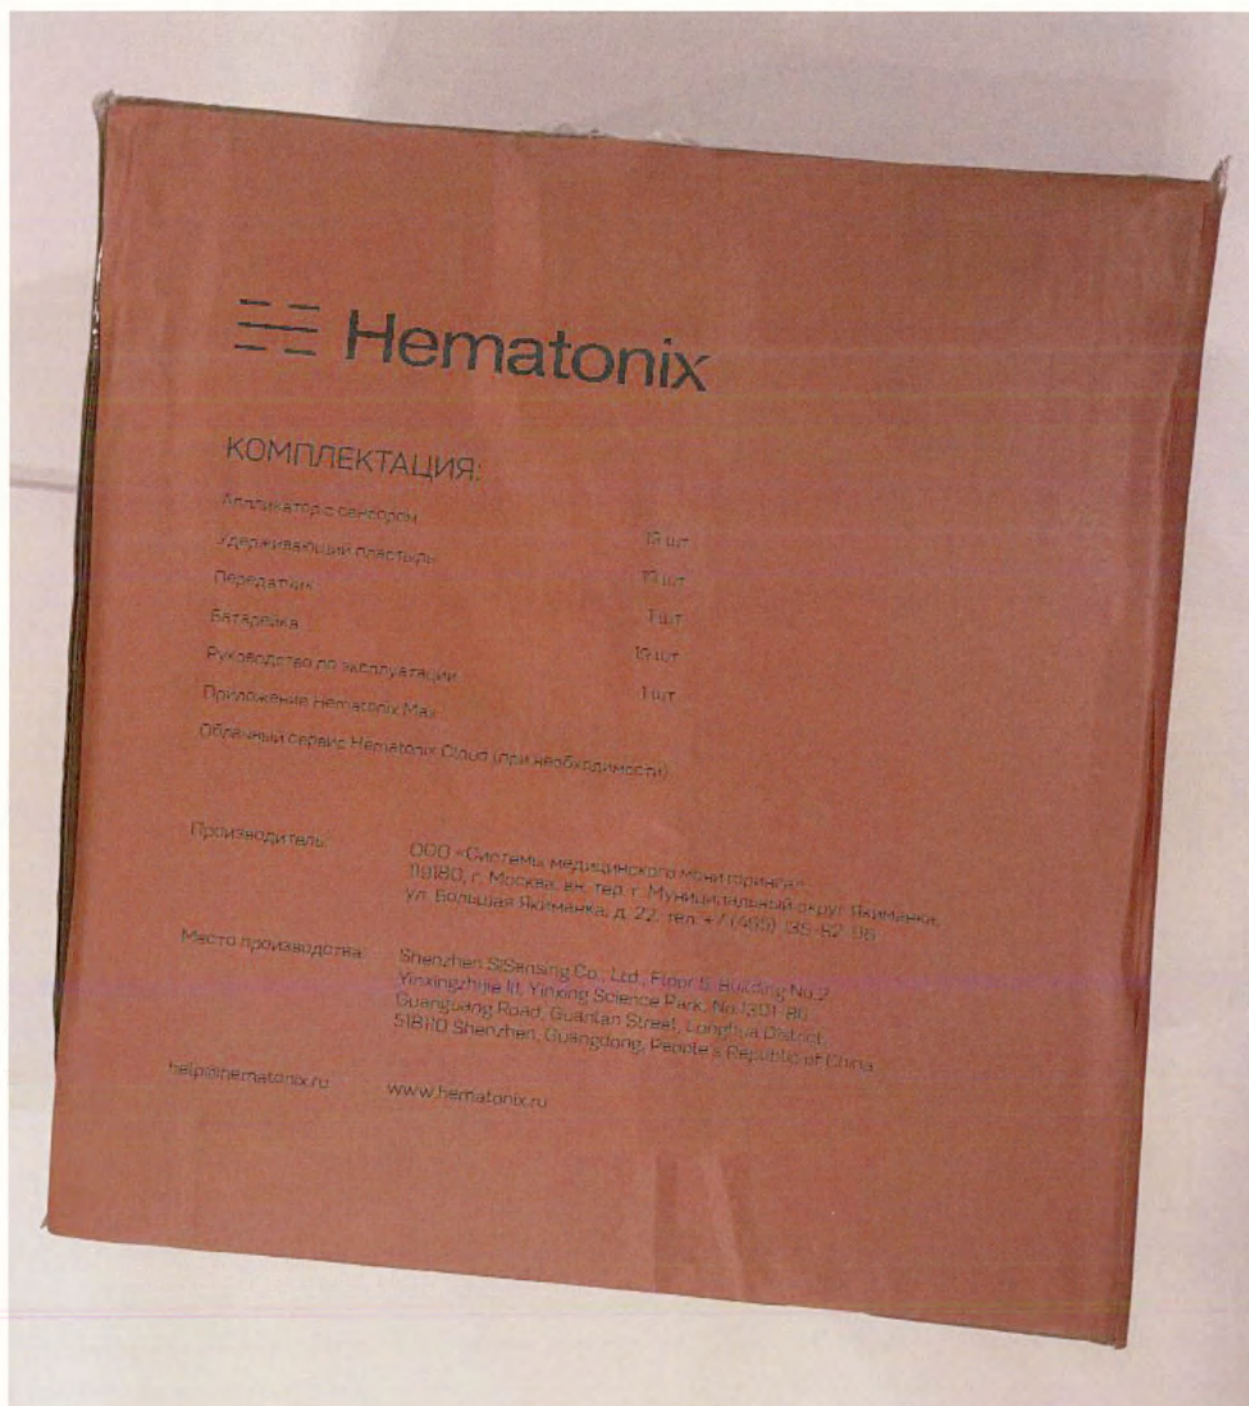


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 11
месяцев

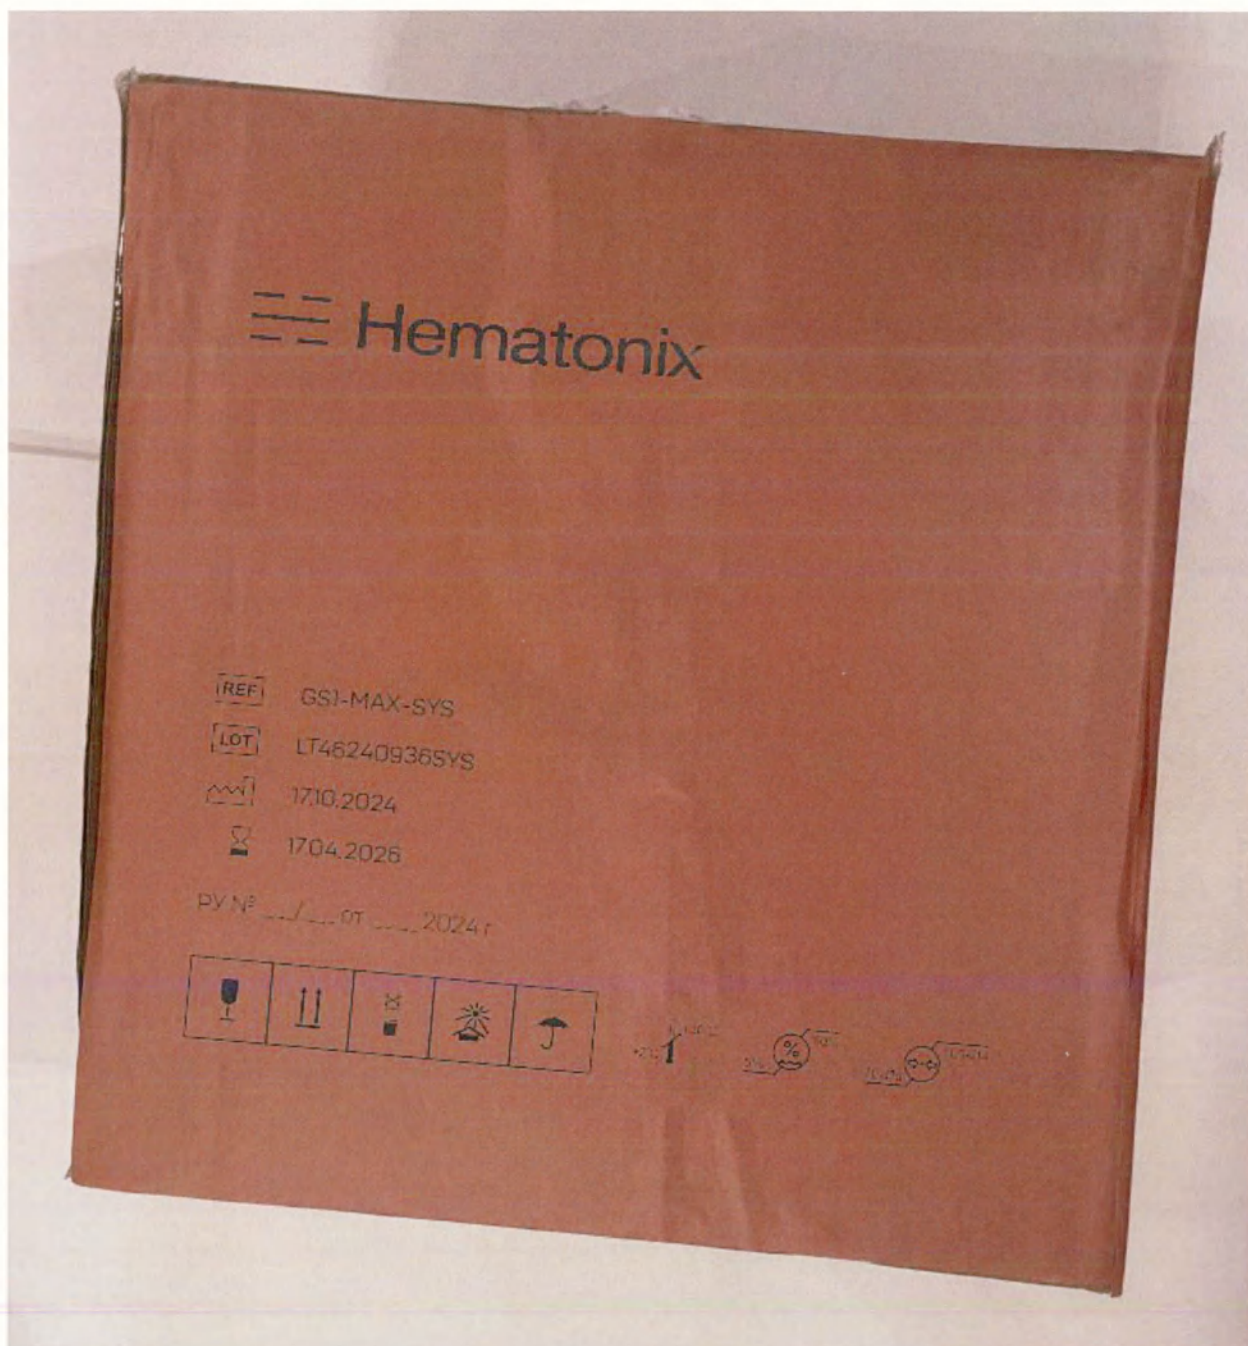


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 11
месяцев

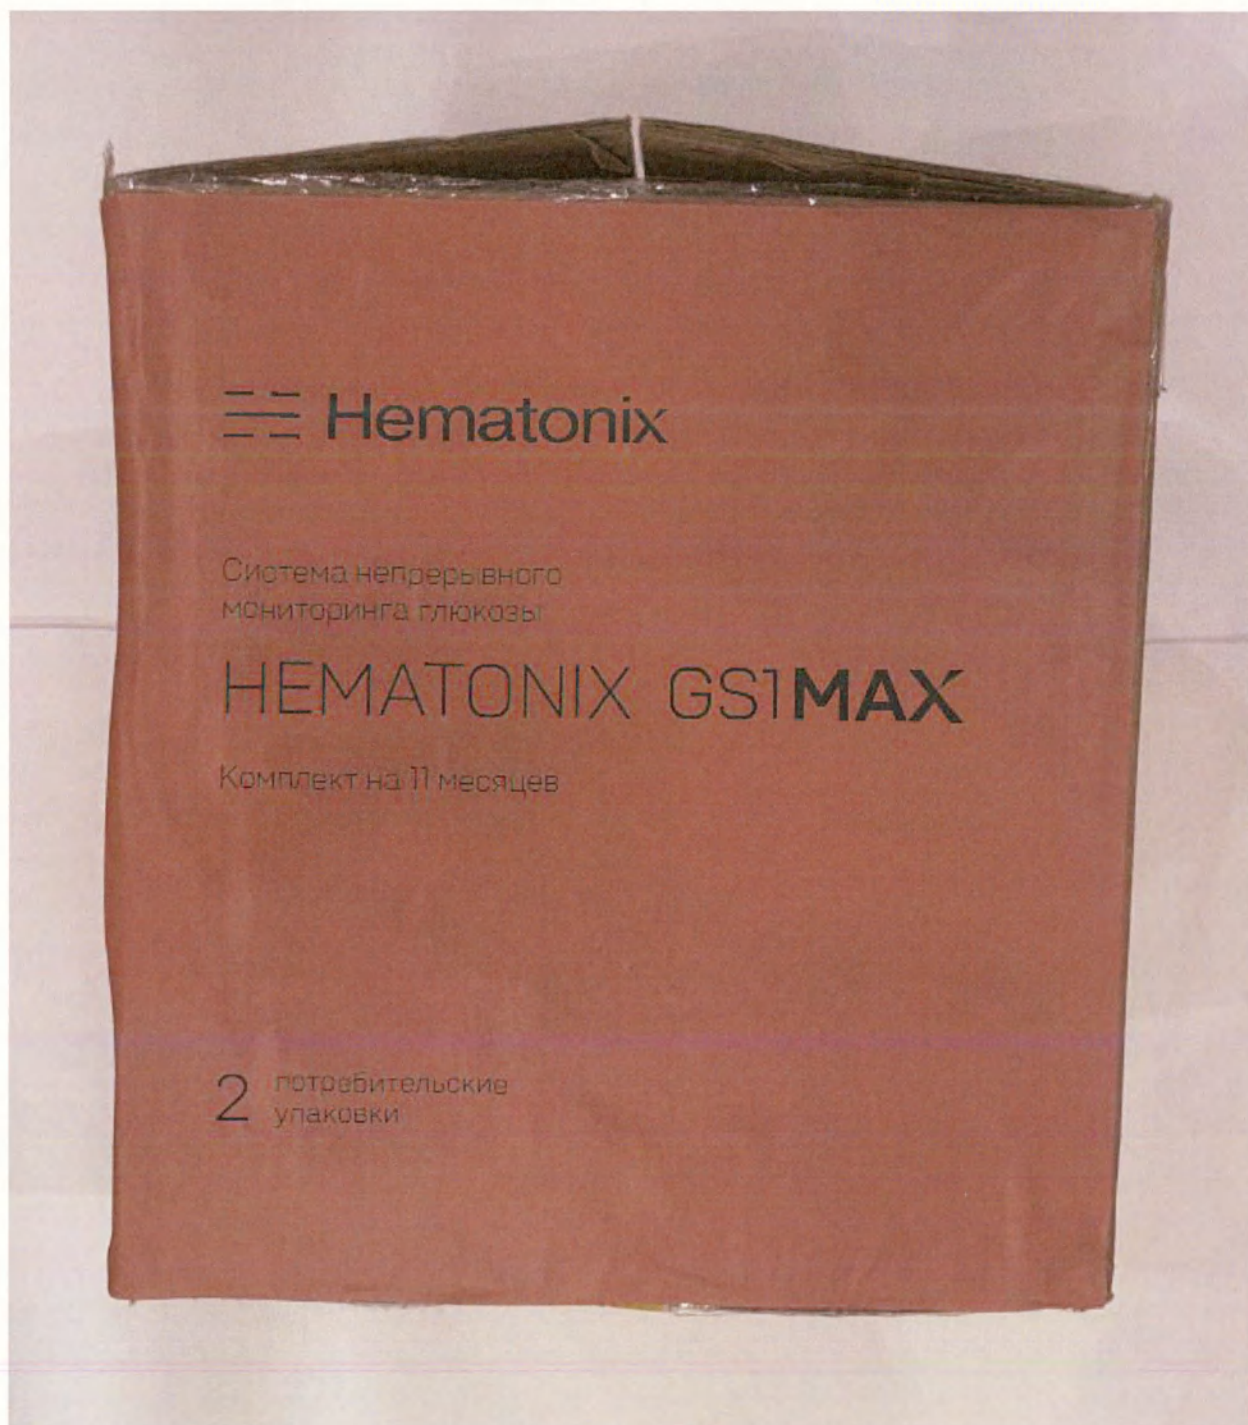


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 11
месяцев

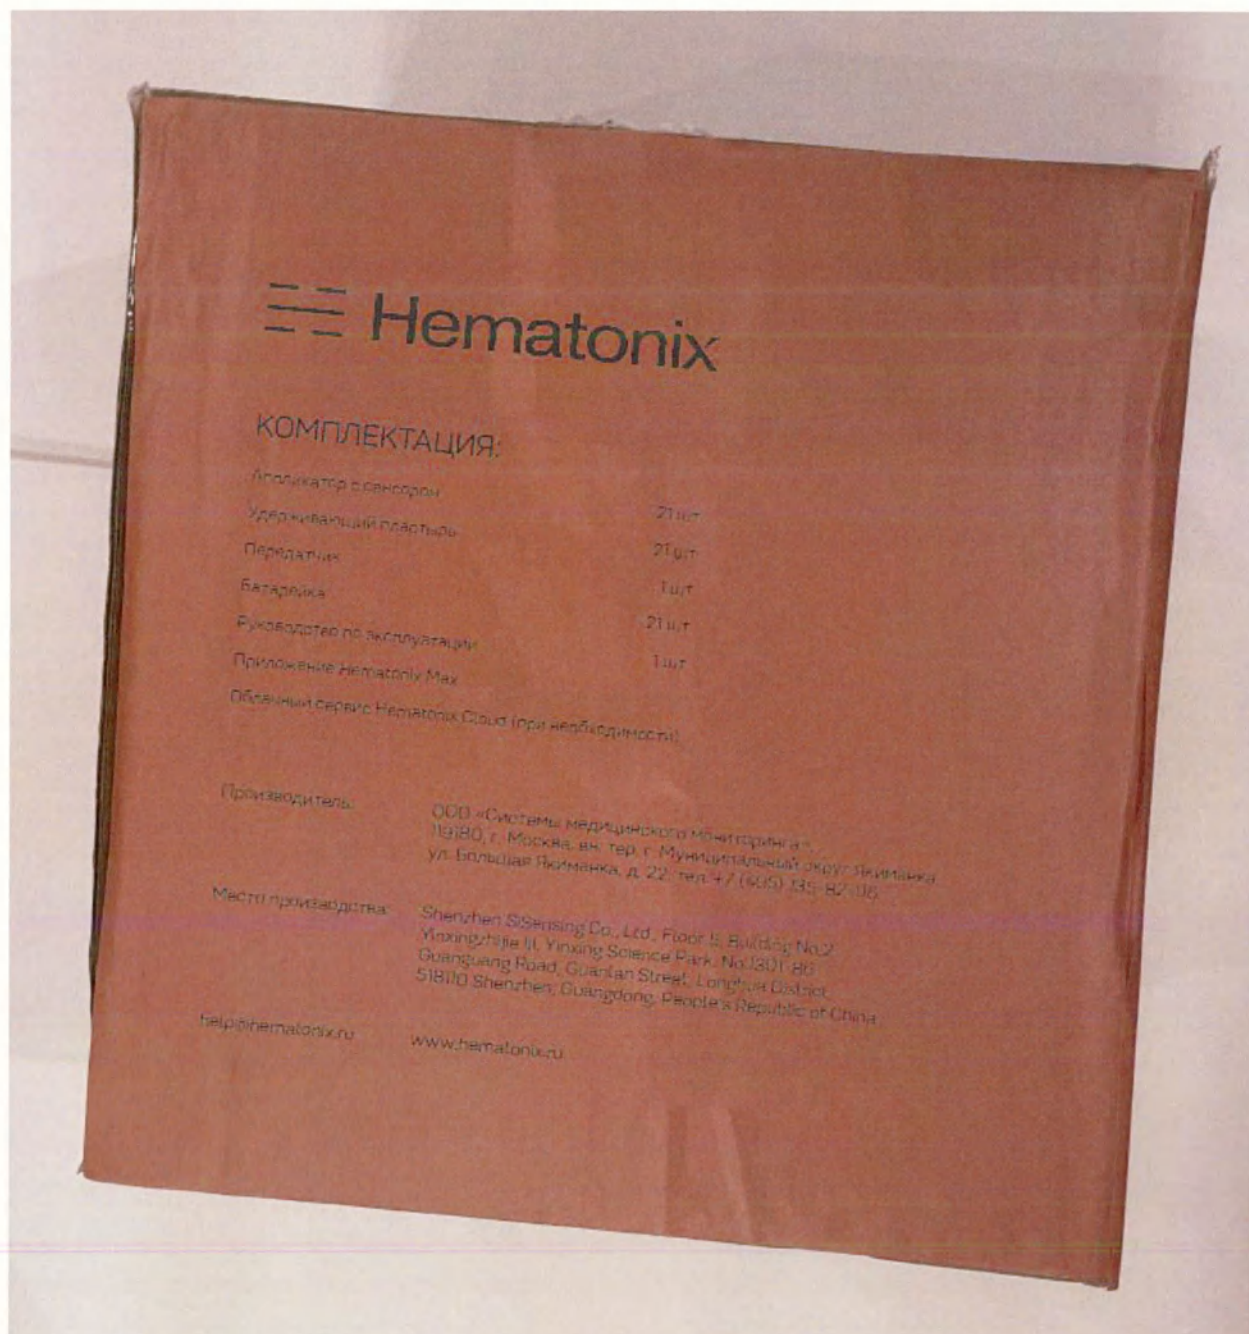


Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 12
месяцев

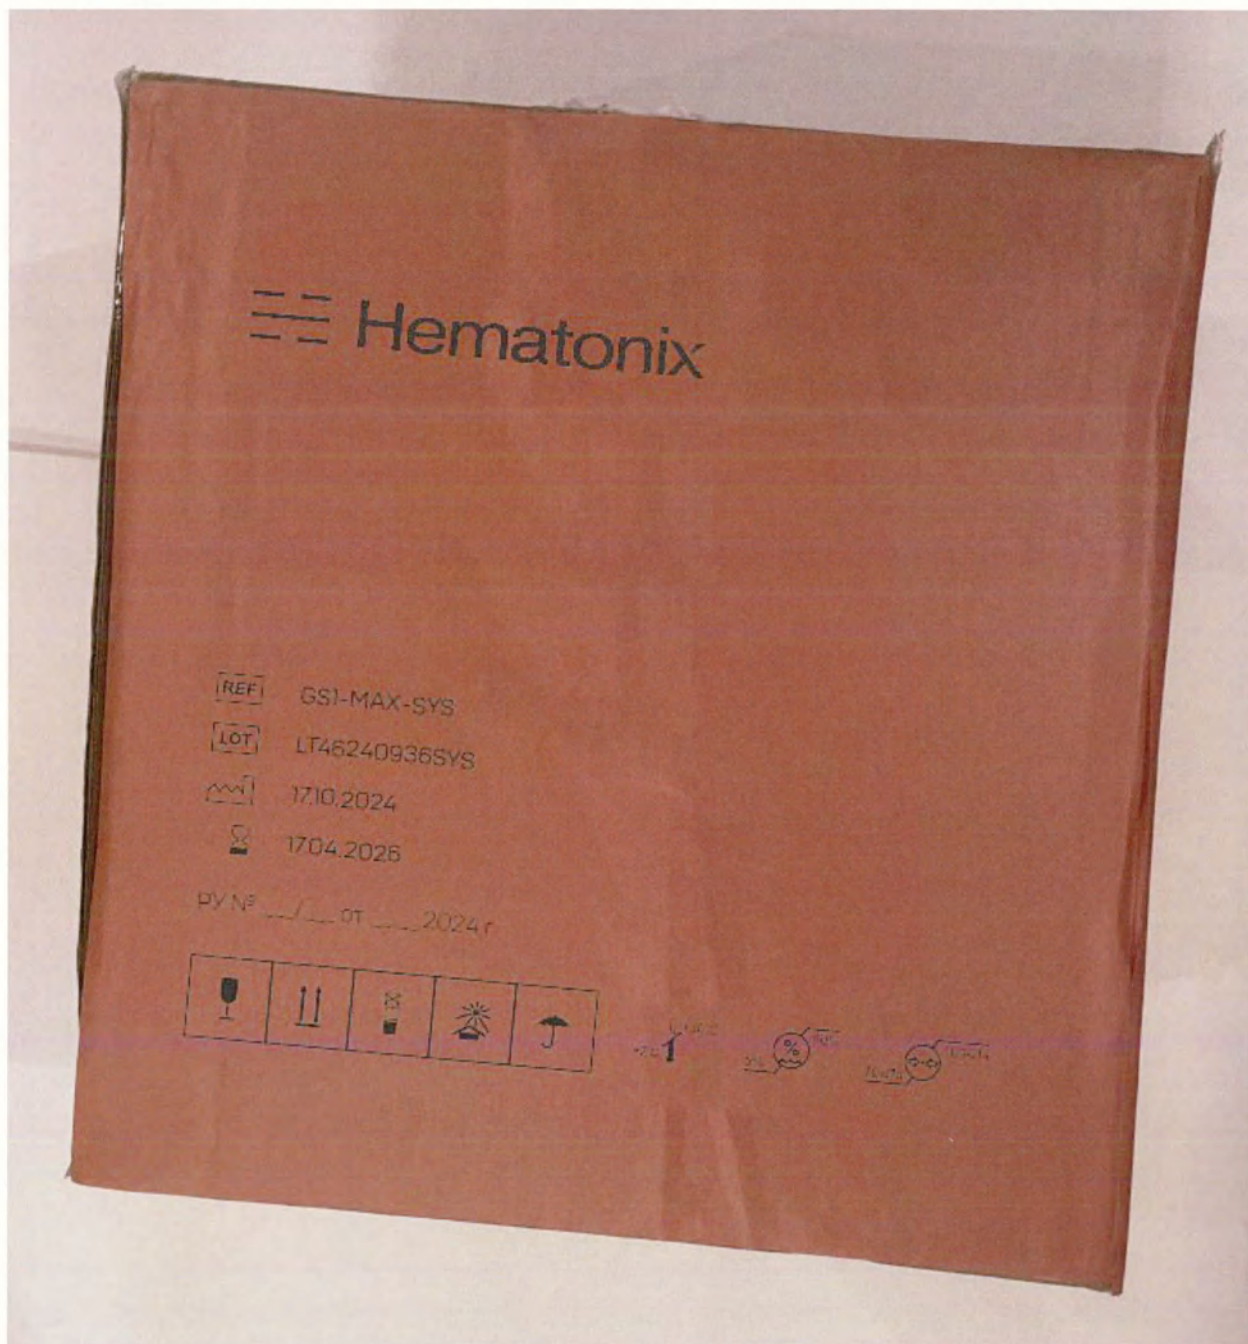

Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 12
месяцев

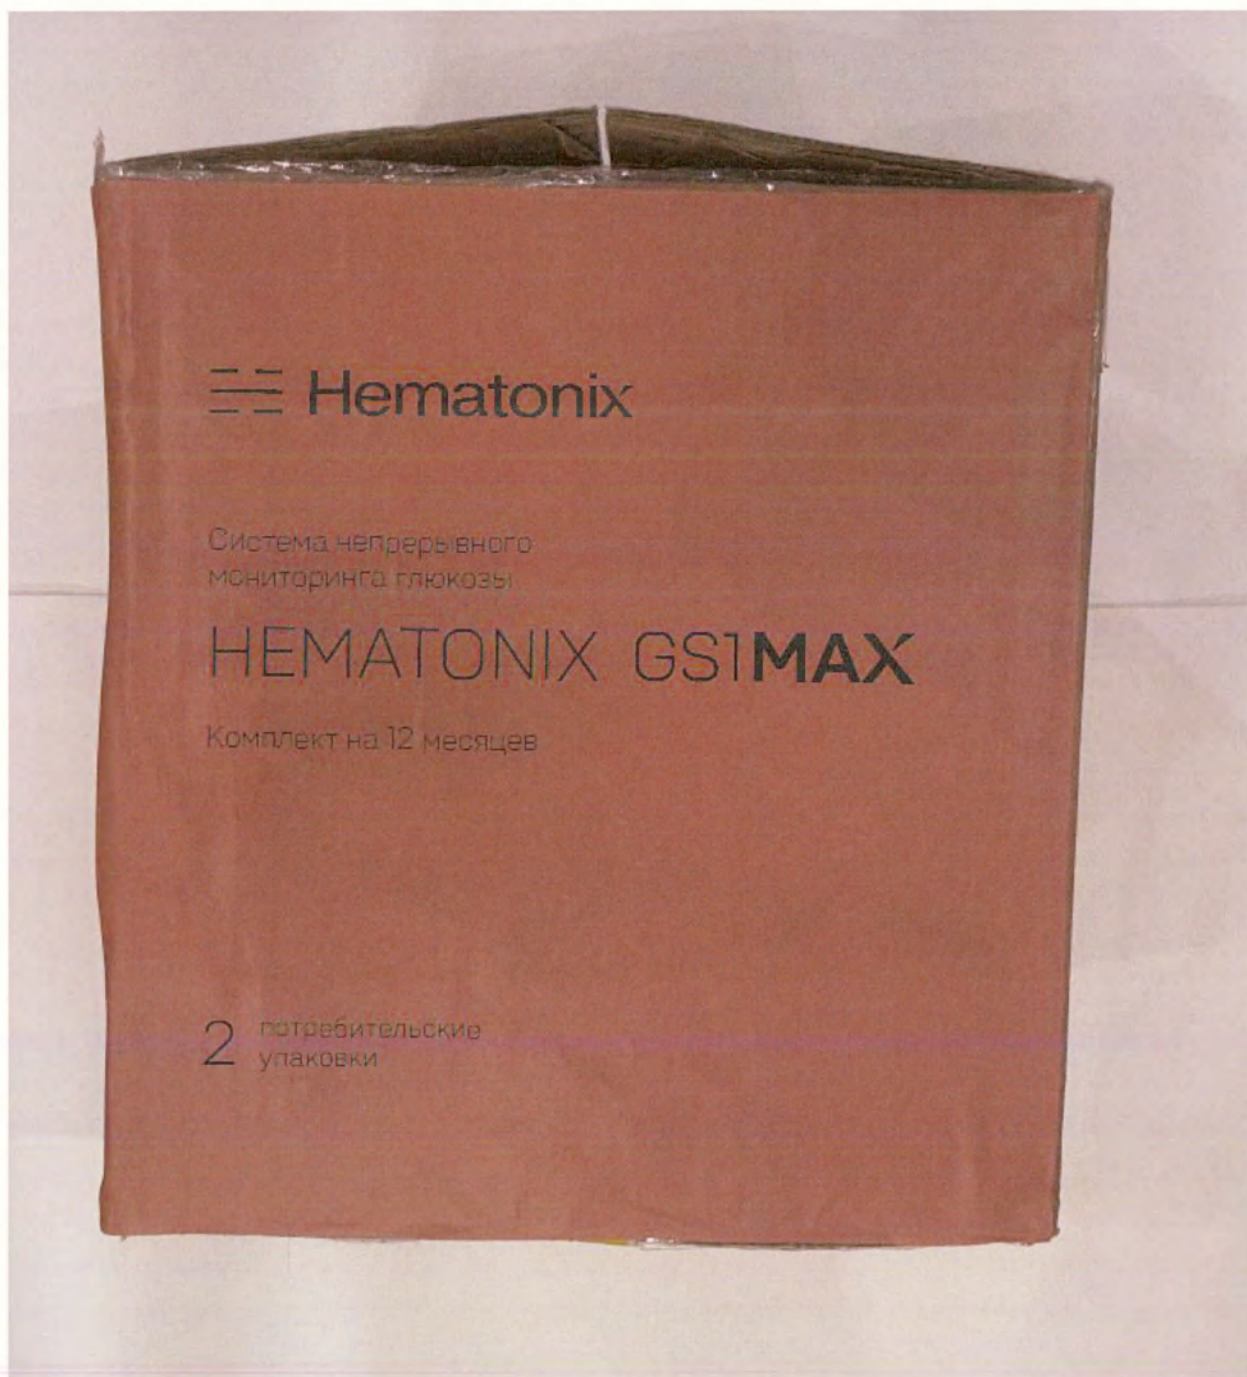

Общий вид транспортной упаковки изделия
Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max, комплект на 12 месяцев

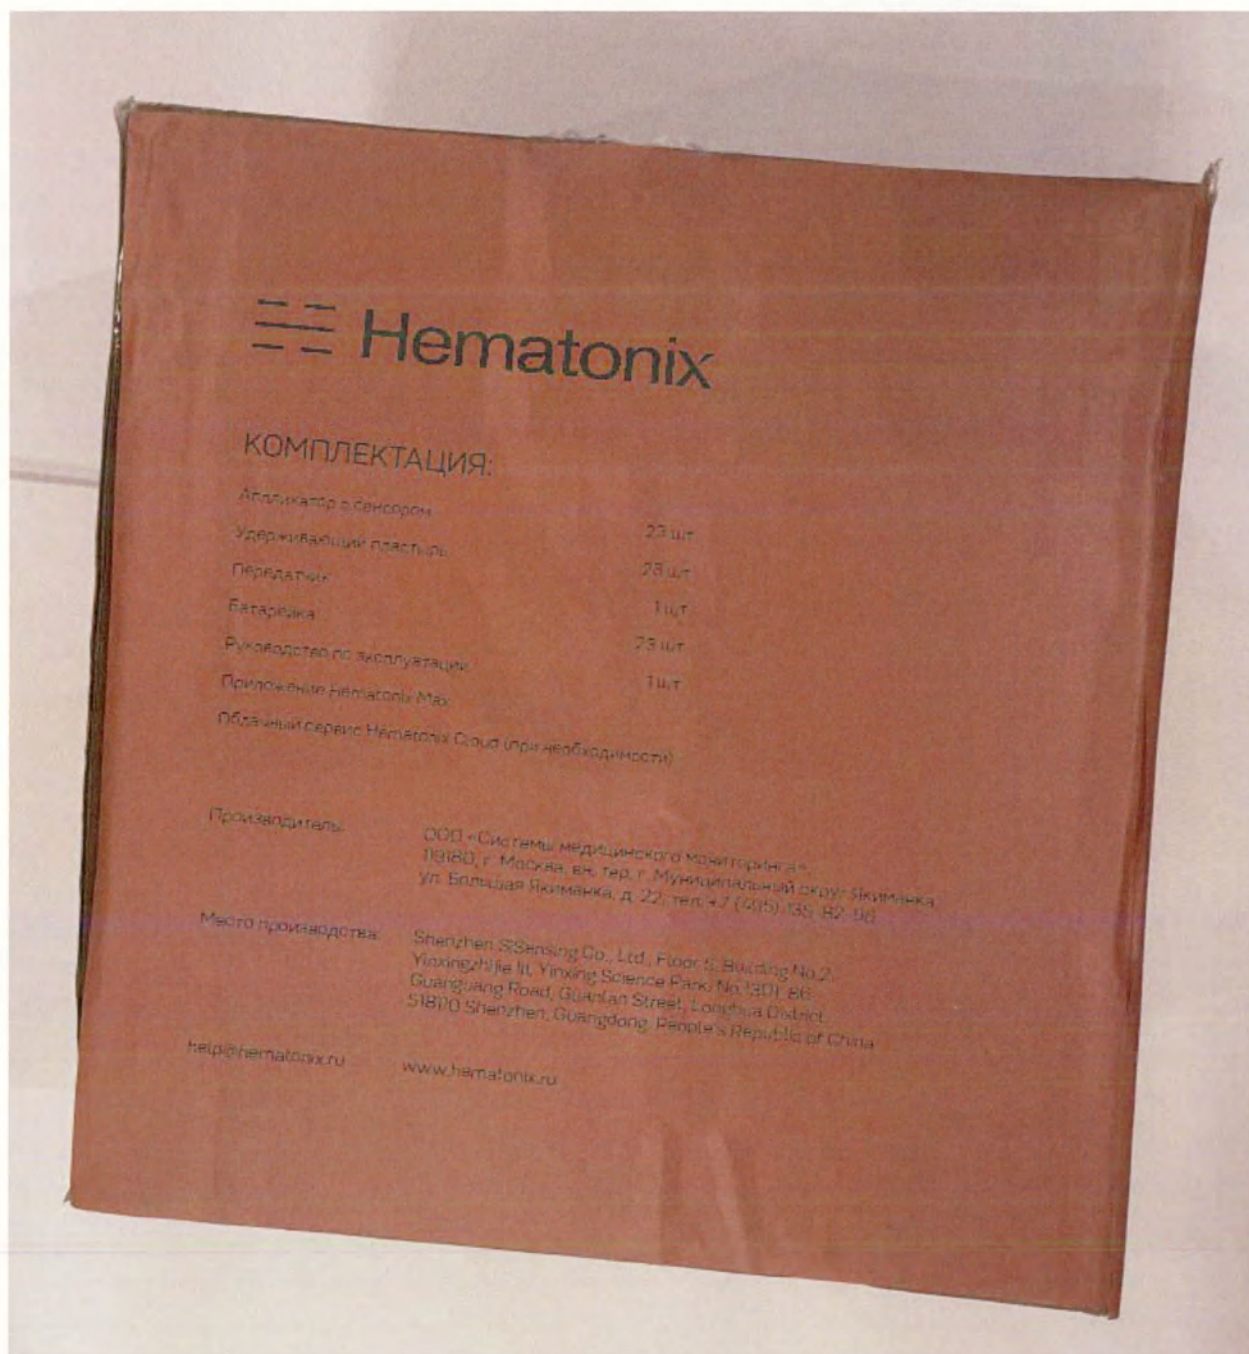

Общий вид интерфейса облачного сервиса

Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max



Общий вид интерфейса приложения

Система непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS1 Max

21:26 18

📶 12 %

Подключить Hematonix позже

Следуйте инструкциям, чтобы подключить ваше устройство.

Для начала использования двухкомпонентного СНМГ Hematonix, вам необходимо иметь:

Описание всех частей двухкомпонентной версии СНМГ Hematonix



Передатчик подключен

Код передатчика

P224106JVN

Время подключения передатчика:

24-02-2025 21:14

Заменить передатчик



Сенсор подключен

Код сенсора:

ZM6KT1YJK7NK6T

Заменить передатчик

Активировать устройство.

Нажмите, чтобы подключиться к предыдущему устройству.



21:29 18

Подключить Hematonix позже

Следуйте инструкциям, чтобы подключить ваше устройство.

Для начала использования двухкомпонентного СНМГ Hematonix, вам необходимо



Активация прошла успешно

Не отключайте передатчик от сенсора во время использования! Снятие передатчика приводит к сбоям в работе сенсора.

Понял

Сенсор подключен

Код сенсора:


Заменить передатчик

Активировать устройство.

Нажмите, чтобы подключиться к предыдущему устройству.

21:29 18

🔇 📶 11 %

 HematonixMAX



 P224106JVN подключен.



Подготовка сенсора...

59 МИН

Сегодняшний TIR в пределах целевого
уровня глюкозы.

3 ч

6 ч

12 ч

24 ч

ммоль/л

15

12

9

6

3

0
19:00

20:00

21:00

22:00

7.8

3.9


Главная


Анализ




Запись


Кабинет

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 74 листа(ов).

Генеральный директор
ООО «Системы медицинского мониторинга»
/ Глушков И.А.

