

Юридический адрес: РФ, 105005, г.Москва,  
ул.Бауманская, д.7, стр.1, помещение I, комн.18  
Фактический адрес: 117393, г. Москва, ул.  
Архитектора Власова, д. 33

Почтовый адрес: 117393, Россия, Москва, а/я 285  
Тел. (495) 258-83-05/-06/-07 Факс (495) 958-29-40  
Интернет: [www.avrora-serv.ru](http://www.avrora-serv.ru)  
Электронная почта: [service@avrora-lab.com](mailto:service@avrora-lab.com)

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО «Аврора Сервис»

В. В. Коновалов

02 2025 г.



## Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для хроматографического определения  
гликированного гемоглобина HbA1c.

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в вариантах исполнения: на 800 тестов, на 3000 тестов.

Набор реагентов для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c).

Изделие выпускается в вариантах исполнения:

1) Набор реагентов на 800 тестов, в составе:

- Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 2 флакона по 1800 мл;
- Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1400 мл;
- Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolyser), 4 флакона по 1800 мл;
- Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC)), 1 шт;
- Фильтры, 2 шт;
- Термочувствительная бумага - 6 рулонов;
- Емкости для образцов - 100 шт..
- Инструкция по применению, 1 шт.

2) Набор реагентов на 3000 тестов, в составе:

- 3 упаковки реагентов в составе (каждая):
  - Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл;
  - Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл;
  - Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл;
  - Термочувствительная бумага - 6 рулонов;
- Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolyser), 5 флаконов по 2000 мл;
- Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC)), 1 шт;
- Фильтры, 6 шт;
- Инструкция по применению, 1 шт.


APPROVED BY

王友翔

王友翔(Wang Youxiang)

Deputy General Manager.

Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd.



INSTRUCTION FOR USE OF IVD MEDICAL DEVICE

HbA1c Assay kit

Reagents for chromatographic determination  
of Glycated Hemoglobin (HbA1c)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ IVD

Набор реагентов для хроматографического определения  
гликированного гемоглобина (HbA1c)

Версия № 4 от 08 февраля 2025 г

Производитель

Шанхай Медконн Биотехнологджи Ко., Лтд. / Shanghai  
Medconn Biotechnology Co., Ltd.

The 3rd and 4th Floor of Building 2

The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3

No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town

Jinshan District

201508 Shanghai

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ООО «Аврора Сервис»

105005, г. Москва, Бауманская ул.,

дом №7, строение 1, помещение I, комната 18

+7 (495) 258-83-05

service@avrore-lab.com


Уполномоченный  
представитель




400  
DURABLE  
2573  
GERMANY


Инструкция (набор на 800 тестов, набор на 3000 тестов - общая)



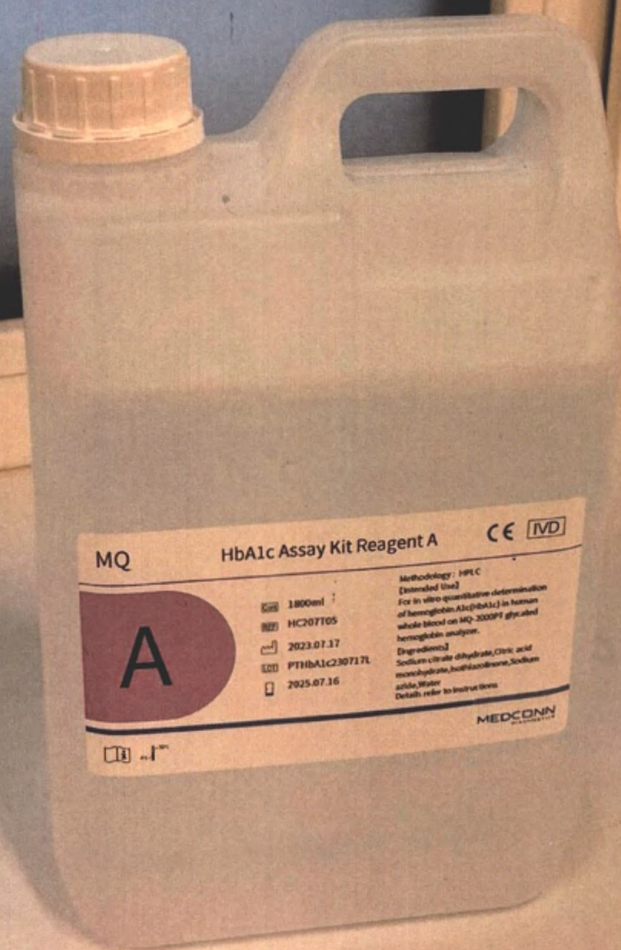



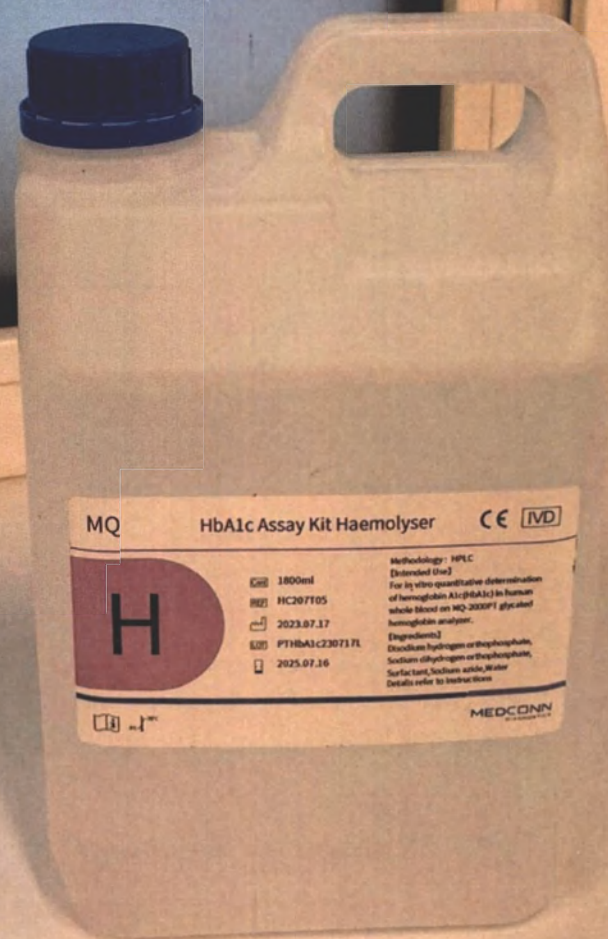

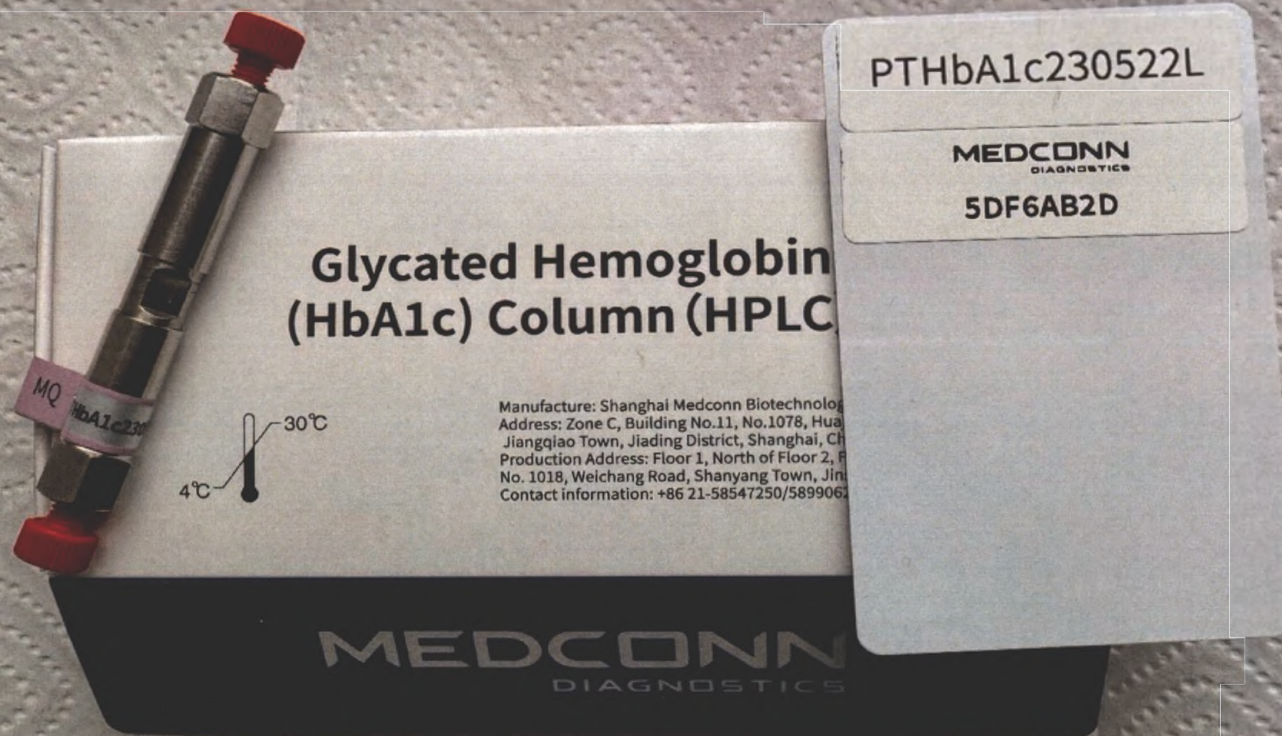

PTNbA1c2401080

MEDCONN

4D99EFEA

2000PT FILTER

(Only for MQ-2000PT)

2 Pcs/Pac

LOT: 2023102301

EXP: 2028.03.16

Shanghai Medconn  
Medical Technology  
Co., Ltd

No. 1018 Weichang Road,  
Shanyang Town, Jinshan  
District, Shanghai, China

蛋白层析柱套件  
液相色谱法)

【生产许可证】沪药监械生产许20120954号

【注册证/技术备案编号】沪械注准20202720259

其他内容详见说明书

住所：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢

1层、4层、5层、2层、4层

电话：+86-21-58547250/58990629

生产地址：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号3幢

一层、二层、三层、四层 邮编：201508

注册人/生产企业：上海惠中生物科技有限公司

（有效期至2028年3月16日）

（请妥善保管，不可丢失）

柱号：799



Емкости для образцов. Набор на 800 тестов



MEDCONN  
DIAGNOSTICS

## DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

MQ

CE IVD

### Glycated Hemoglobin (HbA1c) Assay Kit

Cont: 800 Tests

REF: HC207T05

Methodology: HPLC

Reagent A 2×1800ml

2023.05.22

Production License: SFDA Production Permit No. 20120954

Reagent B 1×1400ml

LOT: PTHbA1c230522L

Medical Device Registration Certificate No./ Product Technical Requirement No.: HD22

Haemolysers 4×1800ml

2025.05.21

No. 20162400156

Details refer to instructions

Made in China



Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd.  
Floor 3, North of Floor 2, Floor 4, Building 3, No. 1018, Weichang Road,  
Shanyang Town, Jinshan District, Shanghai, China



Lotus NL B.V.  
Kortrijkse Julianaplein 10, 1e verd., 2015AA, The Hague,  
Netherlands  
Email: peter@lotusnl.com

MEDCONN  
DIAGNOSTICS

Service hotline: +86 400-000-8312

www.medconn.com

## **Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)**

**Вариант исполнения на 800 тестов**

**Состав:** Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 2 флакона по 1800 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1400 мл; Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolyser), 4 флакона по 1800 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC)), 1 шт; Фильтры, 2 шт; Емкости для образцов, 100 шт; Термочувствительная бумага, 6 рулонов; Инструкция по применению, 1 шт.

**Только для диагностики in vitro**

**Только для лабораторного применения**

**НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ**

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

**РУ №** \_\_\_\_\_ **от** XX.XX.XXXX

**Производитель:** Шанхай Медконн Биотекнолоджи Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

**Уполномоченный представитель:** ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение I, комната 18 +7 (495) 258-83-05 [service@avroralab.com](mailto:service@avroralab.com)

**ИНФОРМАЦИЮ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ**

Набор реагентов на 800 тестов. Потребительская упаковка

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
Вариант исполнения на 800 тестов

Состав: Reagent A (HbA1c Assay Kit Reagent A), 2 флакона по 1800 мл; Reagent B (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1400 мл; Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolyser), 4 флакона по 1800 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC), 1 шт; Фильтры, 2 шт; Емкости для образцов, 100 шт; Термочувствительная бумага, 6 рулонов; Инструкция по применению, 1 шт.

Только для диагностики *in vitro*

Только для лабораторного применения

**НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ**

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

РУ № \_\_\_\_\_ от XX.XX.XXXX

Производитель: Шанхай Медконн Биотекнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)


Уполномоченный представитель: ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение I, комната 18 +7 (495) 258-83-05 [service@avroralab.com](mailto:service@avroralab.com)

**ИНФОРМАЦИЮ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ**

DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

MQ

Glycated Hemoglobin (HbA1c) Assay Kit



上海惠中生物科技有  
Glycated Hemoglo

[c] Assay Kit



(01)069544183036

沪械主准2016240015

械生产许20120954号

MQ

## Glycated Hemoglobin (HbA1c) Assay K

Cont 900 Tests

REF HC207T05

Reagent A 2×1800ml

2023.04.03

Reagent B 1×1400ml

LOT PTHbA1c230403J

Haemolyser 4×1800ml

2025.04.02

Methodology HPLC

Production License: SFDA  
No. 20120954

Medical Device Registration  
Product Technical Require  
No. 20162400156

Details refer to instructions

ermit

No. /  
72

de in China



4°C - 30°C



Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd.  
Floor 1, North of Floor 2, Floor 4, Building 3, No. 1018, W  
Shanyang Town, Jinshan District, Shanghai, China

Lotus NL B.V.



Koningin Julianaplein 10, 1e Vord, 2595AA The Hague,  
Netherlands

Email: peter@lotusnl.com

Service hotline: +86 400-000-8312

CONN  
DIAGNOSTICS

Набор реагентов для хроматографического определения гликированного  
гемоглобина (HbA1c).

Набор на 800 тестов

Производитель: Шанхай Медконн Биотехнологджи Ко., Лтд. / Shanghai Medconn  
Biotechnology Co., Ltd., Китай

Уполномоченный представитель: ООО «Аврора Сервис», Россия

Номер лота, дата производства, срок годности указаны на упаковке.

Набор реагентов на 800 тестов. Транспортировочная упаковка






# DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION


Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
 Вариант исполнения на 3000 тестов (место 1 из 4)  
 Состав: 3 упаковки в составе (наборы): Reagent A (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Reagent B (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Reagent C (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термочувствительная бумага, 6 рулонов; 1 упаковка в составе: Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolyser), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC)), 1 шт; Фильтры, 6 шт; Инструкция по применению, 1 шт.  
 Только для диагностики in vitro  
 Только для лабораторного применения  
 НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ  
 Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке  
 RU № \_\_\_\_\_ от XX.XX.XXXX  
 Производитель: Шанхай Медконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)  
 Уполномоченный представитель: ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №67, строение 1, помещение I, комната 18 +7 (495) 258-83-05 [service@avroga-lab.com](mailto:service@avroga-lab.com)  
 ИНФОРМАЦИЮ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ

[www.medconn.com](http://www.medconn.com)



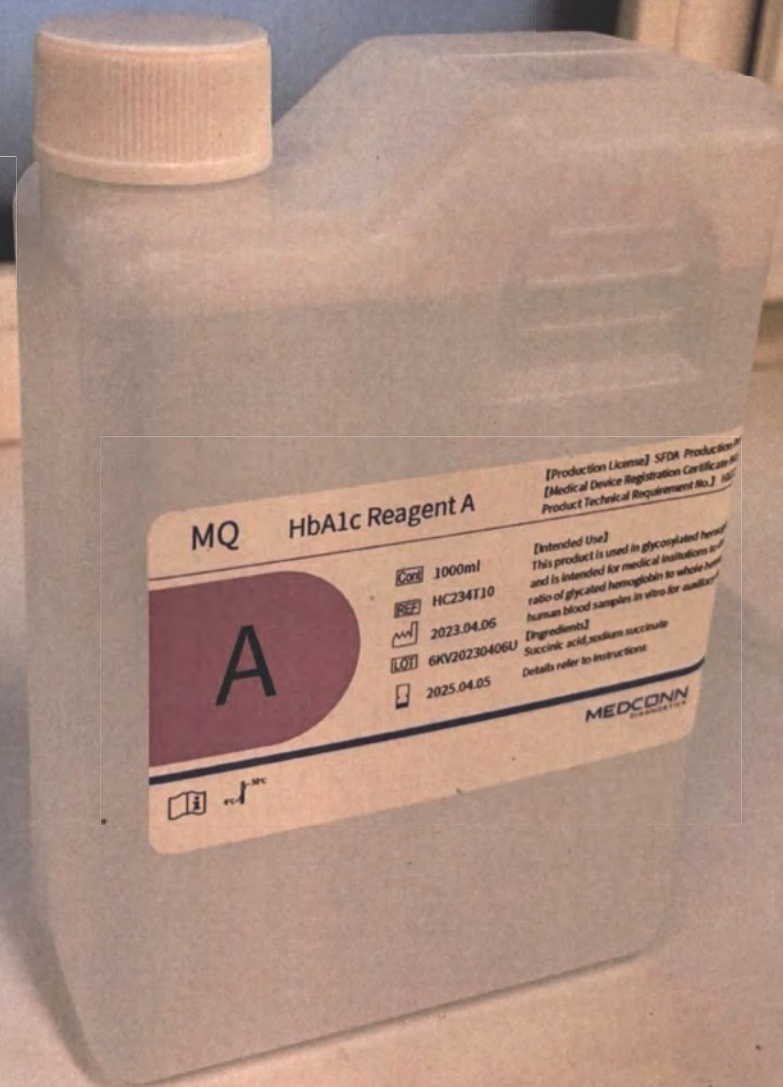



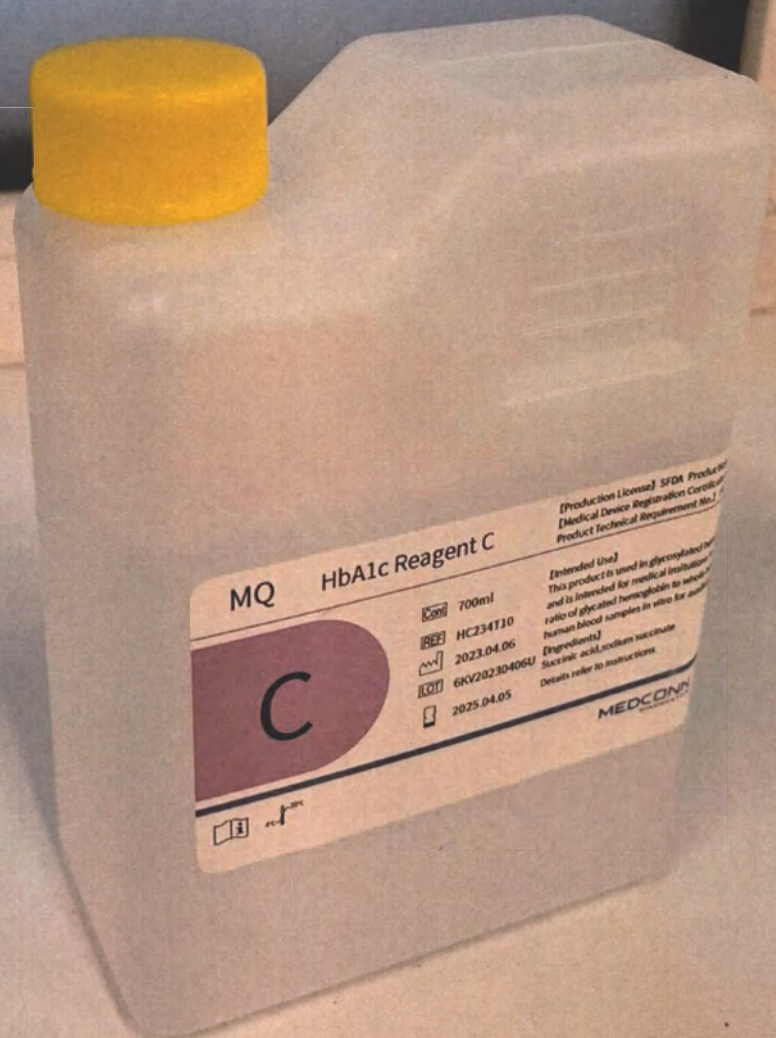

**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

MQ

CE IVD

### HbA1c Assay Kit (HPLC)

**Cont** 1000 Tests

**REF** HC234T10

Methodology: HPLC

**[Package]**

**EXP** 2023.12.11

Production License: SDA Production Permit No.  
20120954

HbA1c Reagent A 3×1000ml

**LOT** 6KV20231211K

Medical Device Registration Certificate No./

HbA1c Reagent B 1×1000ml

Product Technical Requirement No.: HXZZ No.

HbA1c Reagent C 1×700ml

**EXP** 2025.12.10

20212400303

Details refer to instructions

Made in China



4°C -30°C

Service hotline: +86 400-000-8312




Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd.  
Floor 1, North of Floor 2, Floor 4, Building 3, No. 1018, Weichang Road,  
Shanyang Town, Jinshan District, Shanghai, China



Lotus NL B.V.  
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague,  
Netherlands.  
Email: peter@lotusnl.com

**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

[www.medconn.com](http://www.medconn.com)

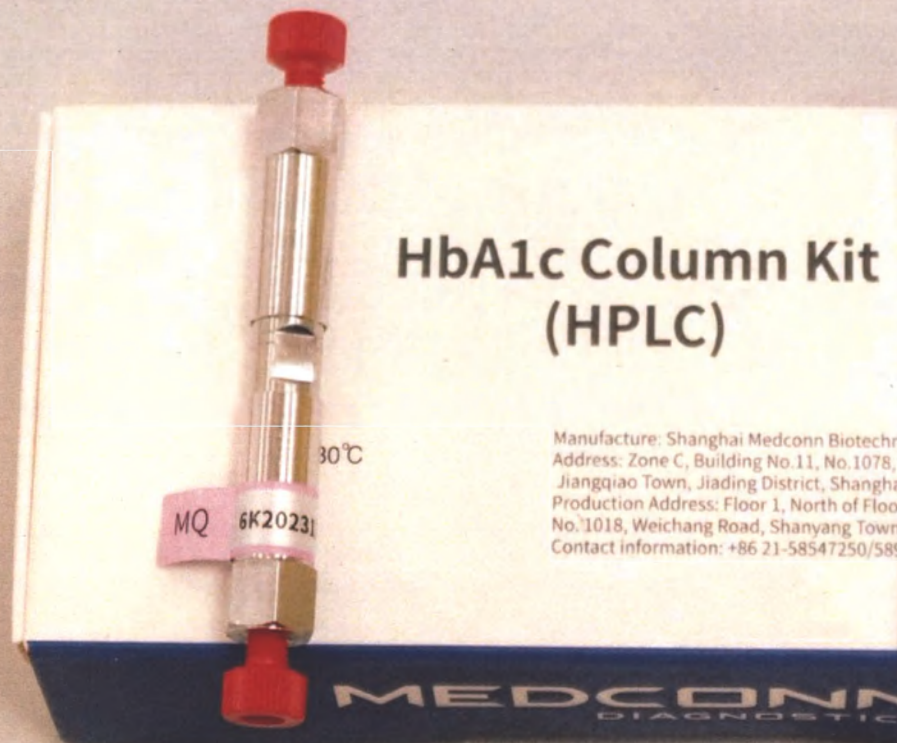

6K20231211K

MEDCONN  
DIAGNOSTICS

C3382F63

Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC)). Набор 3000 тестов

Code: 12041686

MQ-6000 FILTER

6 Pcs/Pac

LOT: 2023111001


EXP: 2028.11.08

## MQ-6000过滤器

(12041686)

[LOT] 2023111001 [Cont] 6 个

液流方向 →

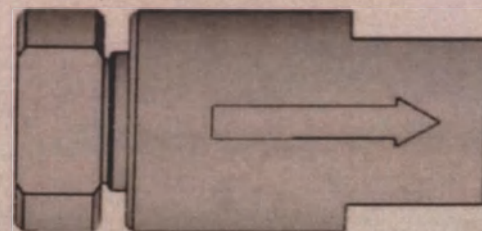

上海惠中医疗科技有限公司  
中国上海市金山区山阳镇卫昌路1018号

电话: +86-21-31653268  
传真: +86-21-50316450



**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

#### DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
Вариант исполнения на 3000 тестов (место 4 из 4)

Состав: 3 упаковки в составе (каждая): Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термостойкая бумага, 6 рулонов; 1 упаковка в составе: Гемоллизер (HbA1c Assay Kit Hemolysate), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC), 1 шт; Фильтры, 6 шт; Инструкция по применению, 1 шт.

Только для диагностики *in vitro*

Только для лабораторного применения

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

RU № \_\_\_\_\_ от XX.XX.XXXX

Производитель: Шанхай Медконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Уполномоченный представитель: ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение 1, комната 18 +7 (495) 258-83-05 [service@avros.ru](mailto:service@avros.ru)

ИНФОРМАЦИЮ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ

**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

#### DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
Вариант исполнения на 3000 тестов (место 3 из 4)

Состав: 3 упаковки в составе (каждая): Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термостойкая бумага, 6 рулонов; 1 упаковка в составе: Гемоллизер (HbA1c Assay Kit Hemolysate), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC), 1 шт; Фильтры, 6 шт; Инструкция по применению, 1 шт.

Только для диагностики *in vitro*

Только для лабораторного применения

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

RU № \_\_\_\_\_ от XX.XX.XXXX

Производитель: Шанхай Медконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Уполномоченный представитель: ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение 1, комната 18 +7 (495) 258-83-05 [service@avros.ru](mailto:service@avros.ru)

ИНФОРМАЦИЮ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ

**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

#### DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
Вариант исполнения на 3000 тестов (место 2 из 4)

Состав: 3 упаковки в составе (каждая): Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термостойкая бумага, 6 рулонов; 1 упаковка в составе: Гемоллизер (HbA1c Assay Kit Hemolysate), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC), 1 шт; Фильтры, 6 шт; Инструкция по применению, 1 шт.

Только для диагностики *in vitro*

Только для лабораторного применения

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

RU № \_\_\_\_\_ от XX.XX.XXXX

Производитель: Шанхай Медконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Уполномоченный представитель: ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение 1, комната 18 +7 (495) 258-83-05 [service@avros.ru](mailto:service@avros.ru)

ИНФОРМАЦИЮ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ

**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

#### DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
Вариант исполнения на 3000 тестов (место 1 из 4)

Состав: 3 упаковки в составе (каждая): Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термостойкая бумага, 6 рулонов; 1 упаковка в составе: Гемоллизер (HbA1c Assay Kit Hemolysate), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC), 1 шт; Фильтры, 6 шт; Инструкция по применению, 1 шт.

Только для диагностики *in vitro*

Только для лабораторного применения

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

RU № \_\_\_\_\_ от XX.XX.XXXX

Производитель: Шанхай Медконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Уполномоченный представитель: ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение 1, комната 18 +7 (495) 258-83-05 [service@avros.ru](mailto:service@avros.ru)

ИНФОРМАЦИЮ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ

[www.medconn.com](http://www.medconn.com)



**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

### DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
Вариант исполнения на 3000 тестов (место 4 из 4)

Состав: 3 упаковки в составе (каждая): Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термочувствительная бумага, бр/улонов, 1 упаковка в составе; Гемолитер (HbA1c Assay Kit Hemolyser), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC)), 1 шт.; Фильтры, 6 шт.; Инструкция по применению, 1 шт.

Только для лабораторного применения

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

RU №

Производитель: Шанхай Медиконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Mediconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Уполномоченный представитель: ООО «Аспора Сервис» 105005, г. Москва, Барыская ул., дом №7, строение 1, помещение 1, комната 18 +7 (495) 258-83-05 [info@aspora.ru](mailto:info@aspora.ru)

ИНФОРМАЦИЯ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ

**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

### DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
Вариант исполнения на 3000 тестов (место 3 из 4)

Состав: 3 упаковки в составе (каждая): Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термочувствительная бумага, бр/улонов, 1 упаковка в составе; Гемолитер (HbA1c Assay Kit Hemolyser), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC)), 1 шт.; Фильтры, 6 шт.; Инструкция по применению, 1 шт.

Только для лабораторного применения

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

RU №

Производитель: Шанхай Медиконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Mediconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Уполномоченный представитель: ООО «Аспора Сервис» 105005, г. Москва, Барыская ул., дом №7, строение 1, помещение 1, комната 18 +7 (495) 258-83-05 [info@aspora.ru](mailto:info@aspora.ru)

ИНФОРМАЦИЯ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ

**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

### DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
Вариант исполнения на 3000 тестов (место 2 из 4)

Состав: 3 упаковки в составе (каждая): Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термочувствительная бумага, бр/улонов, 1 упаковка в составе; Гемолитер (HbA1c Assay Kit Hemolyser), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC)), 1 шт.; Фильтры, 6 шт.; Инструкция по применению, 1 шт.

Только для лабораторного применения

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

RU №

Производитель: Шанхай Медиконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Mediconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Уполномоченный представитель: ООО «Аспора Сервис» 105005, г. Москва, Барыская ул., дом №7, строение 1, помещение 1, комната 18 +7 (495) 258-83-05 [info@aspora.ru](mailto:info@aspora.ru)

RU №

ИНФОРМАЦИЯ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ

### DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
Вариант исполнения на 3000 тестов (место 1 из 4)

Состав: 3 упаковки в составе (каждая): Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термочувствительная бумага, бр/улонов, 1 упаковка в составе; Гемолитер (HbA1c Assay Kit Hemolyser), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC)), 1 шт.; Фильтры, 6 шт.; Инструкция по применению, 1 шт.

Только для лабораторного применения

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

RU №

Производитель: Шанхай Медиконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Mediconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Уполномоченный представитель: ООО «Аспора Сервис» 105005, г. Москва, Барыская ул., дом №7, строение 1, помещение 1, комната 18 +7 (495) 258-83-05 [info@aspora.ru](mailto:info@aspora.ru)

RU №

ИНФОРМАЦИЯ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ

[www.medconn.com.cn](http://www.medconn.com.cn)



**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

# DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
Вариант исполнения на 3000 тестов (место 4 из 4)

Состав: 3 упаковки в составе (каждая): Reagent A (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Reagent B (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Reagent C (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термочувствительная бумага, 6 рулонов; 1 упаковка в составе: Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolysate), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC)), 1 шт; Фильтры, 6 шт; Инструкция по применению, 1 шт.

Только для диагностики in vitro

Только для лабораторного применения

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

RU № \_\_\_\_\_ от XX.XX.XXXX

Производитель: Шанхай Медконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Уполномоченный представитель: ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение 1, комната 18 +7 (495) 258-89-05 [sales@avroservice.ru](mailto:sales@avroservice.ru)

ИНФОРМАЦИЯ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ

**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

# DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
Вариант исполнения на 3000 тестов (место 3 из 4)

Состав: 3 упаковки в составе (каждая): Reagent A (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Reagent B (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Reagent C (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термочувствительная бумага, 6 рулонов; 1 упаковка в составе: Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolysate), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC)), 1 шт; Фильтры, 6 шт; Инструкция по применению, 1 шт.

Только для диагностики in vitro

Только для лабораторного применения

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

RU № \_\_\_\_\_ от XX.XX.XXXX

Производитель: Шанхай Медконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Уполномоченный представитель: ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение 1, комната 18 +7 (495) 258-89-05 [sales@avroservice.ru](mailto:sales@avroservice.ru)

ИНФОРМАЦИЯ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ

**MEDCONN**  
DIAGNOSTICS

# DIAGNOSTICS FOR MEDICAL CONNECTION

Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)  
Вариант исполнения на 3000 тестов (место 2 из 4)

Состав: 3 упаковки в составе (каждая): Reagent A (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Reagent B (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Reagent C (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термочувствительная бумага, 6 рулонов; 1 упаковка в составе: Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolysate), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC)), 1 шт; Фильтры, 6 шт; Инструкция по применению, 1 шт.

Только для диагностики in vitro

Только для лабораторного применения

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

RU № \_\_\_\_\_ от XX.XX.XXXX

Производитель: Шанхай Медконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Уполномоченный представитель: ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение 1, комната 18 +7 (495) 258-89-05 [sales@avroservice.ru](mailto:sales@avroservice.ru)

ИНФОРМАЦИЯ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ

MQ

## 糖化血红蛋白A

Cont 1000 测试/盒

REF

【包装规格】

糖化血红蛋白试剂A 3×1000ml

糖化血红蛋白试剂B 1×1000ml

糖化血红蛋白试剂C 1×700ml

LOT

11211K

10



4°C - 30°C

服务热线: 400-000-8312

2

住 址: 上海市金山区山阳镇卫康路1018号2幢3层、4层、3幢1层、2层、4层  
电 话: +86-21-58547250/58990629  
生 产 地 址: 上海市金山区卫康路1018号3幢一层、二、三层、四、五层 邮 编: 201508

上海惠中生物技术有限公司

SHANGHAI MEDCONN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

MEDCONN  
DIAGNOSTICS

CE IVD

## 试剂盒 (高效液相色谱法)

方法学: 高效液相色谱法

【生产许可证】沪药监械生产许20120954号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

沪械注准20212400303

其他内容详见说明书

配套溶血剂批号: 20231211K

配套层析柱批号: 6K20231211K

MQ

## HbA1c Assay Kit (HPLC)

Cont 1000 Tests

REF HC234T10

【Package】

2023.12.11

HbA1c Reagent A 3×1000ml

HbA1c Reagent B 1×1000ml

HbA1c Reagent C 1×700ml

LOT 6KV20231211K

2023.12.10

Methodology: HPLC

Production License  
20120954

Medical Device Reg.

Product Technical S  
20212400303

Details refer to instr



4°C - 30°C

Service hotline: +86 400-000-8312



Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd.  
Floor 1, North of Floor 2, Floor 4, Building 8, No.  
Shanyang Town, Jinshan District, Shanghai, Chi

Lokus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e verd, 2016SA, The N

Netherlands

Email: peter@lokus.nl

EC REP

EDCONN  
DIAGNOSTICS

CE IVD

ction Permit No.

tificate No./  
No.: 10ZZ No.

Made in China

Набор реагентов для хроматографического определения гликированного  
гемоглобина (HbA1c).

Набор на 3000 тестов

Производитель: Шанхай Медконн Биотекнологджи Ко., Лтд. / Shanghai Medconn  
Biotechnology Co., Ltd., Китай

Уполномоченный представитель: ООО «Аврора Сервис», Россия

Номер лота, дата производства, срок годности указаны на упаковке.

HbA1c Assay Kit (HPLC)



101104934418503447

沪械注准20212400303,沪药监械生产许20120954号

**Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)**

**Вариант исполнения на 800 тестов**

**Состав:** Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 2 флакона по 1800 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1400 мл; Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolyser), 4 флакона по 1800 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC), 1 шт; Фильтры, 2 шт; Емкости для образцов, 100 шт; Термочувствительная бумага, 6 рулонов; Инструкция по применению, 1 шт.

**Только для диагностики in vitro**

**Только для лабораторного применения**

**НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ**

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

**РУ №** \_\_\_\_\_ **от** XX.XX.XXXX

**Производитель:** Шанхай Медконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

**Уполномоченный представитель:** ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение I, комната 18

+7 (495) 258-83-05; [service@avrrora-lab.com](mailto:service@avrrora-lab.com)

**ИНФОРМАЦИЮ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ**

**Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)**

**Вариант исполнения на 3000 тестов (место 1 из 4)**

**Состав:** 3 упаковки в составе (каждая): Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термочувствительная бумага, 6 рулонов; 1 упаковка в составе: Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolyser), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC), 1 шт; Фильтры, 6 шт; Инструкция по применению, 1 шт.

**Только для диагностики in vitro**

**Только для лабораторного применения**

**НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ**

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

**РУ №** \_\_\_\_\_ **от** XX.XX.XXXX

**Производитель:** Шанхай Медконн Биотекнолоджи Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

**Уполномоченный представитель:** ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение I, комната 18

+7 (495) 258-83-05; [service@avrora-lab.com](mailto:service@avrora-lab.com)

**ИНФОРМАЦИЮ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ**

**Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)**

**Вариант исполнения на 3000 тестов (место 2 из 4)**

**Состав:** 3 упаковки в составе (каждая): Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термочувствительная бумага, 6 рулонов; 1 упаковка в составе: Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolyser), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC), 1 шт; Фильтры, 6 шт; Инструкция по применению, 1 шт.

**Только для диагностики in vitro**

**Только для лабораторного применения**

**НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ**

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

**РУ №** \_\_\_\_\_ **от** XX.XX.XXXX

**Производитель:** Шанхай Медконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

**Уполномоченный представитель:** ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение I, комната 18

+7 (495) 258-83-05; [service@avroa-lab.com](mailto:service@avroa-lab.com)

**ИНФОРМАЦИЮ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ**

**Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)**

**Вариант исполнения на 3000 тестов (место 3 из 4)**

**Состав:** 3 упаковки в составе (каждая): Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термочувствительная бумага, 6 рулонов; 1 упаковка в составе: Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolyser), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC), 1 шт; Фильтры, 6 шт; Инструкция по применению, 1 шт.

**Только для диагностики in vitro**

**Только для лабораторного применения**

**НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ**

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

**РУ №** \_\_\_\_\_ от XX.XX.XXXX

**Производитель:** Шанхай Медконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

**Уполномоченный представитель:** ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение I, комната 18

+7 (495) 258-83-05; [service@avrora-lab.com](mailto:service@avrora-lab.com)

**ИНФОРМАЦИЮ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ**

**Набор для хроматографического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)**

**Вариант исполнения на 3000 тестов (место 4 из 4)**

**Состав:** 3 упаковки в составе (каждая): Реагент А (HbA1c Assay Kit Reagent A), 3 флакона по 1000 мл; Реагент В (HbA1c Assay Kit Reagent B), 1 флакон, 1000 мл; Реагент С (HbA1c Assay Kit Reagent C), 1 флакон, 700 мл; термочувствительная бумага, 6 рулонов; 1 упаковка в составе: Гемолизер (HbA1c Assay Kit Haemolyser), 5 флаконов по 2000 мл; Хроматографическая колонка с идентификационной картой (Glycated Hemoglobin (HbA1c) Column (HPLC), 1 шт; Фильтры, 6 шт; Инструкция по применению, 1 шт.

**Только для диагностики in vitro**

**Только для лабораторного применения**

**НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ**

Код партии, срок годности, условия хранения, дата изготовления и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

**РУ №** \_\_\_\_\_ **от** XX.XX.XXXX

**Производитель:** Шанхай Медконн Биотехнологии Ко., Лтд. / Shanghai Medconn Biotechnology Co., Ltd. (The 3rd and 4th Floor of Building 2, The 1st, 2nd and 4th Floor of Building 3, No. 1018, Weichang Road, Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

**Уполномоченный представитель:** ООО «Аврора Сервис» 105005, г. Москва, Бауманская ул., дом №7, строение 1, помещение I, комната 18

+7 (495) 258-83-05; [service@avrora-lab.com](mailto:service@avrora-lab.com)

**ИНФОРМАЦИЮ НА СТИКЕРЕ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ**

Пронумеровано, скреплено, прошито 34 листов

Генеральный директор ООО «Аврора Сервис»

В. В. Коновалов

По доверенности от Shanghai Medconn Biotechnology Co. Ltd

№ 6/н от 19 октября 2024 года

