

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»



А.В. Шварёв

« 1 » 01 2025 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи и транспортировки серии V, в вариантах
исполнения: V1, V1D

2025

Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи и транспортировки V1. Блок аппарата искусственной вентиляции легких V1 (Общий вид).




Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи и транспортировки VID. Блок аппарата искусственной вентиляции легких VID (Общий вид).








Многоразовая силиконовая головная повязка для маски для взрослых

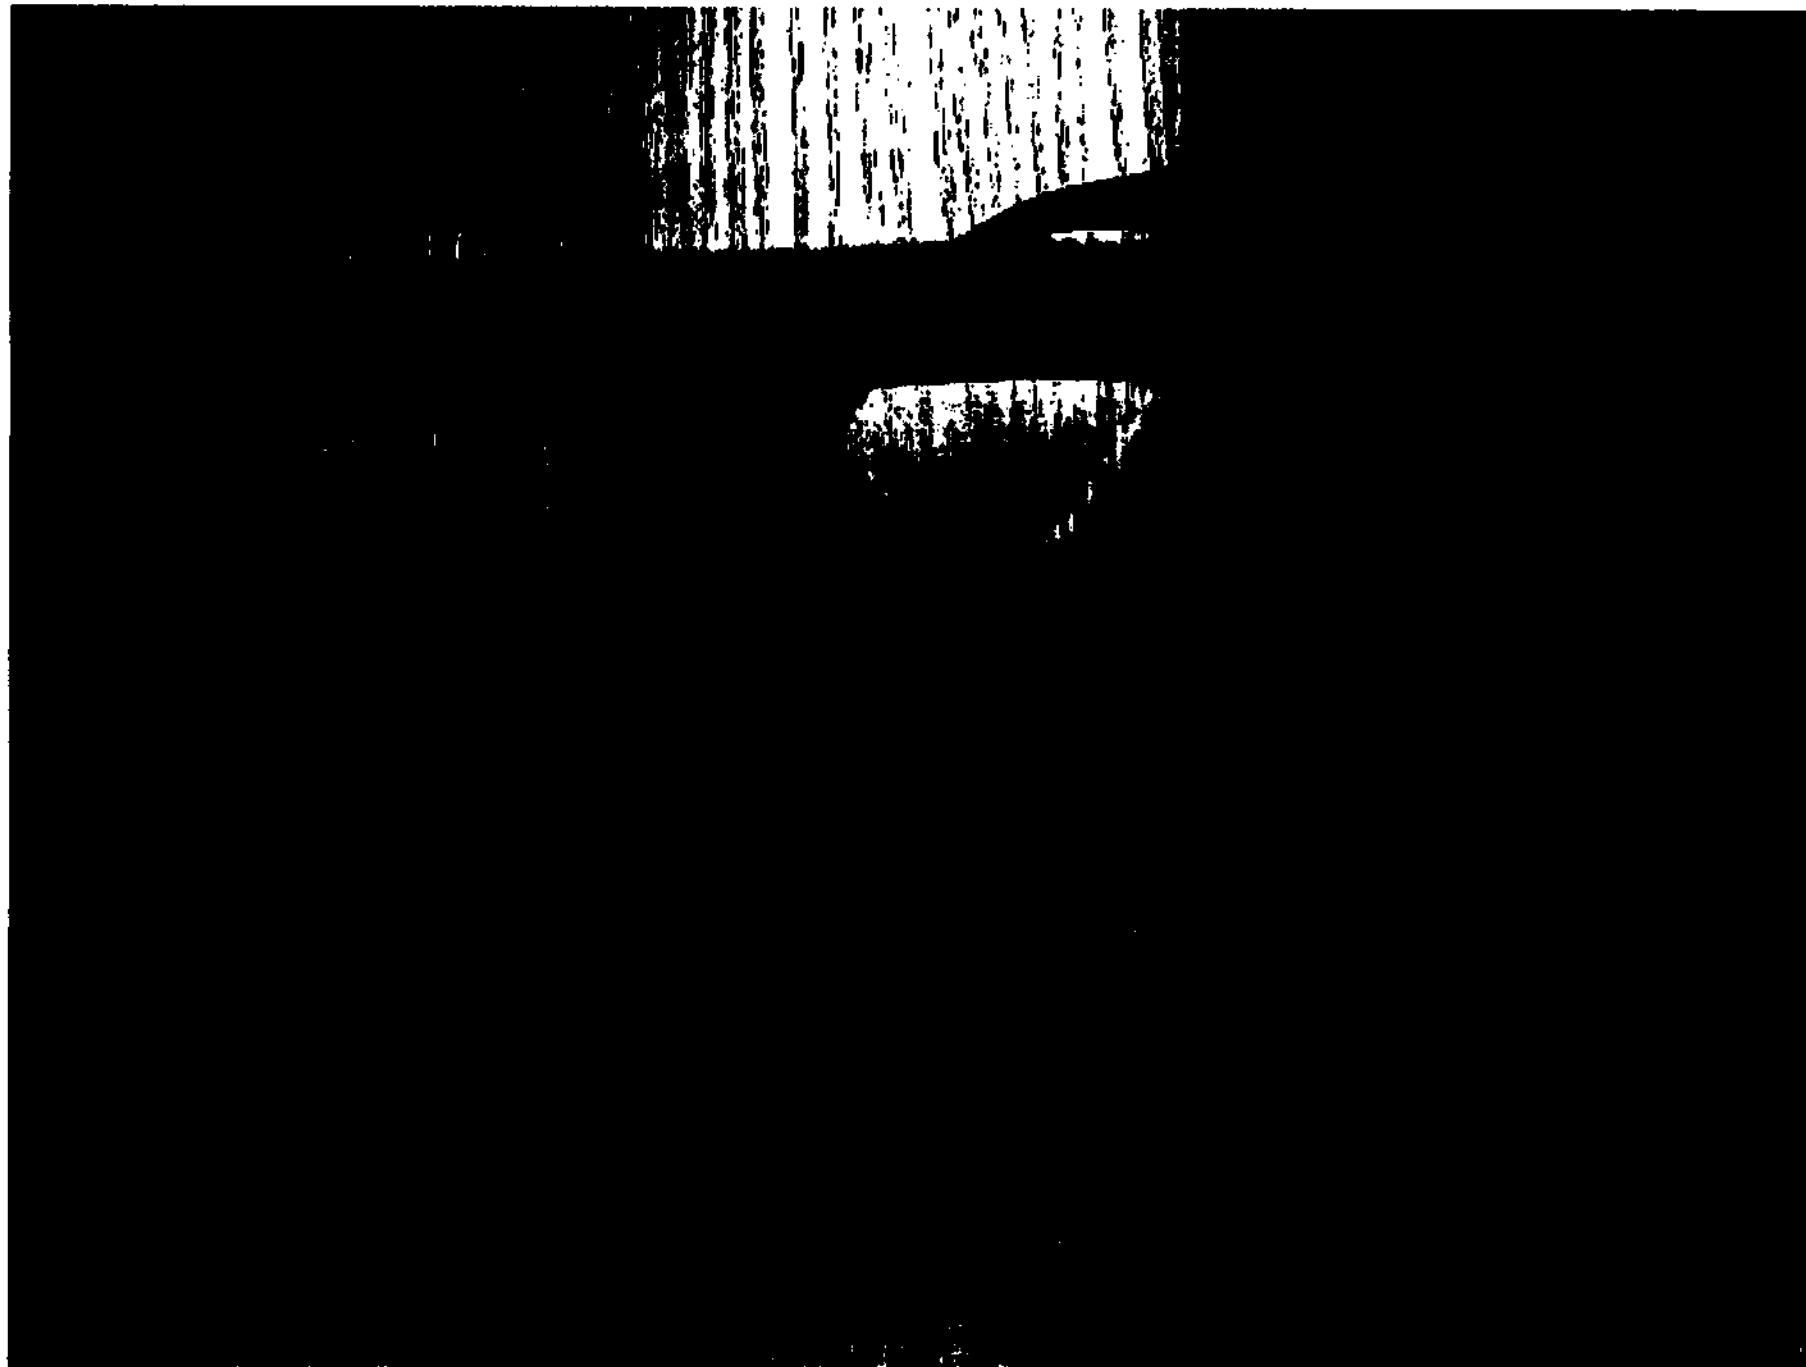

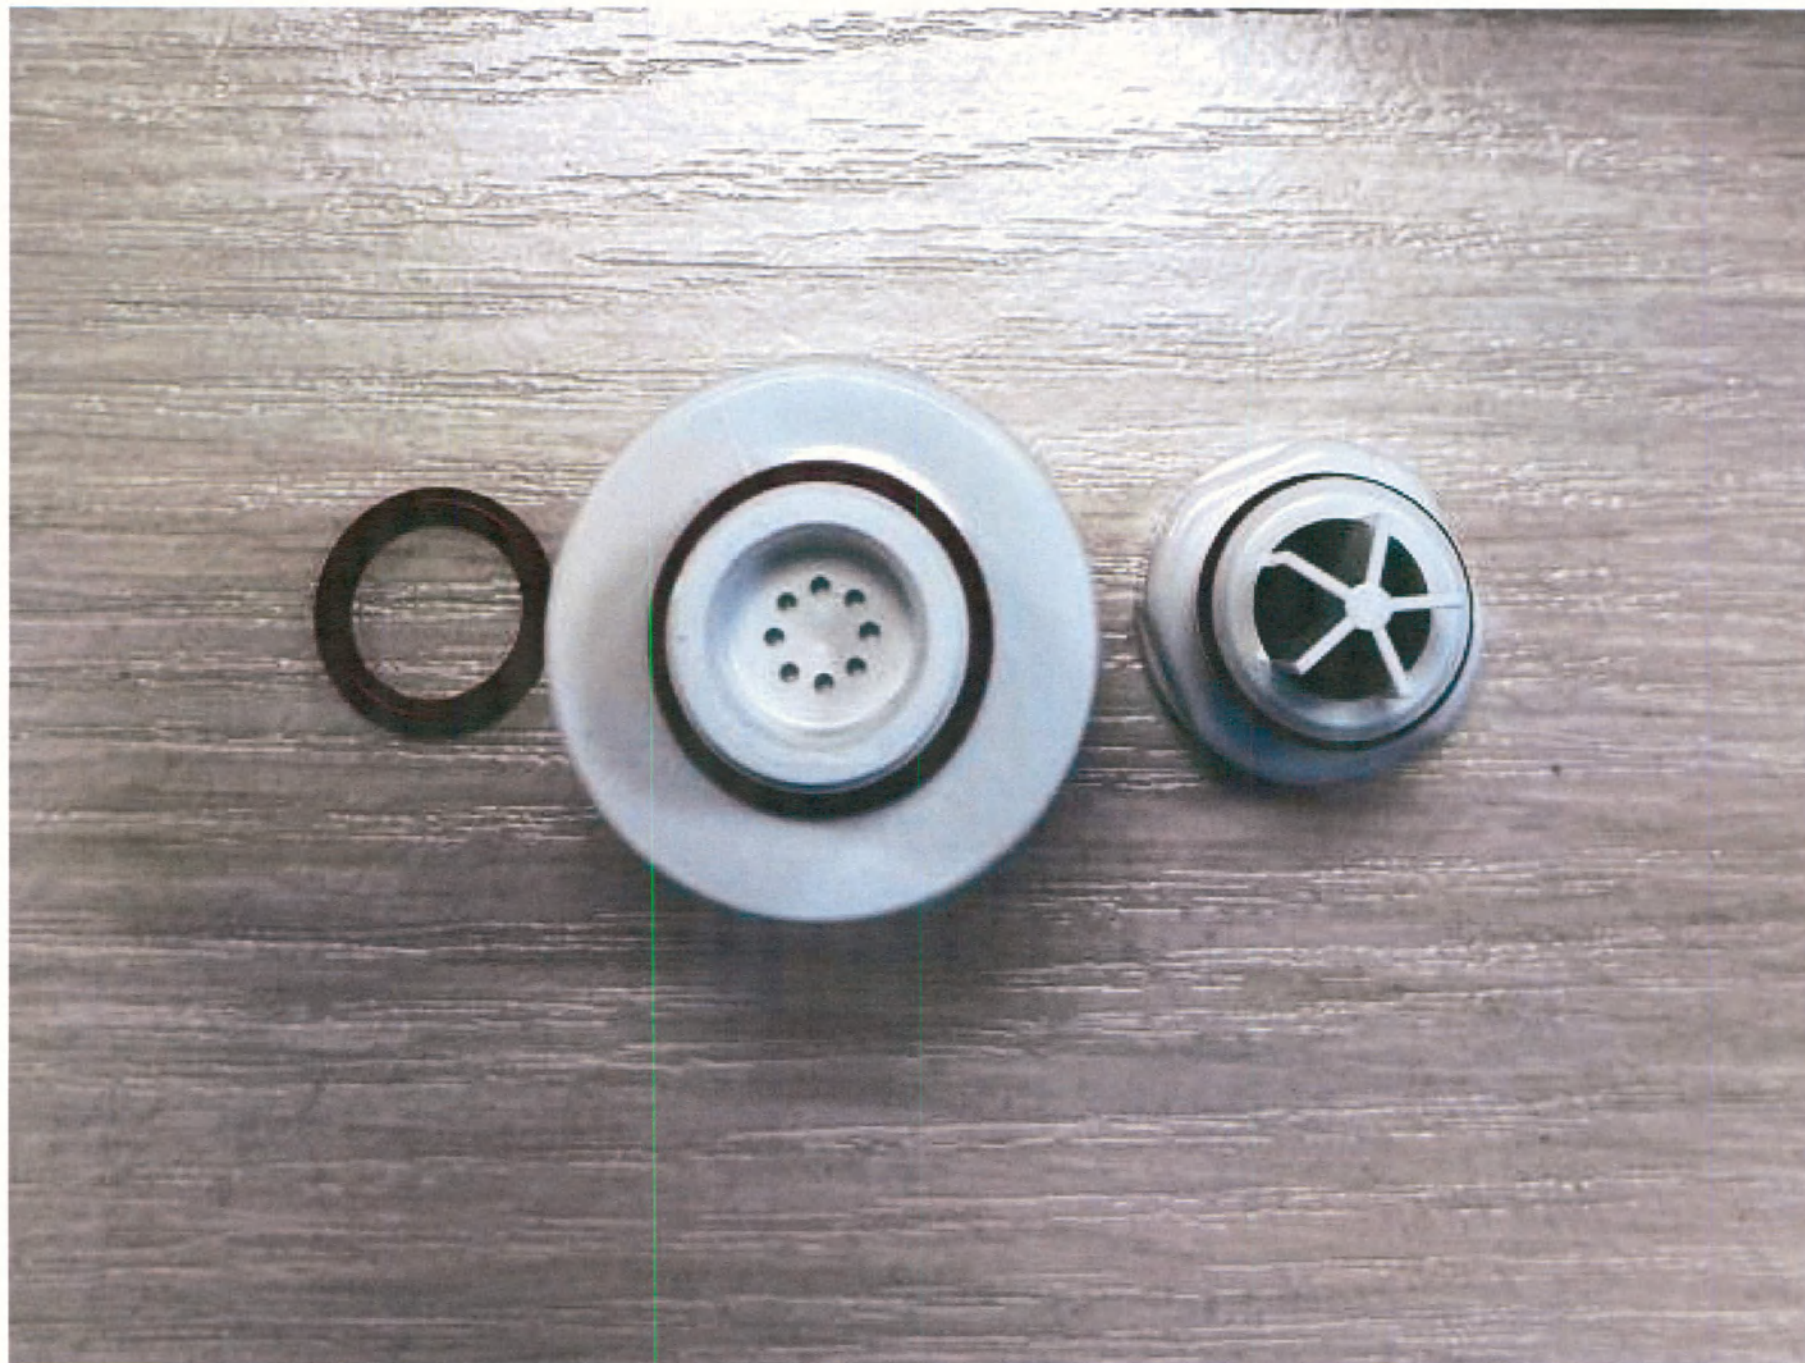










Хомут для шланга



Кабель питания

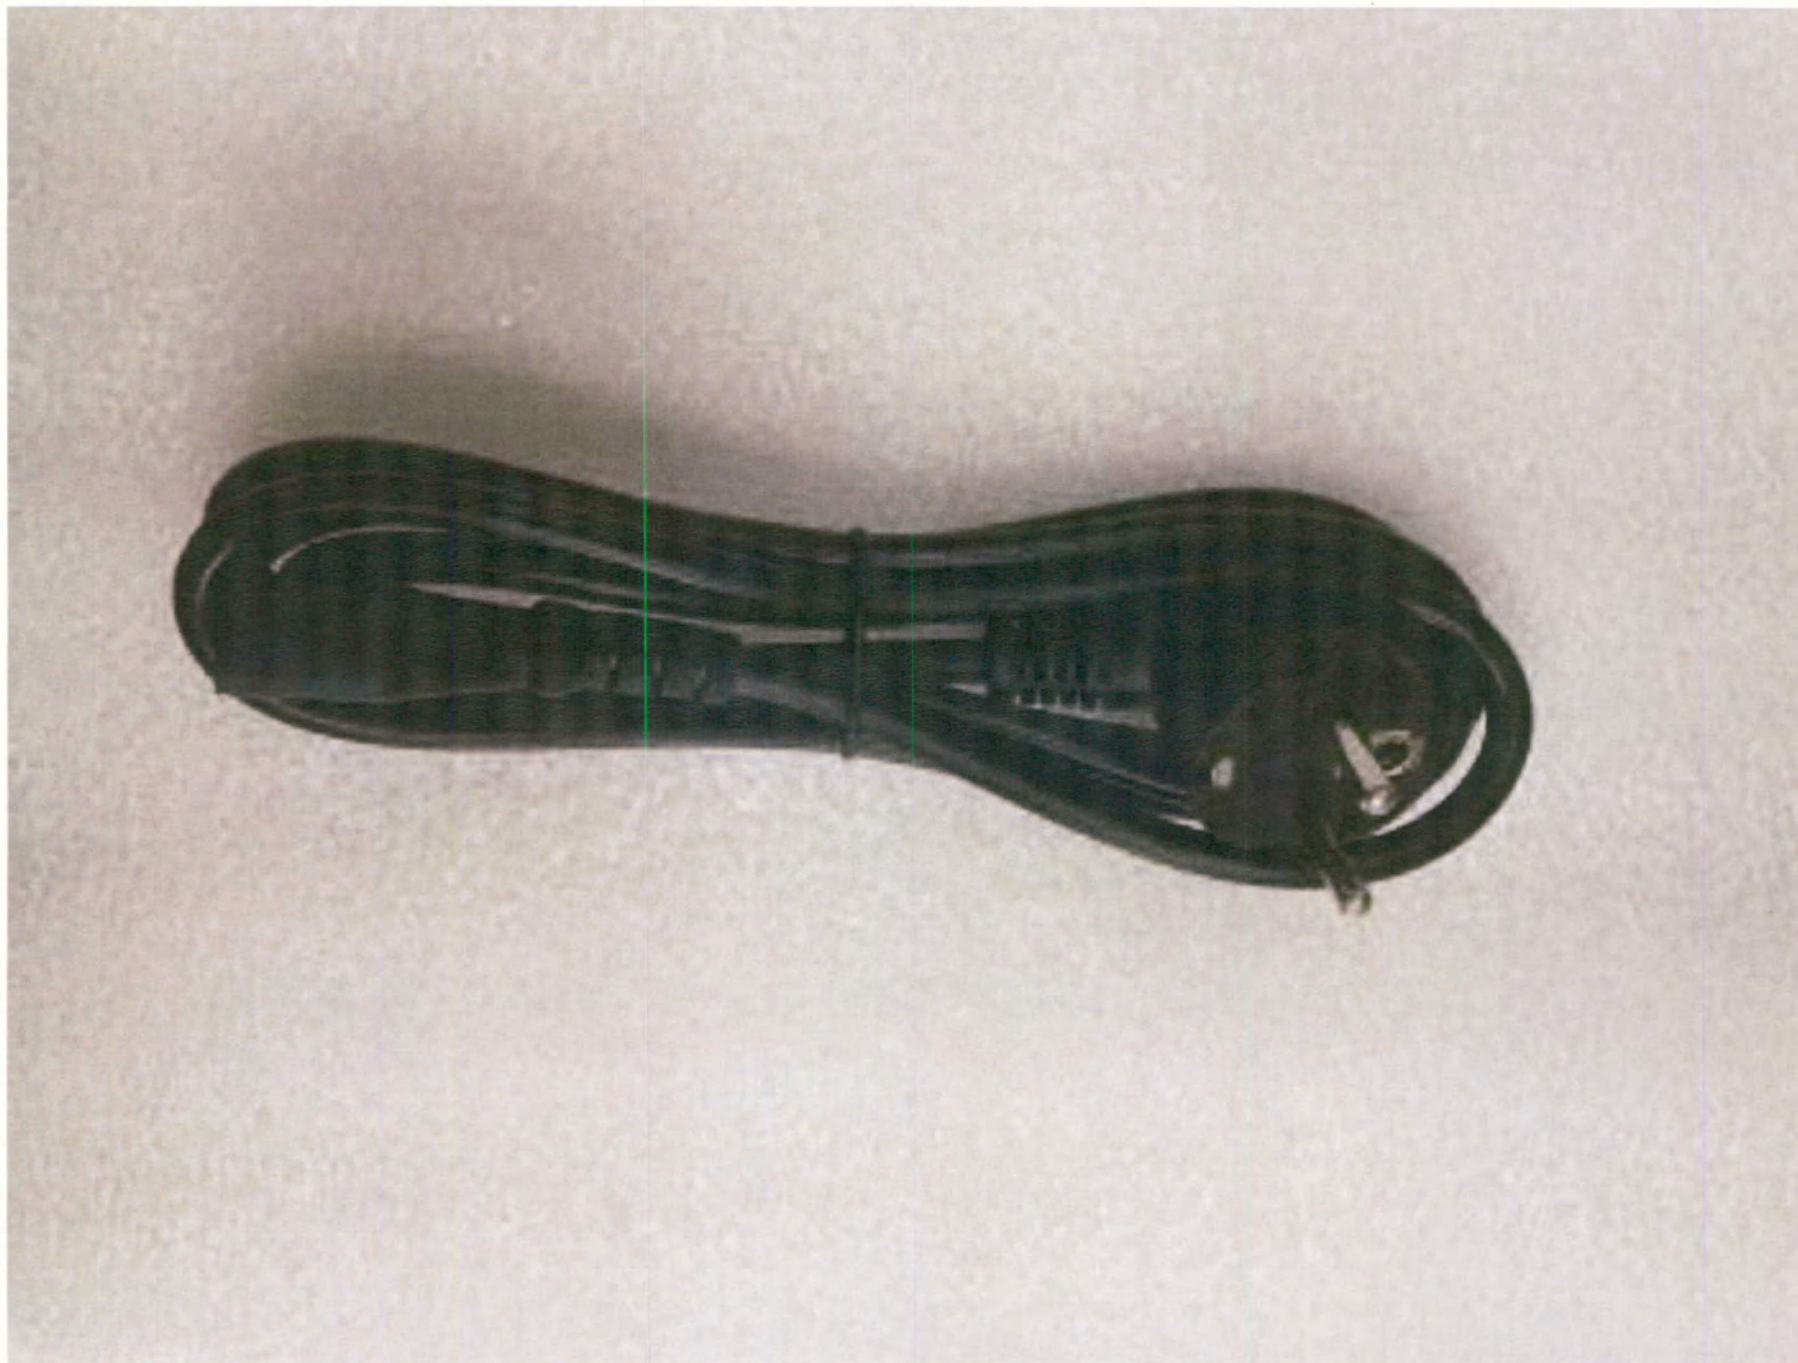


	«APPROVED BY» «УТВЕРЖДАЮ» Director General / Генеральный директор Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./ Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд. Yi Yong (Hou) Yi Yong (Hou) 26 2024 г. Seamp/Seamex
--	---

USER MANUAL OF MEDICAL DEVICE/
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

V-series emergency and transport ventilator, available in the following
versions: V1, V1D/

Аппарат искусственной вентиляции легких для
экстренной помощи и транспортировки серии V, в
вариантах исполнения: V1, V1D

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./
Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.

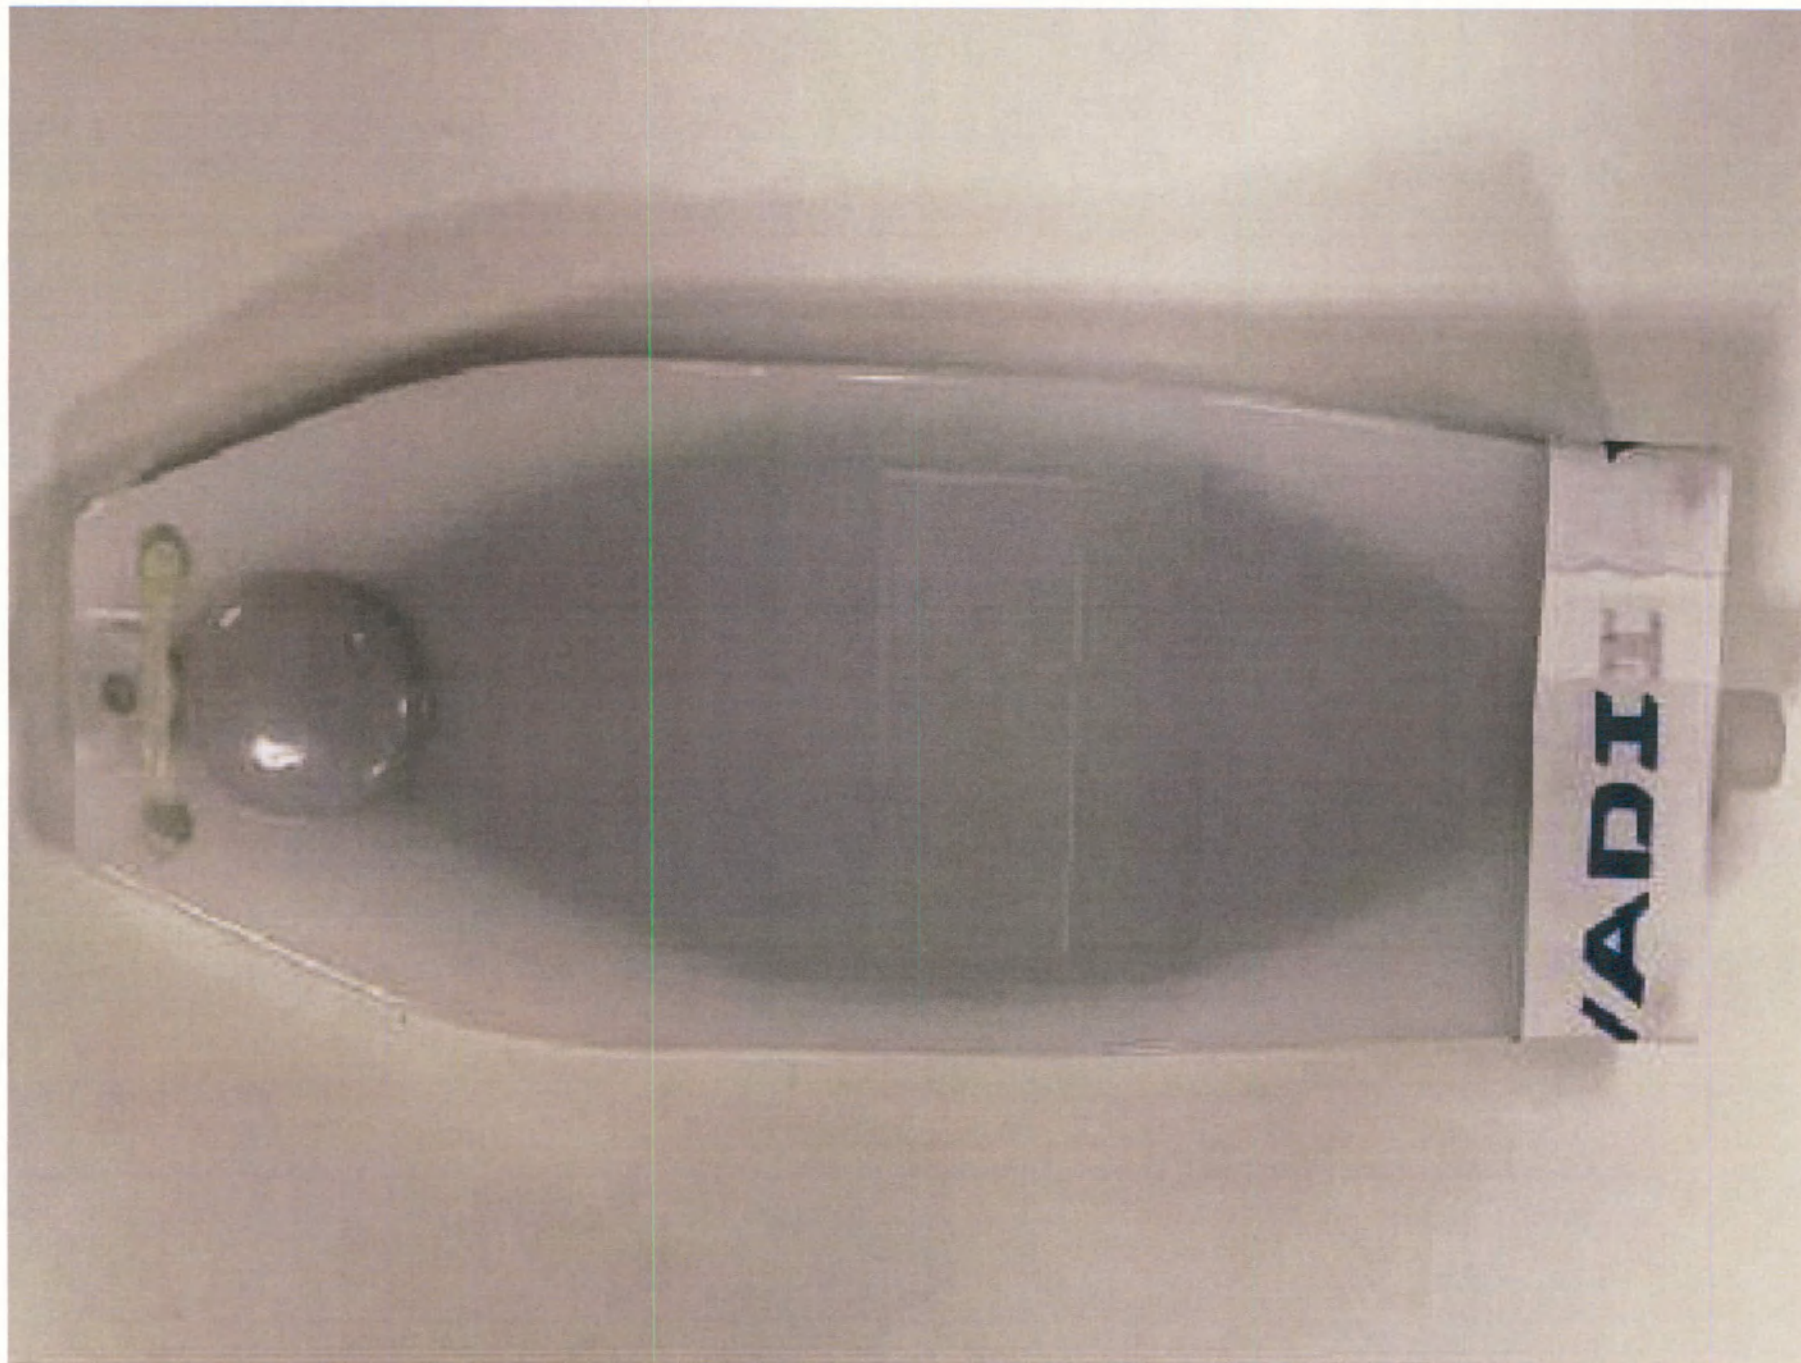












Одноразовый однолинейный дыхательный контур (DAA150)

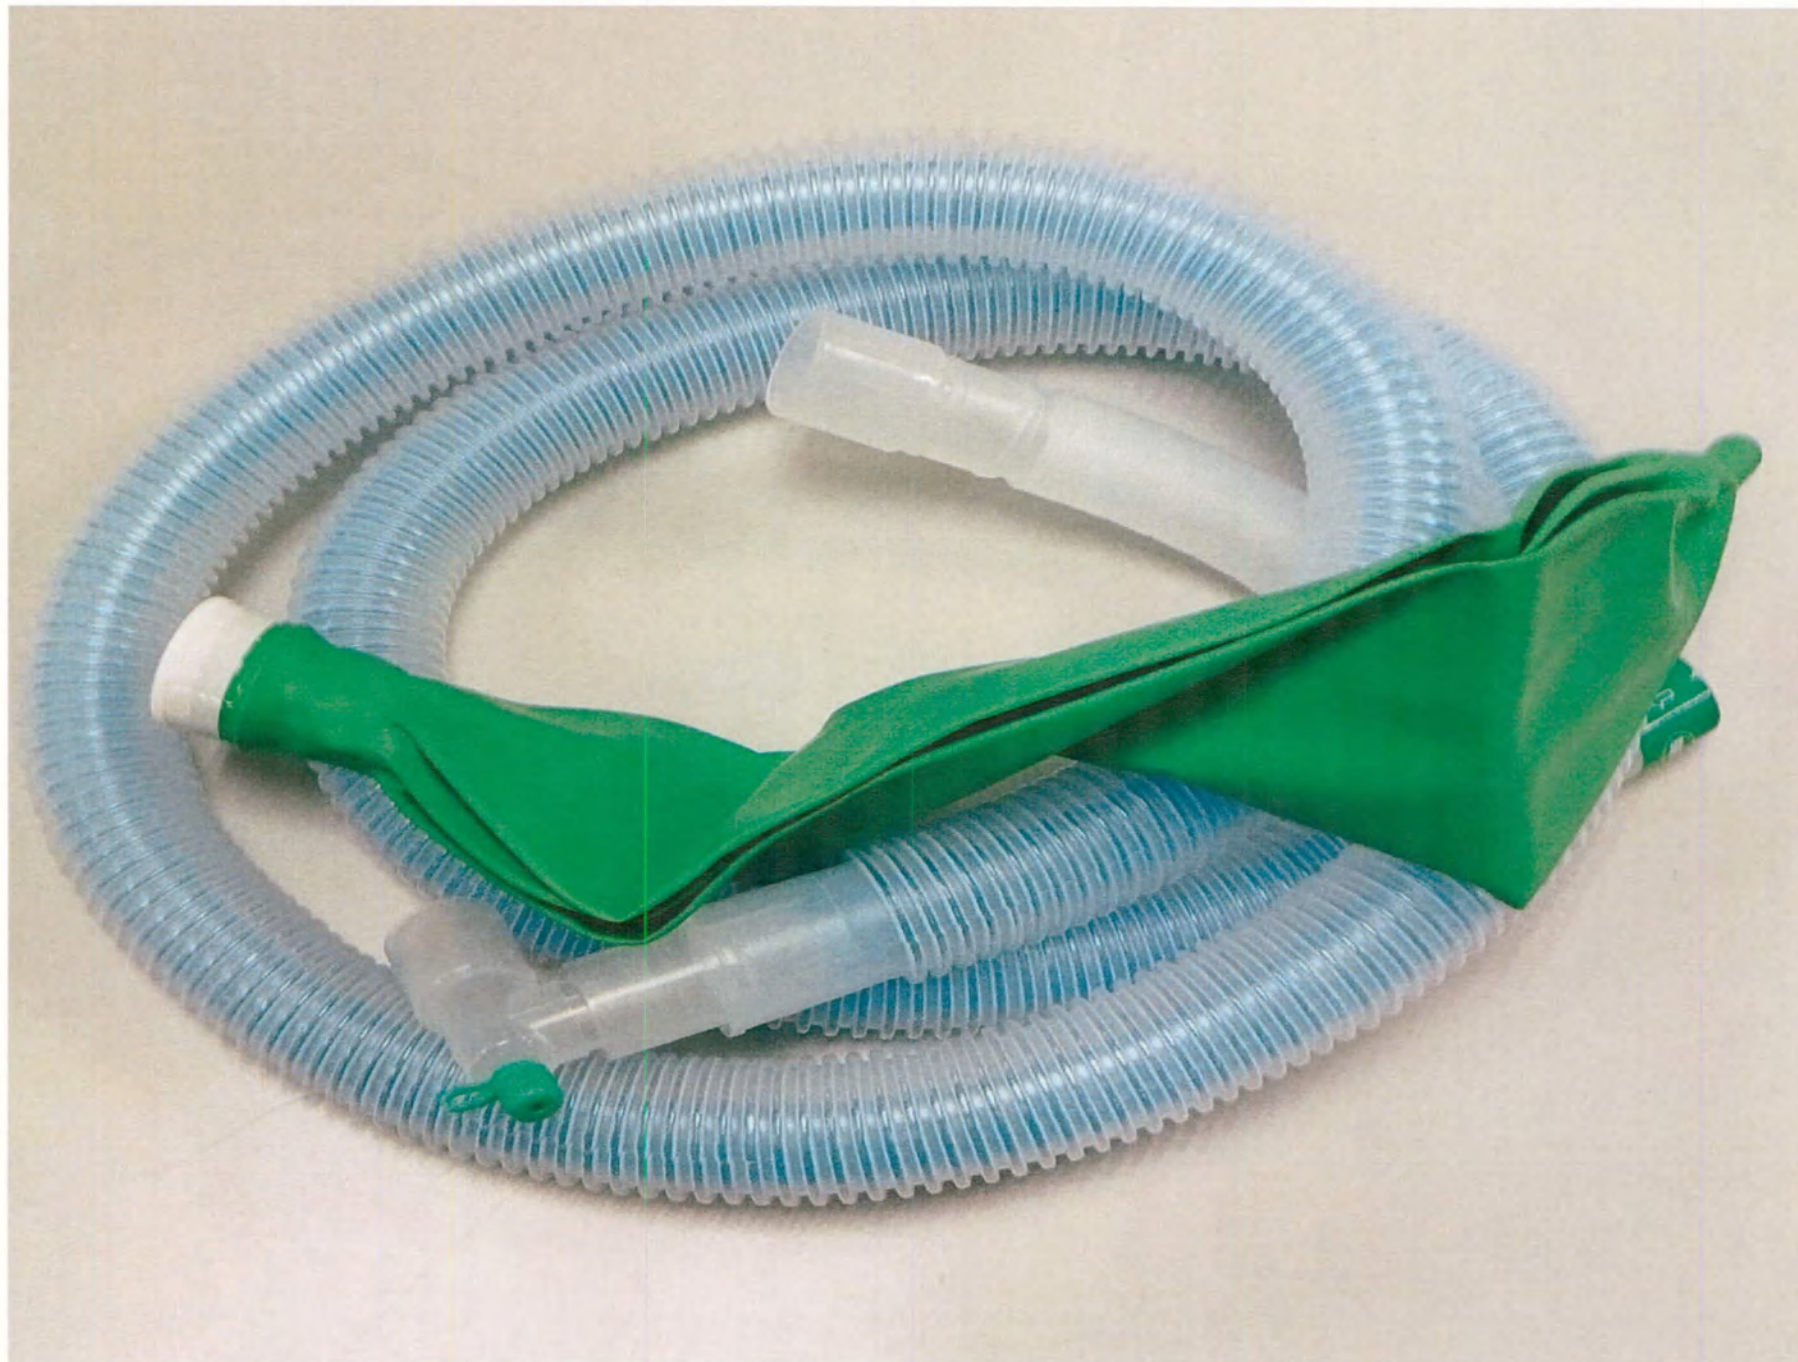


Многоразовый дыхательный контур для младенцев и детей (G-330000)

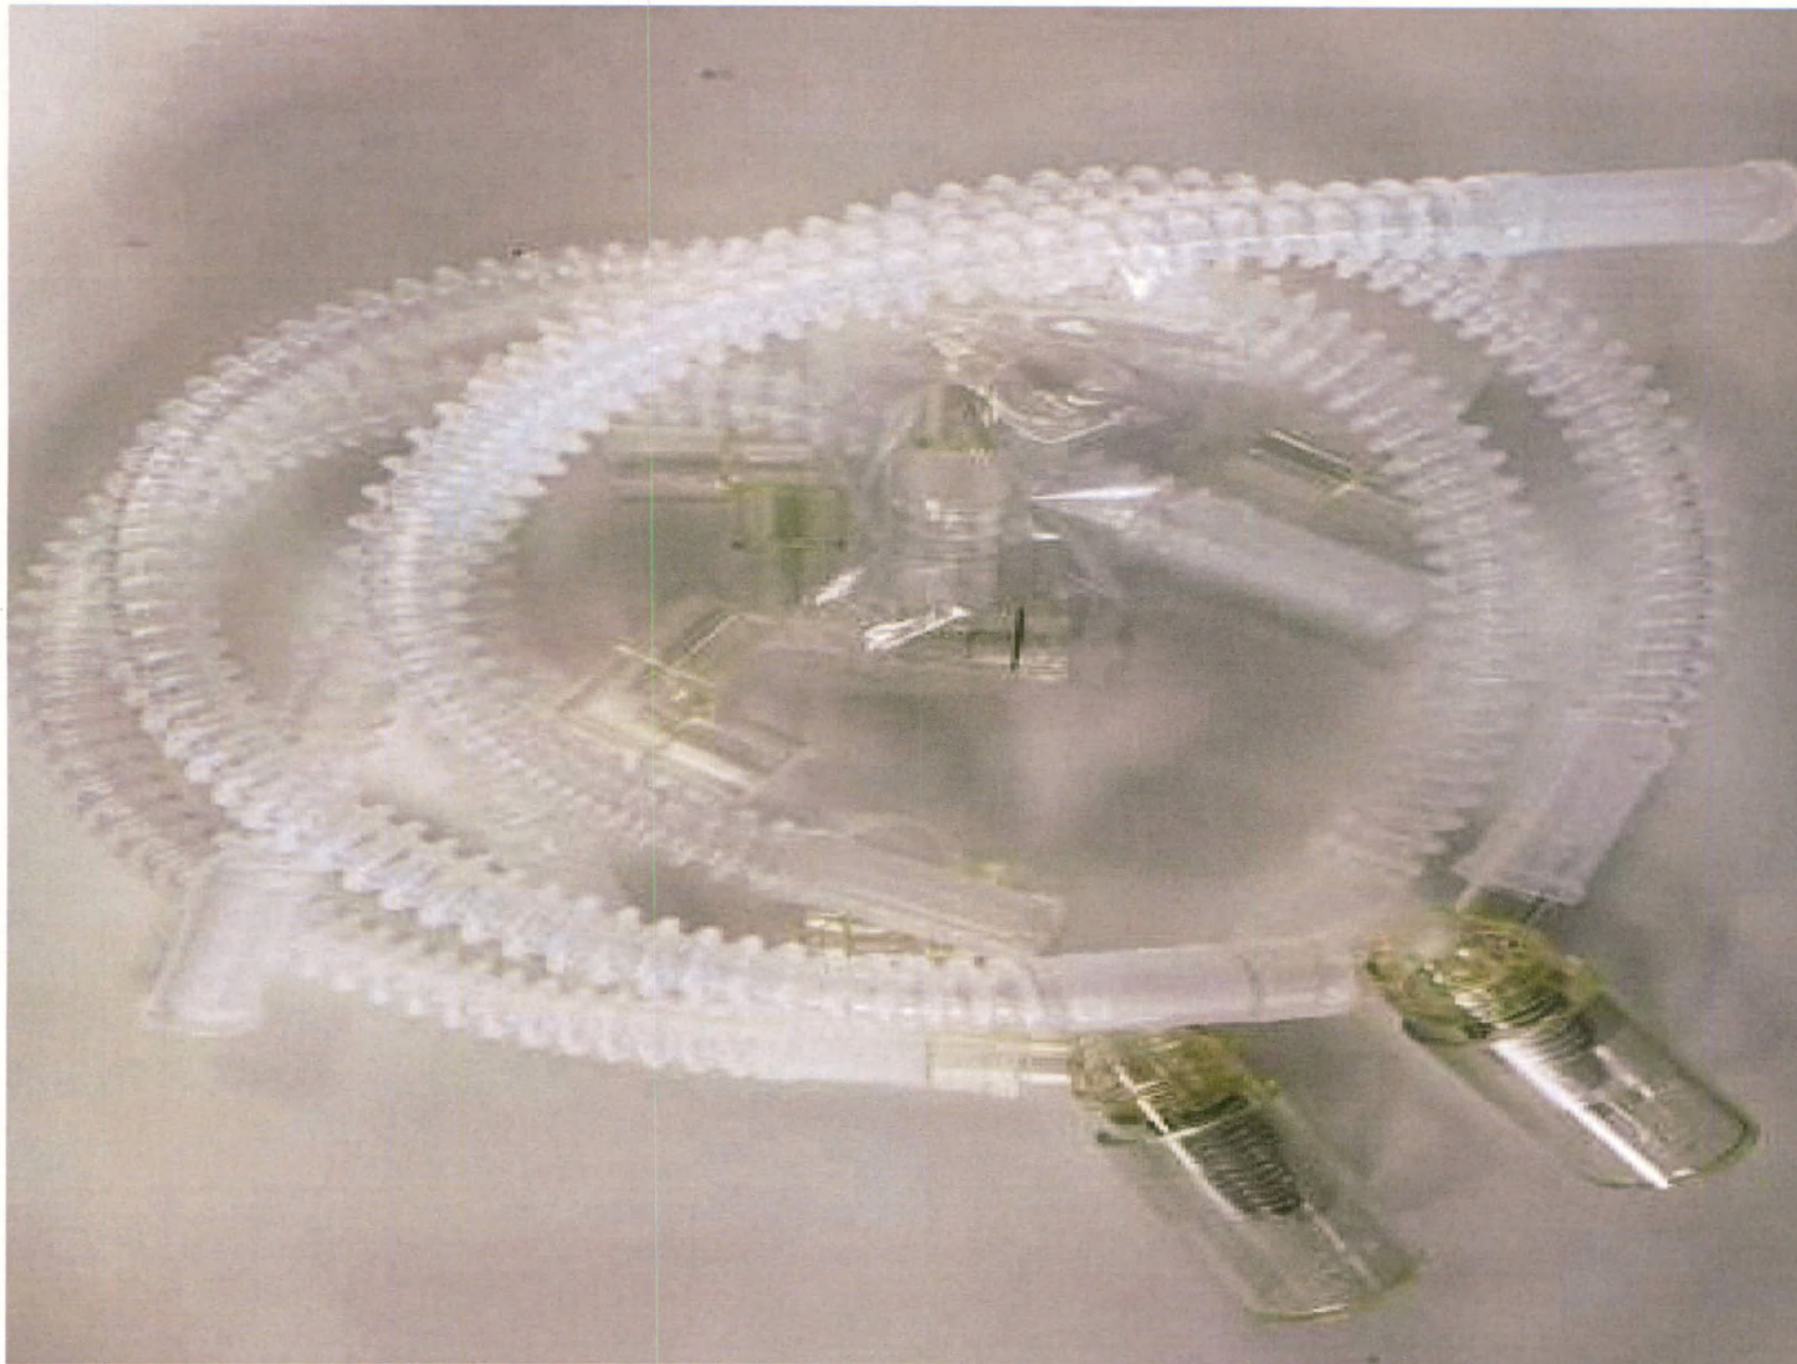



Многоразовый дыхательный контур для взрослых (G-328000)

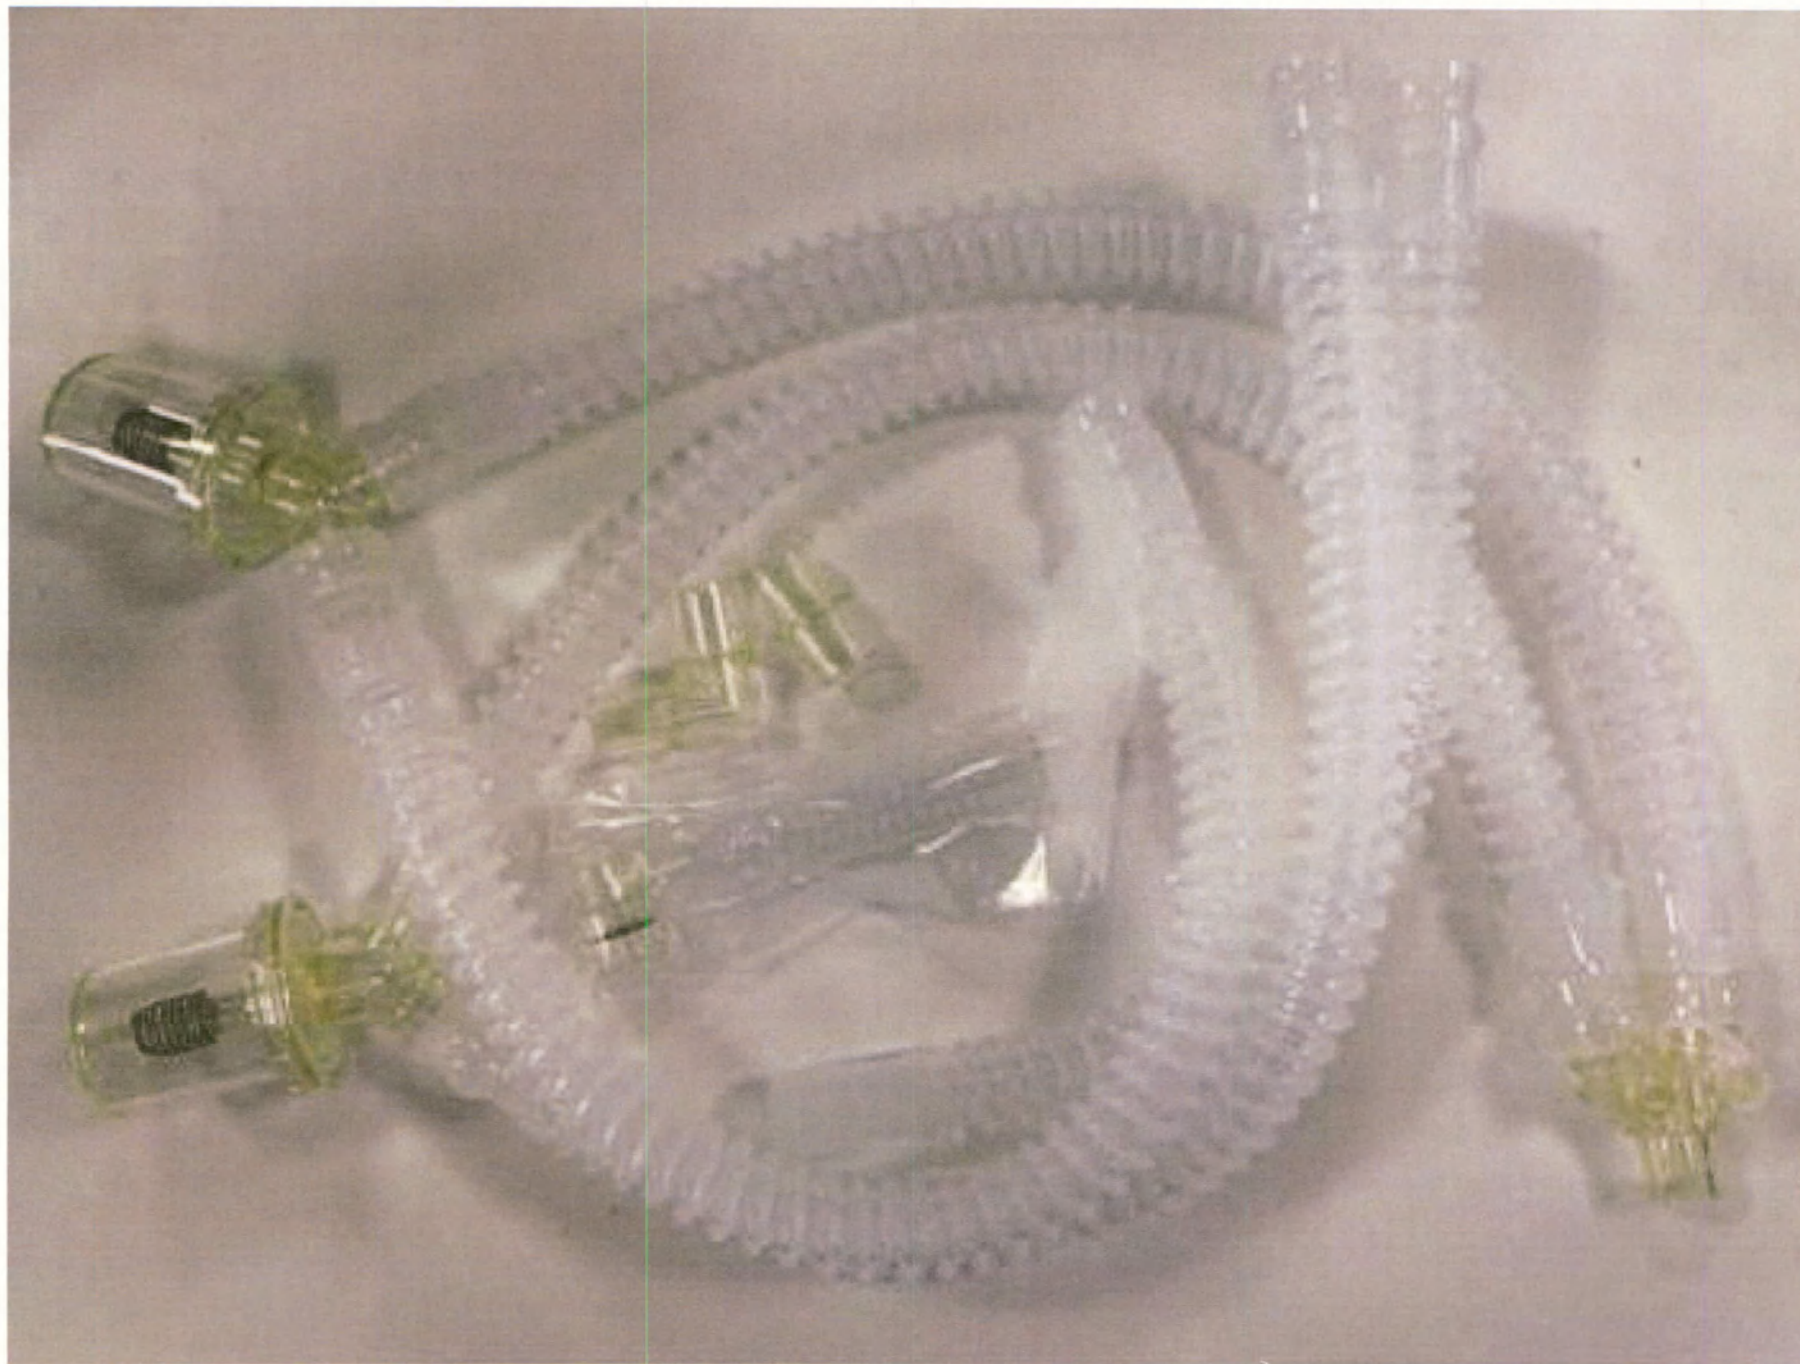

Многоразовый силиконовый дыхательный мешок (G-118001)

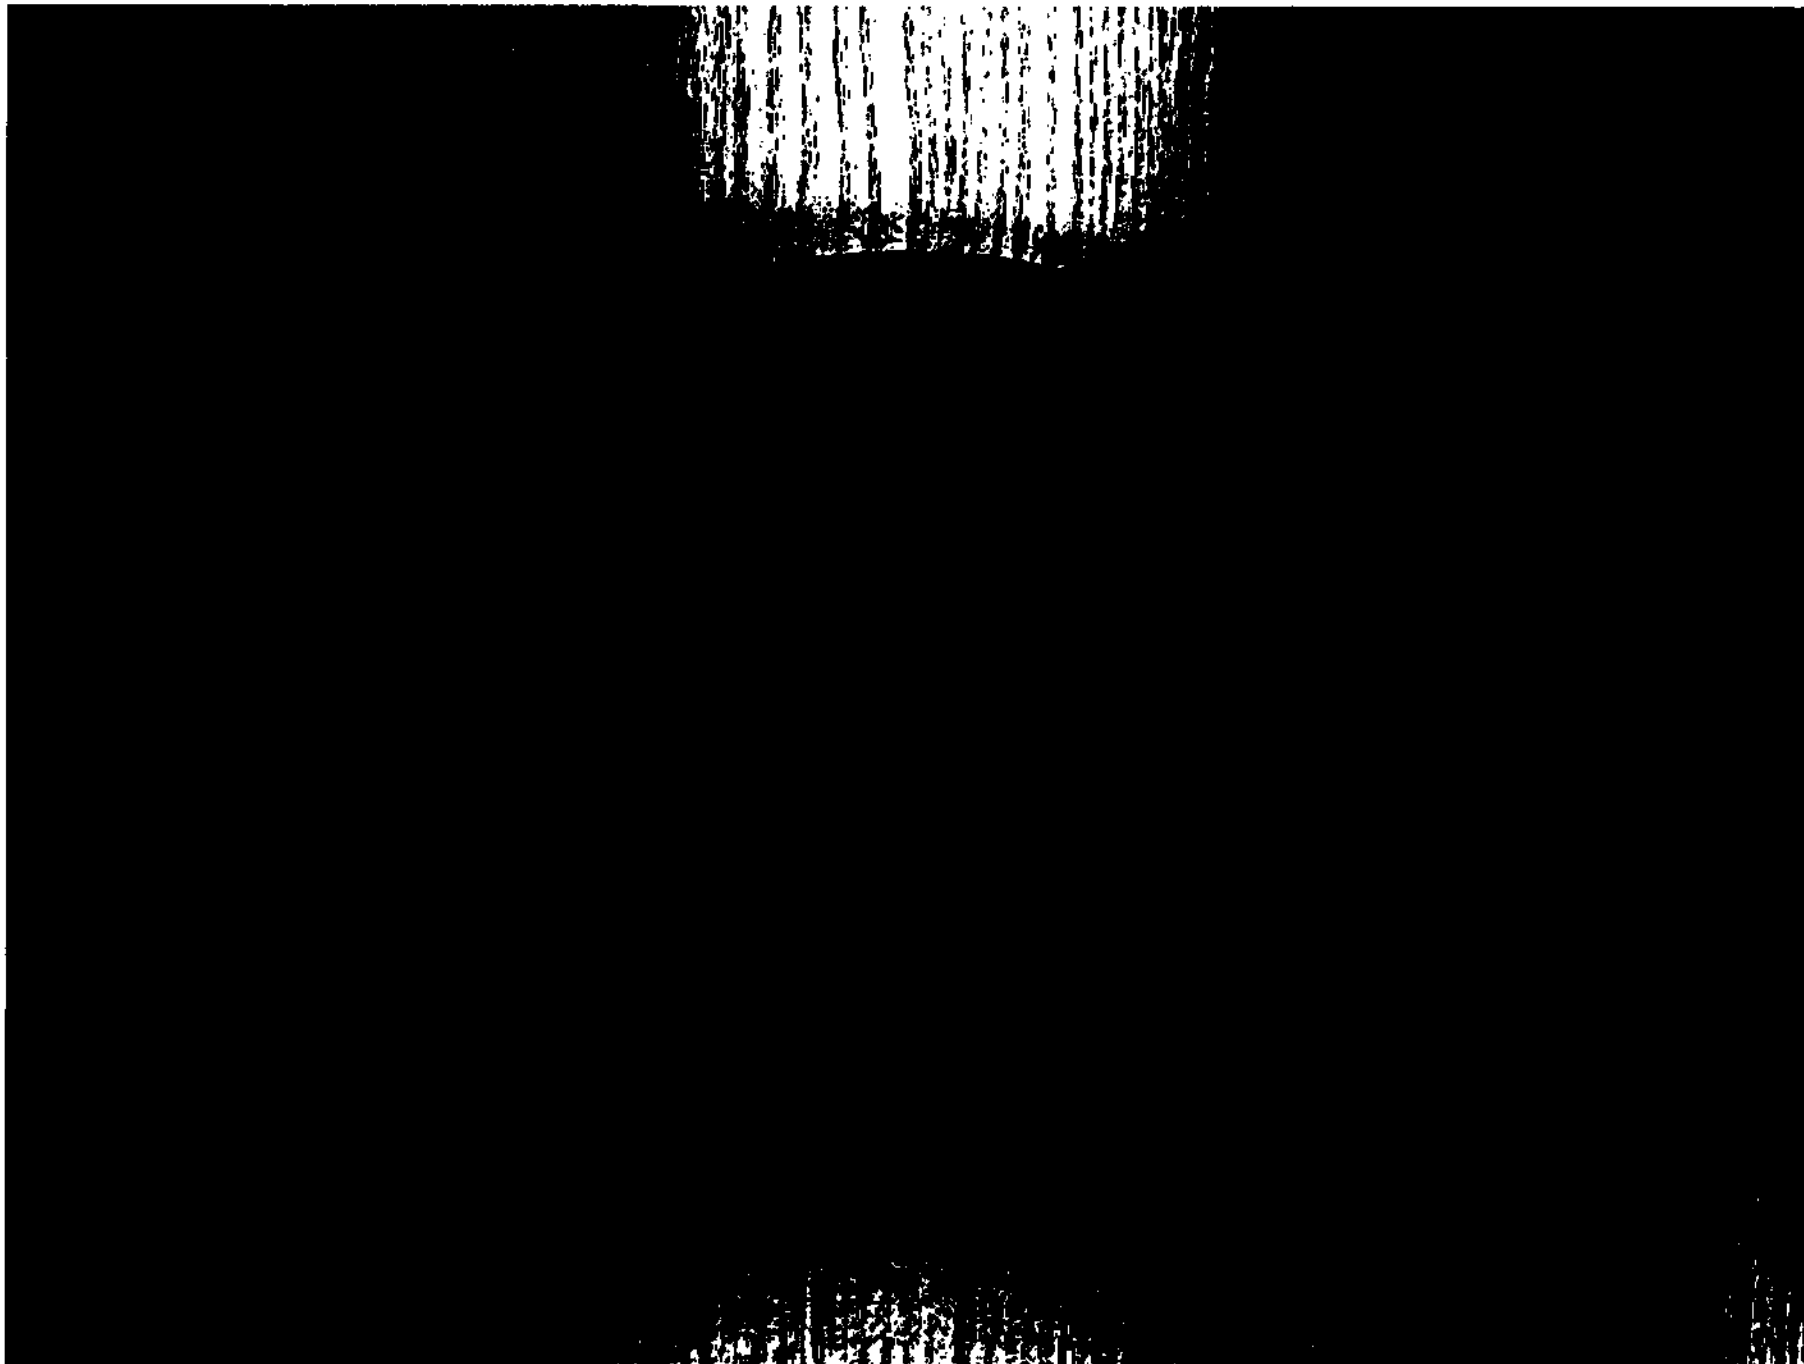

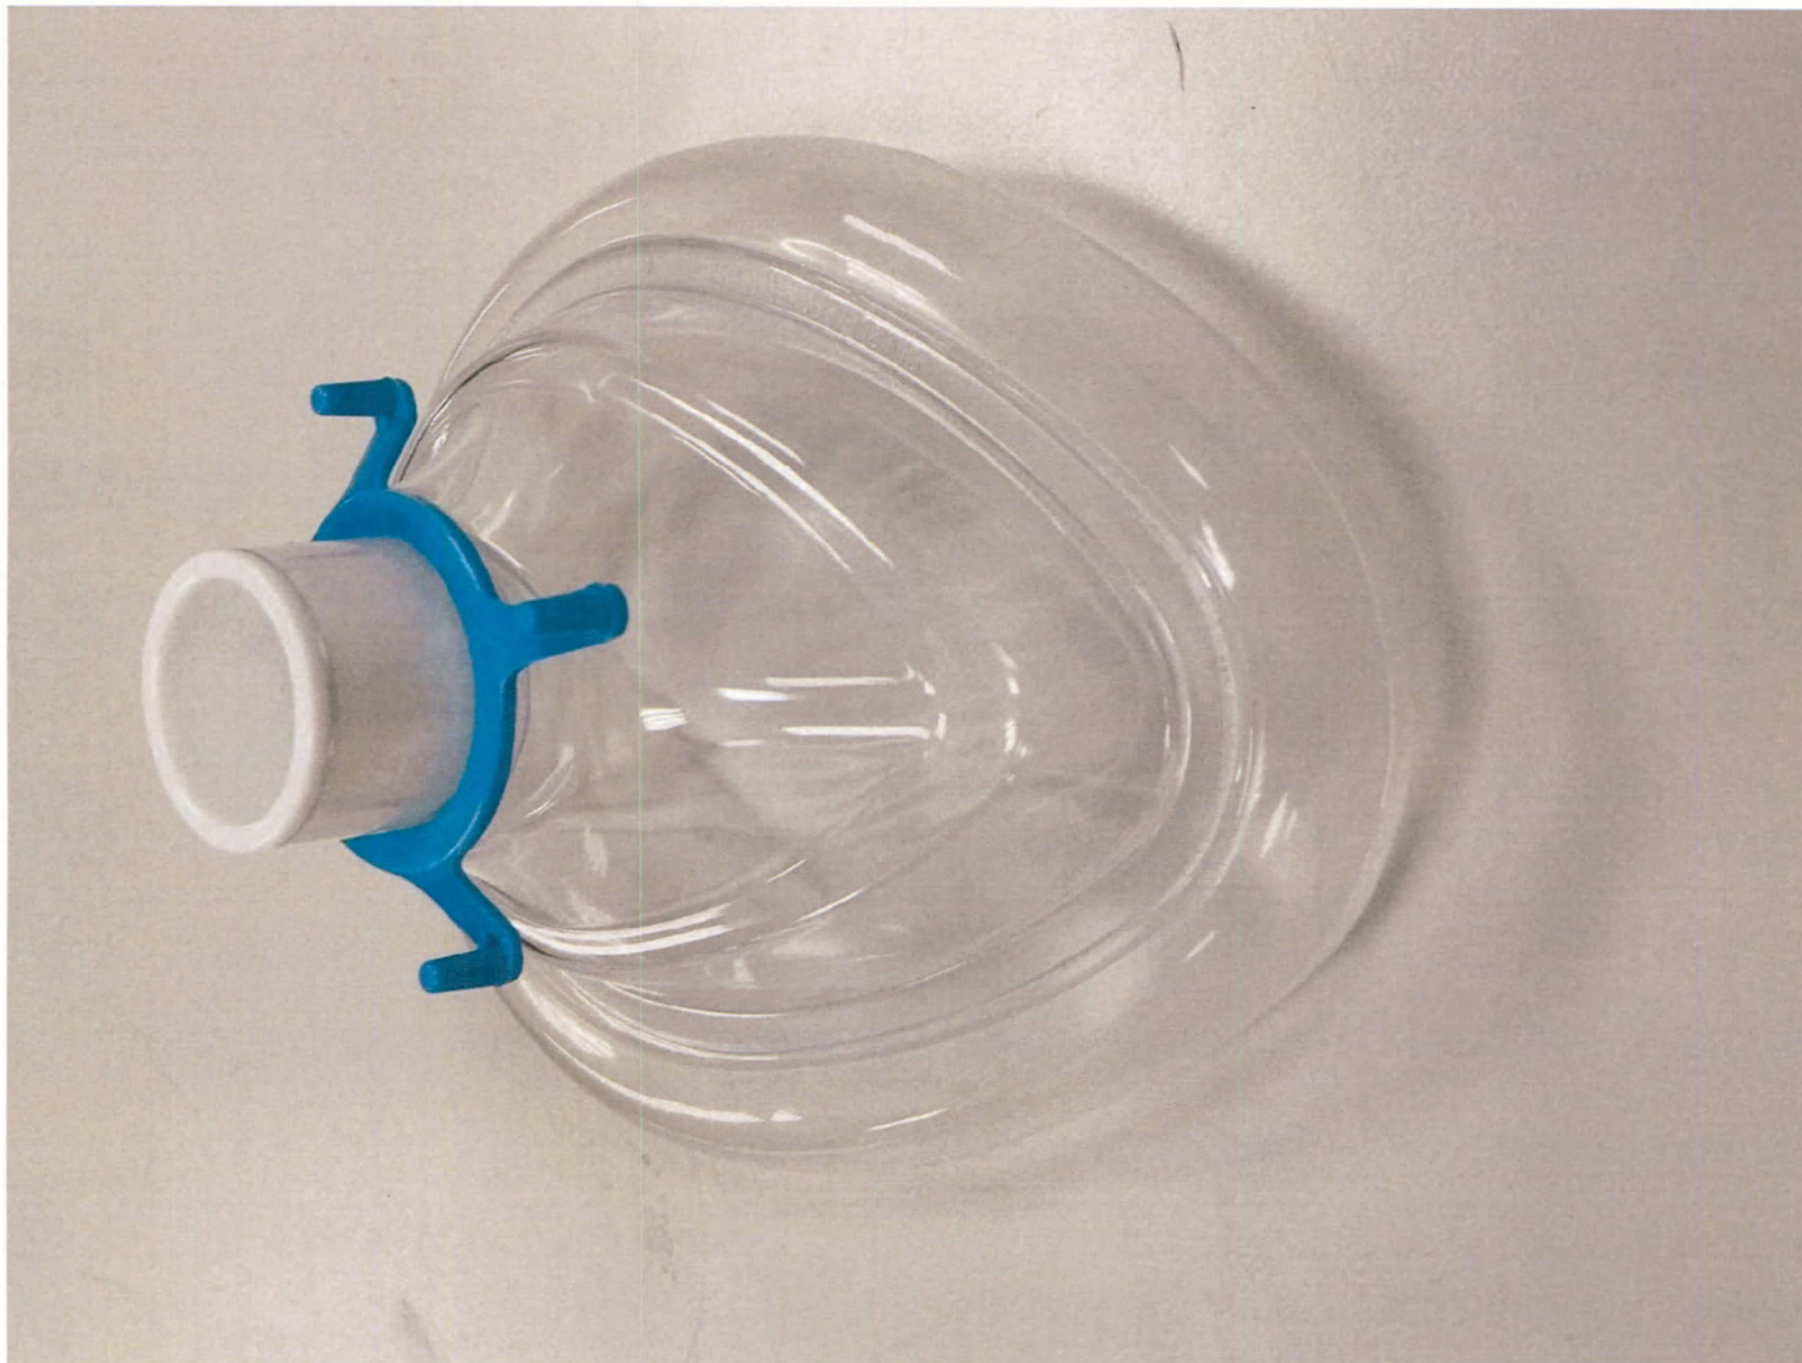


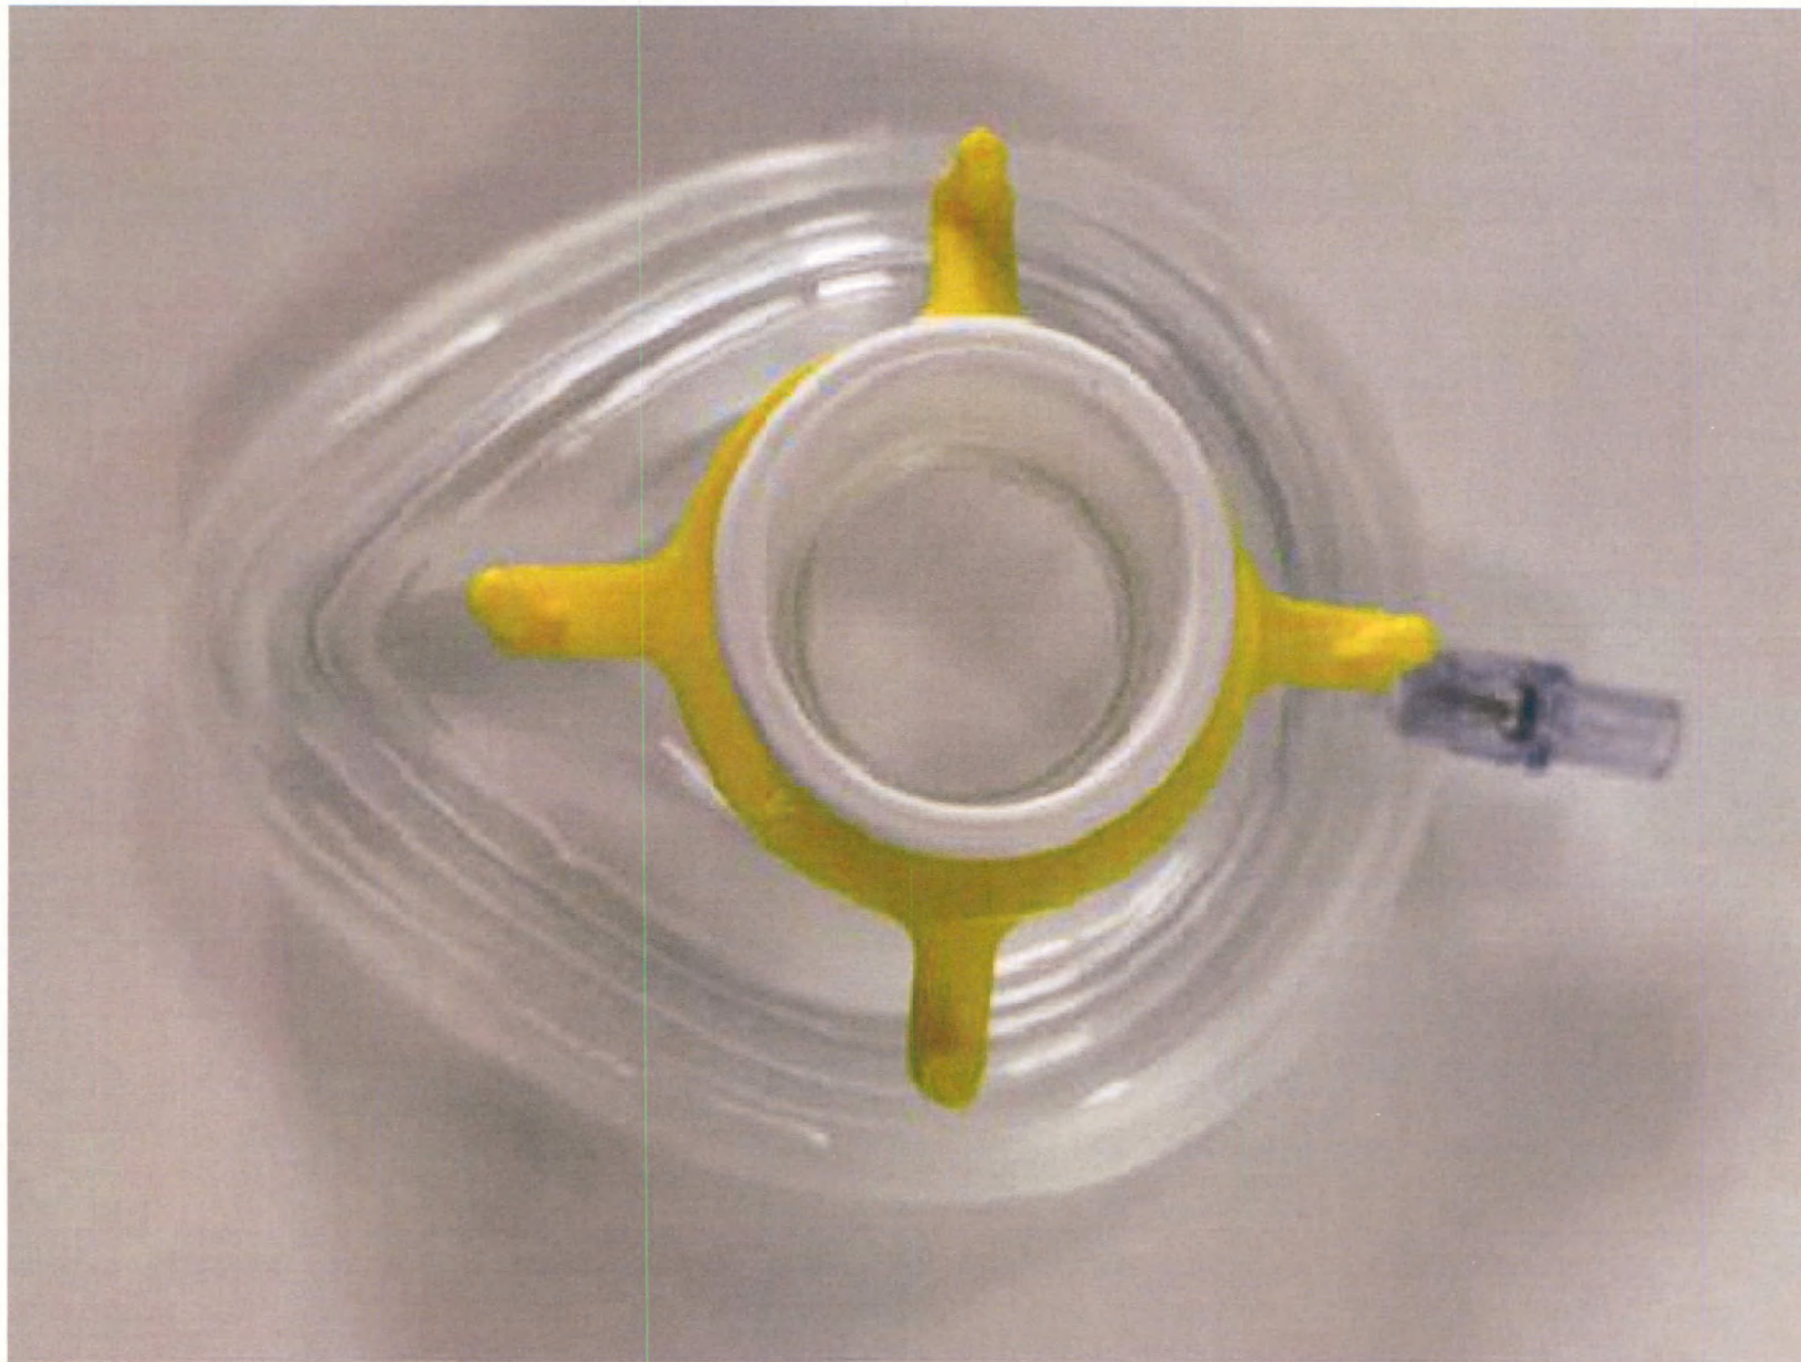





Набор для небулайзера с ротовой насадкой (М-0801)

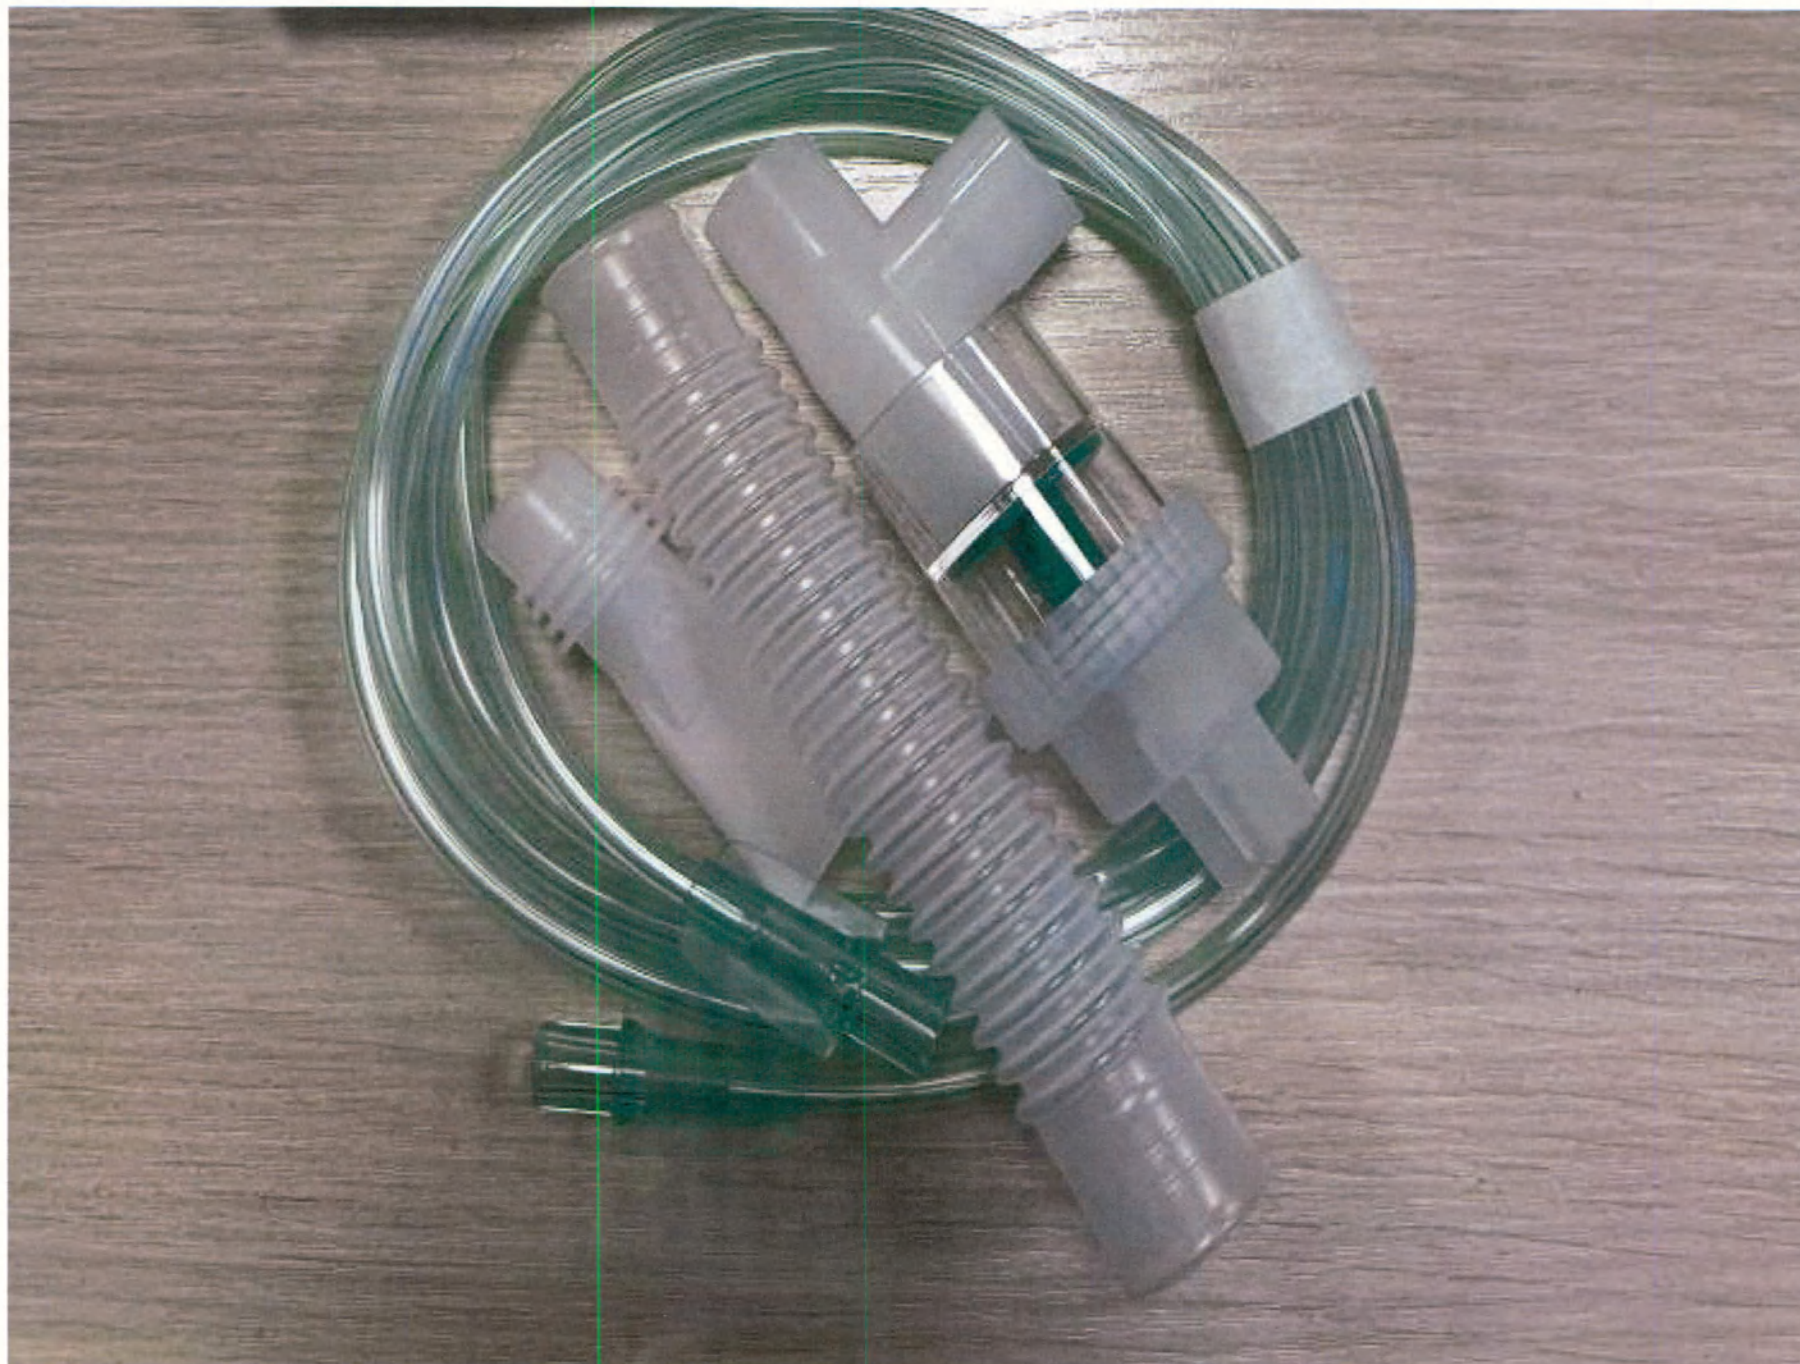

Назальная канюля (RVL001S)



Назальная канюля (RVL001M)



Назальная канюля (RVL001L)





Многоцветный датчик SpO₂ с зажимом для пальцев для взрослых



















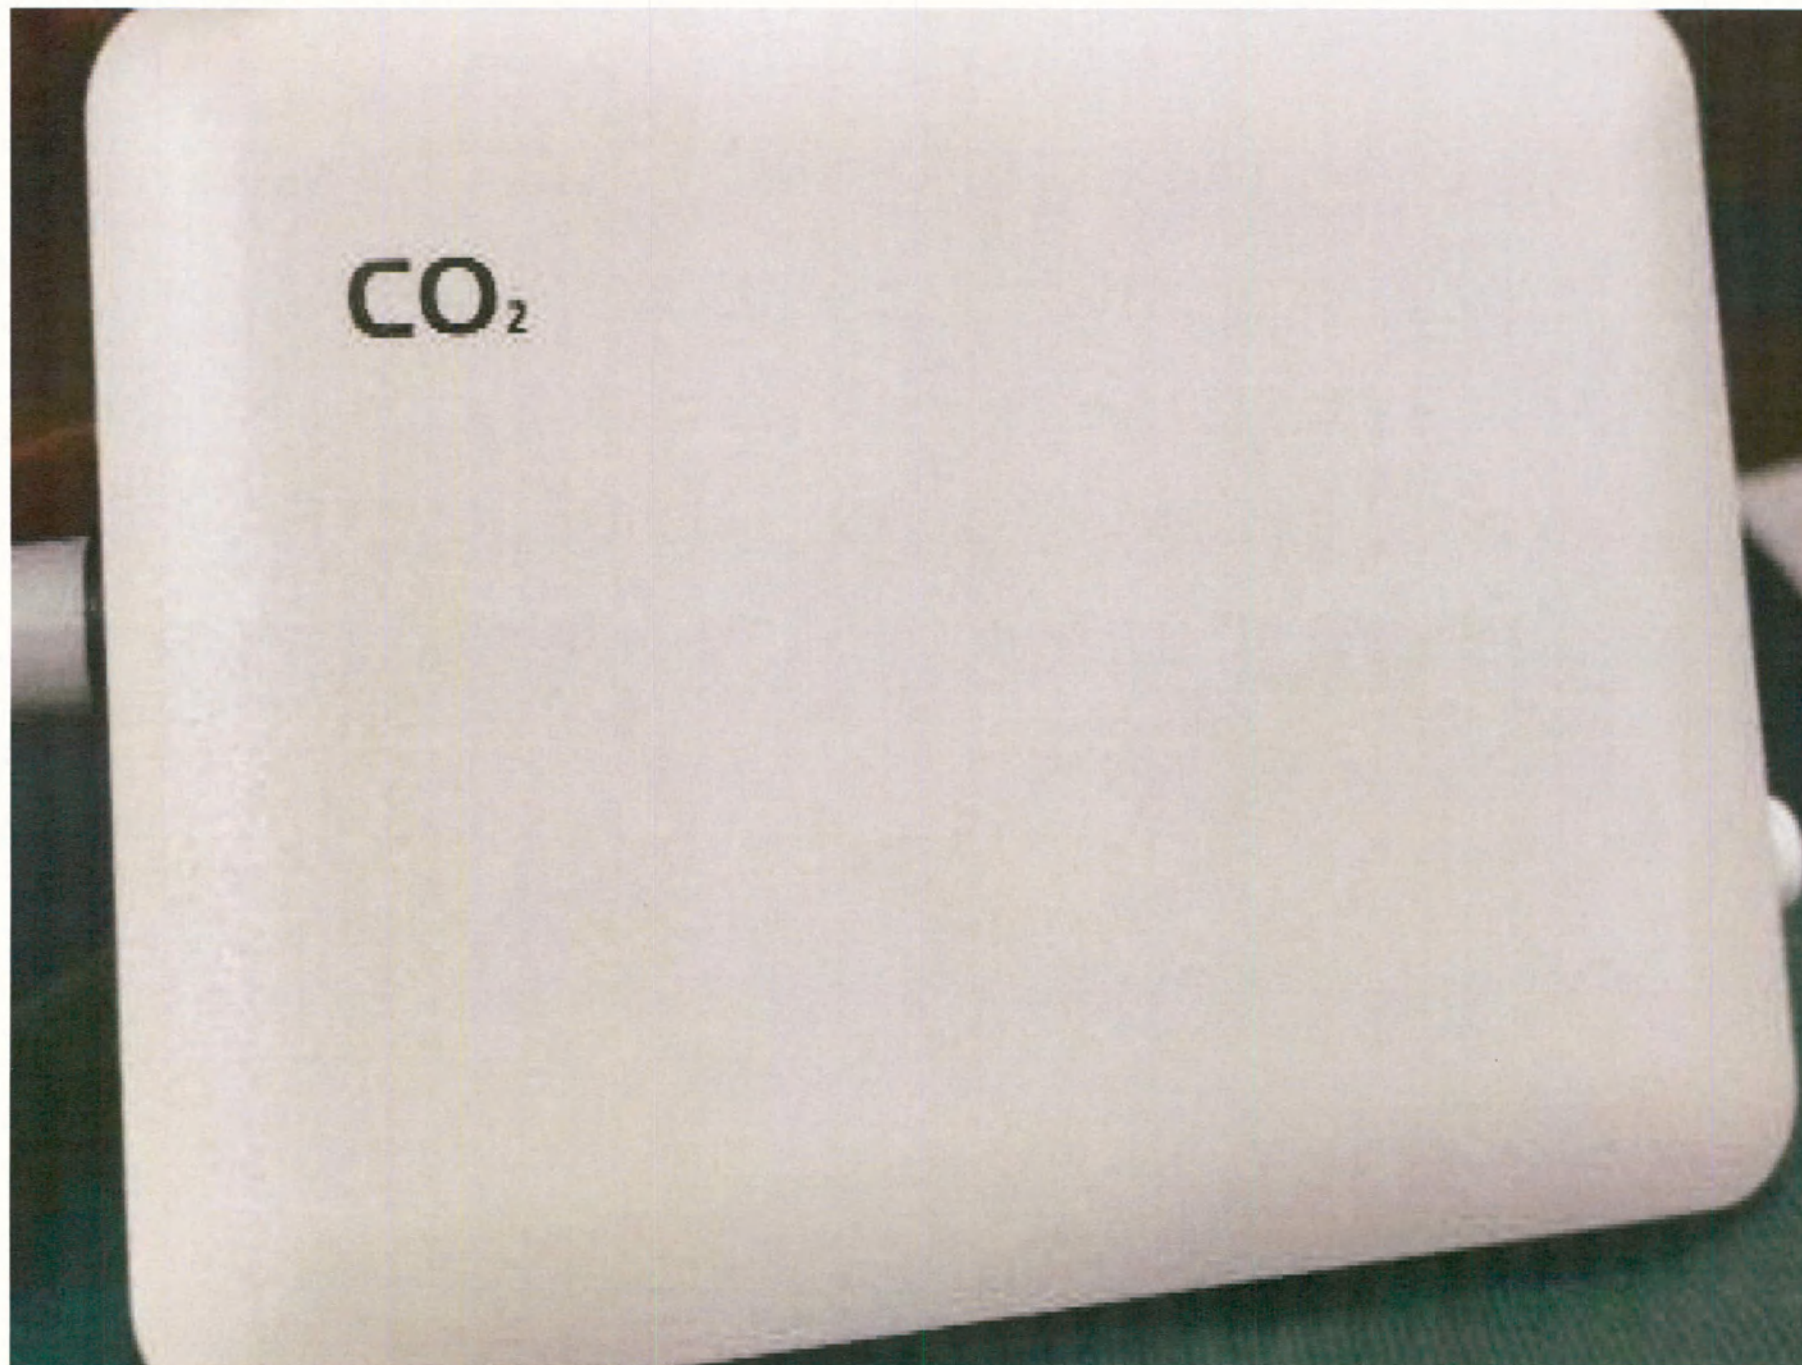







Линия забора пробы газа бокового потока CO₂ для взрослых

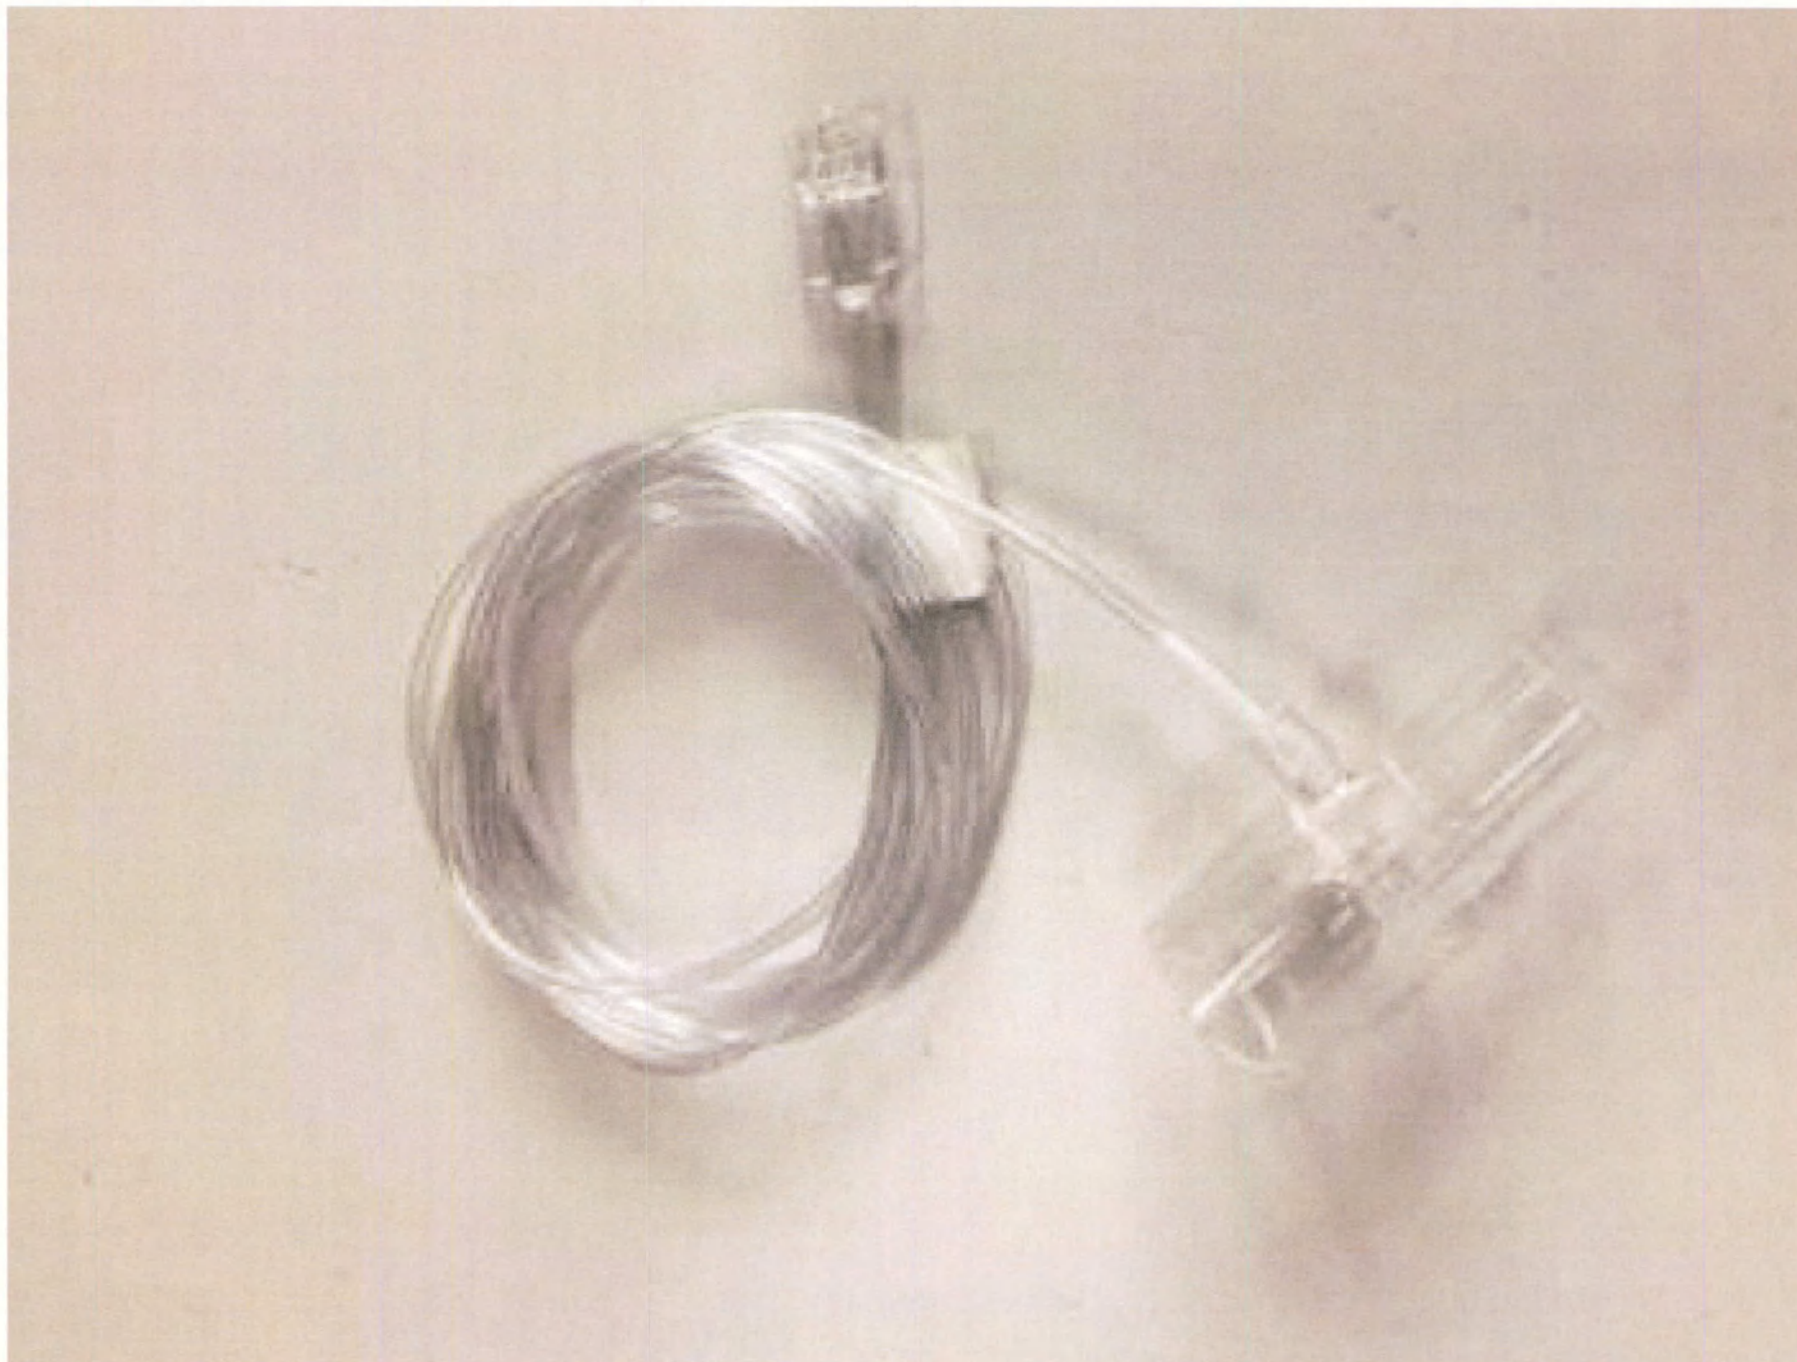


Линия забора пробы газа бокового потока CO₂ для детей

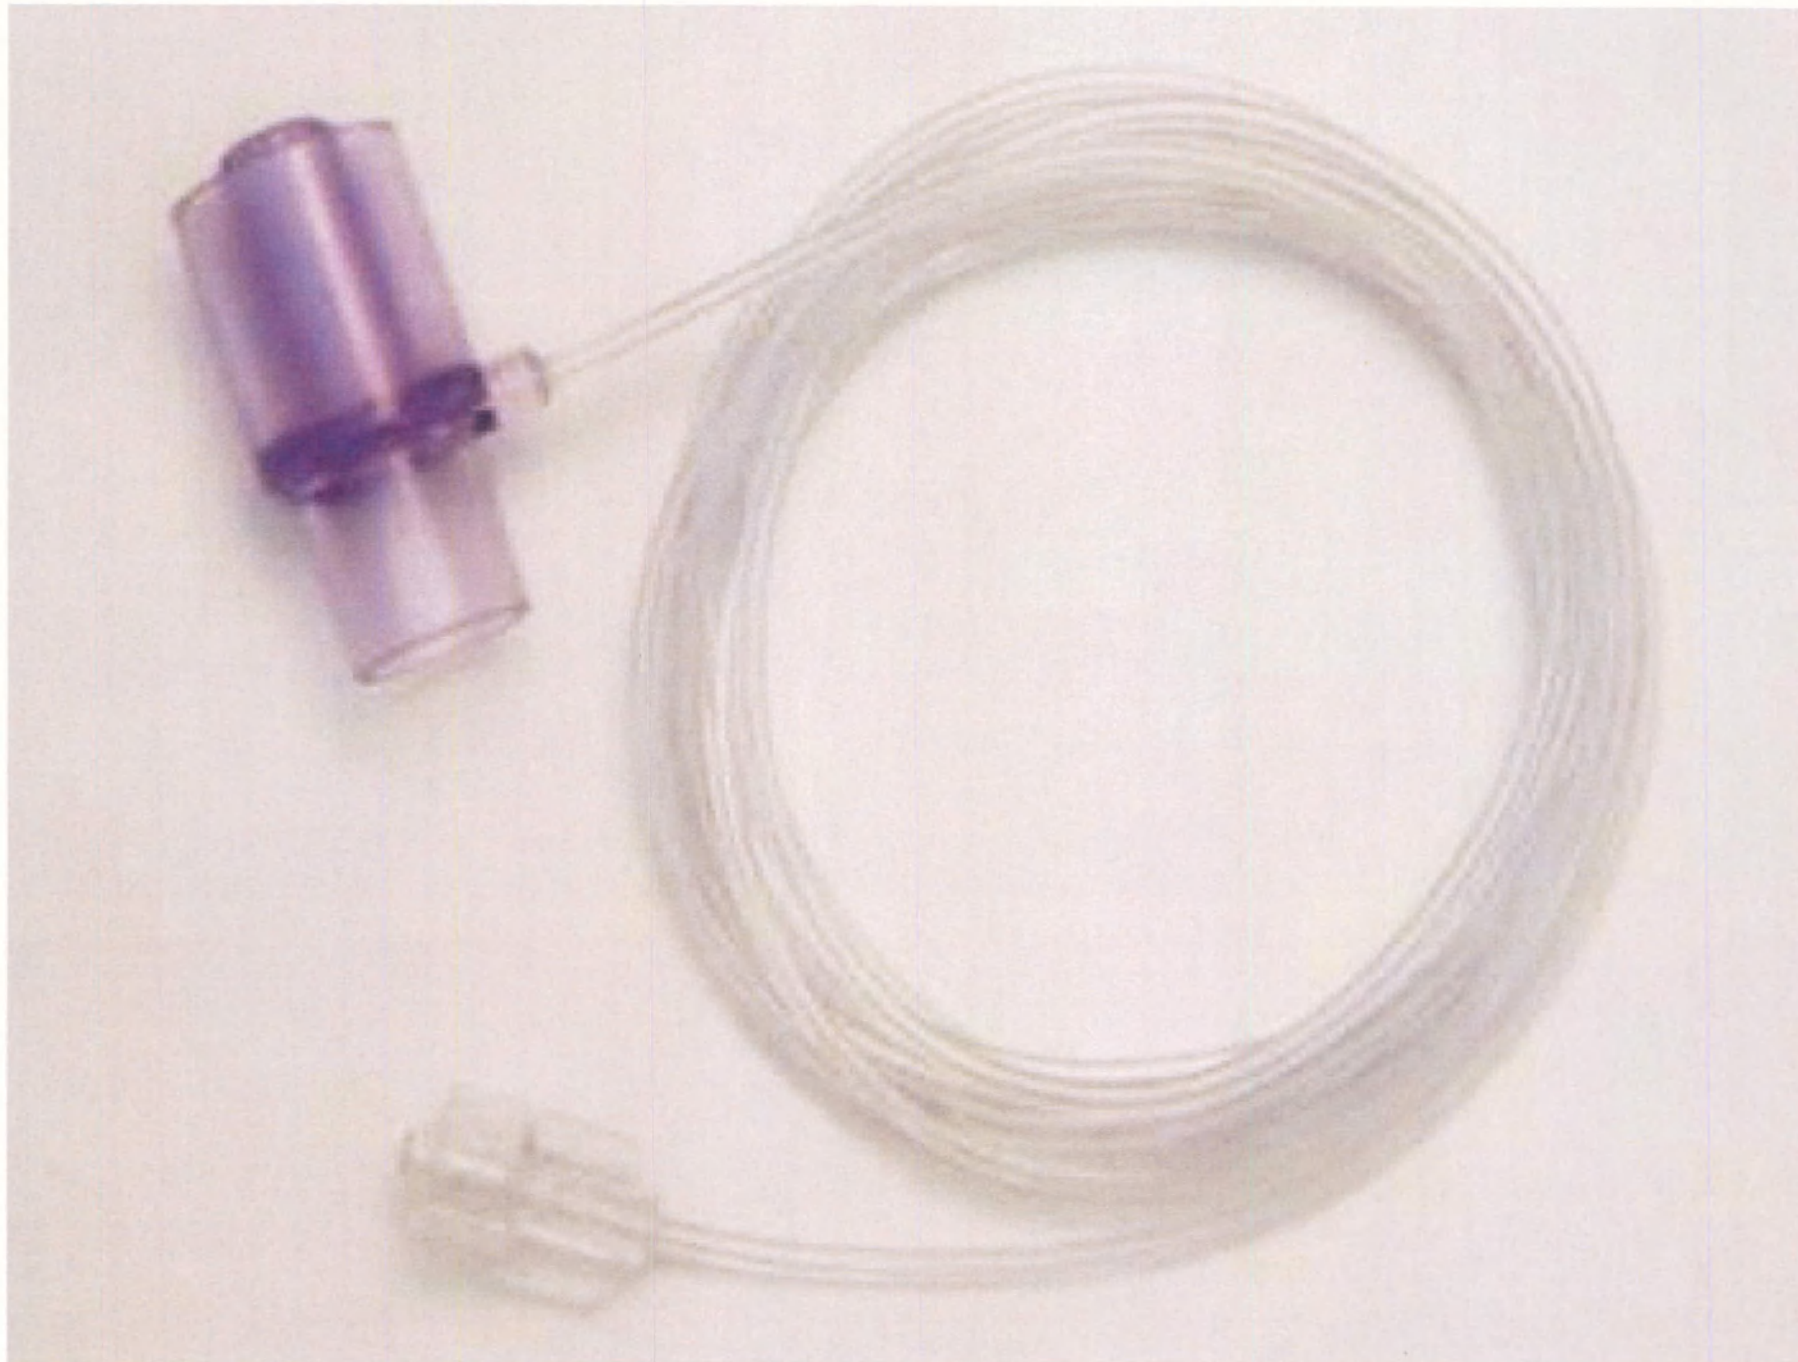



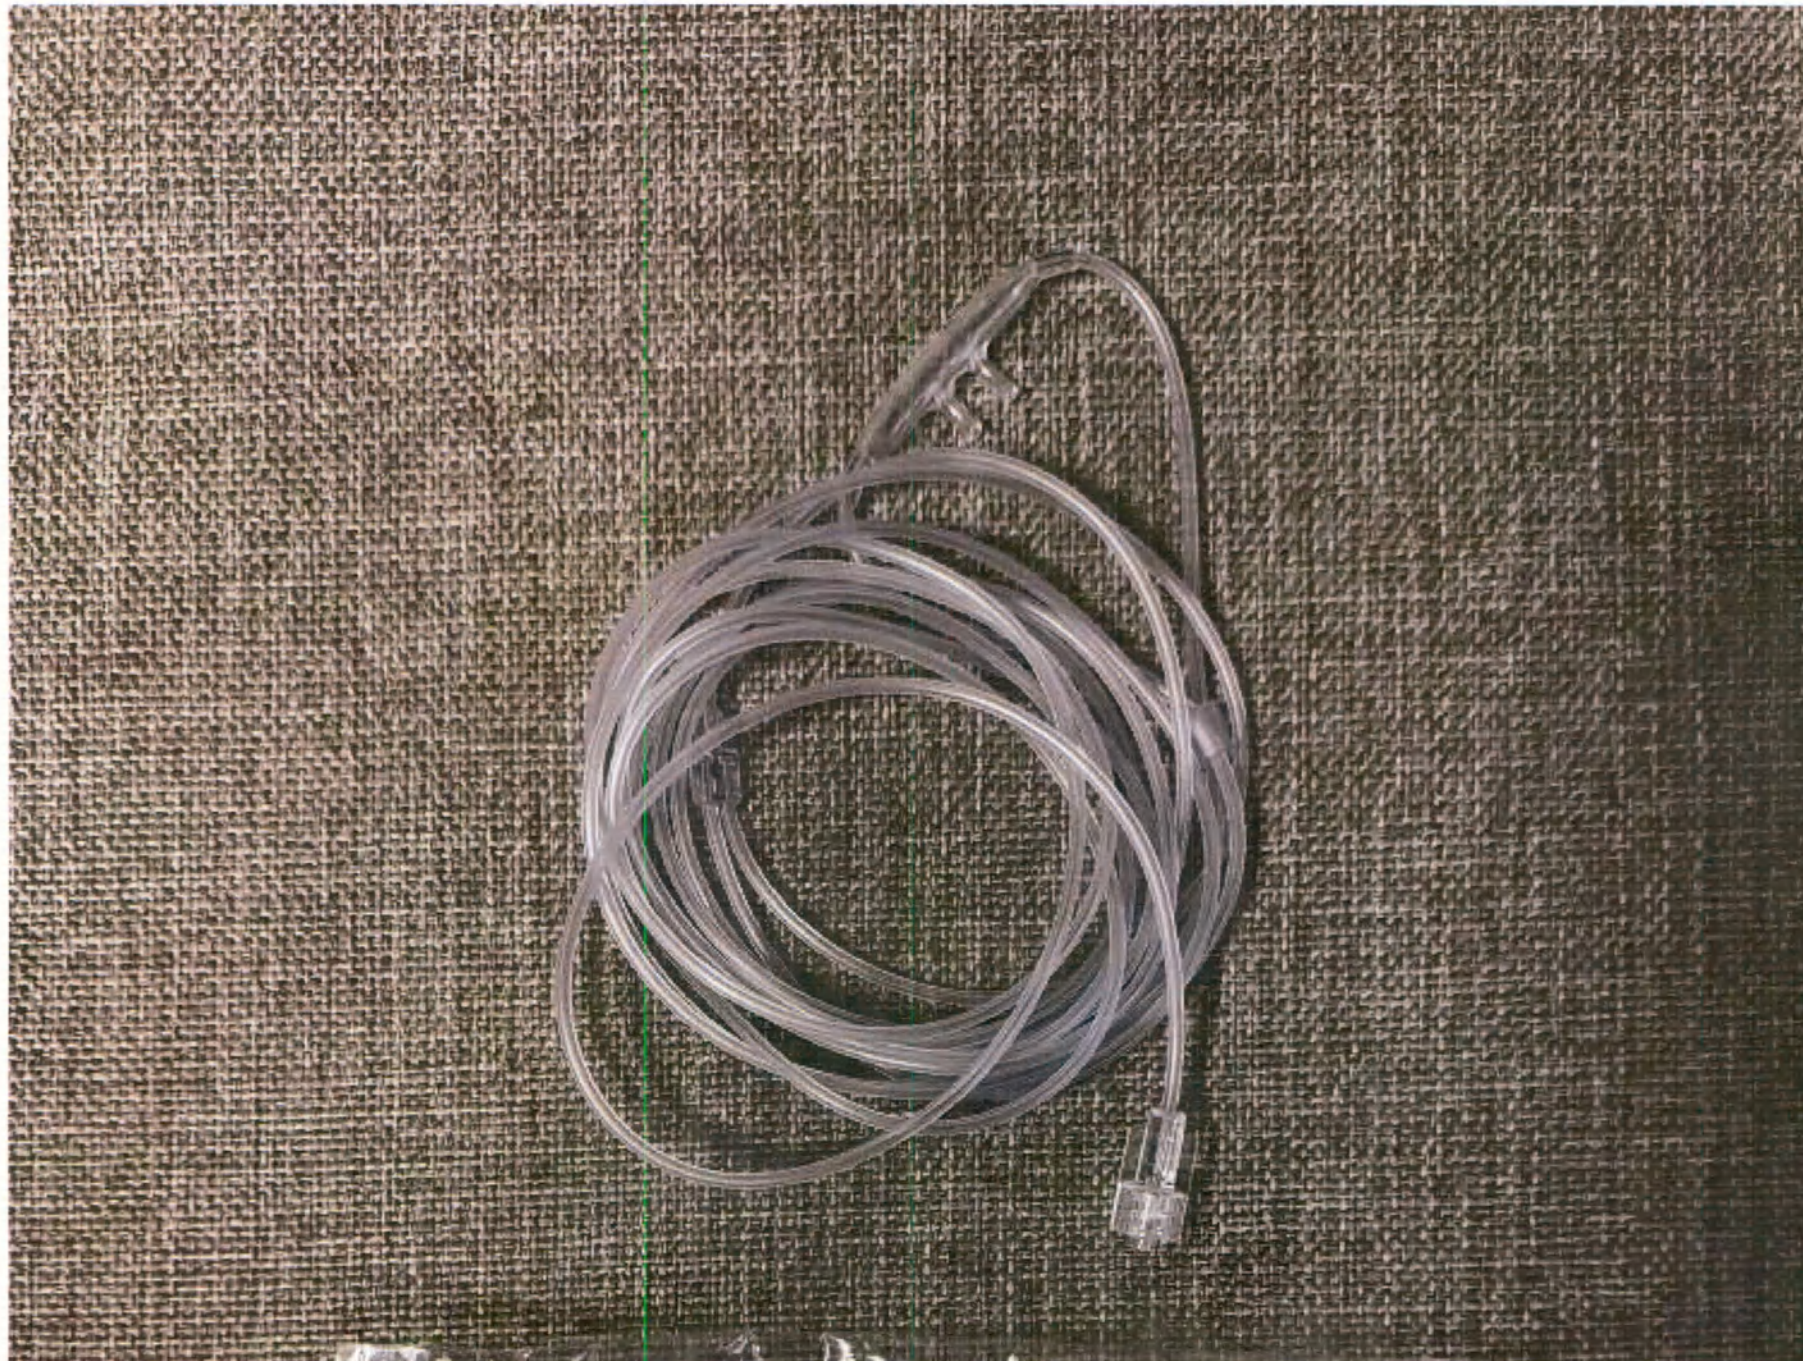


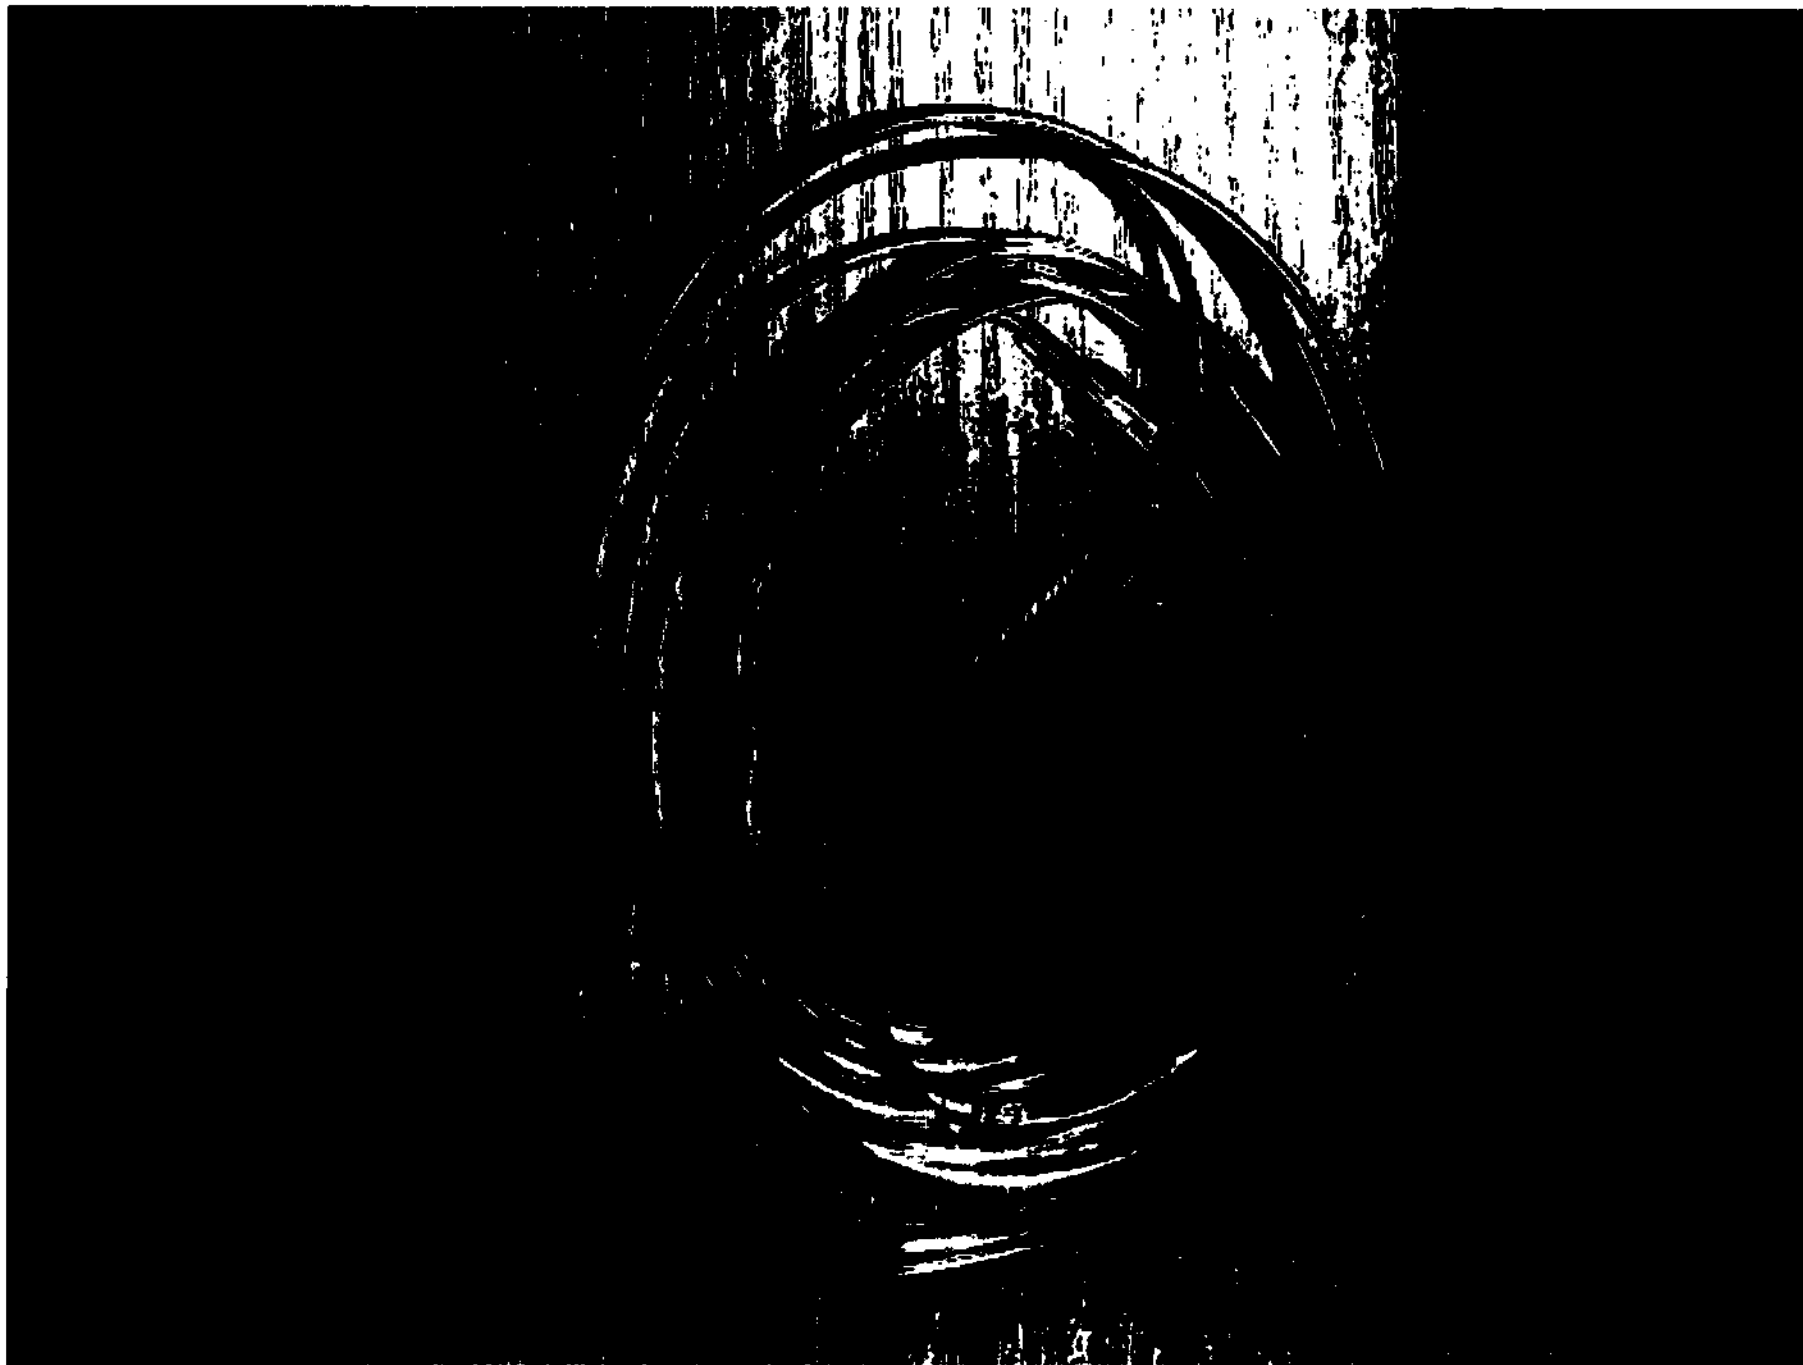







Держатель дыхательного контура

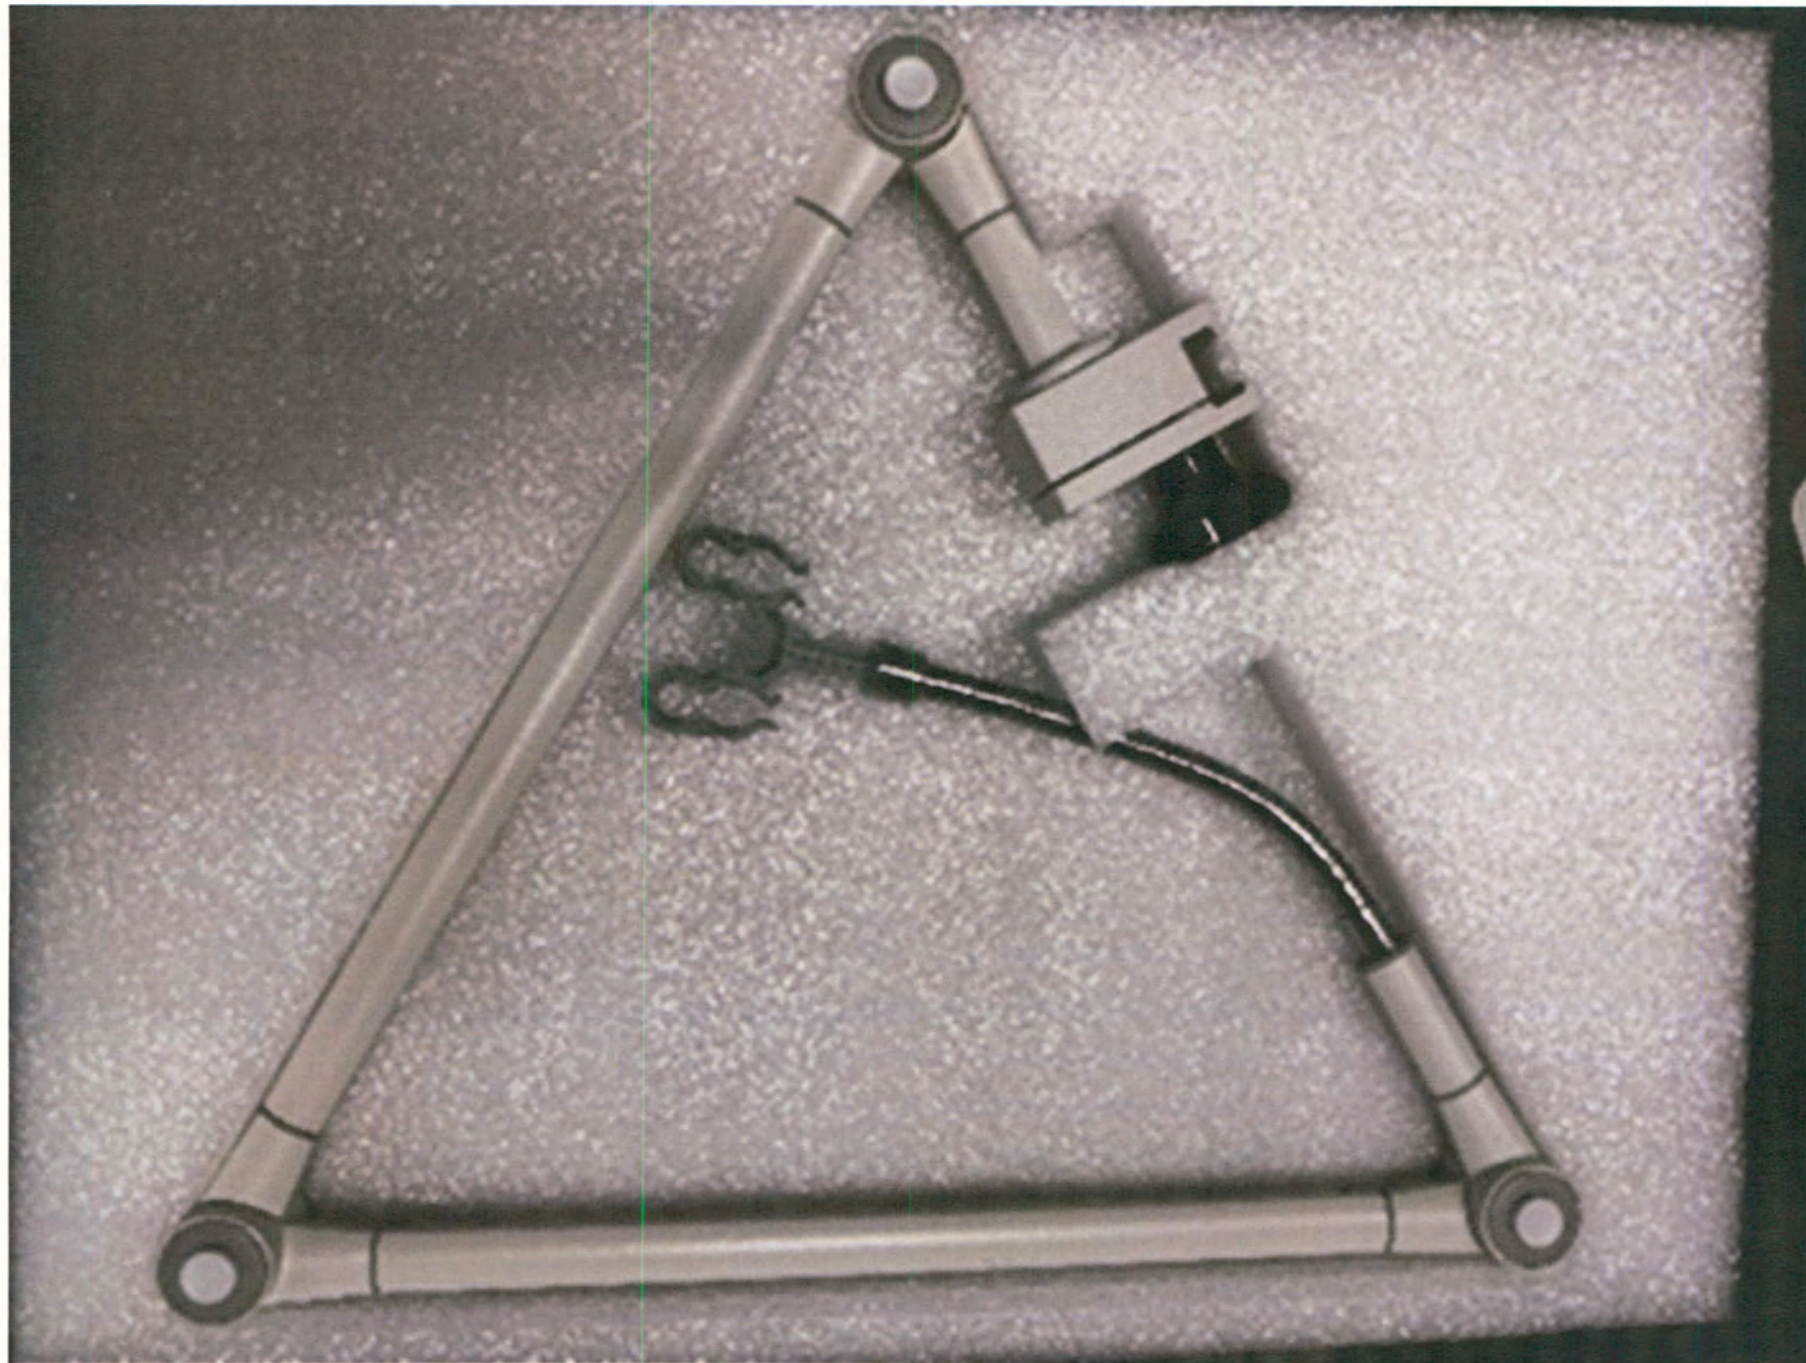


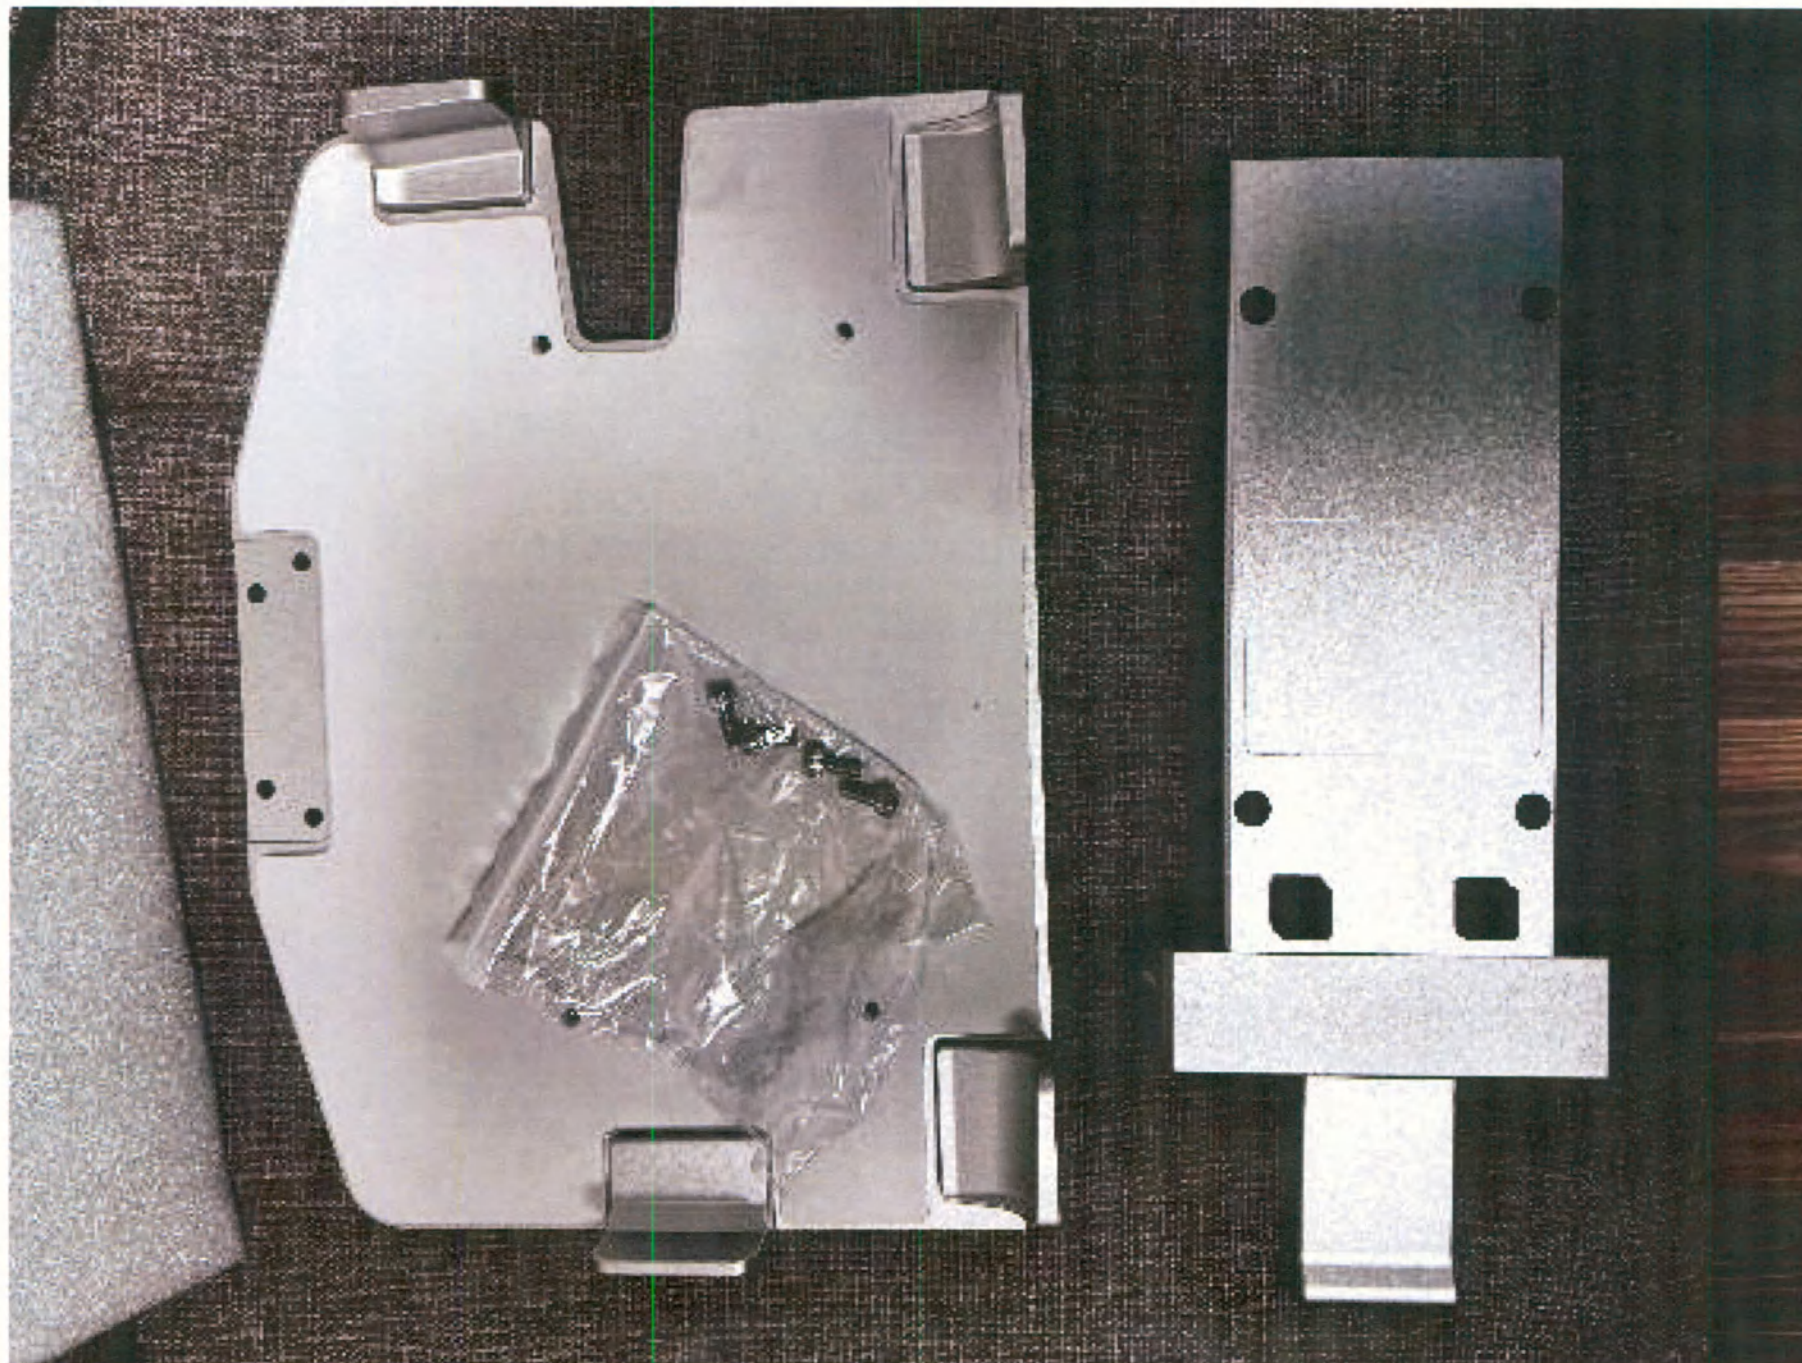




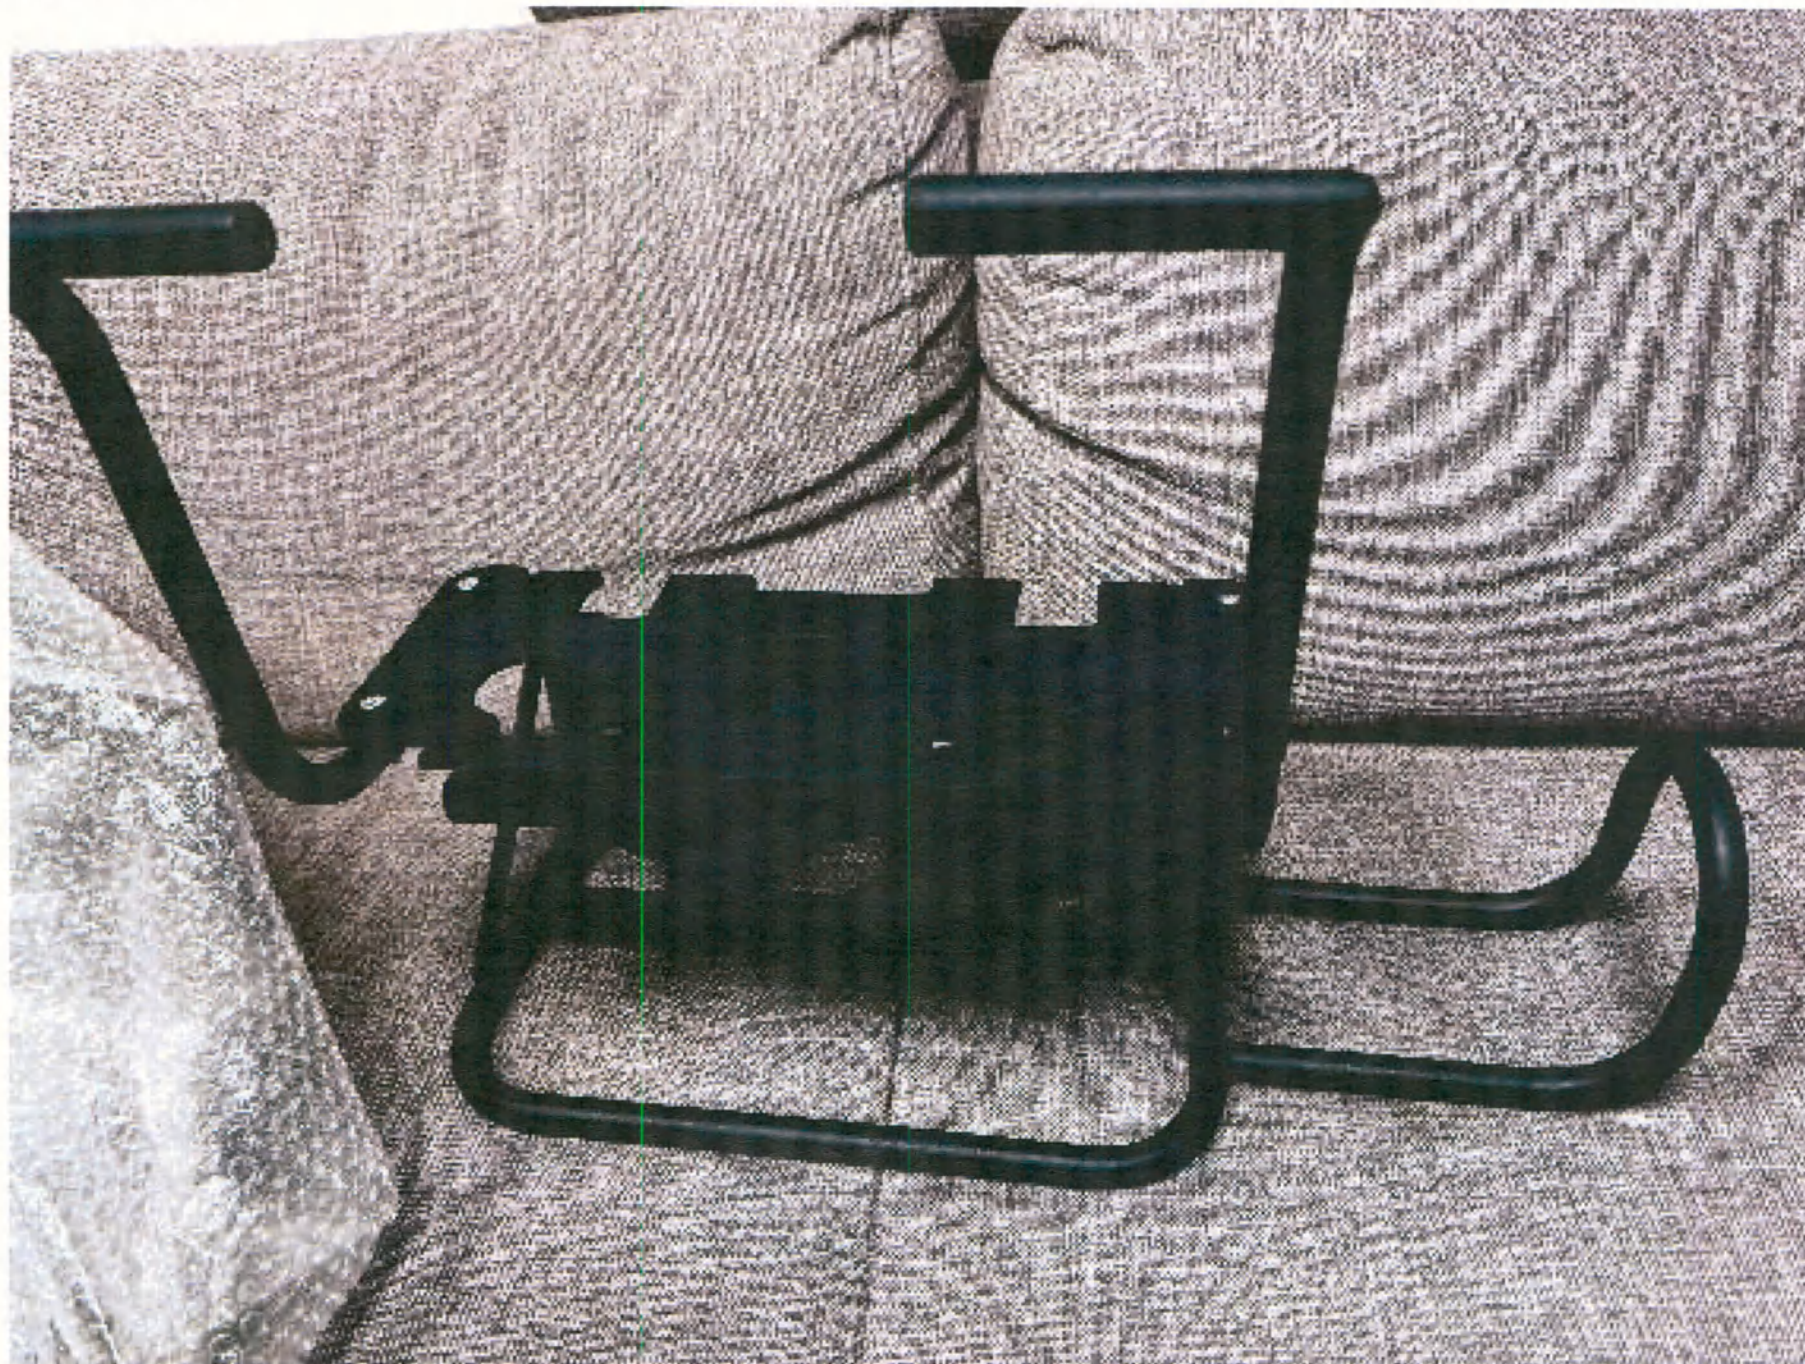


Кислородный баллон 2,5л (CGA870)

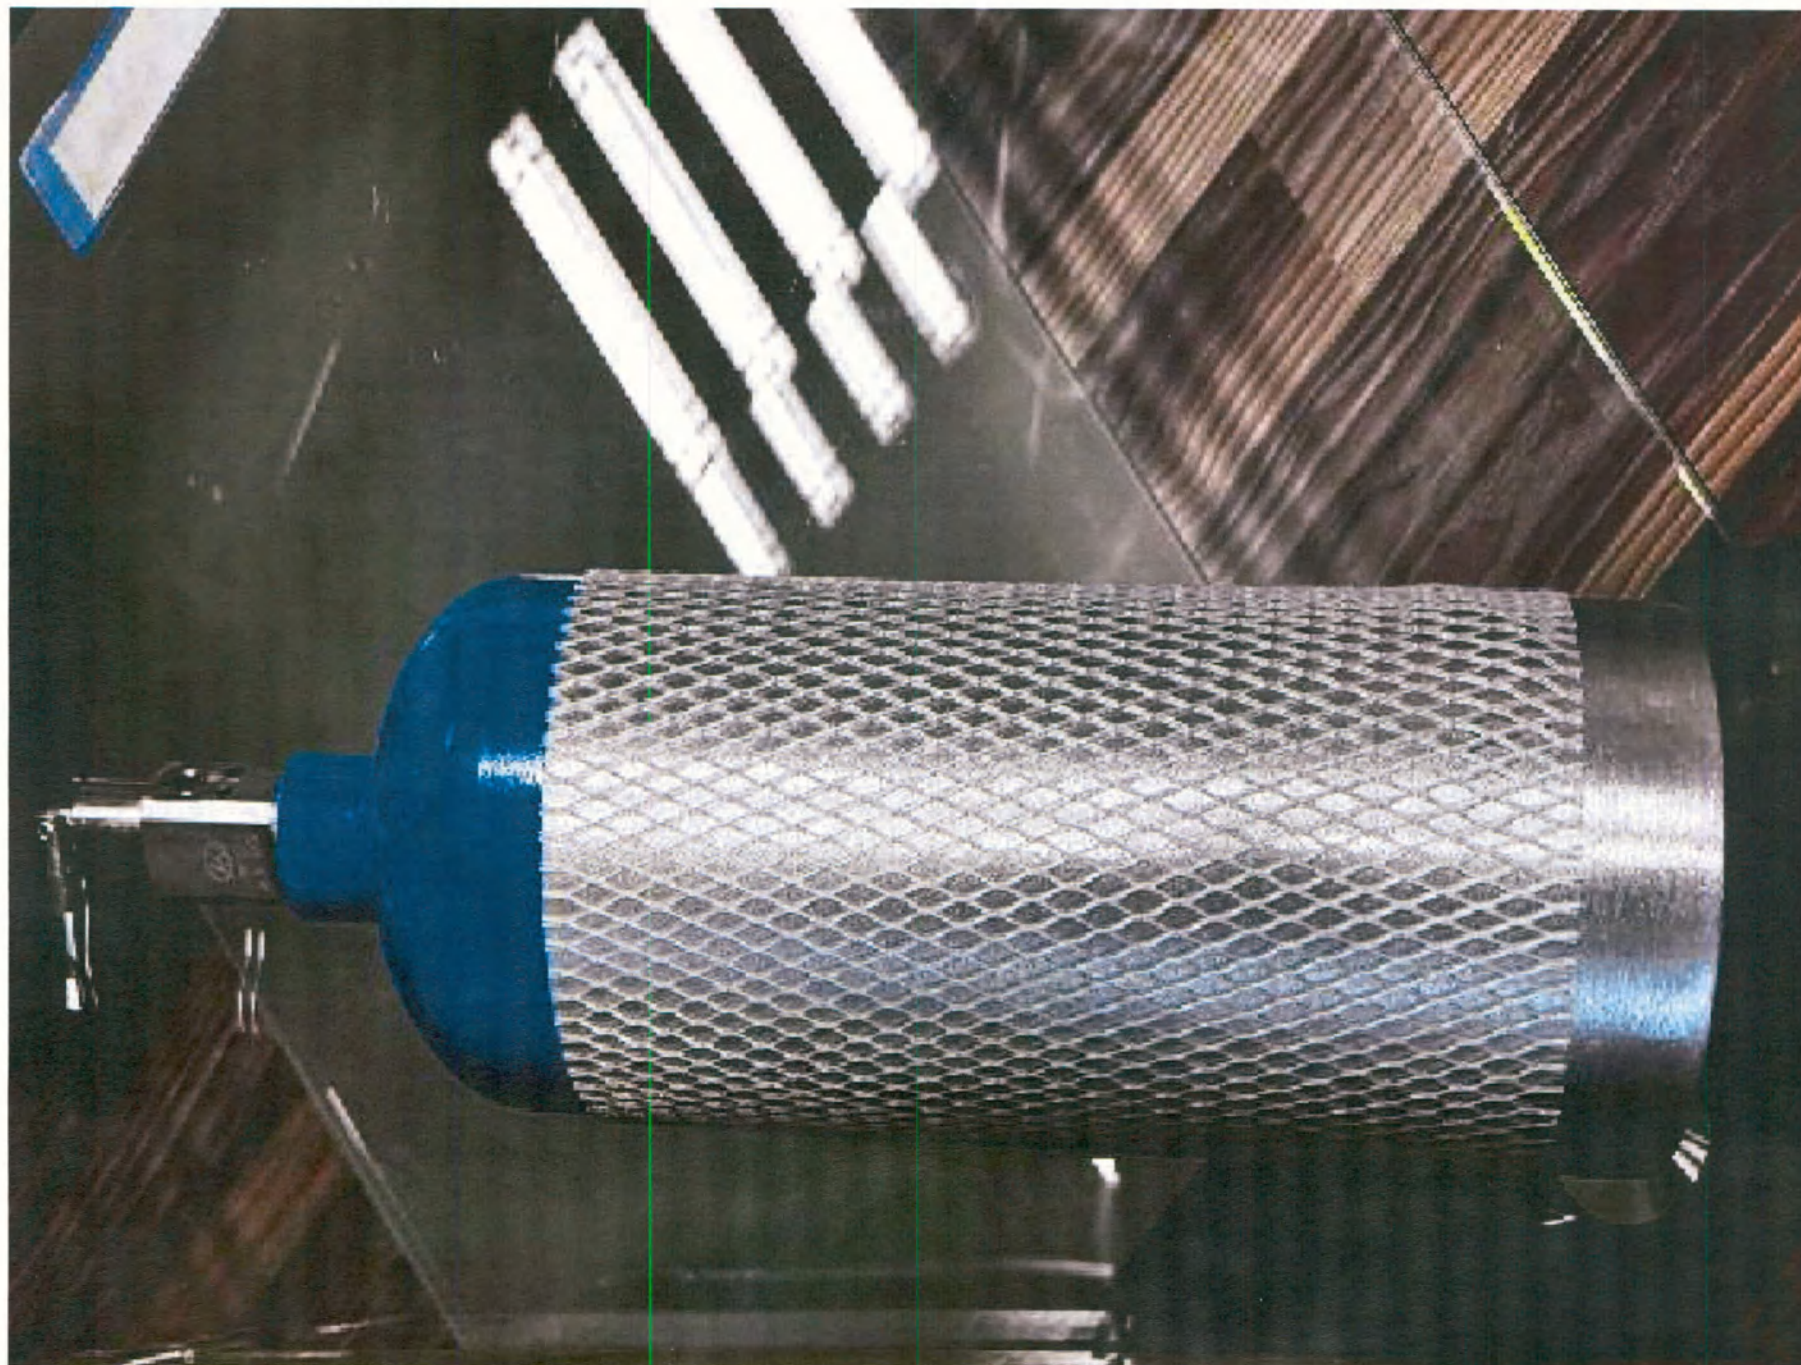


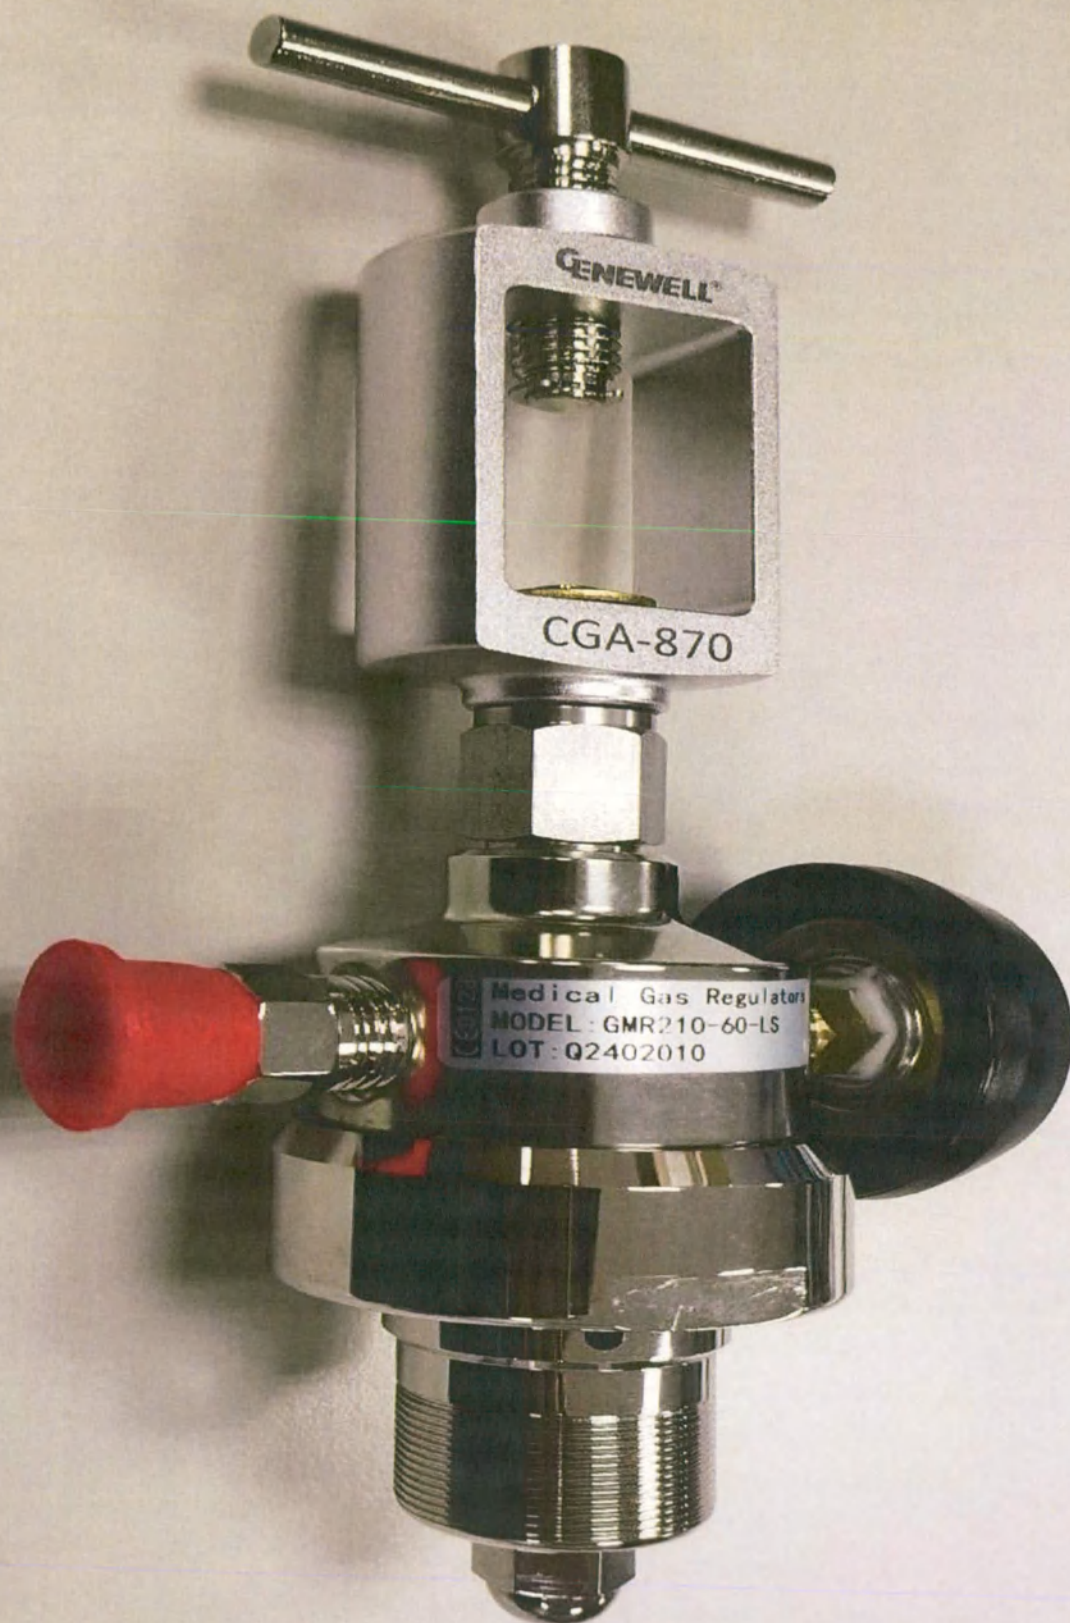

Клапан баллона для наполнения кислородом

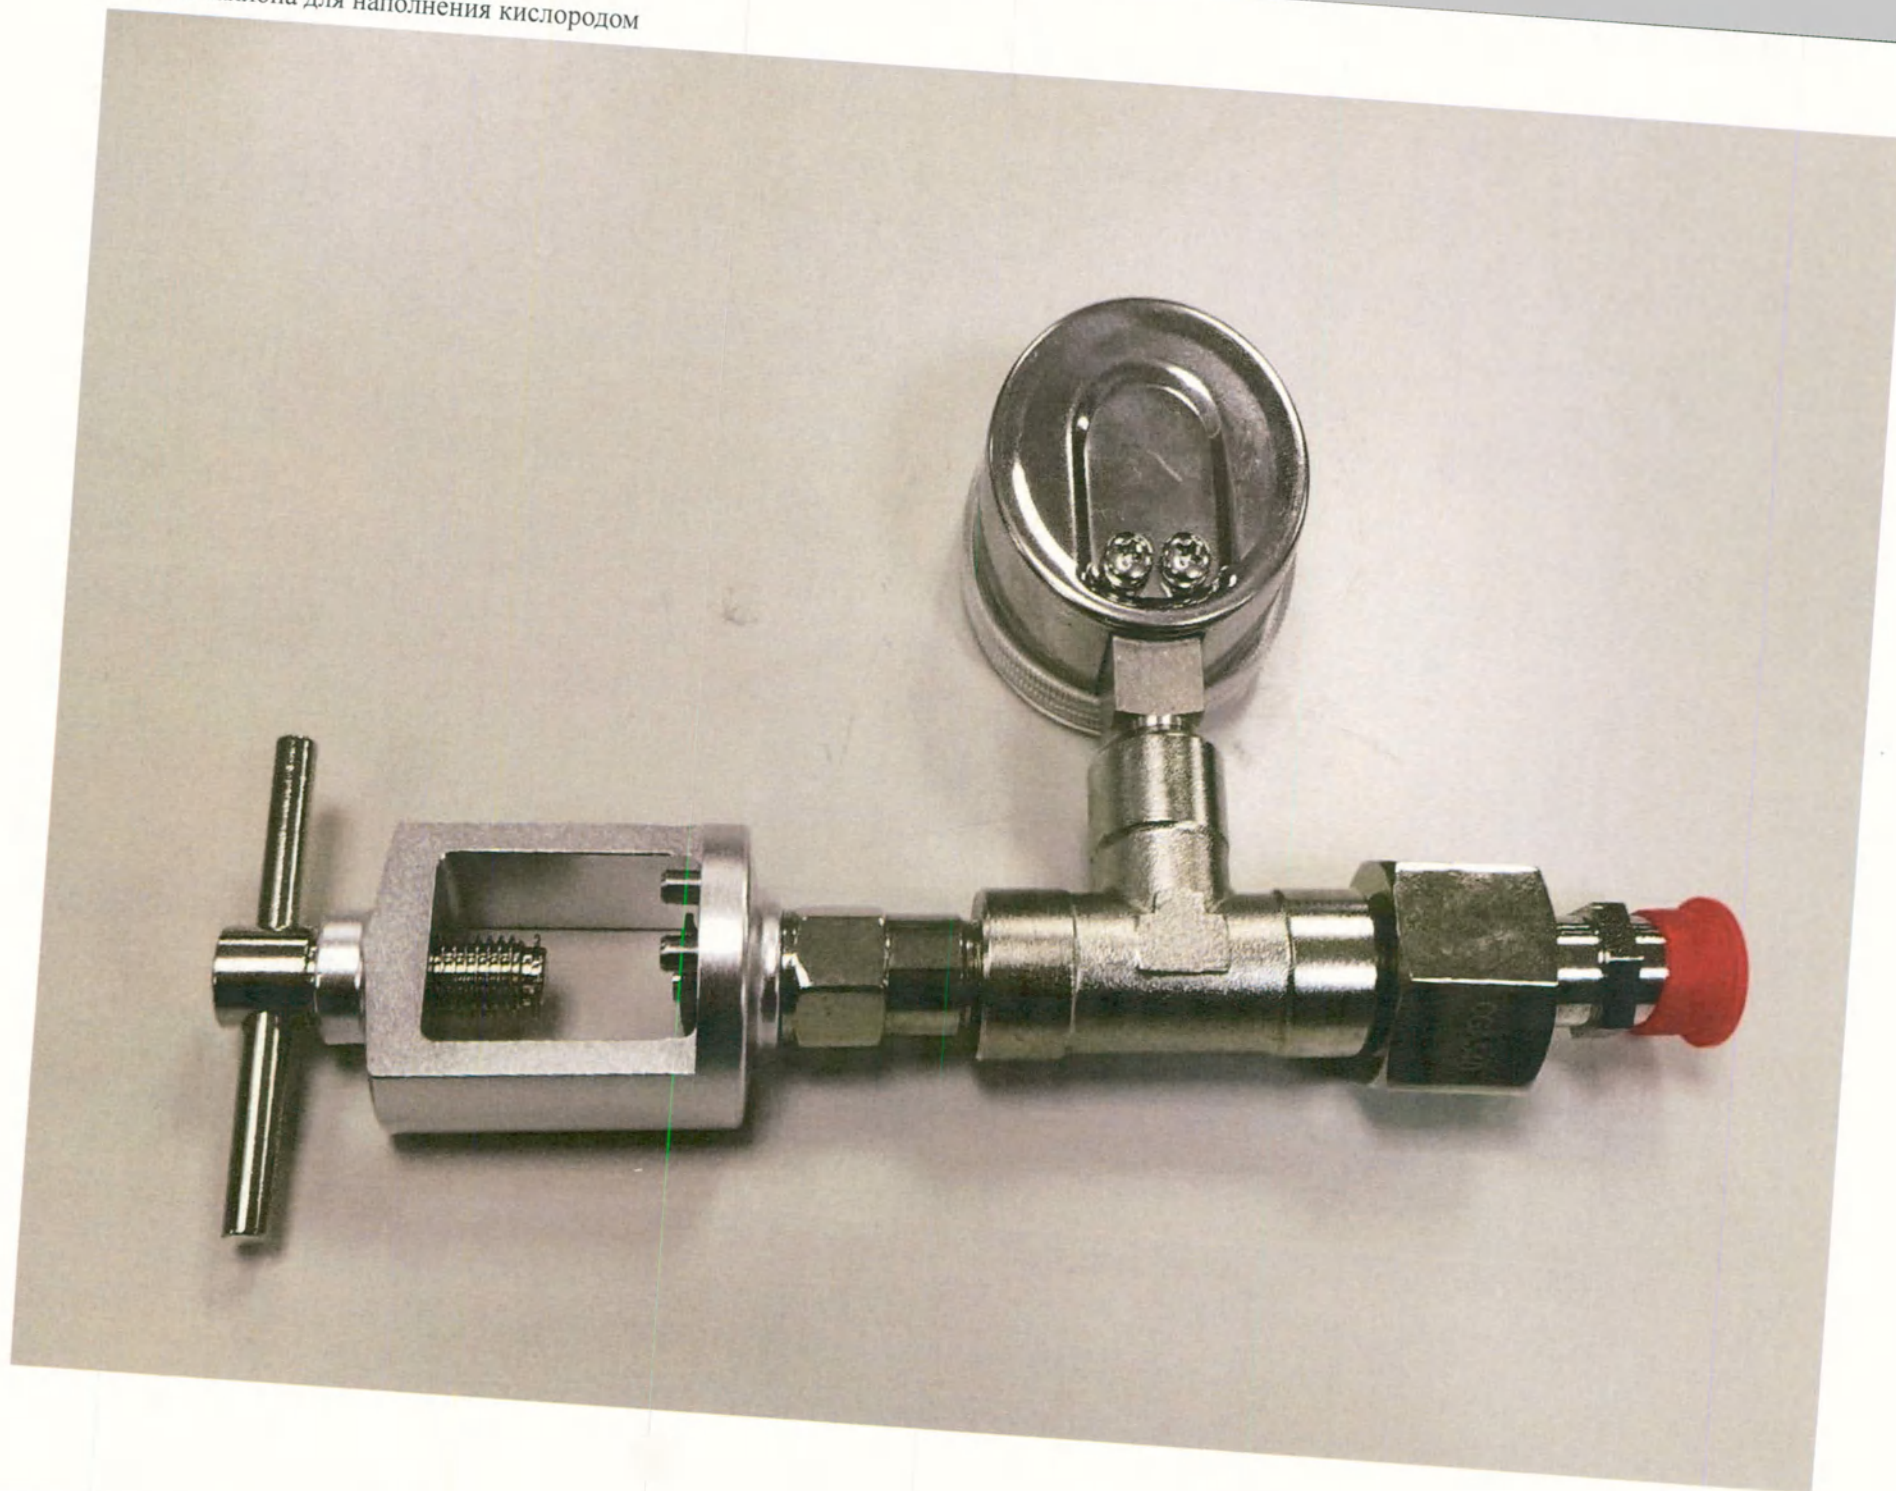

Кислородный газовый шланг для баллона

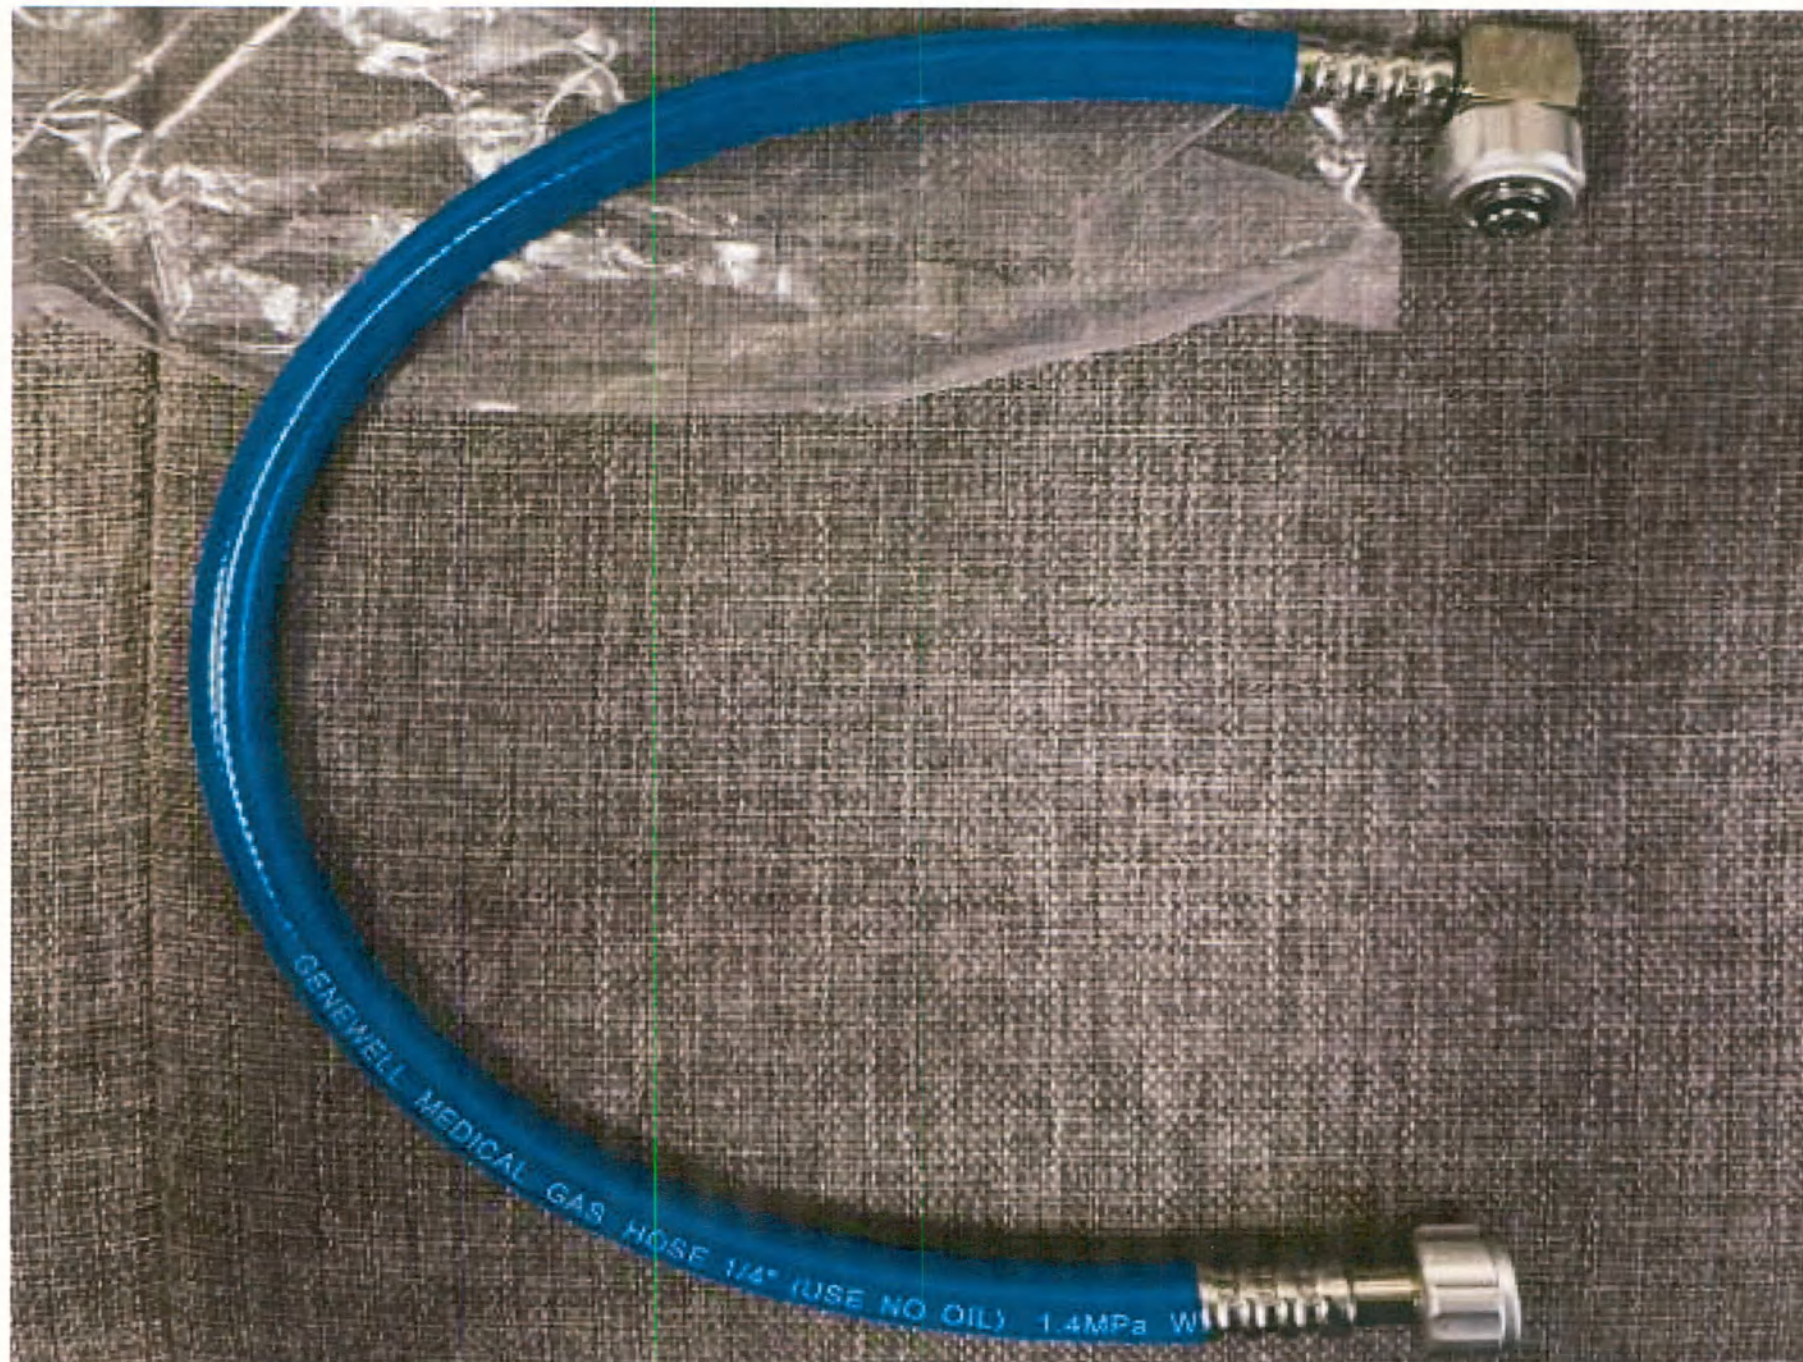





Датчик температуры (VH30T165)



Нагревательный кабель (VH30100)

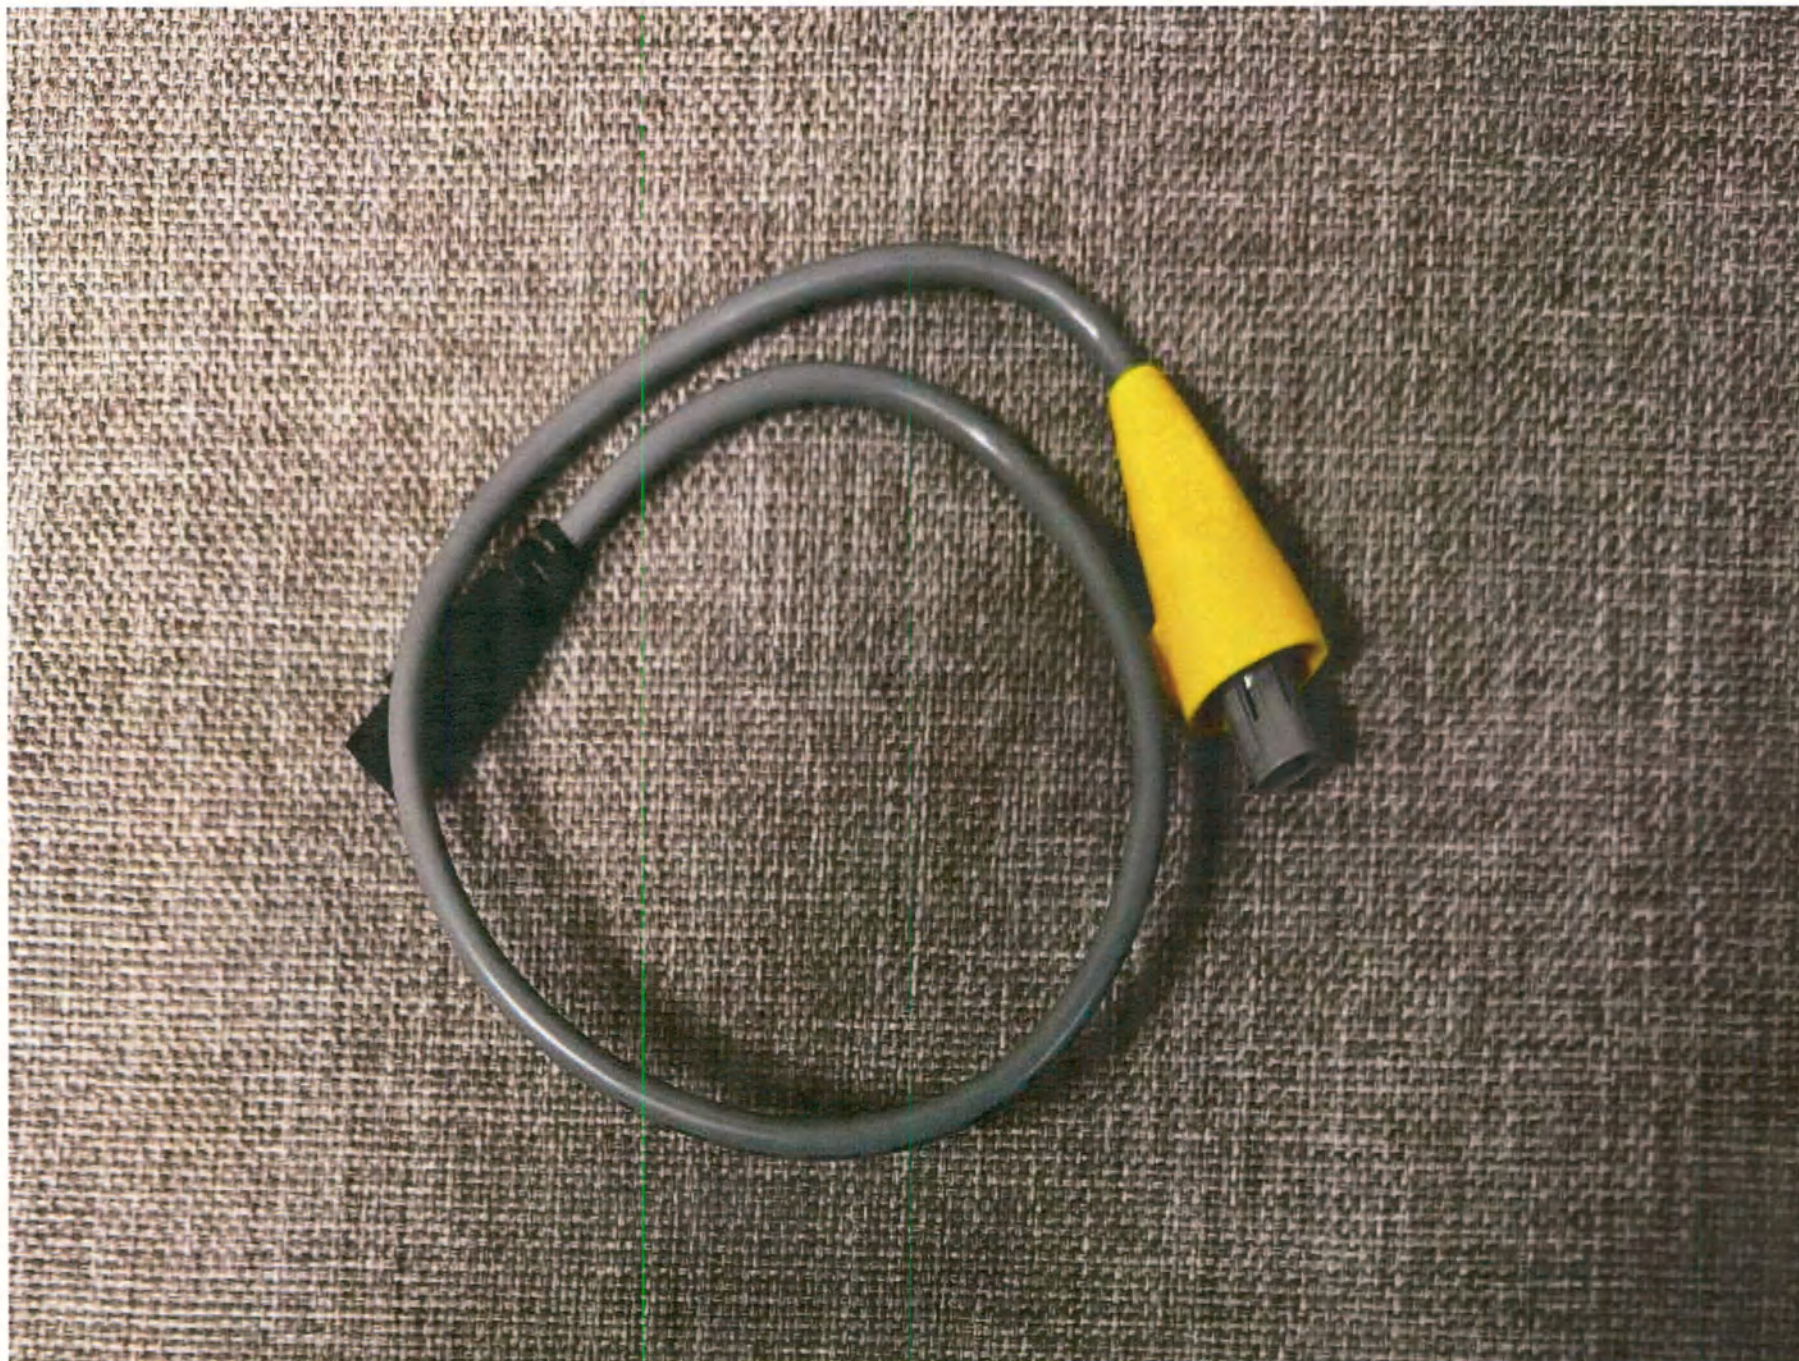


Многоразовая камера увлажнителя для новорожденных и детей (G-314005)

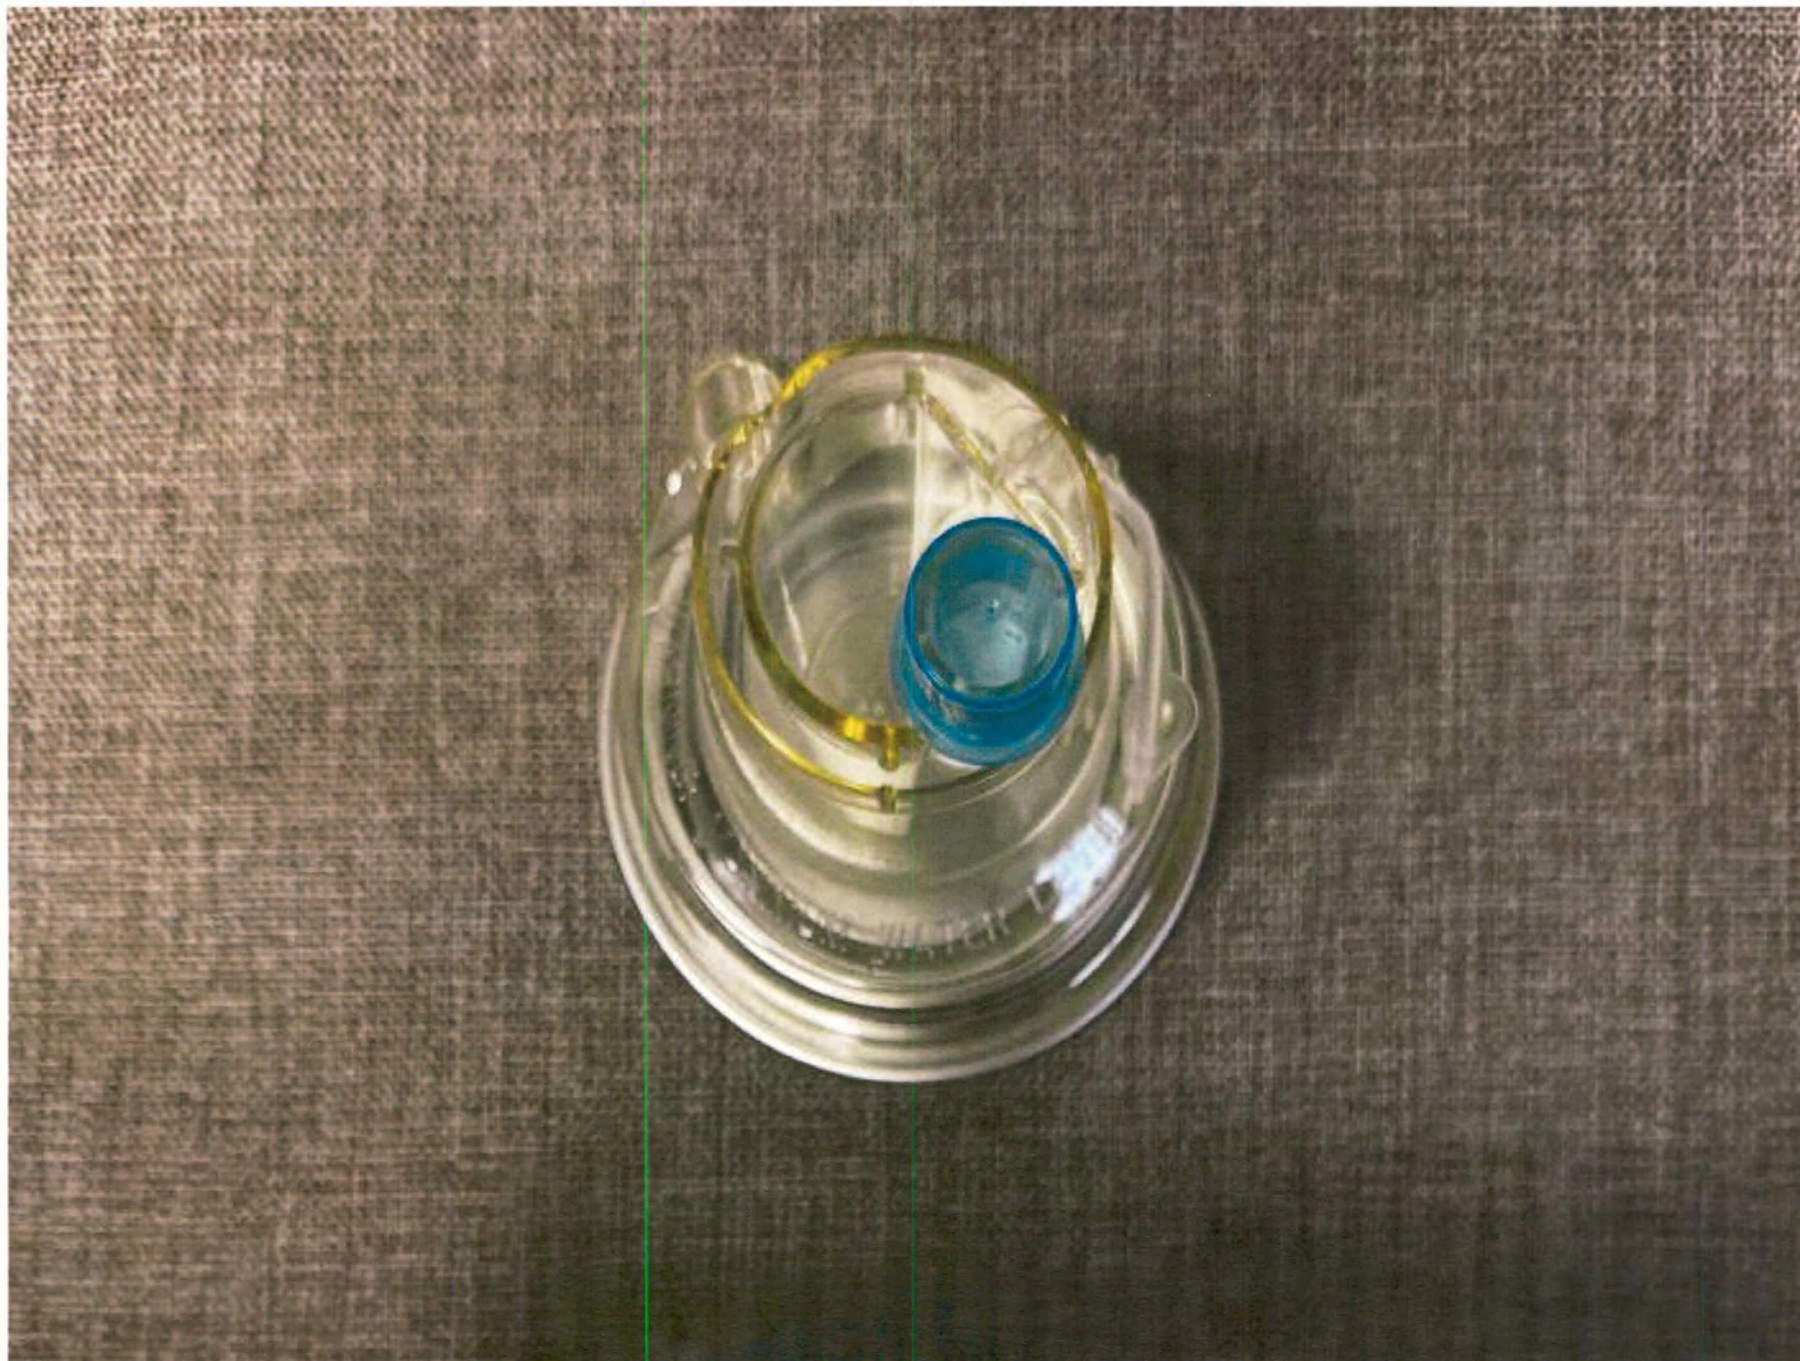






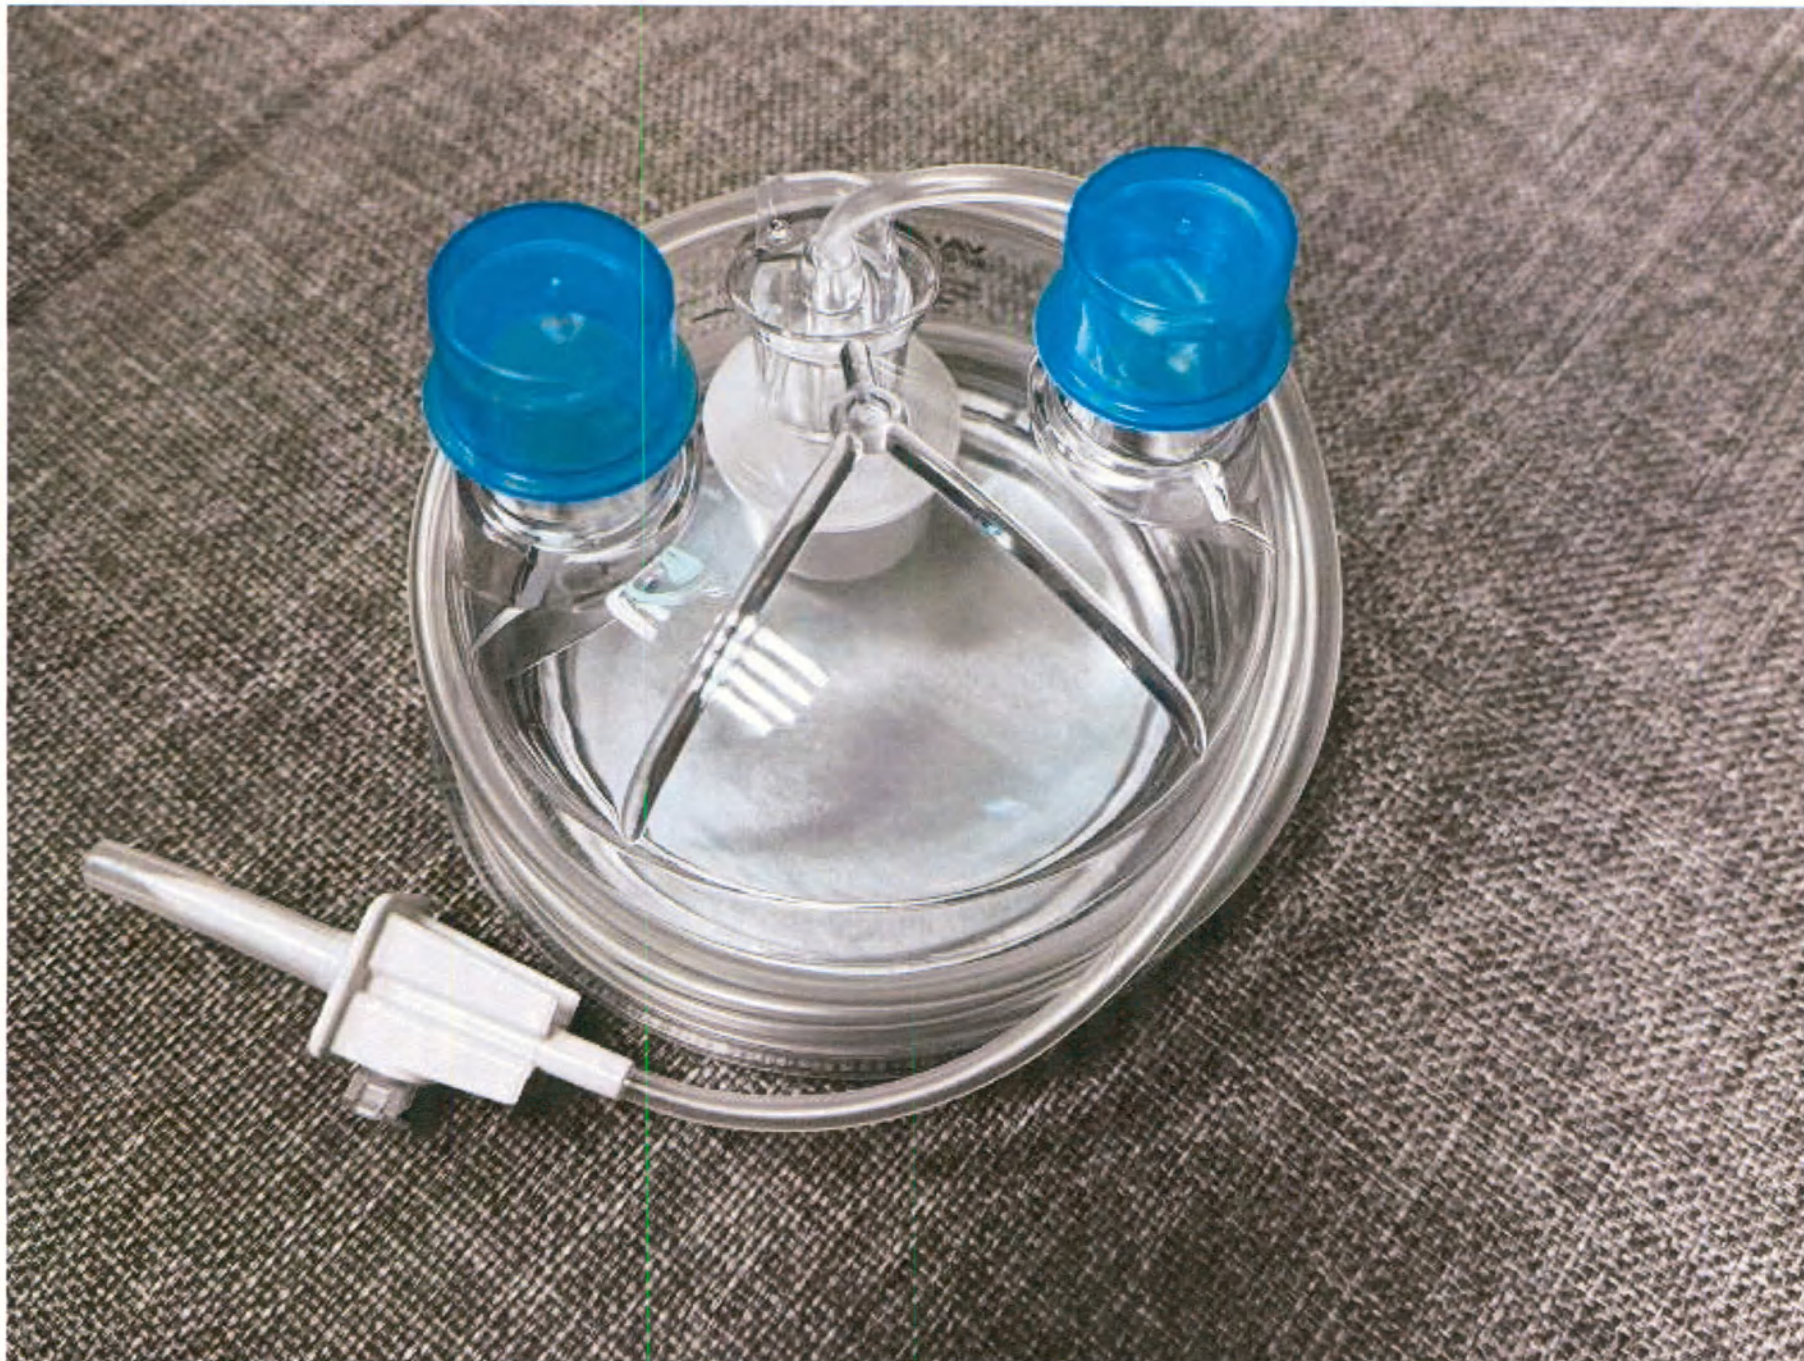


Одноразовый двухлинейный дыхательный контур с нагревательным проводом для новорожденных (G-219000-S)

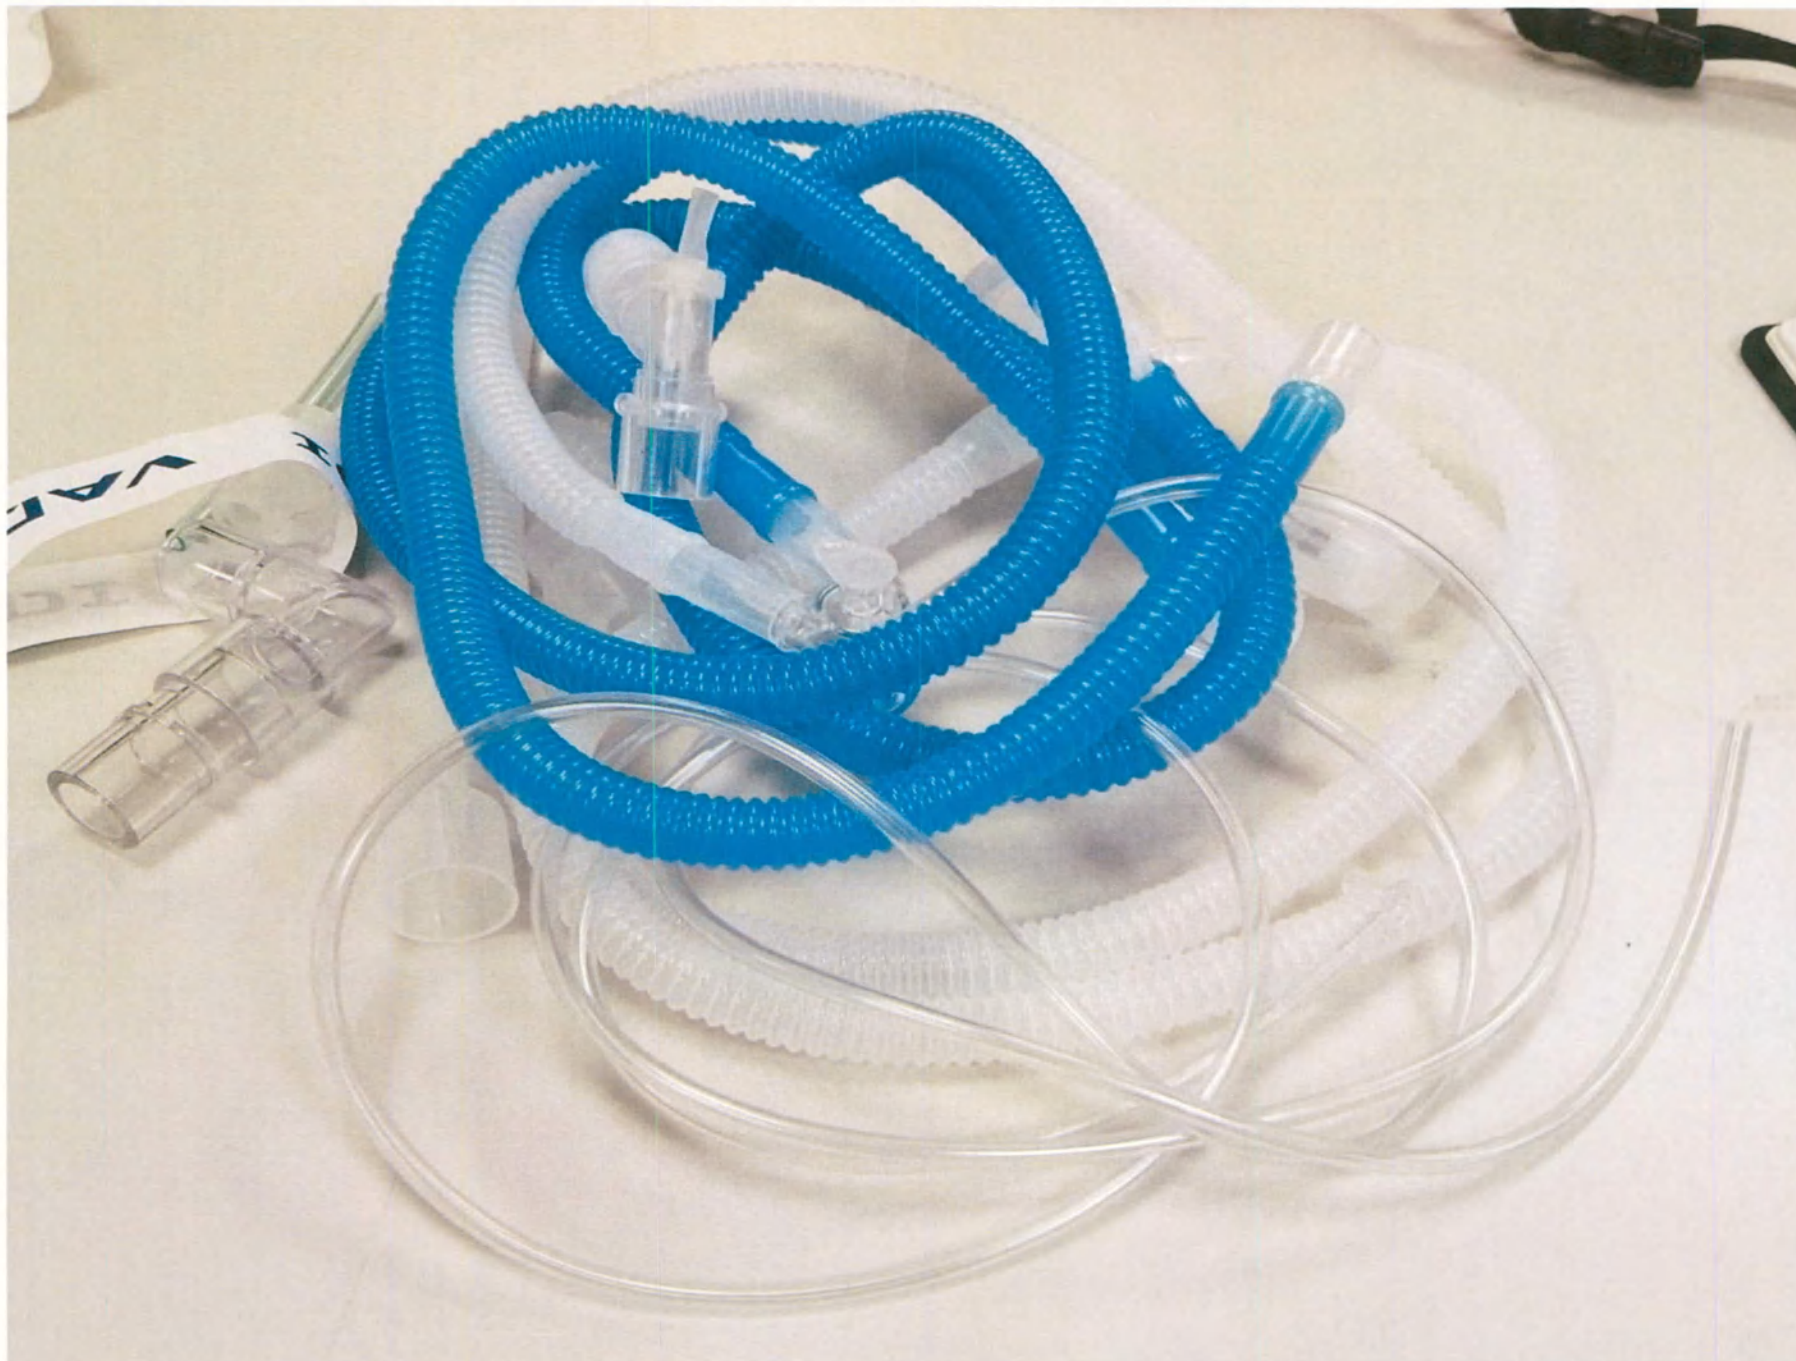





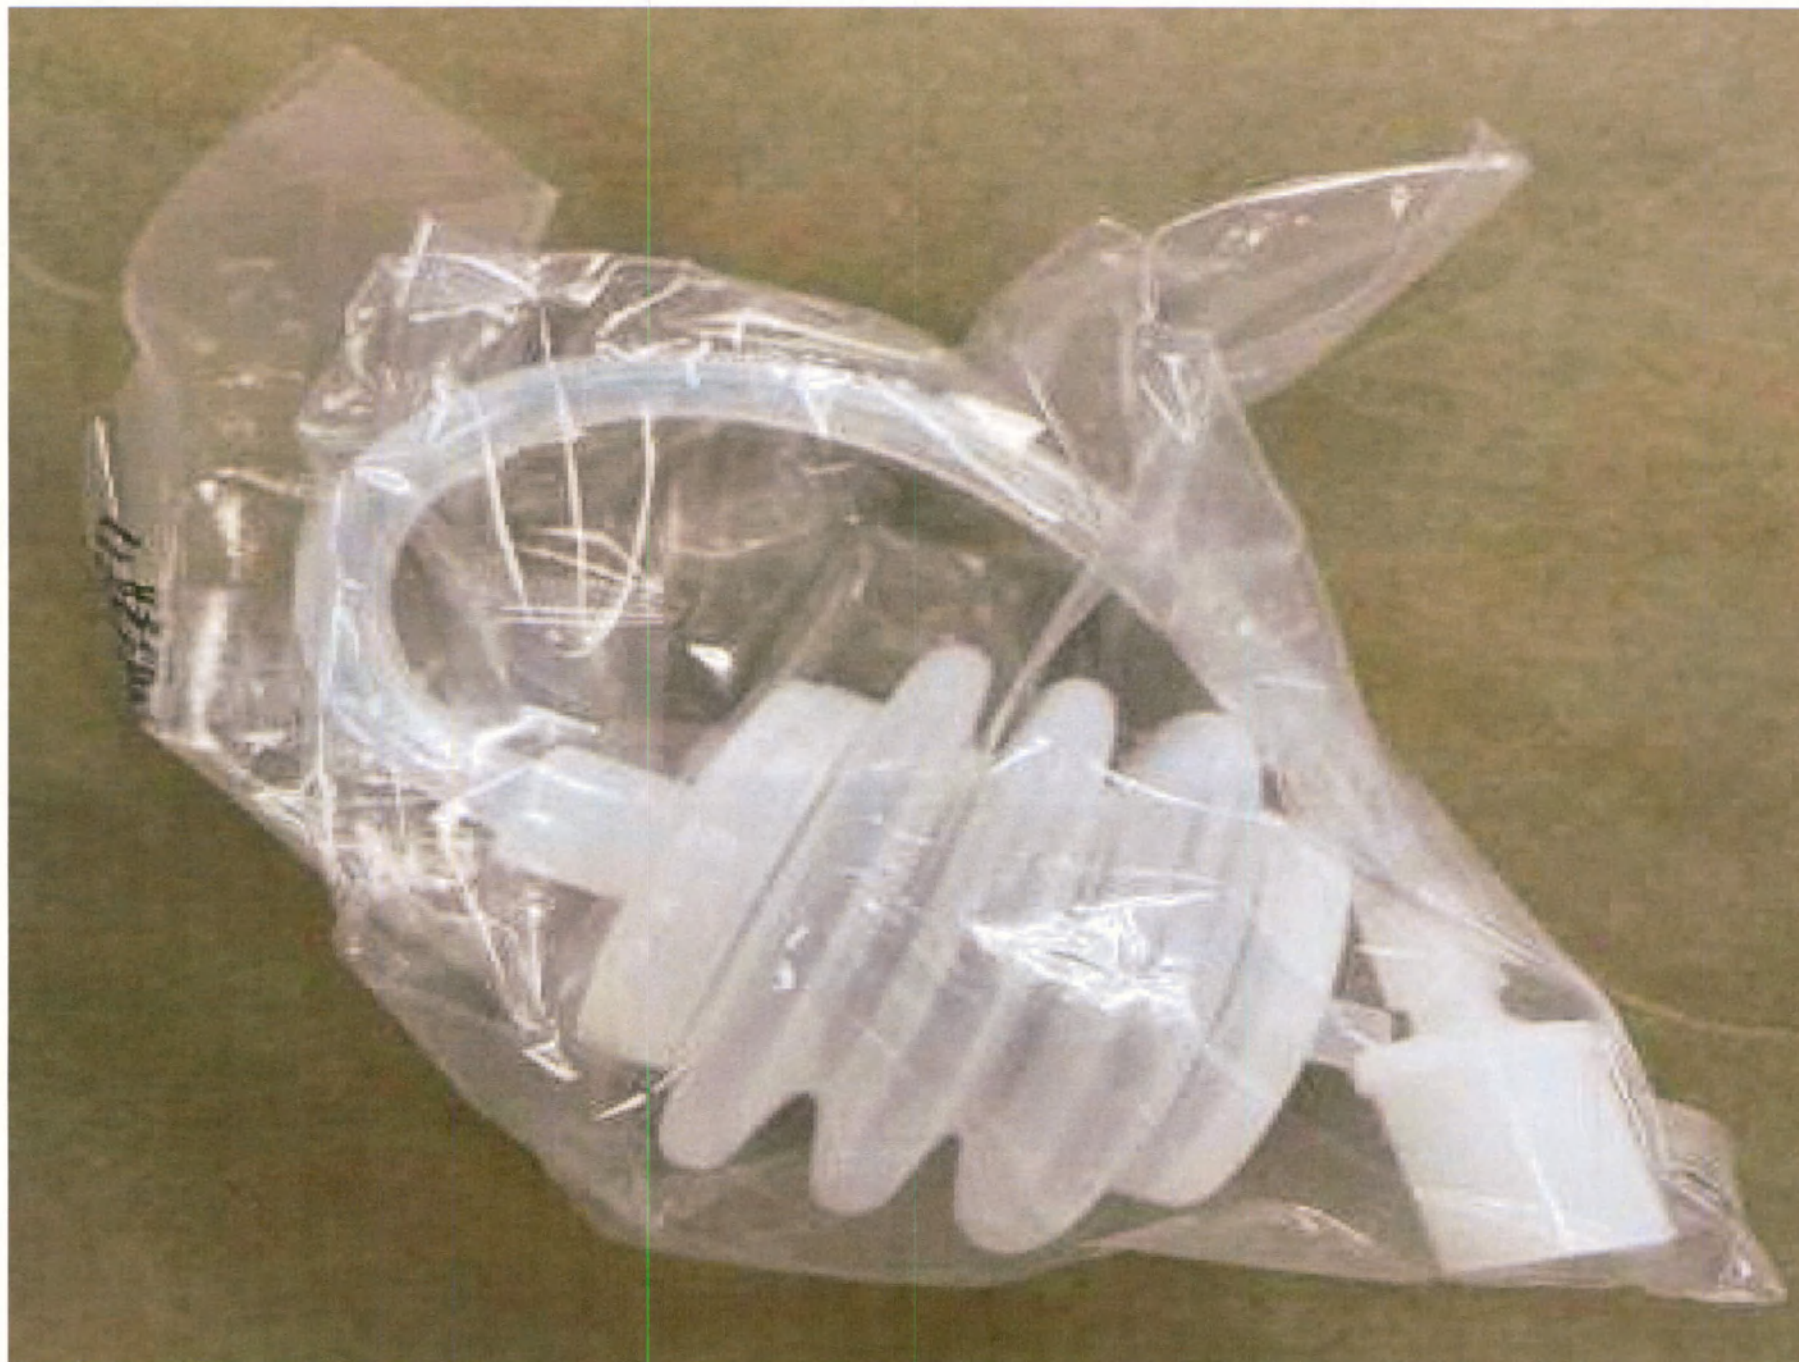






Одноразовый неонатальный дыхательный контур постоянного потока с обогревом (RT224)



Многоразовый однолинейный дыхательный контур для новорожденных (G-329000)

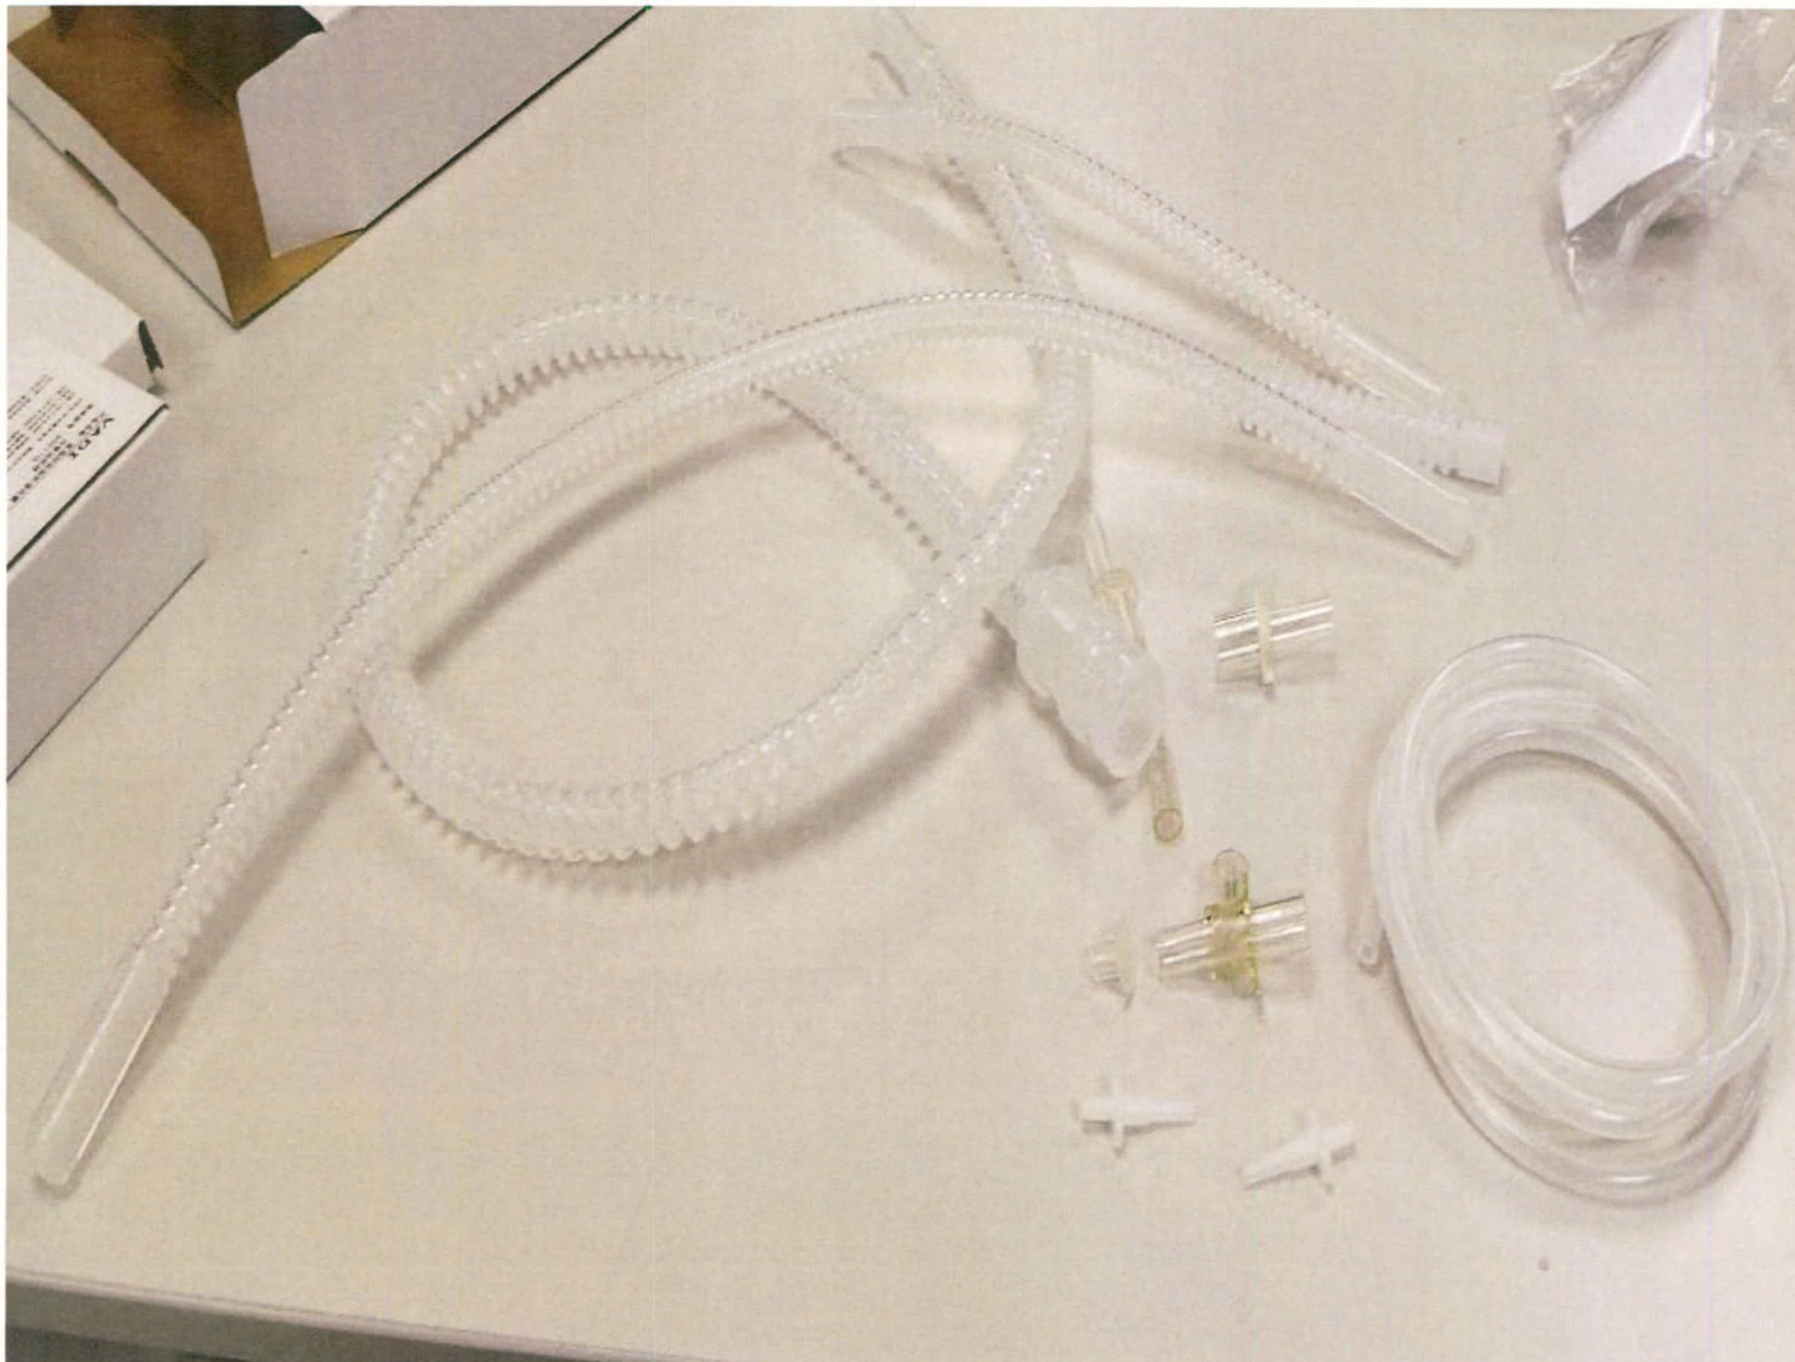


Многоразовый дыхательный контур с обогревом (RC-R-H1)



Одноразовый неонатальный дыхательный контур с обогревом (RT330)



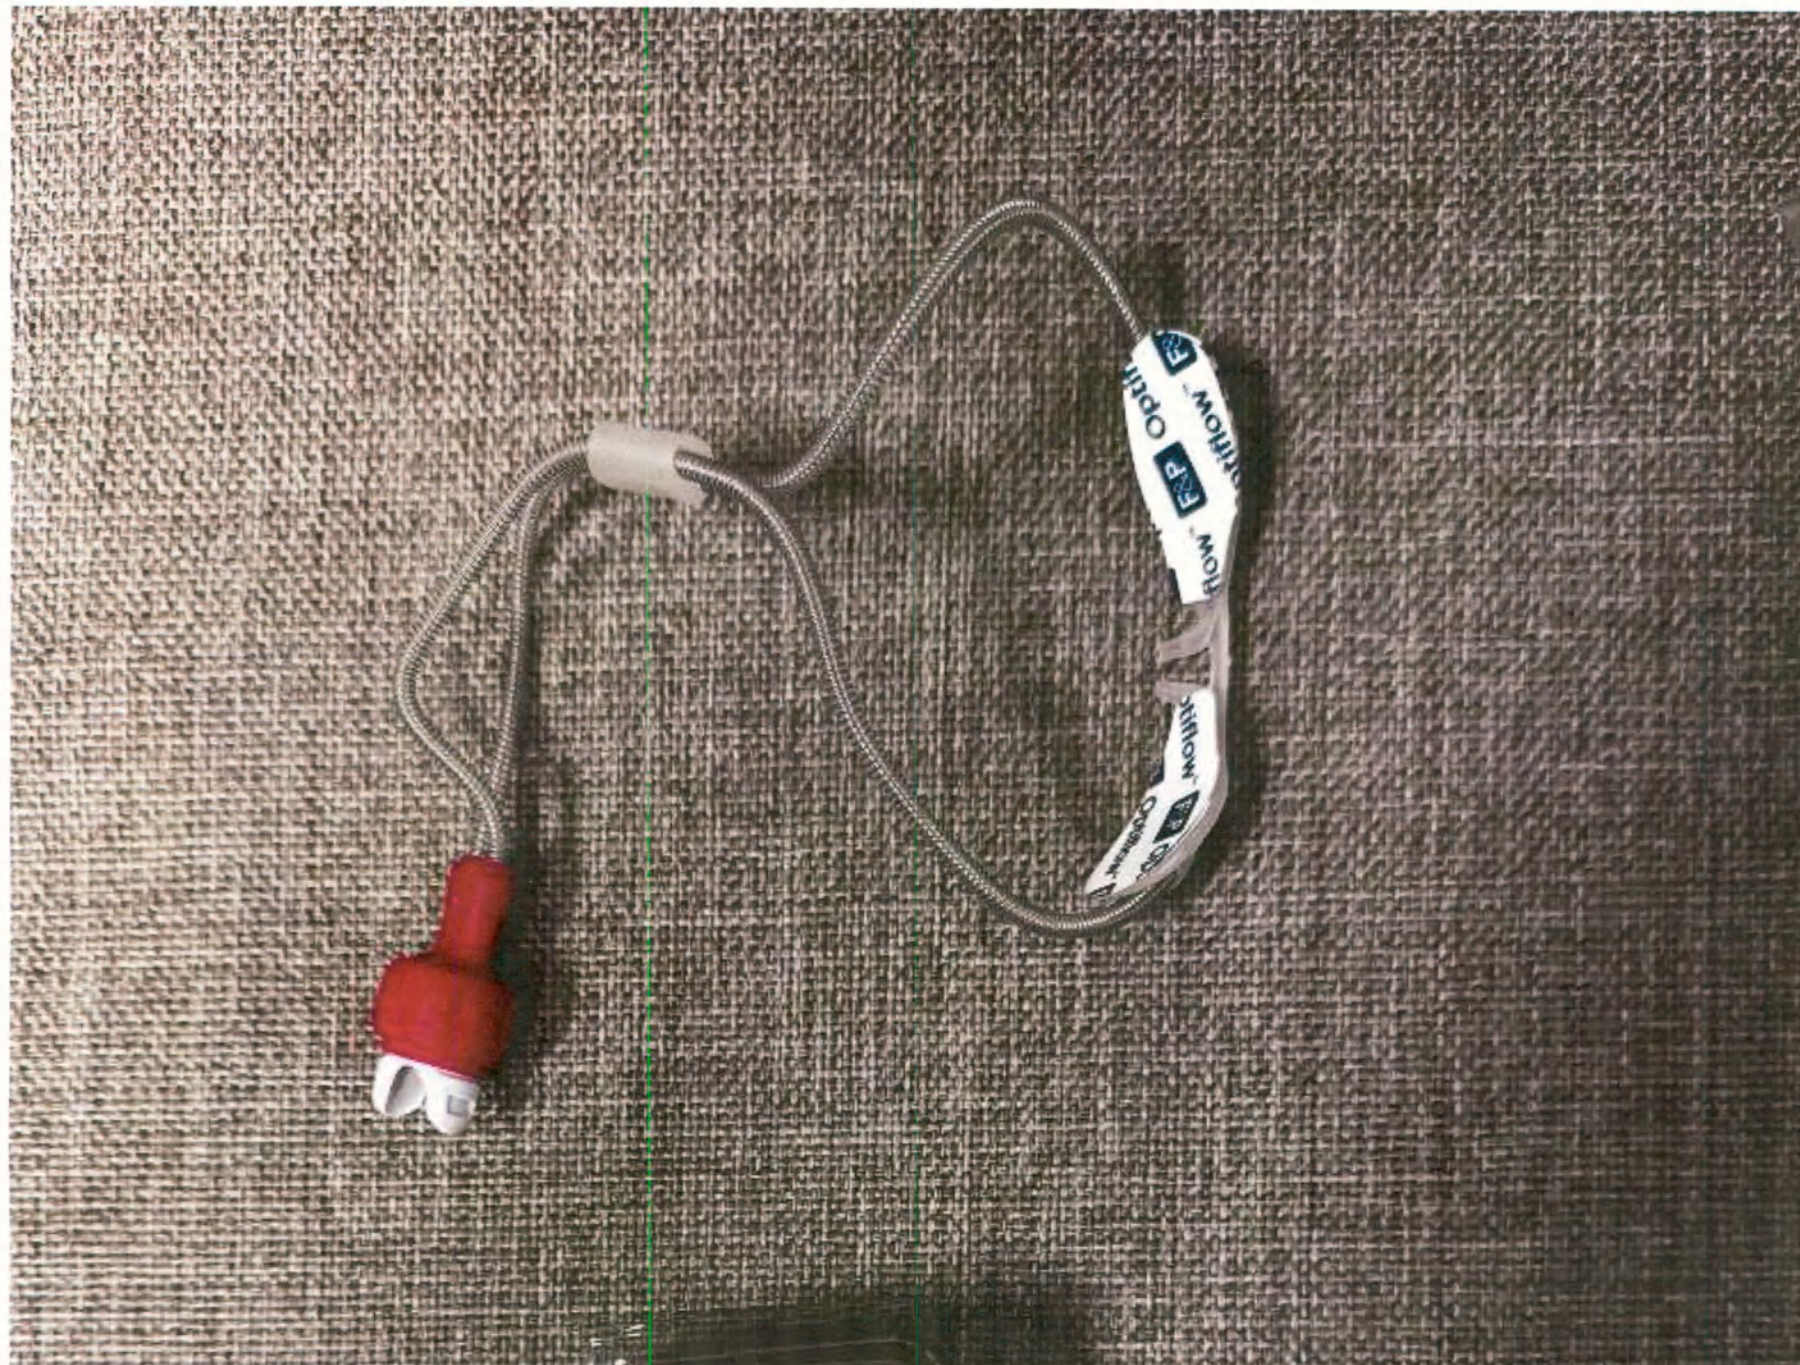







Пример макета основной маркировки на русском языке на примере: «Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи и транспортировки серии V, вариант исполнения: V1»

SN		COMEN
	SNYYMMDDXXX	
	YYYY.MM.DD	
Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи и транспортировки серии V, в вариантах исполнения: V1, V1D		
Вариант исполнения:		
<u>Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи и транспортировки V1</u>		
Входное напряжение: 100–240 В~ Входная частота: 50/60 Гц Входной ток: 1,8~0,75 А Потребляемая мощность: 50 ВА стандартный, 180 ВА максимальный		     IP34
	Shenzhen Comen Medical Instrument Co., Ltd. (Шэньчжэнь Камен Медикал Инструментс Ко., Лтд.) Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China	
Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС» (ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС») 117342, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 52, стр. 3		
Регистрационное удостоверение № XXXXXX от XX.XX.XXXX г.		


Пример макета маркировки на русском языке стерильных компонентов из состава медицинского изделия на примере: «Одноразовый бактериальный фильтр»,

LOT		COMEN
	XXXXXXXX	 
	YYYY.MM.DD	 YYYY.MM.DD
Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи и транспортировки серии V, в вариантах исполнения: V1, V1D		
Вариант исполнения: _____		
Одноразовый бактериальный фильтр		
MD	 	STERILE EO
	Shenzhen Comen Medical Instrument Co., Ltd. (Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.) Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guandong, 518106, P.R.China	
Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС» (ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС») 117342, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 52, стр. 3		
Регистрационное удостоверение № XXXXXX от XX.XX.XXXX г.		

Пример макета маркировки на русском языке нестерильного изделия на примере: «Назальная канюля для проб CO2 для взрослых

LOT		COMEN
XXXXXXX		 
 YYYY.MM.DD	 YYYY.MM.DD	
Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи и транспортировки серии V, в вариантах исполнения: V1, V1D		
Вариант исполнения: _____		
Назальная канюля для проб CO2 для взрослых		
MD	 	
	Shenzhen Comen Medical Instrument Co., Ltd. (Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.) Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China	
Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС» (ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС») 117342, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 52, стр. 3		
Регистрационное удостоверение № XXXXXX от XX.XX.XXXX г.		

Пример макета маркировки транспортной упаковки на русском языке на примере: «Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи и транспортировки серии V, вариант исполнения: V1

SN	 SNYYMMDDXXX	COMEN		
	YYYY.MM.DD			
Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи и транспортировки серии V, в вариантах исполнения: V1, V1D				
Вариант исполнения:				
<u>Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи и транспортировки V1</u>				
	Shenzhen Comen Medical Instrument Co.,Ltd. (Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.) Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China			
Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС» (ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС») 117342, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 52, стр. 3				
Регистрационное удостоверение № XXXXXX от XX.XX.XXXX г.				
				

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 84

_____ листах

