

Фотографические изображения медицинского изделия

**Цитофлуориметр проточный CellRiver для диагностики in vitro по ТУ
26.51.53-001-24537644-2024**

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ЛАБВИЖН»

Христинченко О.И.

(подпись и печать)



Цитофлуориметр проточный CellRiver (2 лазера, 6 флуоресцентных параметров) (общий вид)



Цитофлуориметр проточный CellRiver (3 лазера, 14 флуоресцентных параметров) (общий вид)



Цитофлуориметр проточный CellRiver (2 лазера, 6 флуоресцентных параметров) (макет маркировки)

Цитофлуориметр проточный CellRiver для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-001-24537644-2024

Вариант исполнения: Цитофлуориметр проточный CellRiver (2 лазера, 6 флуоресцентных параметров)

Ток питания:

Напряжение 220-240 В

Частота 50/60 Гц

Мощность не более 160 Вт

SN

REF



IPX0



ООО «ЛАБВИЖН»

197046, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Посадский, пер Певческий, д. 12, литера А, помещ. 3-Н, часть помещения 10, офис 404

Дата производства: _____

IVD

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Цитофлуориметр проточный CellRiver (3 лазера, 14 флуоресцентных параметров) (макет маркировки)

Цитофлуориметр проточный CellRiver для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-001-24537644-2024

Вариант исполнения: Цитофлуориметр проточный CellRiver (3 лазера, 14 флуоресцентных параметров)

Ток питания:
Напряжение 220-240 В
Частота 50/60 Гц
Мощность не более 160 Вт

SN

REF



IPX0



ООО «ЛАБВИЖН»

197046, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Посадский, пер Певческий, д. 12, литера А, помещ. 3-Н, часть помещения 10, офис 404

Дата производства: _____

IVD


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Бутылка для очищающего раствора в составе:

Бутылка

Крышка

Трубка

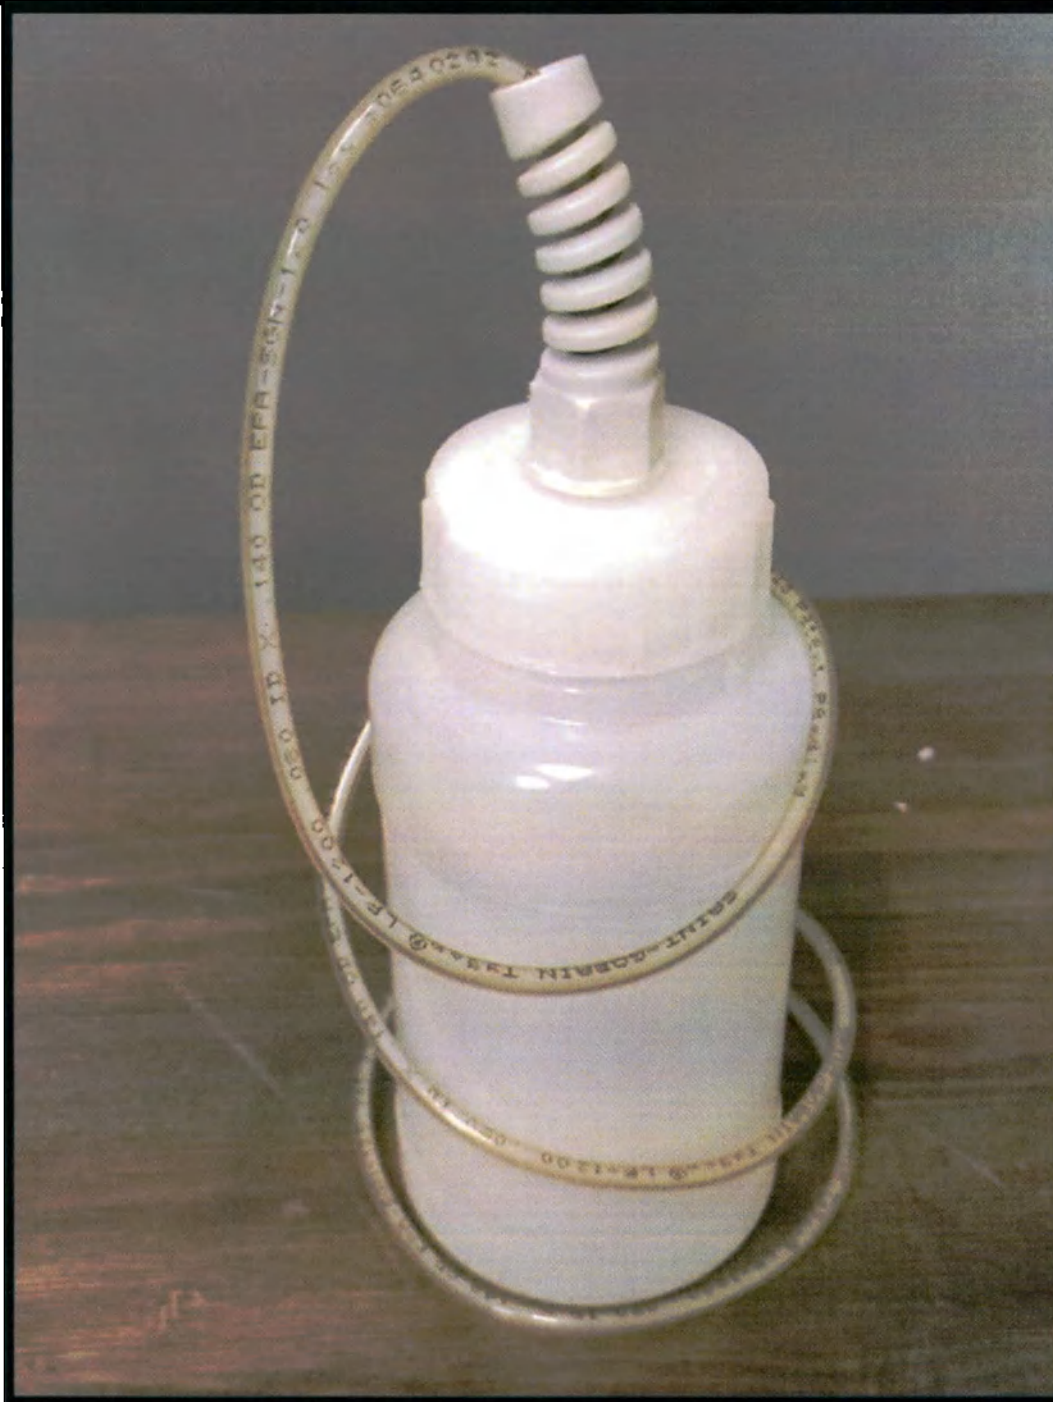

Канистра для проточной жидкости



Каннестра для отходов




Комплект проводки с датчиком уровня проточной жидкости в составе:

Датчик уровня проточной жидкости

Трубка

"Канистра для проточной жидкости в составе: Крышка"

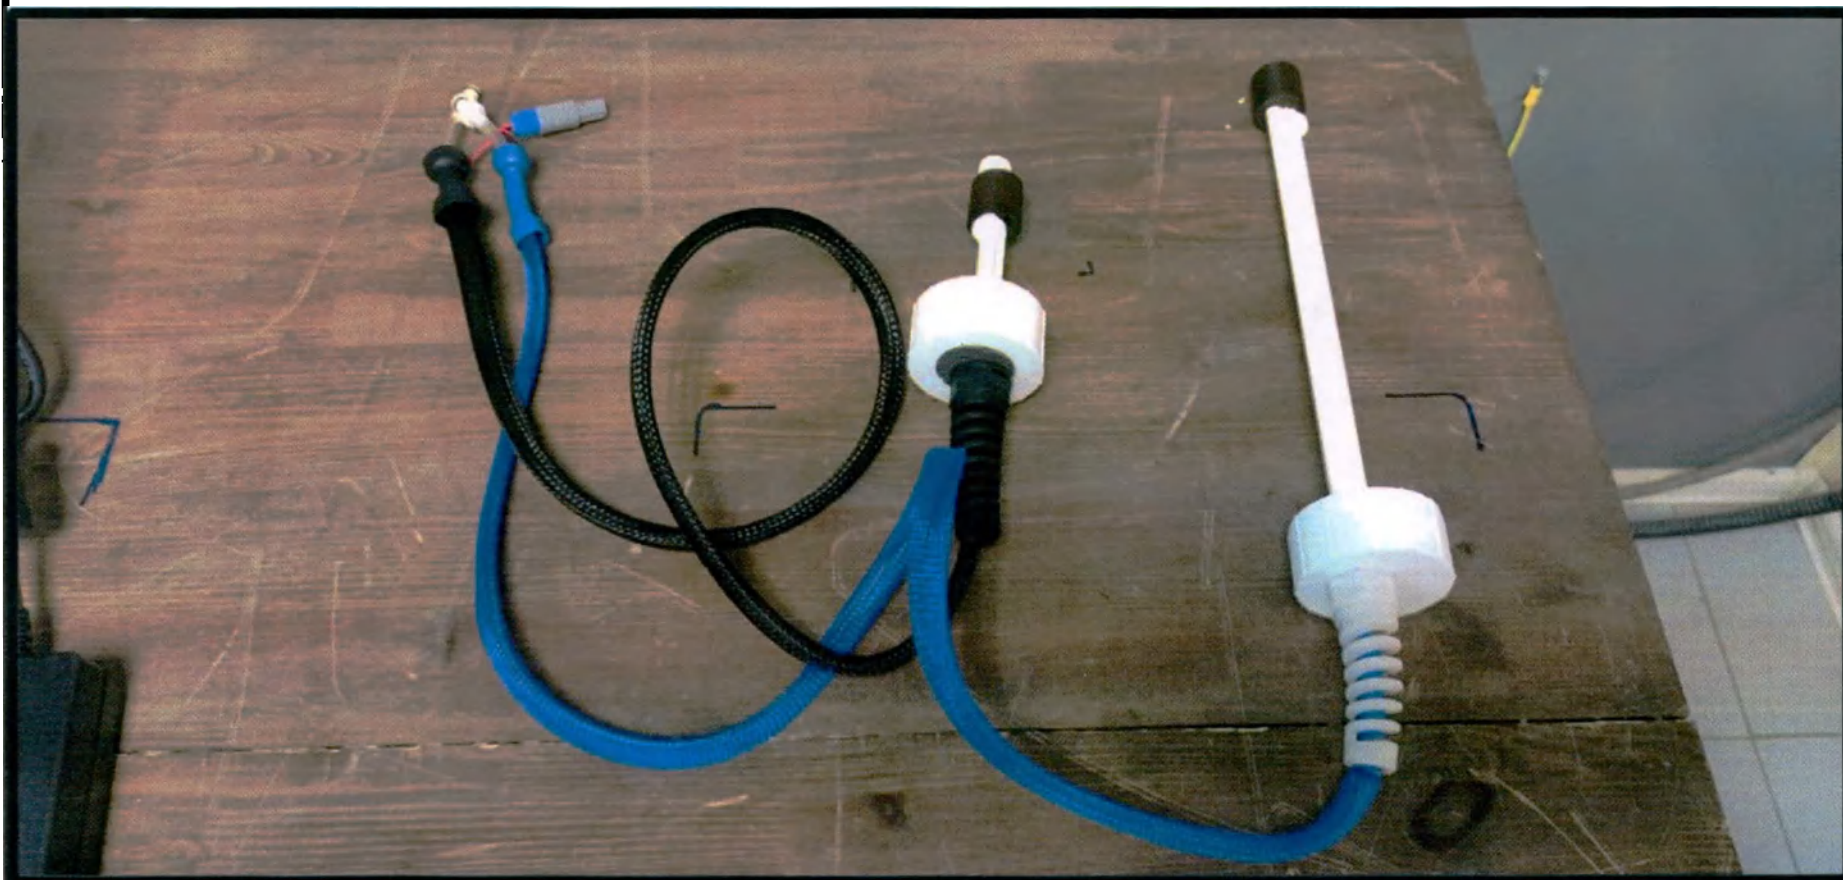


Комплект проводки с датчиком уровня отходов в составе:


Датчик уровня отходов

Трубка


"Канистра для отходов в составе: Крышка"

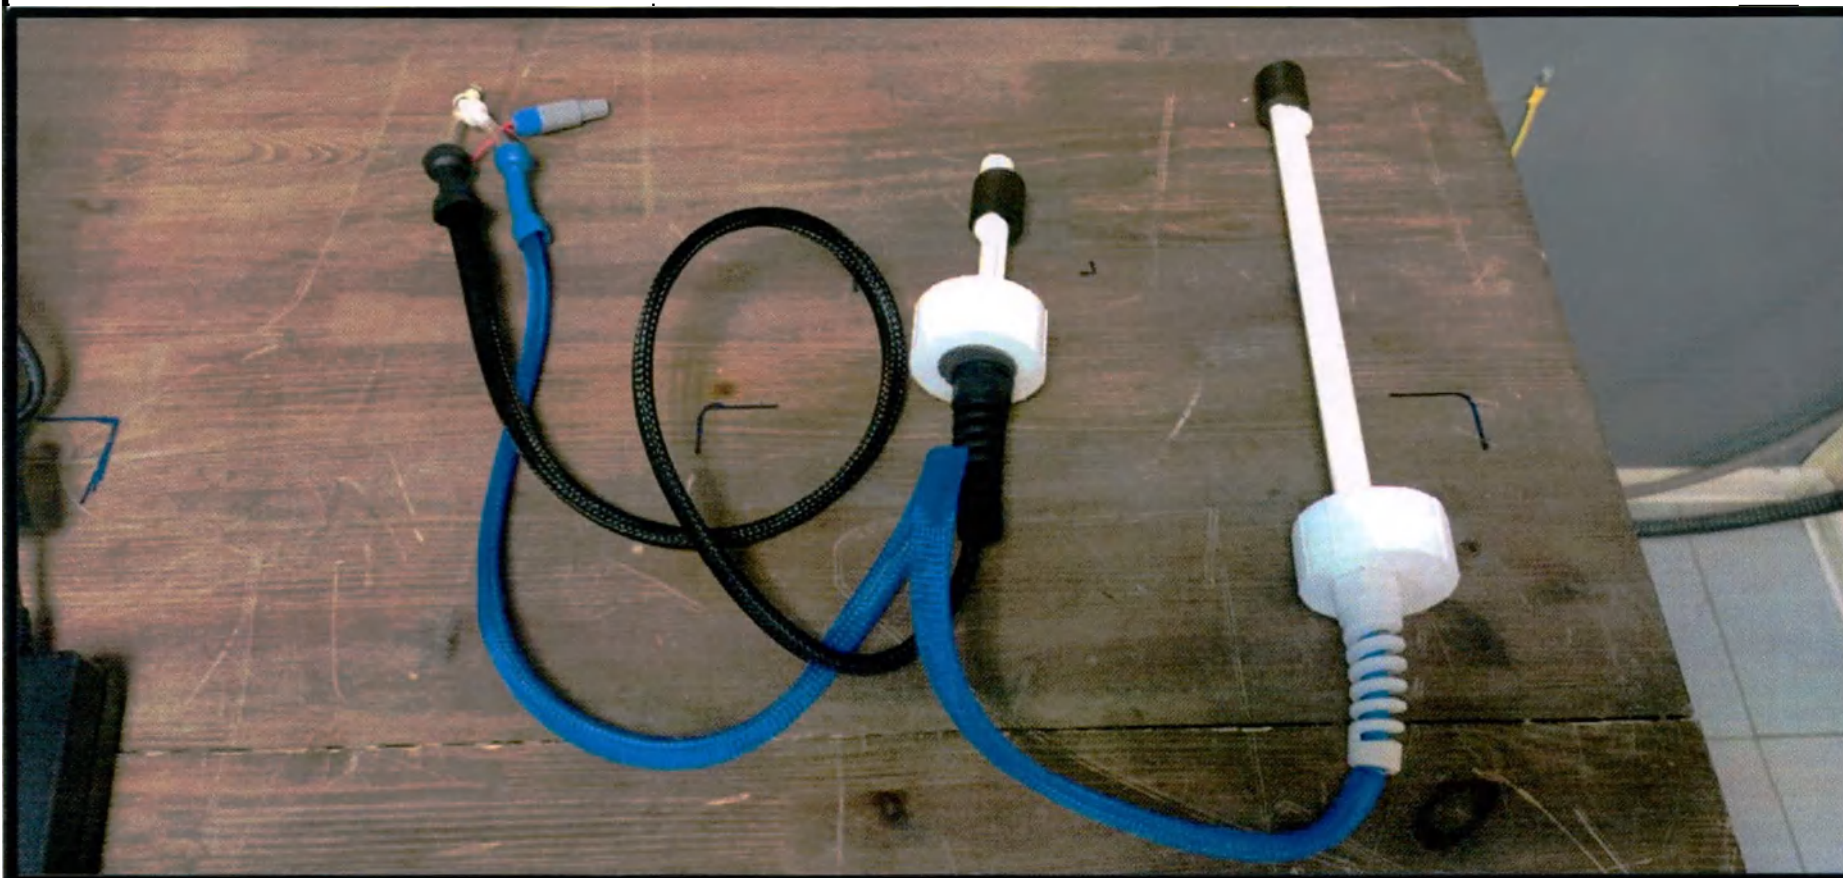


Штатив на 40 пробирок 12x75

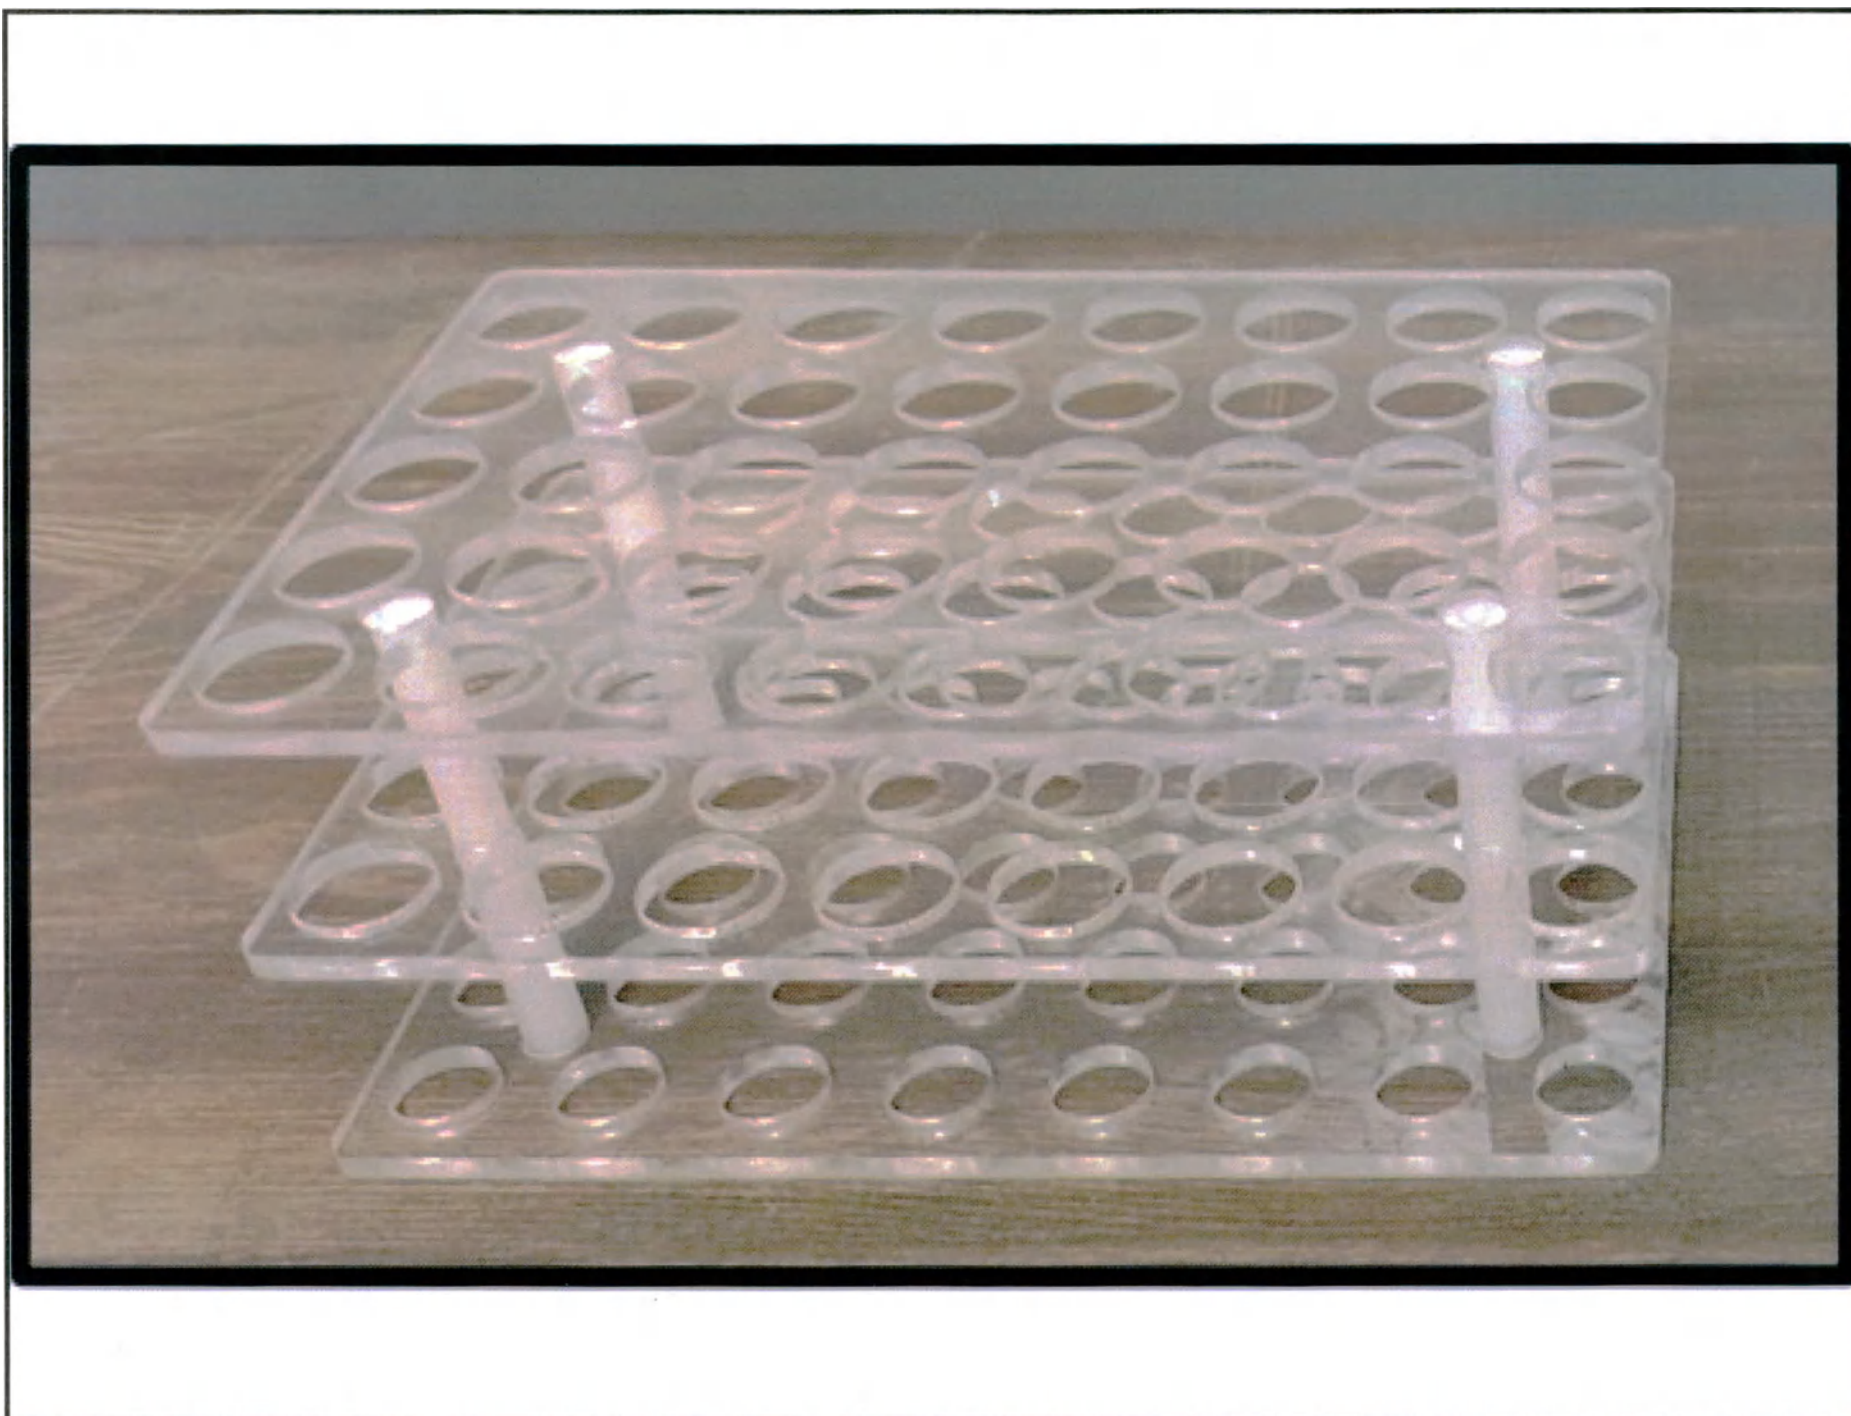

Штатив на 40 пробирок типа Эппендорф

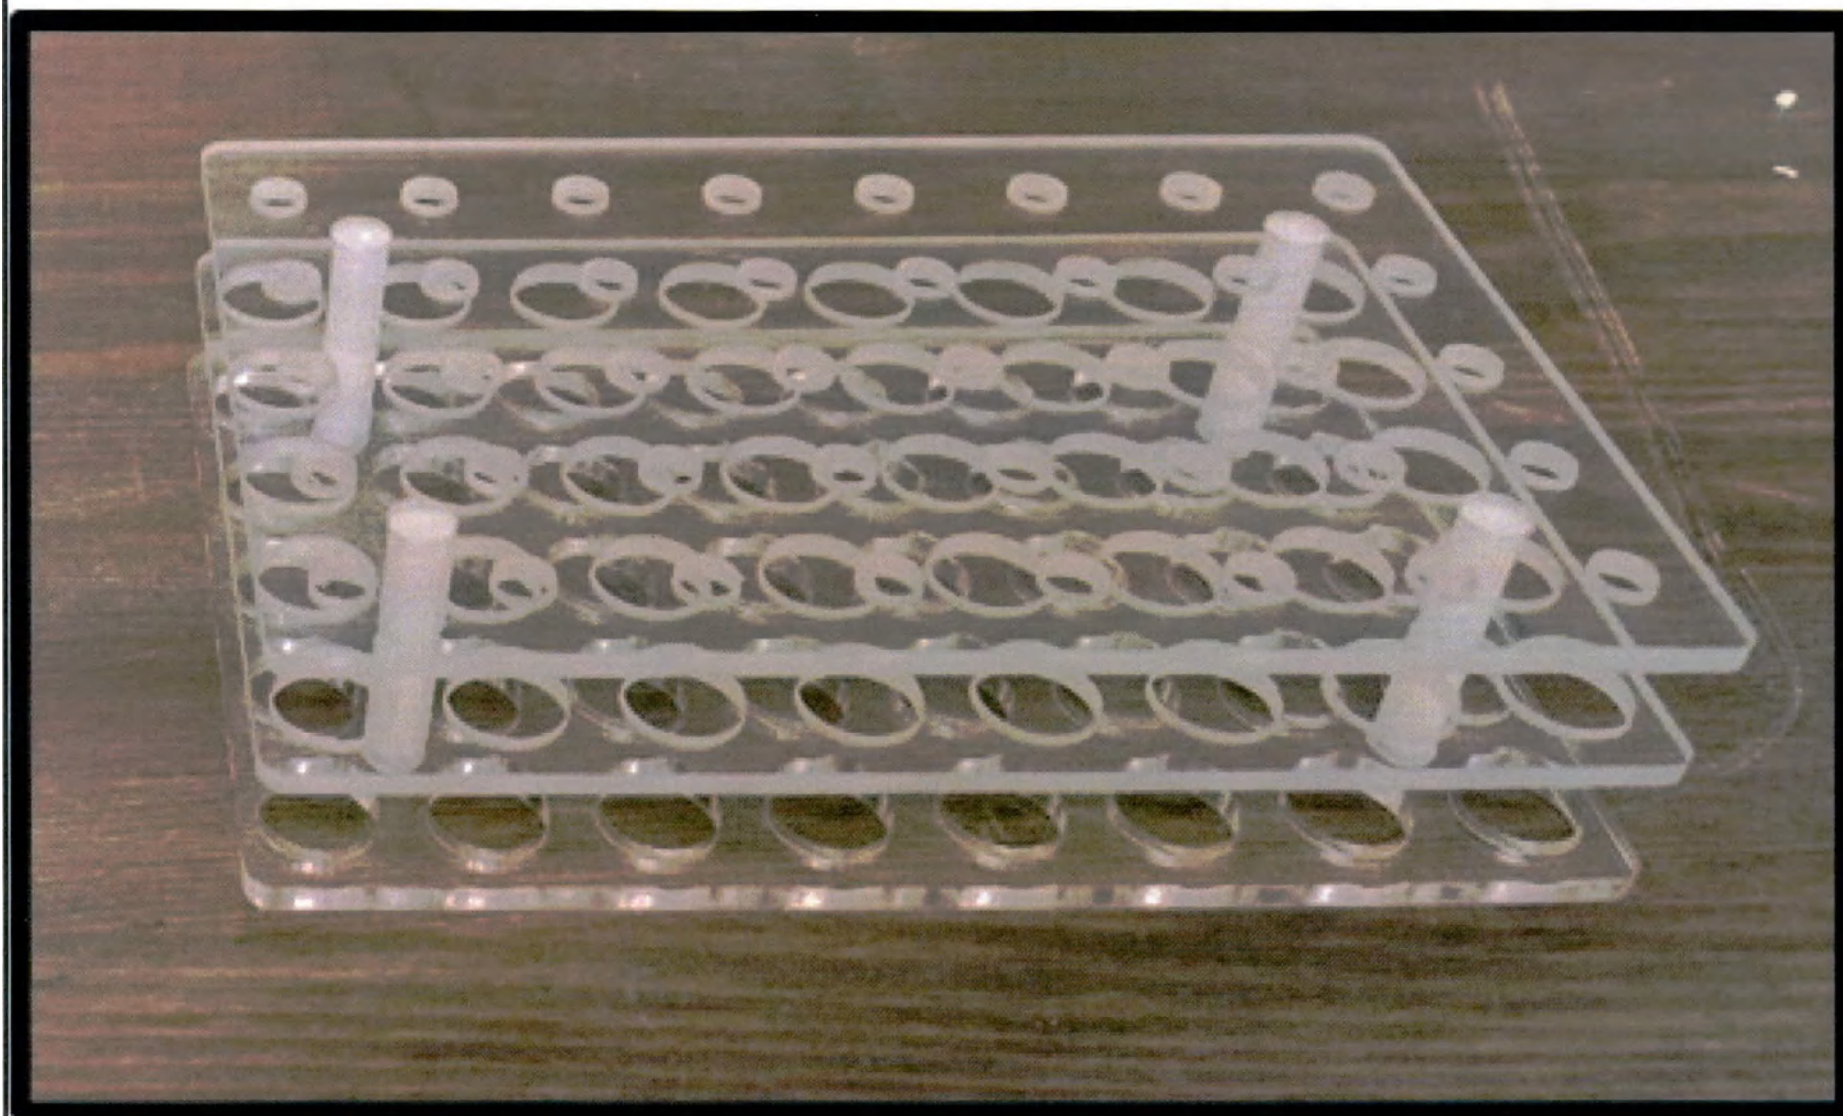

Адаптер питания

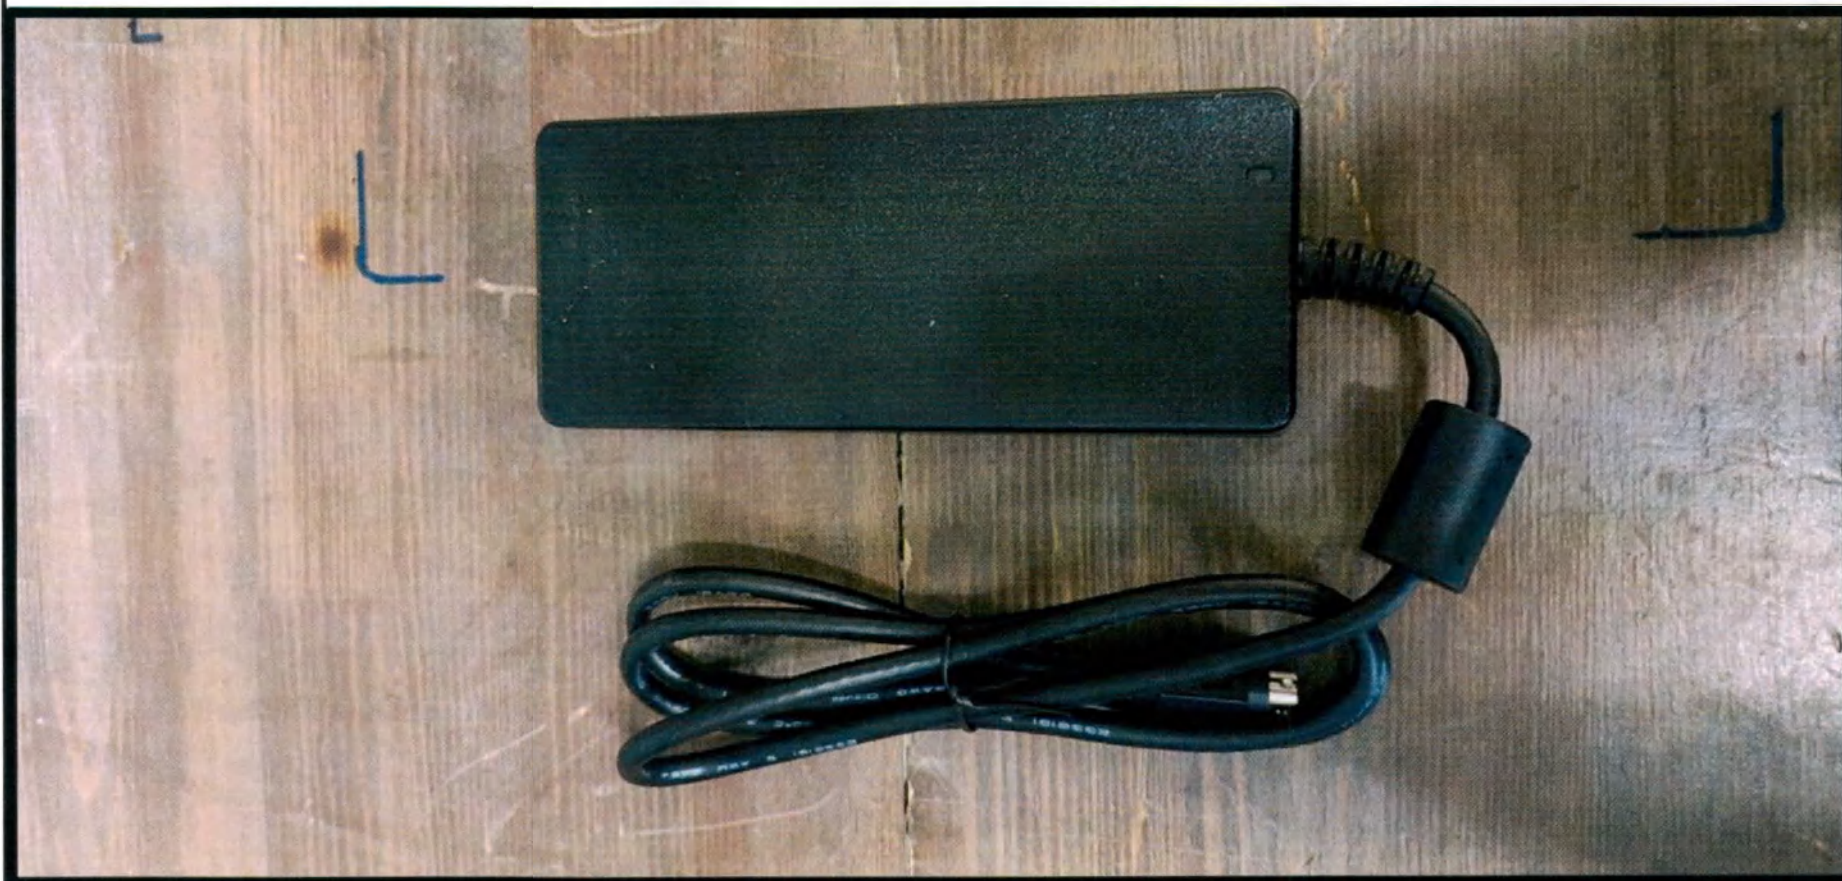



Адаптер питания (Кабель питания)



Кабель коммуникационный Ethernet



Подставка для емкостей



Стартовый калибратор CellRiver




Рабочая станция, в составе:

Системный блок


Кабель питания




Рабочая станция, в составе: Монитор

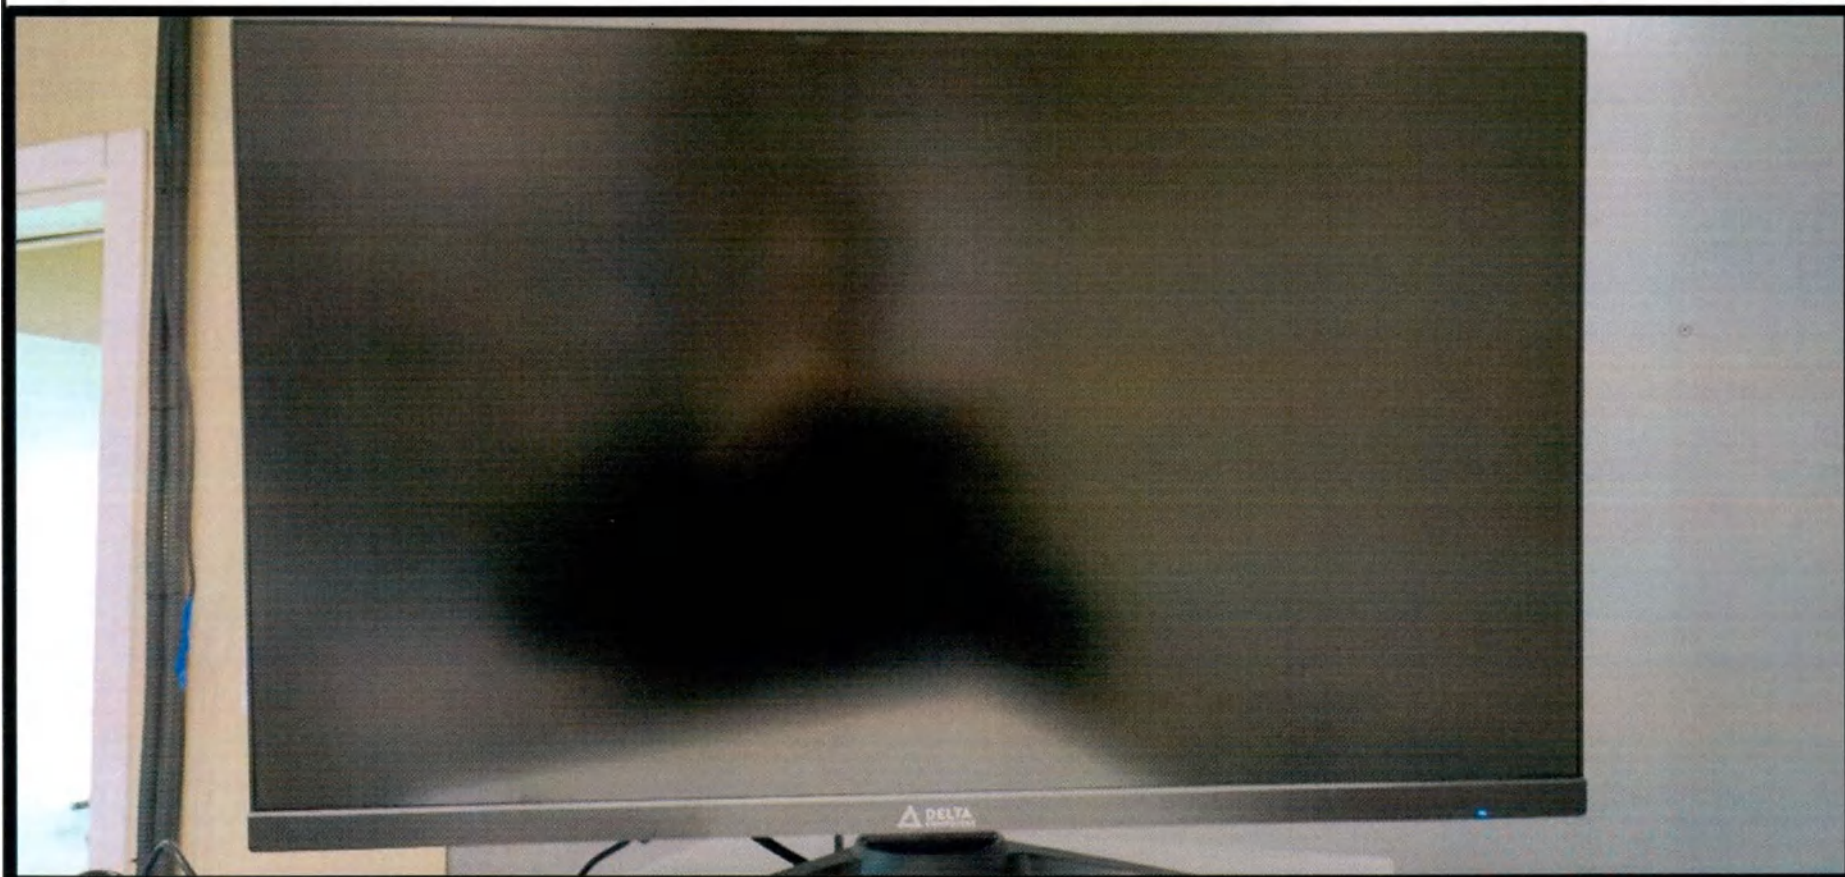

Рабочая станция, в составе: Интерфейсный кабель (HDMI)

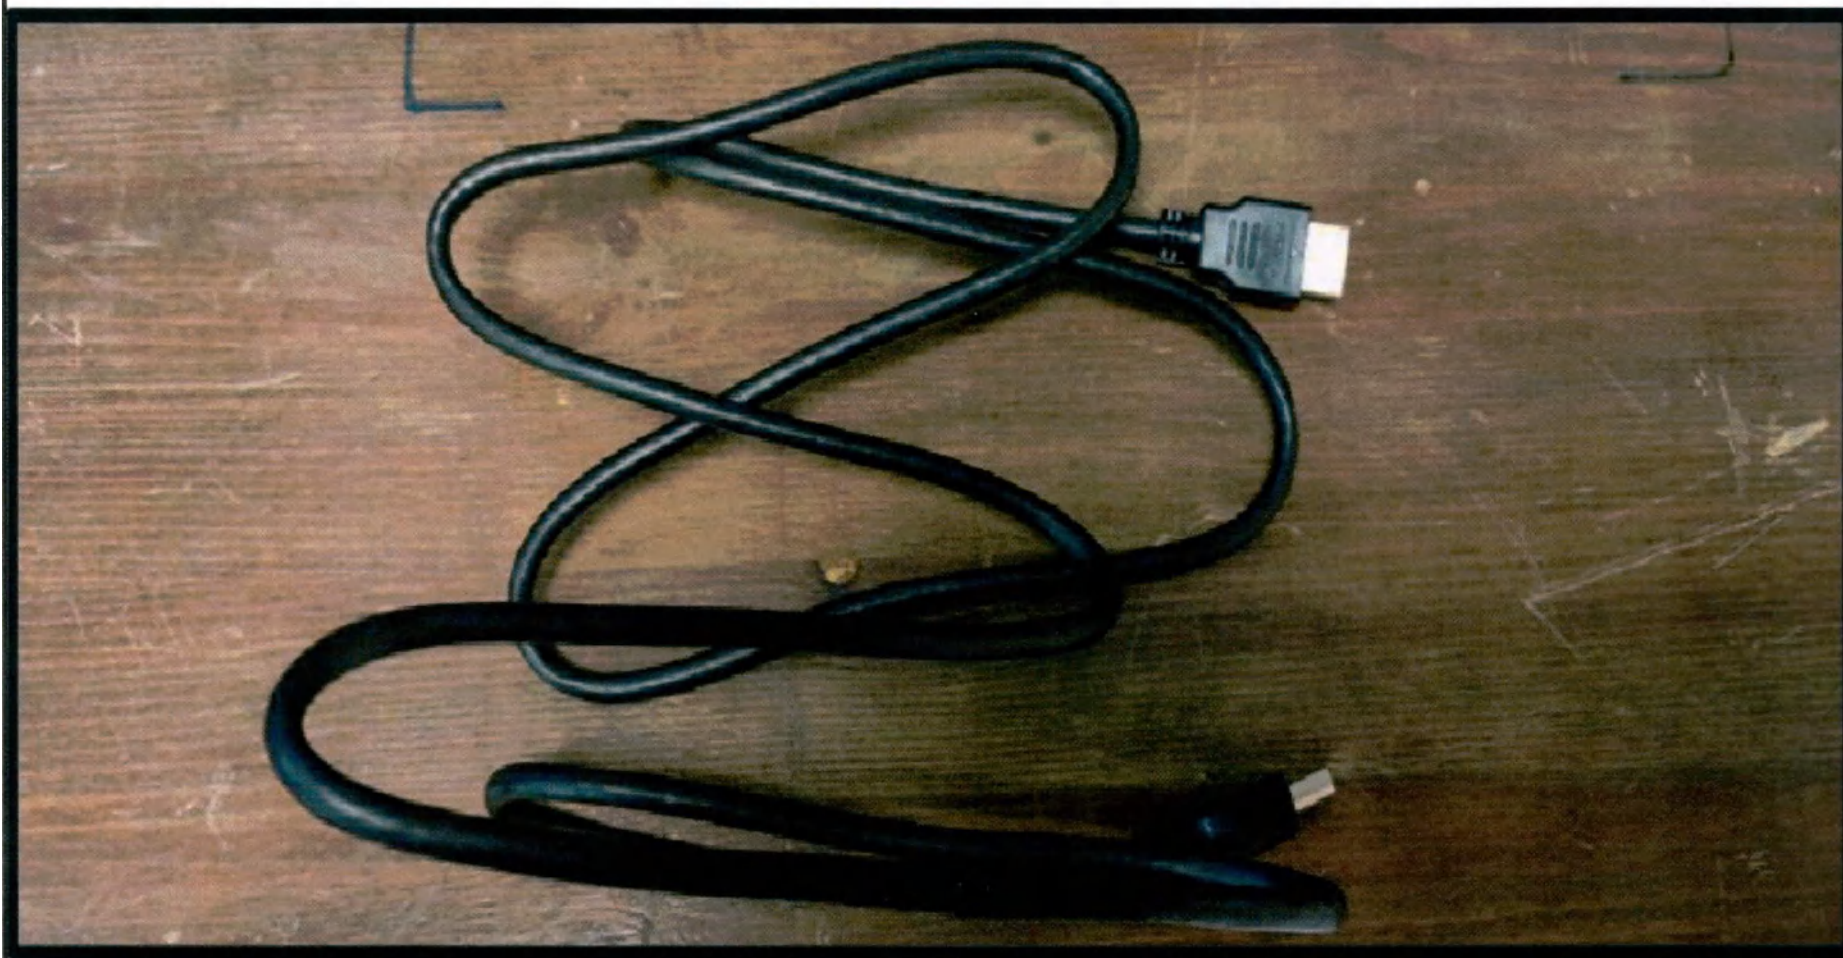

Рабочая станция, в составе:

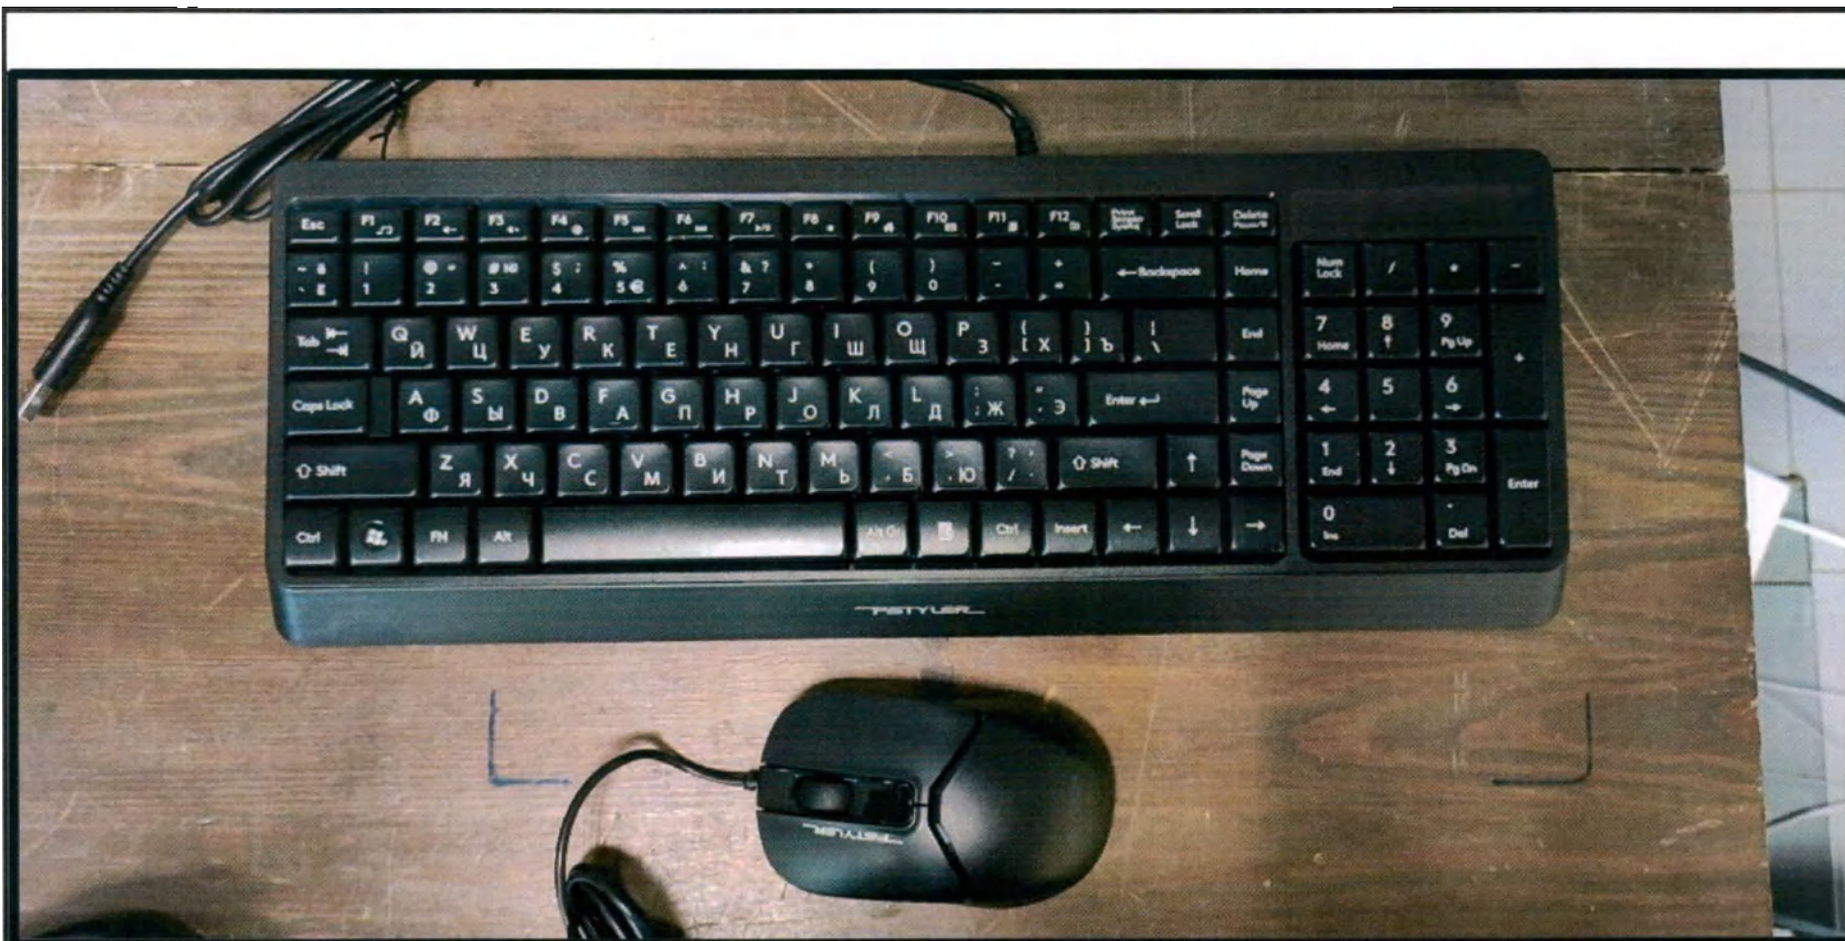


Манипулятор "мышь"

Клавиатура

Рабочая станция, в составе: Кабель питания



Рабочая станция, в составе: Источник бесперебойного питания

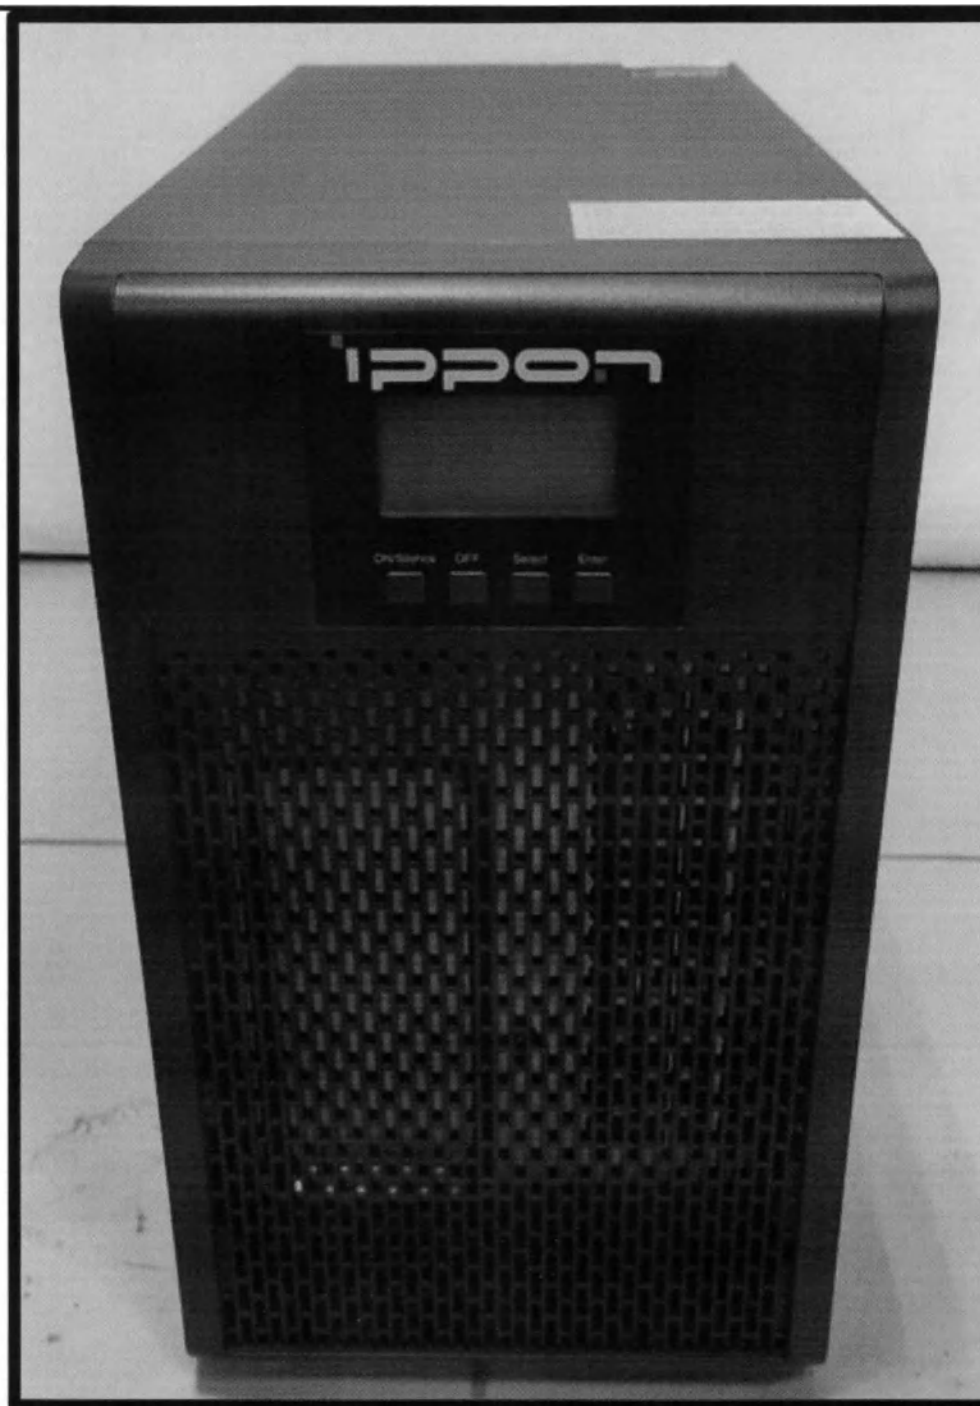

Цитофлуориметр проточный CellRiver для диагностики in vitro
по ТУ 26.51.53-001-24537644-2024

Руководство по эксплуатации



Редакция 1.0


Произведено: ООО «ЛАБВИЖН»

197046, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Посадский, пер Певческий,
д. 12, литера А, помещ. 3-Н, часть помещения 10, офис 404

Пример транспортной упаковки: Цитофлуориметр проточный CellRiver (Ящик с аналитическим блоком)



Пример транспортной упаковки: Цитофлуориметр проточный CellRiver (Ящик с компонентами, входящими в состав.)

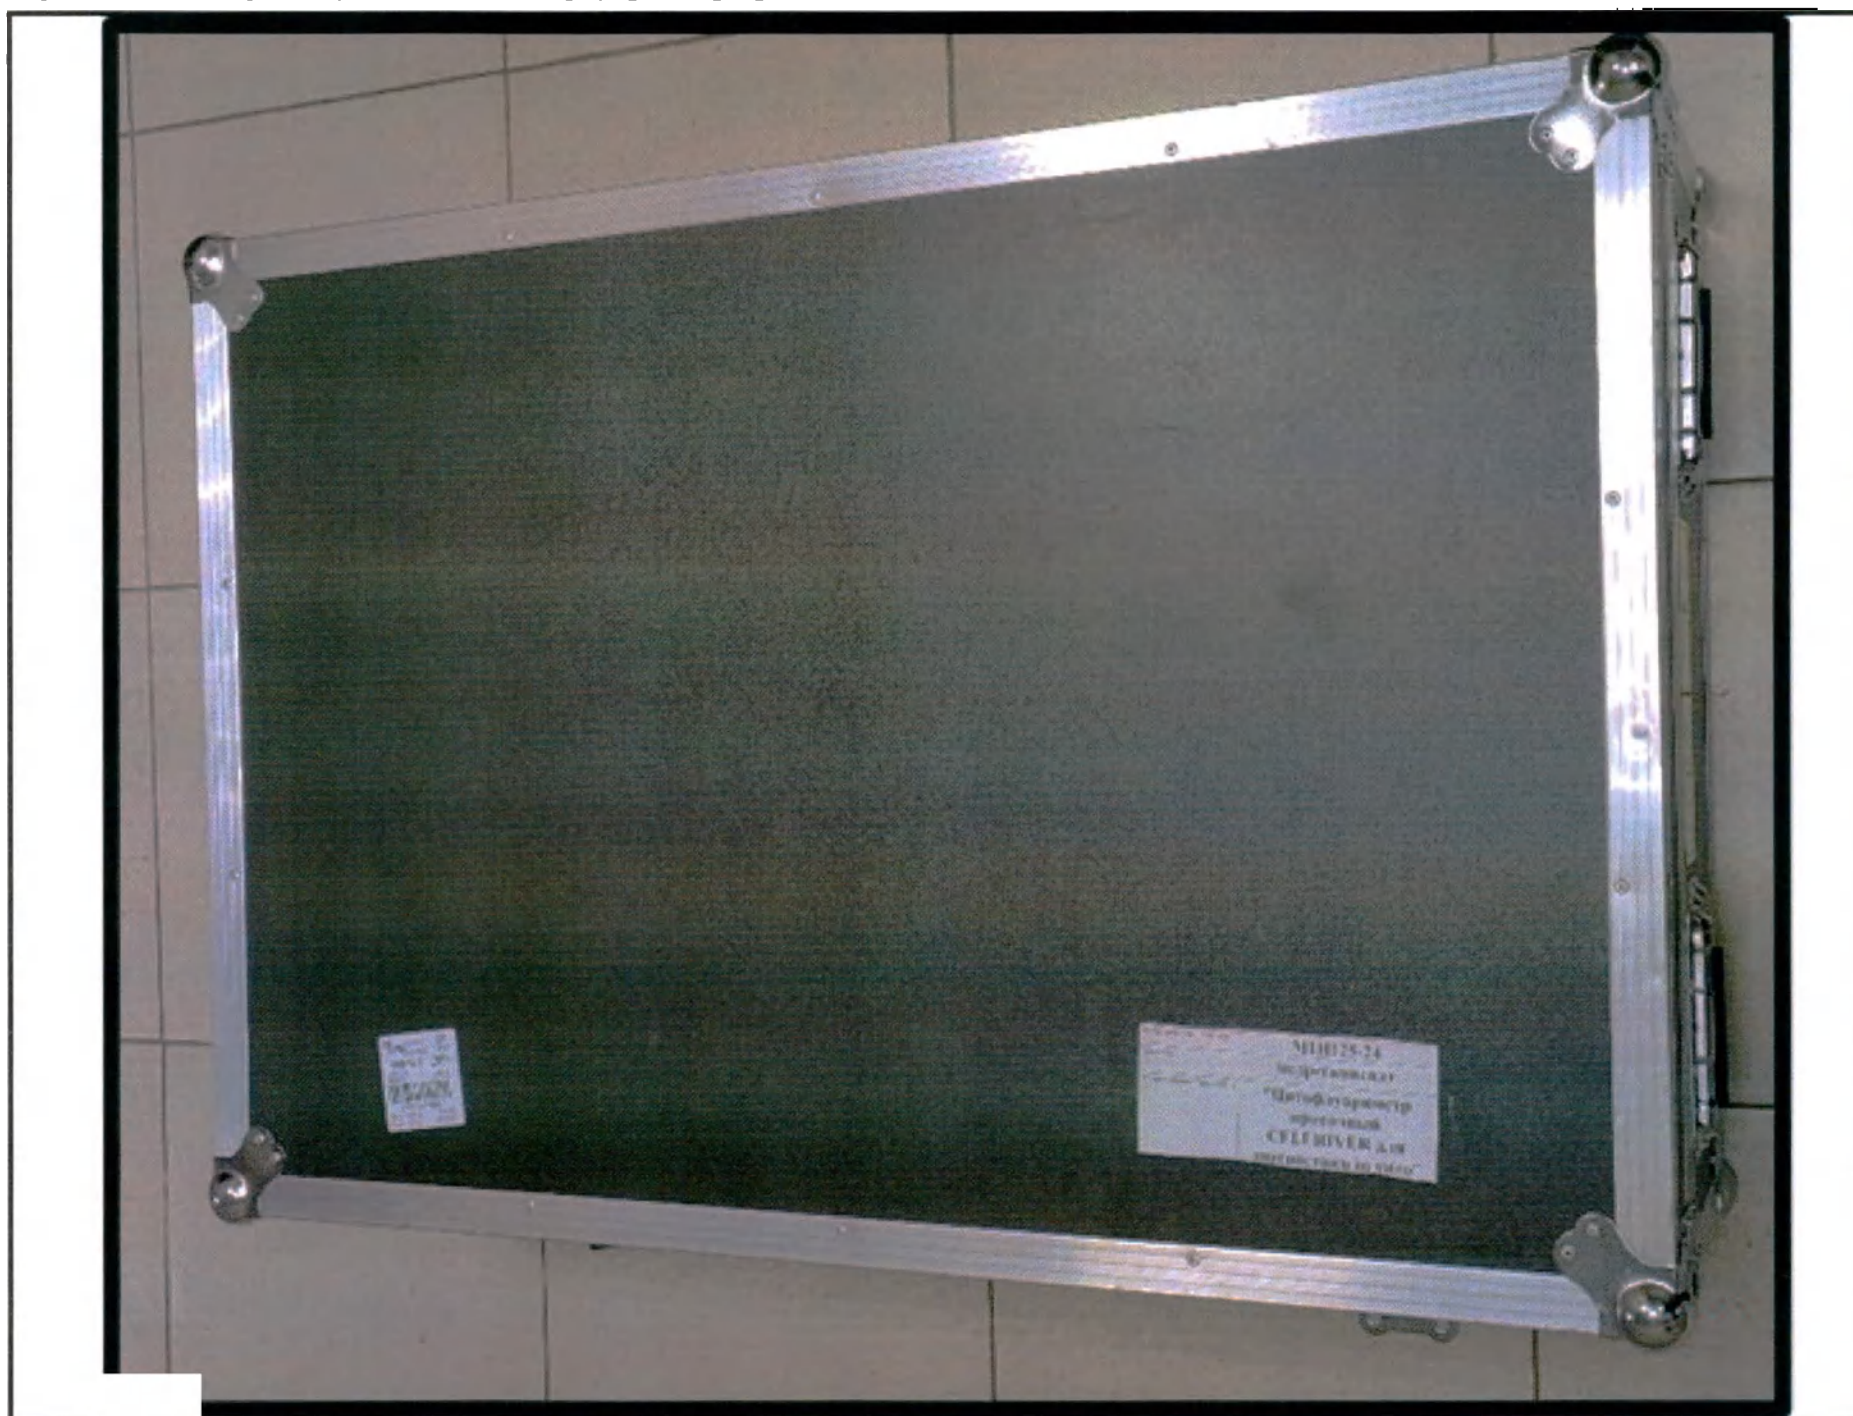

Цитофлуориметр проточный CellRiver для диагностики in vitro
по ТУ 26.51.53-001-24537644-2024

Вариант исполнения:

Цитофлуориметр проточный CellRiver (3 лазера, 14 флуоресцентных параметров),



в составе:

Аналитический блок CellRiver (3 лазера, 14 флуоресцентных параметров) – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.



SN



Габаритные размеры - (730 x 640 x 750) мм (± 70 мм)

Масса брутто - не более 60 кг



Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБВИЖН» (ООО «ЛАБВИЖН»)
197046, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Посадский, пер Певческий, д.
12, литера А, помещ. 3-Н, часть помещения 10, офис 404
Тел.: 8-800-550-83-57

РУ № РЗН _____ от _____

Пример макет транспортной маркировки: Цитофлуориметр проточный CELLRIVER (Ящик с компонентами)

Цитофлуориметр проточный CellRiver для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53-001-24537644-2024

Вариант исполнения:

Цитофлуориметр проточный CellRiver (3 лазера, 14 флуоресцентных параметров),

в составе:

Бутылка для очищающего раствора в составе:

Бутылка – 1 шт.

Крышка – 1 шт.

Трубка – 1 шт.

Канистра для проточной жидкости в составе:

Канистра – 1 шт.

Крышка – 1 шт.

Канистра для отходов в составе:

Канистра – 1 шт.

Крышка – 1 шт.

Комплект проводки с датчиком уровня проточной жидкости в составе:

Датчик уровня проточной жидкости – 1 шт.

Трубка – 1 шт.

Комплект проводки с датчиком уровня отходов в составе:

Датчик уровня отходов – 1 шт.

Трубка – 1 шт.

Штатив на 40 пробирок 12x75 – 1 шт.

Штатив на 40 пробирок типа Эппендорф – 1 шт.

Адаптер питания в комплекте:

Адаптер питания – 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Кабель коммуникационный Ethernet – 1 шт.

Подставка для емкостей – 1 шт.

Стартовый калибратор CellRiver – 1 фл.

Рабочая станция, в составе:

Системный блок – 1 шт.

Монитор – 1 шт.


Интерфейсный кабель HDMI – 1 шт.

Манипулятор "мышь" – 1 шт.

Клавиатура – 1 шт.

Кабель питания – 2 шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.



Габаритные размеры - (1100 x 620 x 370) мм (± 100 мм)

Масса брутто - не более 25 кг



Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБВИЖН» (ООО «ЛАБВИЖН»)

197046, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Посадский, пер Певческий, д.

12, литера А, помещ. 3-Н, часть помещения 10, офис 404

Тел.: 8-800-550-83-57

РУ № РЗН _____ от _____

ПОДПИСАНО
И СЕРТИФИЦИ
29 ЛИСА-ОВ-

