

Фотографические изображения медицинского изделия  
Термометры медицинские электронные моделей WT-03  
base, WT-04 standart,  
WT-05 accuracy, WT-06 flex, WT-07 jumbo,  
WT-09 quick, WF-1000, WF-2000



# B. Well

ТЕРМОМЕТР  
МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ

- Влагозащищенный корпус
- Звуковой сигнал
- Без ртути и стекла
- Автоматическое отключение
- Защитный футляр
- Большой ЖК дисплей
- Память последнего измерения

Электронный термометр для всех членов семьи. Простая надежная конструкция термометра позволит без труда, быстро и точно определить температуру тела.

Термометр не боится воды, обладает большим заметным дисплеем, защитным футляром и памятью последнего измерения.

**БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для Москвы  
**(495) 645 87 01**  
для всех регионов  
**8 800 200 33 22**

Официальный интернет-магазин термометров B. Well  
117526 Москва, в/о Урологическая А.В. МПЗ, компания ООО "Сити-Мед"



Батарей: 1x AAA

Питье: тошнотворное, удушье/закрытие  
6C NP2006/97 от 30.01.2006



6 946159 500098

Термометр медицинский электронный  
**WT-03 BASE**

**B. Well Limited**  
770 Great Cambridge Road, the Bioscience Centre, Epsford, Mansfield, DN1 3YN, United Kingdom  
Kingsford of Great Britain and Northern Ireland - www.bwell-uk.co.uk  
Импортёр: ООО "Сити-Мед"  
750 Грейт Камбридж Роуд, Бизнес-центр, Эпсфорд, Мансфилд, DN1 3YN, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Адрес: Москва - импортер: ООО "Сити-Мед", 117526 Москва, в/о Урологическая А.В. МПЗ, компания ООО "Сити-Мед"  
Сделано в Китае

# B. Well

ТЕРМОМЕТР  
МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ

- Клинически проверен
- Память последнего измерения
- Защитный футляр
- Автоматическое отключение
- Звуковой сигнал



60  
СЕКУНД

ЗВУКОВОЙ  
СИГНАЛ

ЗАЩИТА  
ОТ ВОДЫ

# B. Well

ЭЛЕКТРОННЫЙ  
ТЕРМОМЕТР



# B. Well

ТЕРМОМЕТР  
МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ



**БЕЗ РТУТИ  
И СТЕКЛА  
БЕЗОПАСНЫЙ**

60  
СЕКУНД

ЗВУКОВОЙ  
СИГНАЛ

ЗАЩИТА  
ОТ ВОДЫ

**СЕМЕЙНЫЙ**

Норма  
35.2-36.8 °C  
35.7-37.3 °C  
36.2-37.7 °C

Продолжительность  
2-3 минуты  
60 секунд  
60 секунд

Способ измерения  
1 Аксилярно  
2 Орально  
3 Ректально



# B. Well

ТЕРМОМЕТР  
МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ


Перед использованием подробно внимательно прочтите инструкцию



или




Батарейка для модели WT-03 base

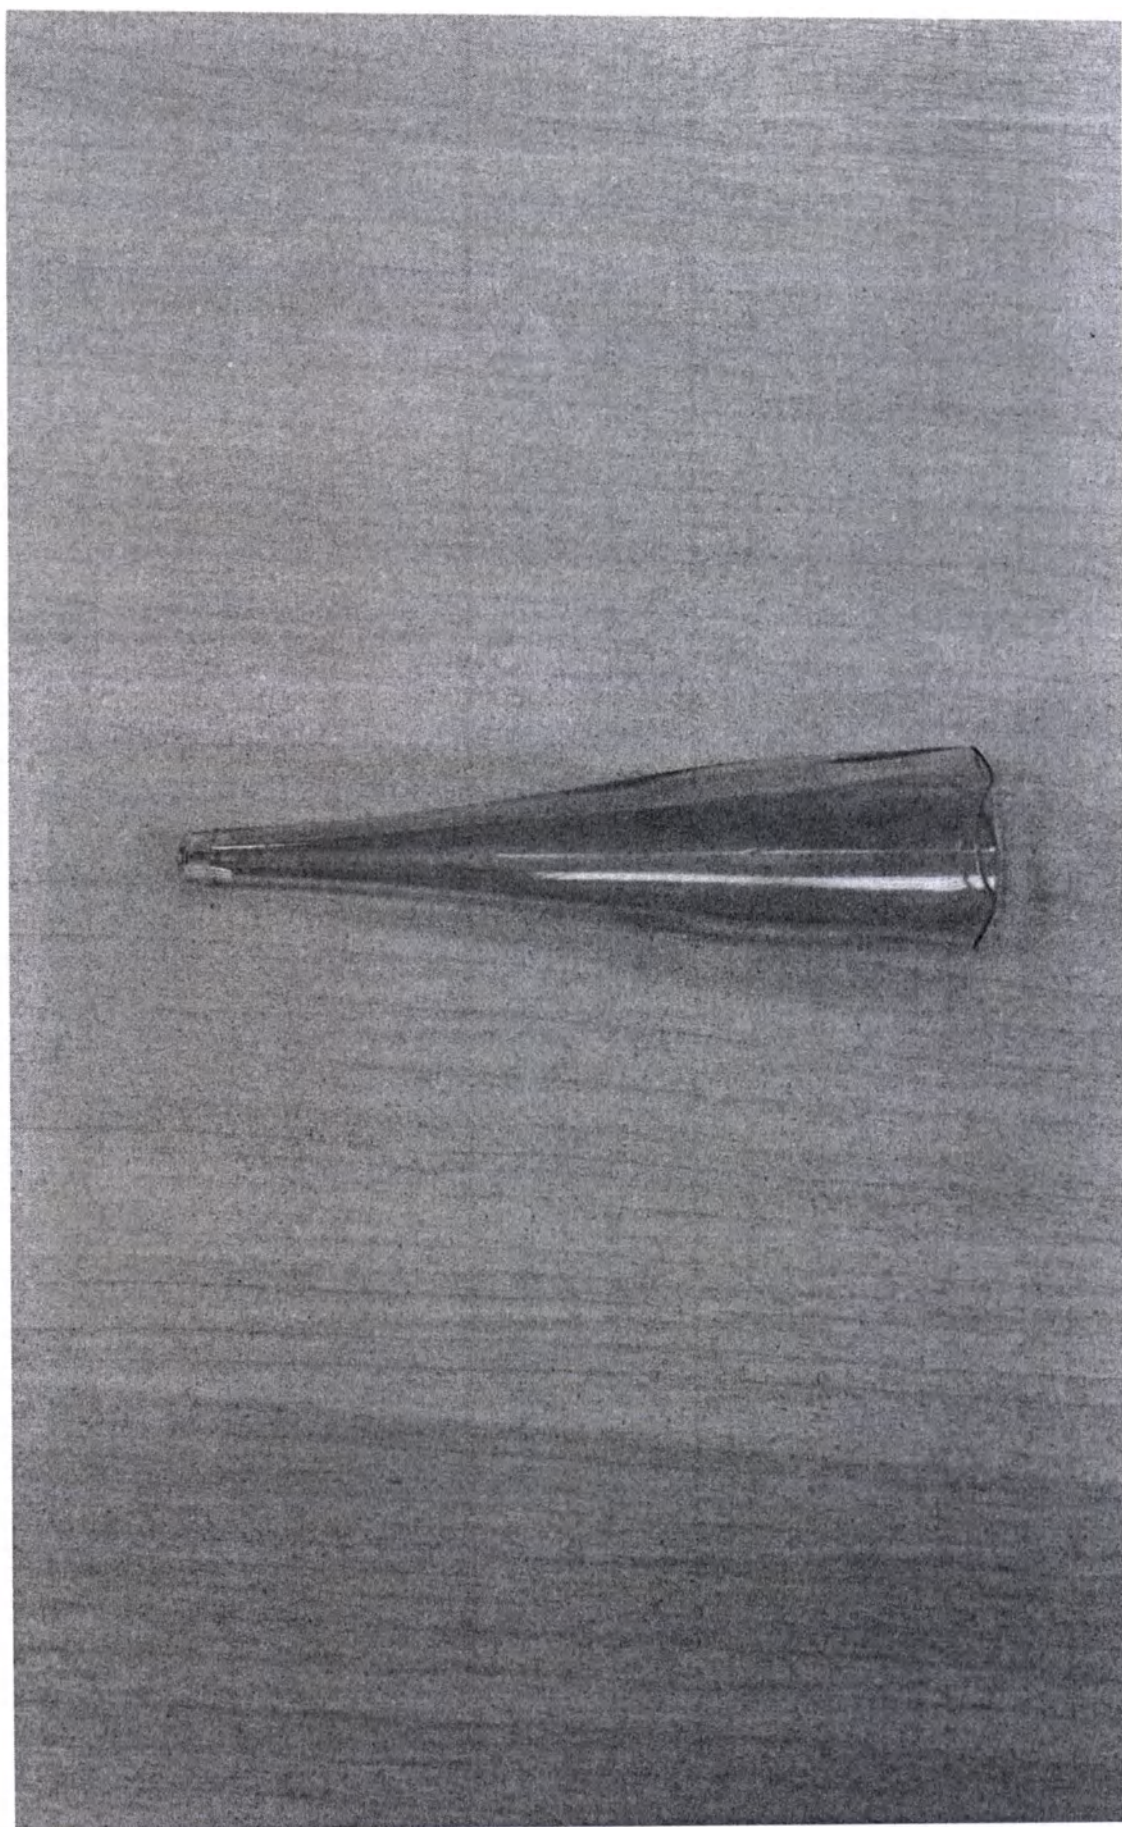

Защитный футляр для модели WT-03 base




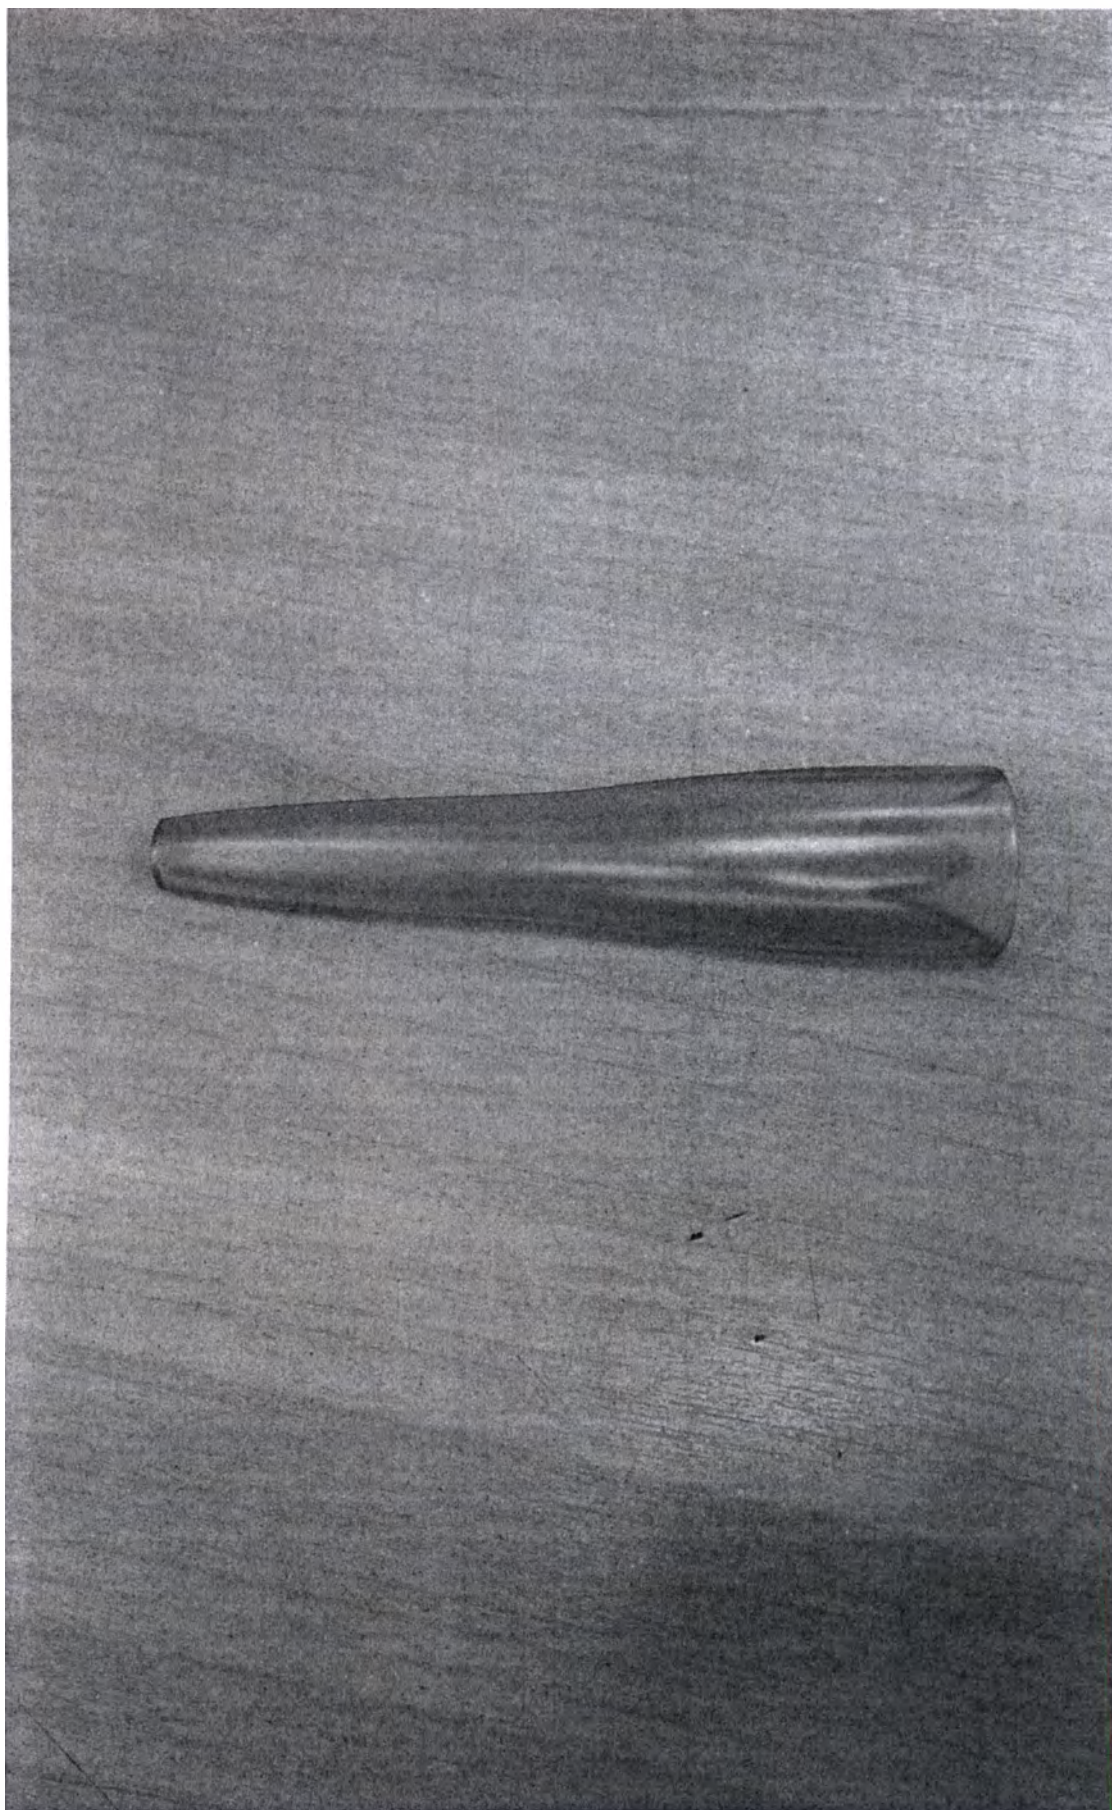

Защитный футляр для модели WT-04 standart




ИЛИ

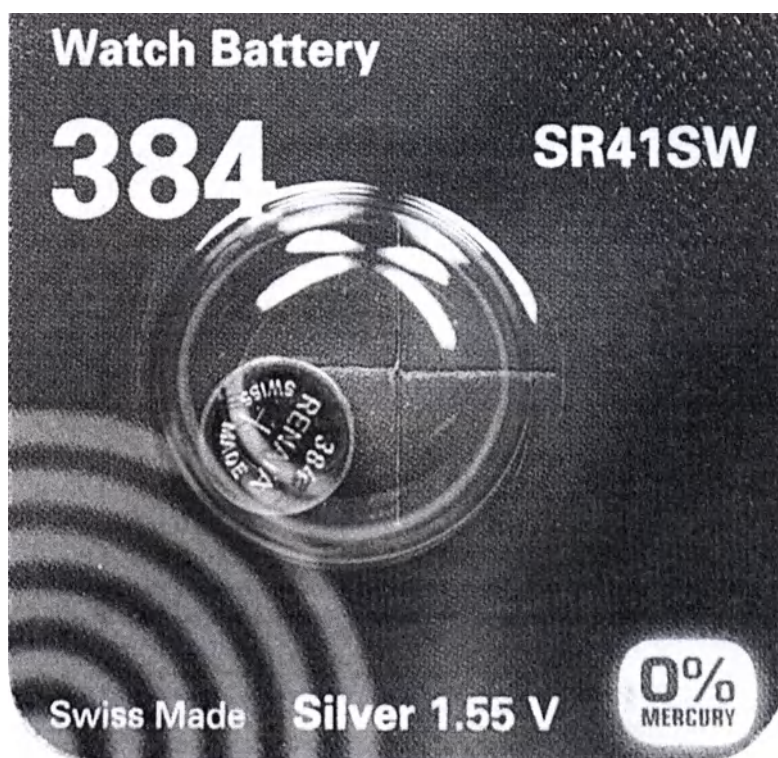

Батарейка для модели WT-04 standart

Термометры медицинский электронный модель WT-05 accuracy




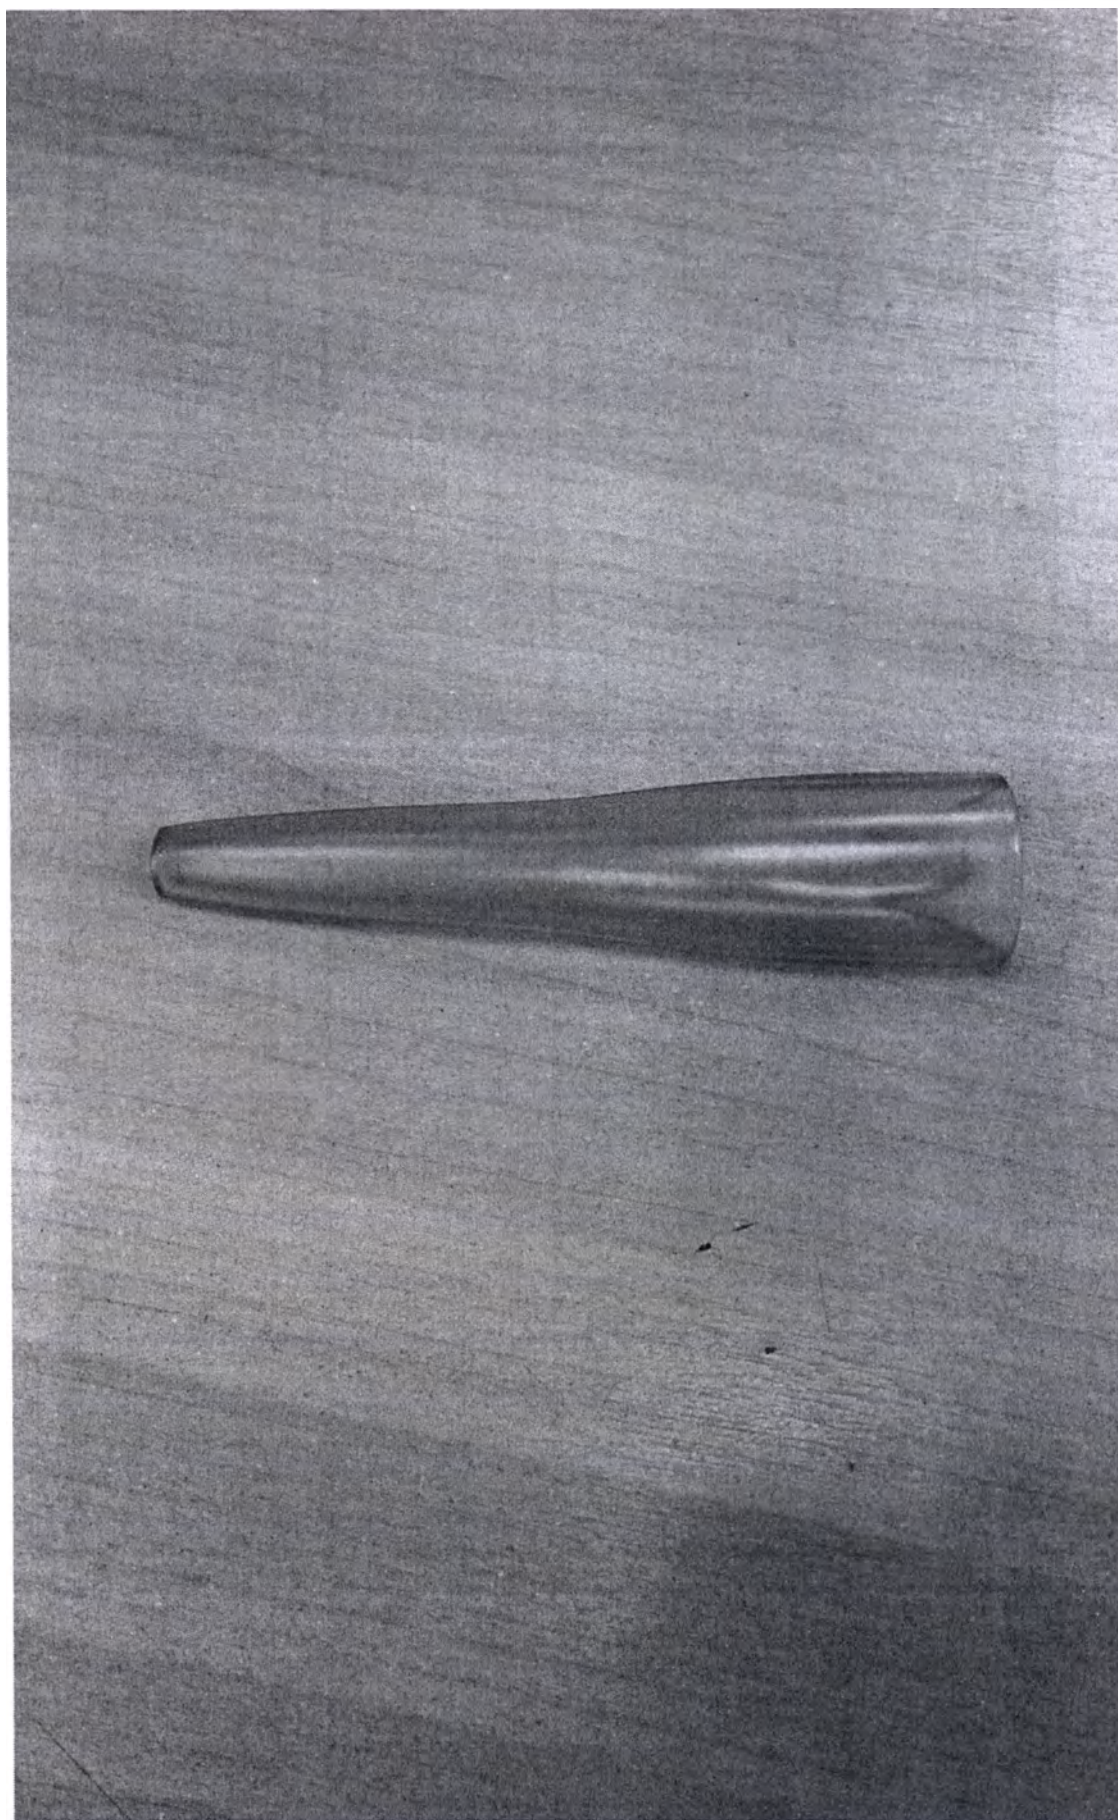

Защитный футляр для модели WT-05 accuracy



ИЛИ

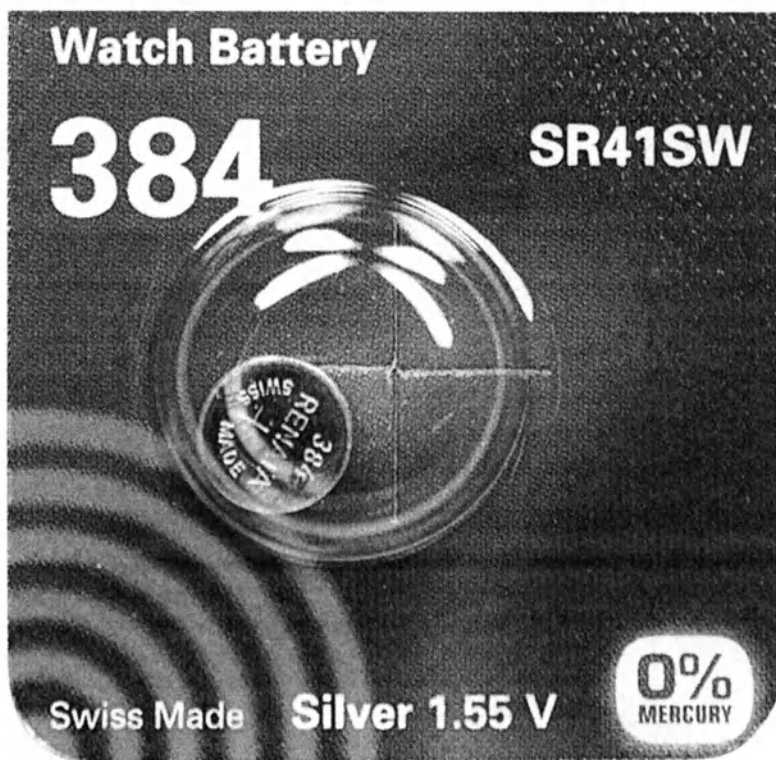

Батарейка для модели WT-05 accuracy

Термометры медицинский электронный модель WT-06 flex



## Руководство по эксплуатации

### Инструкция по эксплуатации

Данный медицинский термометр ВТ-06 фирмы В.Велл предназначен для измерения температуры тела человека. Он имеет простую конструкцию и удобен в использовании. Термометр имеет цифровой дисплей, который показывает температуру в градусах Цельсия. Термометр имеет датчик, который вставляется в рот или подмышку. Термометр имеет кнопку, которая используется для включения и выключения. Термометр имеет батарейки, которые используются для питания. Термометр имеет защитный футляр, который используется для защиты датчика. Термометр имеет инструкцию по эксплуатации, которая используется для ознакомления с устройством.

**Как измерить температуру?**  
 Для измерения температуры тела человека термометр необходимо вставить в рот или подмышку. Термометр должен находиться в месте измерения в течение 10 секунд. После этого на дисплее появится температура. Термометр можно использовать для измерения температуры тела ребенка. Термометр имеет датчик, который не повреждает кожу. Термометр имеет батарейки, которые используются для питания. Термометр имеет защитный футляр, который используется для защиты датчика. Термометр имеет инструкцию по эксплуатации, которая используется для ознакомления с устройством.

Характеристики ВТ-06 электронного термометра

Длина ВТ-06 100 мм

## Блистерная упаковка

Термометр

Защитный футляр

## Упаковка

**B.Well**  
 ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ  
 ЭЛЕКТРОННЫЙ



БЕЗ РТУТИ  
 И СТЕКЛА

НЕЖНОЕ  
 ПРИКОСНОВЕНИЕ  
 БЕЗОПАСНЫЙ

НАКОНЕЧНИК  
 ГИБКИЙ

10  
 СЕКУНД

ЗАЩИТА  
 ОТ ВОДЫ

УТЁНОК

# B. Well

ТЕРМОМЕТР  
МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ

- Без ртути и стекла
- Измерение за 10 секунд
- Гибкий наконечник
- Влагозащищенный корпус
- Звуковой сигнал
- Автоматическое отключение
- Батарейка в комплекте

Гибкий наконечник гарантирует мягкое прикосновение к нежной детской коже

Термометр для детей выполнен в форме кролика

При производстве термометра использованы только безопасные для детей материалы

Гибкий наконечник, автоматическое отключение и скорость измерения 10 секунд делают процесс измерения удобным и быстрым

**БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**

для Москвы:

**(495) 645 87 01**

для регионов:

**8 800 200 33 22**

Самостоятельный монтаж, установка и настройка термометра не требуют специальных знаний. Подробные инструкции по эксплуатации и установке прилагаются к каждому термометру.



Батарейка: 1 x AA  
Питание: от батареек  
Функции: память последнего измерения, звуковой сигнал, автоматическое отключение



6 946159 500821



# B. Well

ТЕРМОМЕТР  
МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ



# B. Well

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ



# B. Well

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ



**БЕЗ РТУТИ  
И СТЕКЛА  
НЕЖНОЕ  
ПРИКОСНОВЕНИЕ  
БЕЗОПАСНЫЙ**



НАКОНЕЧНИК



# К РО Л И К

Термометр медицинский электронный - это WT-06 Flex  
B. Well Limited  
758 Great Cambridge Road, the Business Centre, Enfield, Middlesex, EN1 3PH,  
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - www.bwell-swiss.ch  
Изготовитель: B. Well Limited  
758 Great Cambridge Road, Бизнес-центр, Энфилд, Мидлсекс, EN1 3PH,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Адрес завода - изготовителя: Индустриальный Район, Дунган Сити, провинция Гуандун, Китай. Сделано в Китае

Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию

| Способ измерения | Продолжительность | Норма        |
|------------------|-------------------|--------------|
| 1 Аксиллярно     | от 20 секунд      | 35,2-36,8 °C |
| 2 Орально        | от 10 секунд      | 35,7-37,3 °C |
| 3 Ректально      | от 6 секунд       | 36,2-37,7 °C |



- Клинически проверен
- Память последнего измерения
- Индикатор разрядки батареи
- Автоматическое отключение
- Защитный футляр

**B. Well**  
ТЕРМОМЕТР  
МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ

# B. Well

ТЕРМОМЕТР  
МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ

- Без ртути и стекла
- Измерение за 10 секунд
- Гибкий наконечник
- Влагозащищенный корпус
- Звуковой сигнал по окончании измерения
- Автоматическое отключение
- Батарейка в комплекте



Гибкий наконечник гарантирует мягкое прикосновение к нежной детской коже.

Термометр для детей выполнен в форме утенка. При производстве термометра использованы только безопасные для детей материалы.

Гибкий наконечник, автоматическое отключение и скорость измерения 10 секунд делают процесс измерения удобным и быстрым.

**БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для Москвы  
**(495) 645 87 01**  
для регионов  
**8 800 200 33 22**

Специальный интернет-ресурс: [www.bwell-sveta.ru](http://www.bwell-sveta.ru)  
Сайт производителя: [www.bwell-sveta.ru](http://www.bwell-sveta.ru)  
117526 Москва, ул. Рязанская д. 8, стр. 2, корпус 1

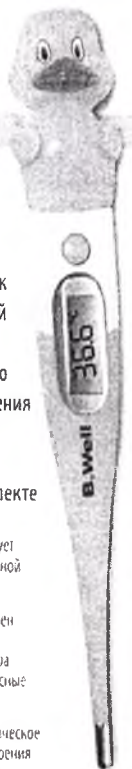

# B. Well

ТЕРМОМЕТР  
МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ




# B. Well

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ



# B. Well


ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ

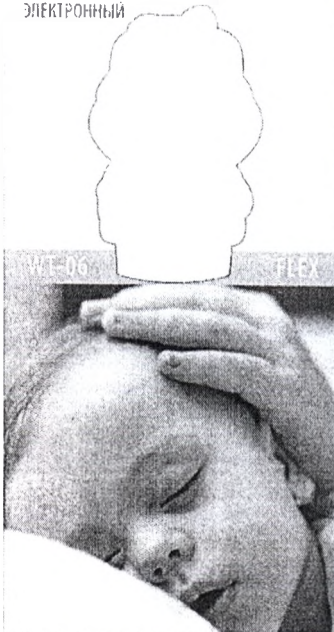

БЕЗ РТУТИ  
И СТЕКЛА

НЕЖНОЕ  
ПРИКОСНОВЕНИЕ  
БЕЗОПАСНЫЙ

НАКОНЕЧНИК



# УТЁНОК

Термометр медицинский электронный тип WT-06 Flex  
B. Well Limited  
758 Great Cambridge Road, the Business Centre, Enfield, Middlesex, EN1 3PL  
United Kingdom or Great Britain and Northern Ireland • [www.bwell-sveta.ru](http://www.bwell-sveta.ru)  
Изготовитель: Би Велл Лимитед  
758 Претей Колумбридж Роуд, Бизнес-центр, Энфилд, Мидлсекс, EN1 3PL  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Адрес завода - изготовителя: Ань Ву Дистрикт, Далиань Цзун,  
Донгуань Сити, провинция Гуандун, Китай. Сделано в Китае

Норма

Продолжительность

Способ измерения



- Клинически проверен
- Память последнего измерения
- Индикатор разрядки батареи
- Автоматическое отключение
- Защитный футляр

**B. Well**  
ТЕРМОМЕТР  
МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ

Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию




или




Батарейка для модели WT-05 accuracy



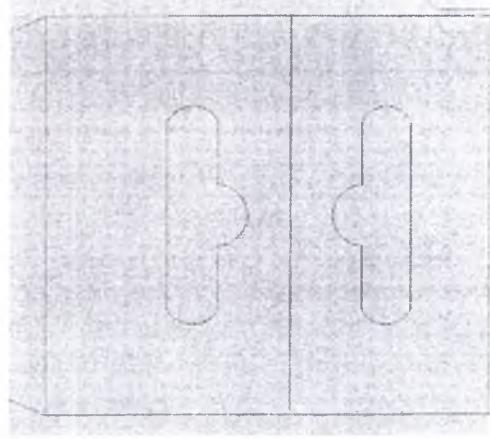

## B.Well®

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ

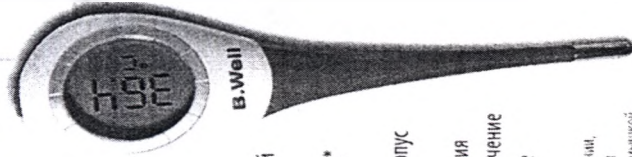

- Профессиональная точность
- Память последнего измерения
- Супербольшой дисплей
- Подсветка
- Измерение за 8 секунд\*
- Гибкий наконечник
- Влагозащитный корпус
- Звуковой сигнал по окончании измерения
- Автоматическое отключение
- Батарейка в комплекте

\* Время измерения температуры:  
8 секунд при ректальном измерении,  
10 секунд при измерении во рту и  
10-20 секунд при измерении подмышкой

**БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**


для Москвы:

**(495) 645 87 01**

для регионов:

**8 800 200 33 22**

Официальный интернет-портал производителя:  
www.bwell.ru, электронная почта: info@bwell.ru  
117535 Москва, ул. Ресурсы д.8, корп.3, 3-й этаж (Трамвайная)

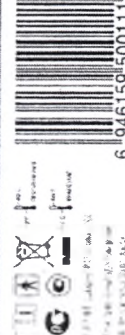

6 946159 500111

## B.Well®

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ

- Профессиональная точность
- Клинически проверен
- Память последнего измерения
- Индикатор разрядки батареи
- Автоматическое отключение



## B.Well®

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ

- Способ измерения
- 1 Аксилитарно 20 секунд
  - 2 Орально 10 секунд
  - 3 Ректально 8 секунд
- Продолжительность
- 35.2-36.8 °C  
35.7-37.3 °C  
36.2-37.7 °C
- Норма

БЕЗ РТУТИ  
И СТЕКЛА

БЕЗОПАСНЫЙ

НЕЖНОЕ

ПРИКОСНОВЕНИЕ

ЭКОНОМИЧНЫЙ



**JUMBO**

Термометр медицинский электронный на WT-47 Jumbo

B.Well Limited

704, West Cottesloe Road, The Burrell Centre, Bristol, England, BS1 9JN, United Kingdom

Anglopharm of Great Britain and Northern Ireland - www.bwell-jumbo.co.uk

Anglopharm Ltd, 100, North Street, London, England, EC1A 3BB, United Kingdom

Anglopharm Ltd, 100, North Street, London, England, EC1A 3BB, United Kingdom

Anglopharm Ltd, 100, North Street, London, England, EC1A 3BB, United Kingdom

Anglopharm Ltd, 100, North Street, London, England, EC1A 3BB, United Kingdom

Anglopharm Ltd, 100, North Street, London, England, EC1A 3BB, United Kingdom

## B.Well®

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ



- Способ измерения
- 1 Аксилитарно 20 секунд
  - 2 Орально 10 секунд
  - 3 Ректально 8 секунд
- Продолжительность
- 35.2-36.8 °C  
35.7-37.3 °C  
36.2-37.7 °C
- Норма



**JUMBO**

Термометр медицинский электронный на WT-47 Jumbo

B.Well Limited

704, West Cottesloe Road, The Burrell Centre, Bristol, England, BS1 9JN, United Kingdom

Anglopharm of Great Britain and Northern Ireland - www.bwell-jumbo.co.uk


Anglopharm Ltd, 100, North Street, London, England, EC1A 3BB, United Kingdom

Anglopharm Ltd, 100, North Street, London, England, EC1A 3BB, United Kingdom

Anglopharm Ltd, 100, North Street, London, England, EC1A 3BB, United Kingdom

Anglopharm Ltd, 100, North Street, London, England, EC1A 3BB, United Kingdom

Anglopharm Ltd, 100, North Street, London, England, EC1A 3BB, United Kingdom

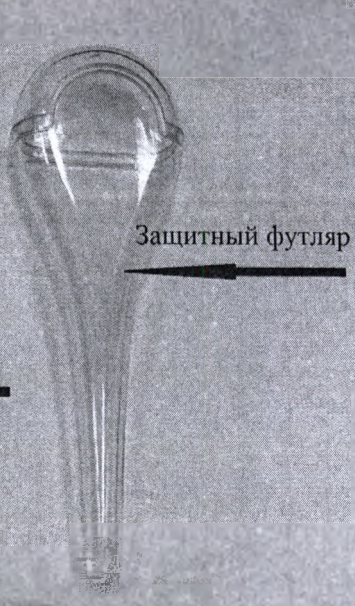

Упаковка

Термометр

Защитный футляр

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с покупкой медицинского электронного термометра B. Well. В комплект входит...

Что такое «нормальная температура»? Температура тела человека зависит от многих факторов. В норме температура тела человека составляет 36,6-37,0°C...


Характеристики Вашего электронного термометра. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Кнопка быстрого сброса. Индикаторный датчик.

Очистка и дезинфекция. Протрите датчик спиртом или мыльной водой. Дезинфицируйте датчик в 70% спиртовом растворе.

Как измерять температуру. Накиньте пленку (вкладыш) на выключатель термометра. Разожмите язычок датчика и поместите его в рот. Будет слышен звуковой сигнал. По истечении 30 секунд...

Аккумуляторные элементы. Проверьте уровень заряда аккумулятора. Если уровень заряда низкий, замените аккумулятор.

Как измерять температуру. (Дальнейшая информация о температуре) нормальная температура 36,6-37,0°C. Медицинский термометр имеет высокую точность измерения.

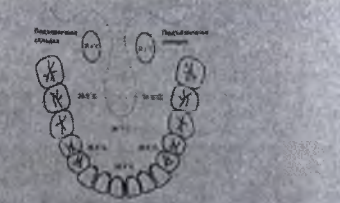


Обратите внимание! Состояние полости рта. Избегайте приема пищи и напитков перед измерением температуры.

Ректальное измерение. Для ректального измерения используйте ректальный датчик. Не используйте ректальный датчик для измерения температуры в полости рта.


Измерение температуры. Измерение температуры занимает 6-7 минут. Не вынимайте датчик из полости рта до звукового сигнала.

Аккумуляторные элементы. Проверьте уровень заряда аккумулятора. Если уровень заряда низкий, замените аккумулятор. Не используйте термометр, если уровень заряда аккумулятора низкий.


Блистерная упаковка

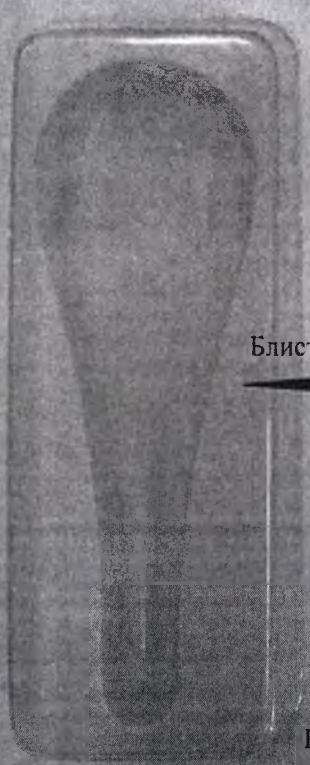

Руководство по эксплуатации

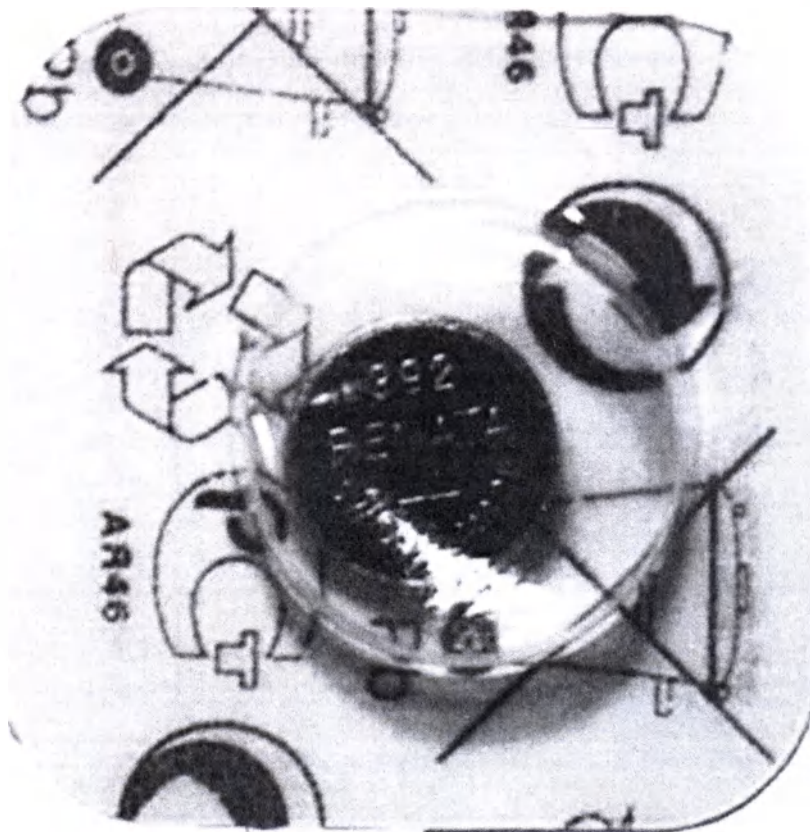



или

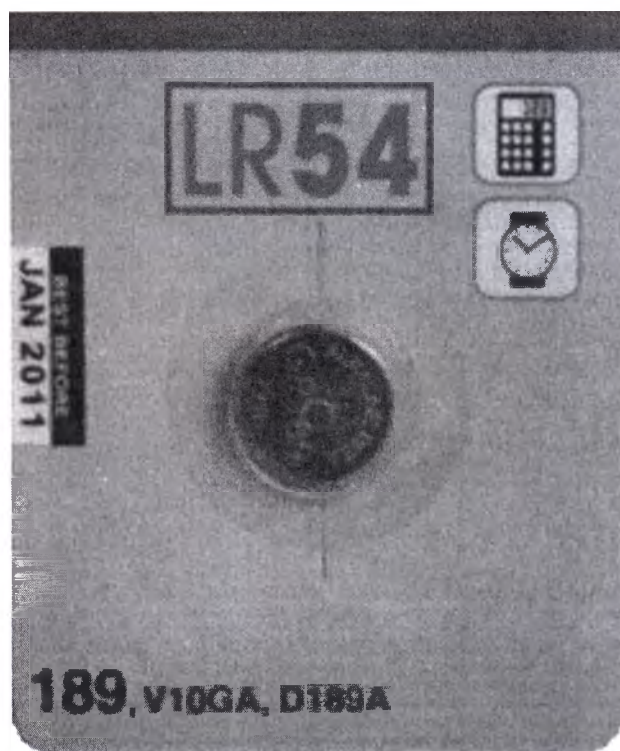

Батарейка для модели WT-07 jumbo

Термометры медицинский электронный модель WT – 09 quick

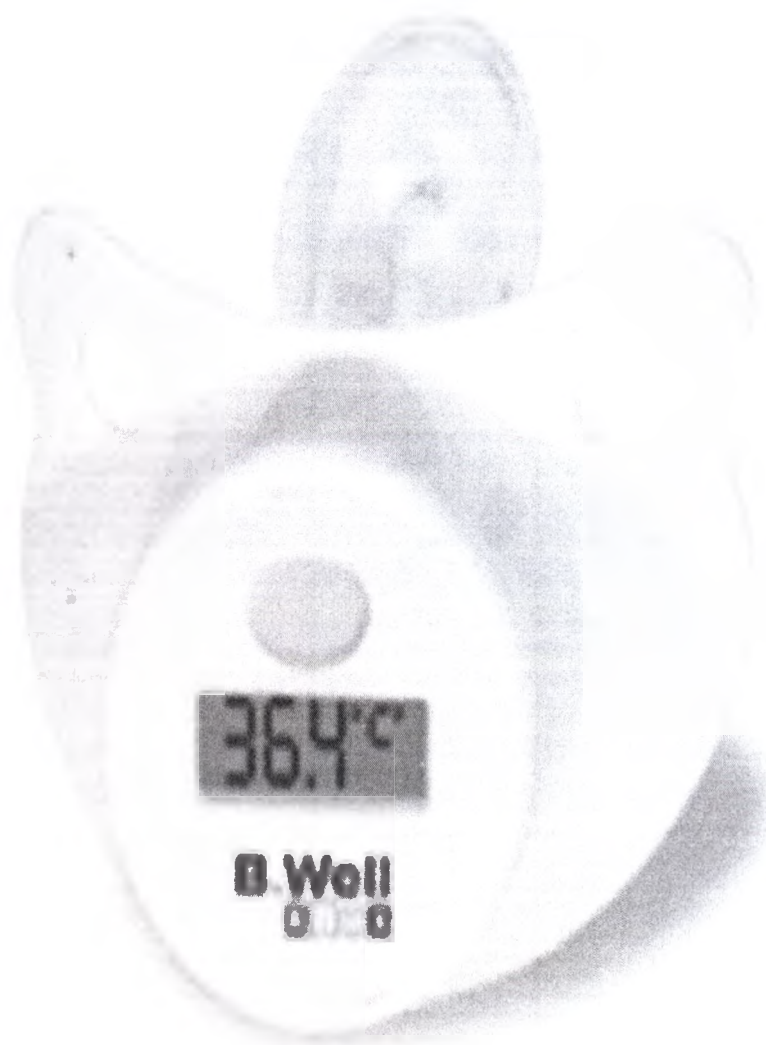

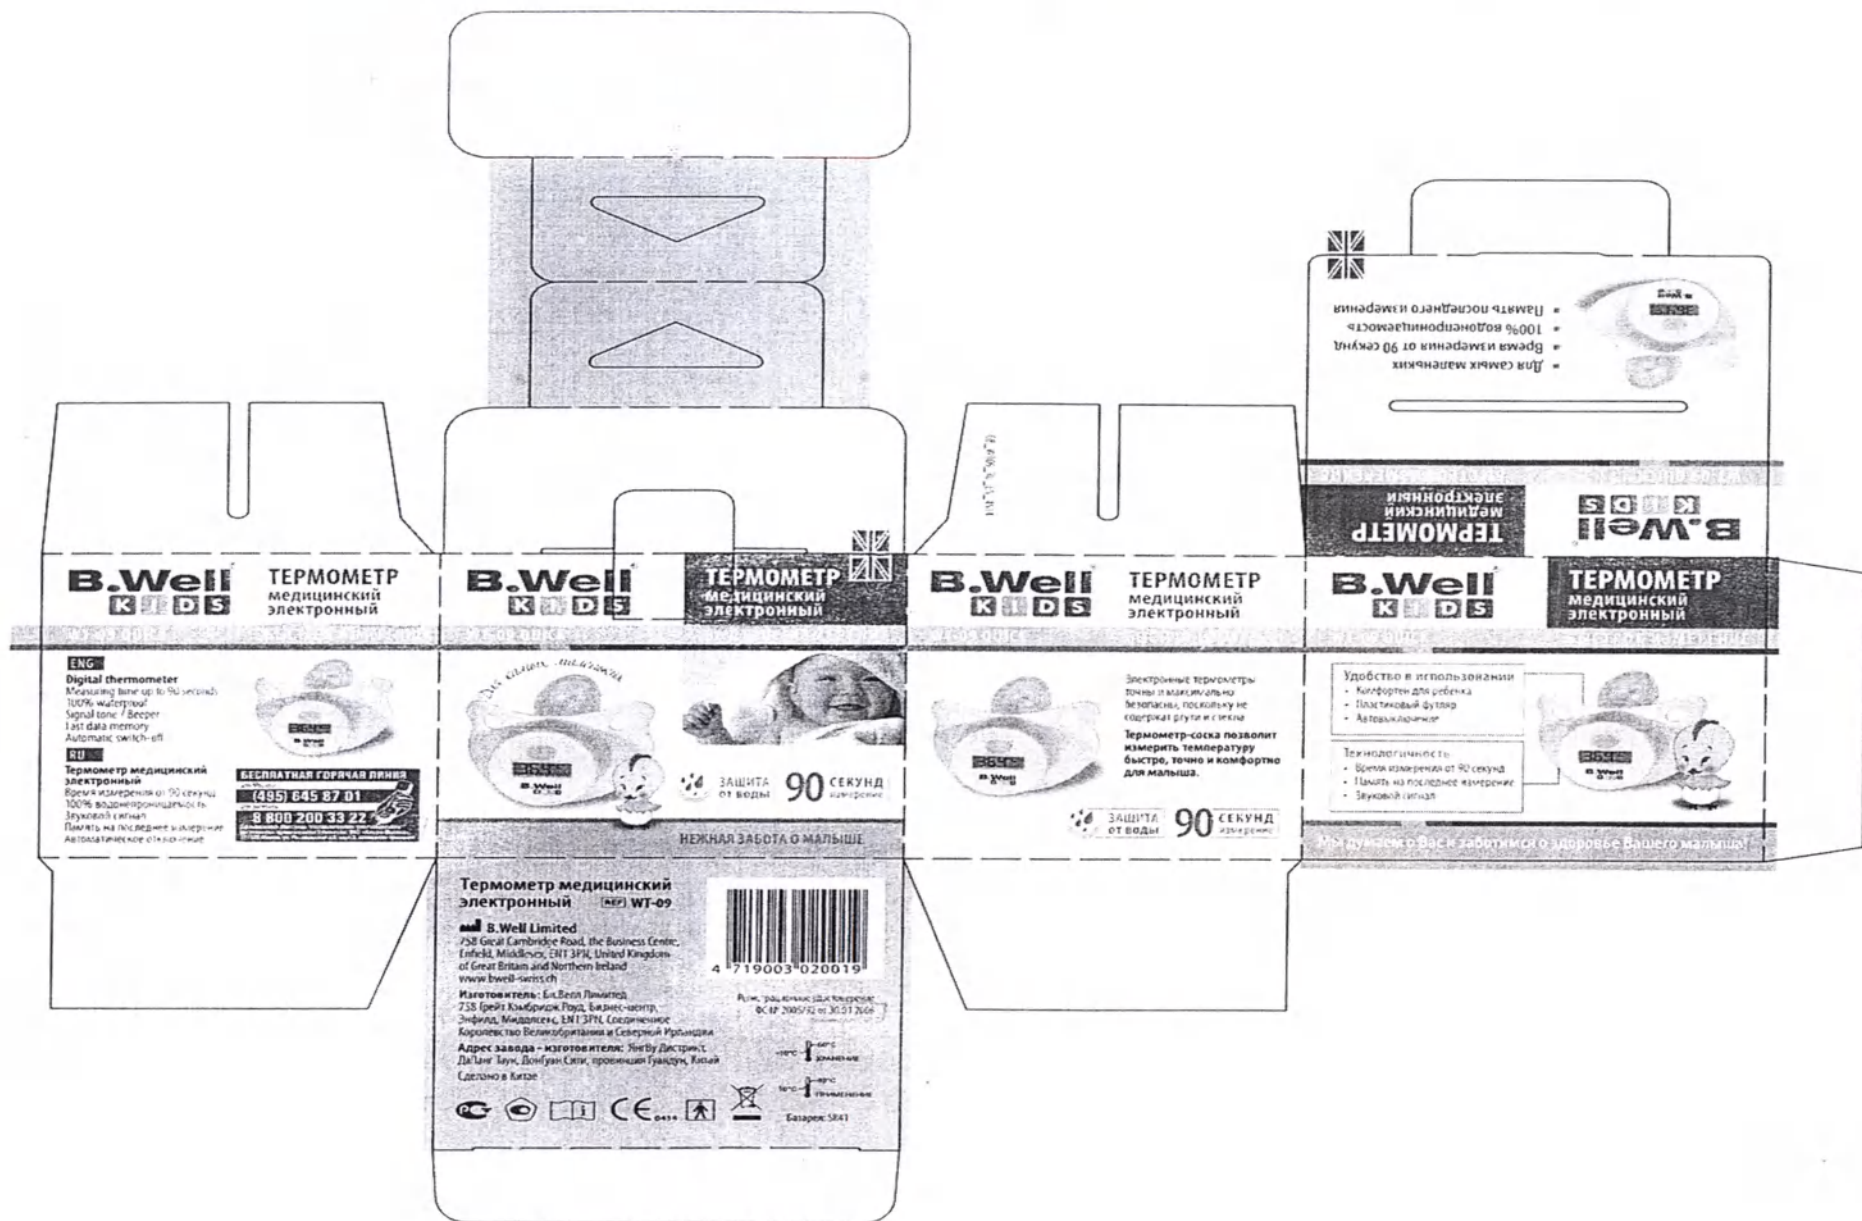

Упаковка



#### Инструкция по эксплуатации

Поскольку медицинский термометр B.Well Kids является медицинским изделием, предназначенным для использования в медицинских целях, он должен использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Перед использованием термометра необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. В случае возникновения вопросов по использованию термометра, пожалуйста, обратитесь к специалисту.

#### Общие сведения о термометре

Термометр B.Well Kids предназначен для измерения температуры тела ребенка. Он имеет цифровой дисплей, который показывает температуру в градусах Цельсия. Термометр имеет датчик, который вставляется в рот ребенка. Датчик имеет защитный футляр, который защищает датчик от повреждений.

#### Технические данные

Модель B.Well Kids

Датчик



Термометр B.Well Kids имеет следующие характеристики:

- Цифровой дисплей, который показывает температуру в градусах Цельсия.
- Датчик, который вставляется в рот ребенка.
- Защитный футляр, который защищает датчик от повреждений.

#### Правила использования термометра

- Перед использованием термометра необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
- Термометр должен использоваться только для измерения температуры тела ребенка.
- Датчик должен вставляться в рот ребенка.
- Термометр должен использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Правила использования термометра:


- Перед использованием термометра необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
- Термометр должен использоваться только для измерения температуры тела ребенка.
- Датчик должен вставляться в рот ребенка.
- Термометр должен использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

#### Дополнительная информация

Термометр B.Well Kids имеет следующие характеристики:

- Цифровой дисплей, который показывает температуру в градусах Цельсия.
- Датчик, который вставляется в рот ребенка.
- Защитный футляр, который защищает датчик от повреждений.


Термометр

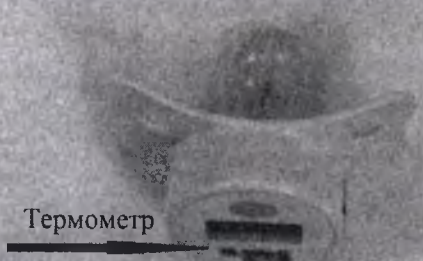

Руководство по эксплуатации

Защитный футляр



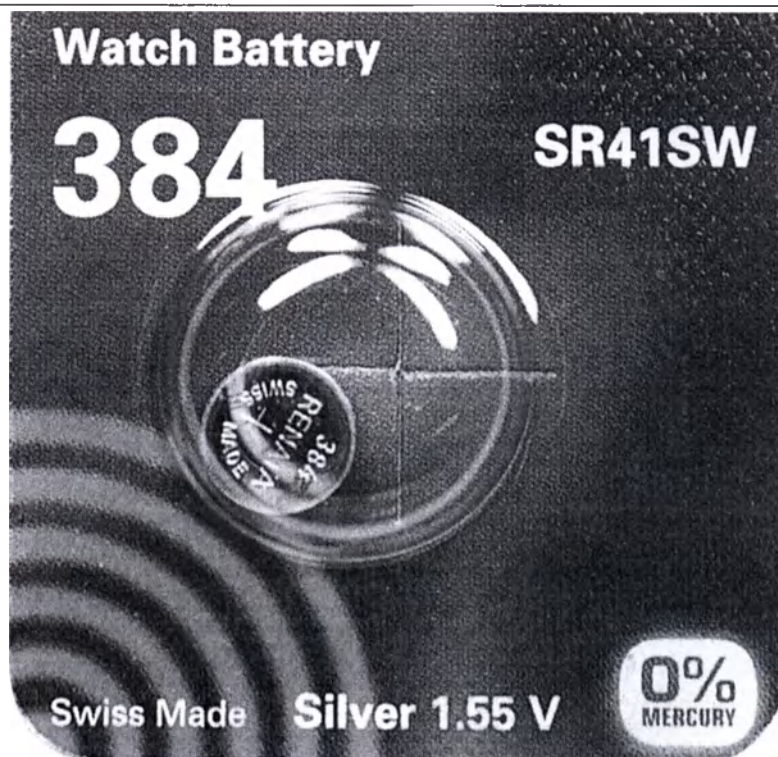

Батарейка для модели WT – 09 quick

Термометры медицинский электронный модель WF-1000







Батарейка для модели WF-1000



# B.Well

- Время измерения 0,1 секунды
- Диапазон измерения от -22 до +80 °C
- Измерение температуры воздуха и окружающей среды

## B.Well

WF-2000  
инфракрасный  
лобный

ТЕРМОМЕТР  
медицинский  
электронный



ТЕРМОМЕТР  
медицинский  
электронный



ТЕХНИКА ТОРГОВЛИ  
4951 645 87 01  
8 800 200 33 22

- Идеален для измерения температуры младенцев и маленьких детей
- Время измерения от 1 секунды
- Диапазон измерения от -22 до +80 °C

# B.Well



THERMOMETER  
INFRARED FOREHEAD DIGITAL MEDICAL

- Able to save up to 25 measurements
- Detects room temperature
- Detects body temperature in an absolutely precise and painless way with infrared method



# B.Well

THERMOMETER  
INFRARED FOREHEAD DIGITAL MEDICAL

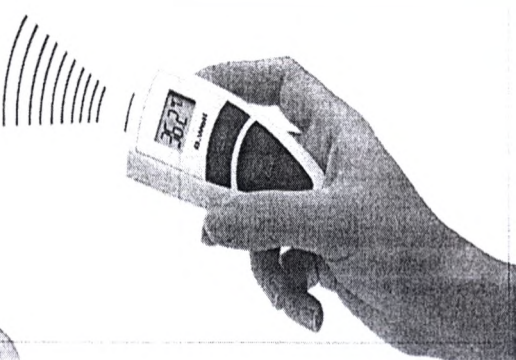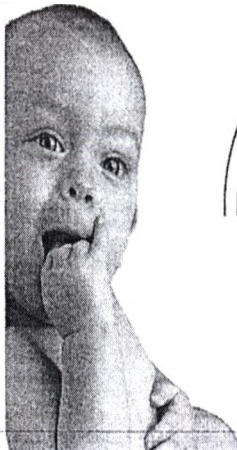

- Able to save up to 25 measurements
- Detects room temperature
- Detects body temperature in an absolutely precise and painless way with infrared method

Термометр медицинский  
электронный (WF-2000)  
инфракрасный лобный

B.Well Limited  
753 Great Cambridge Road, Bedfordshire, England, MK43 0PH, United Kingdom  
of Great Britain and Northern Ireland  
www.bwell-uk.co.uk

Применяется для безболезненного  
измерения температуры тела, температуры  
воздуха, влажности, температуры  
жидкости и окружающей среды

Адрес завода - изготовителя:  
19, 195, Ленинский район, 191000, Санкт-Петербург  
Государственный завод "Беломор", Ленинский район  
Республика Карелия, 169000



8 013240 401201  
Сделано в Китае



Батарейка для модели WF-2000

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью 16 листов  
Генеральный директор  
Кедров А. В.

