

"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по управлению процессами
регистрации и сертификации России и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»




Н.С.Анхимова

2015г

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**"Система медицинская диагностическая Precision THUNIS - 800+ в
исполнениях с принадлежностями".**



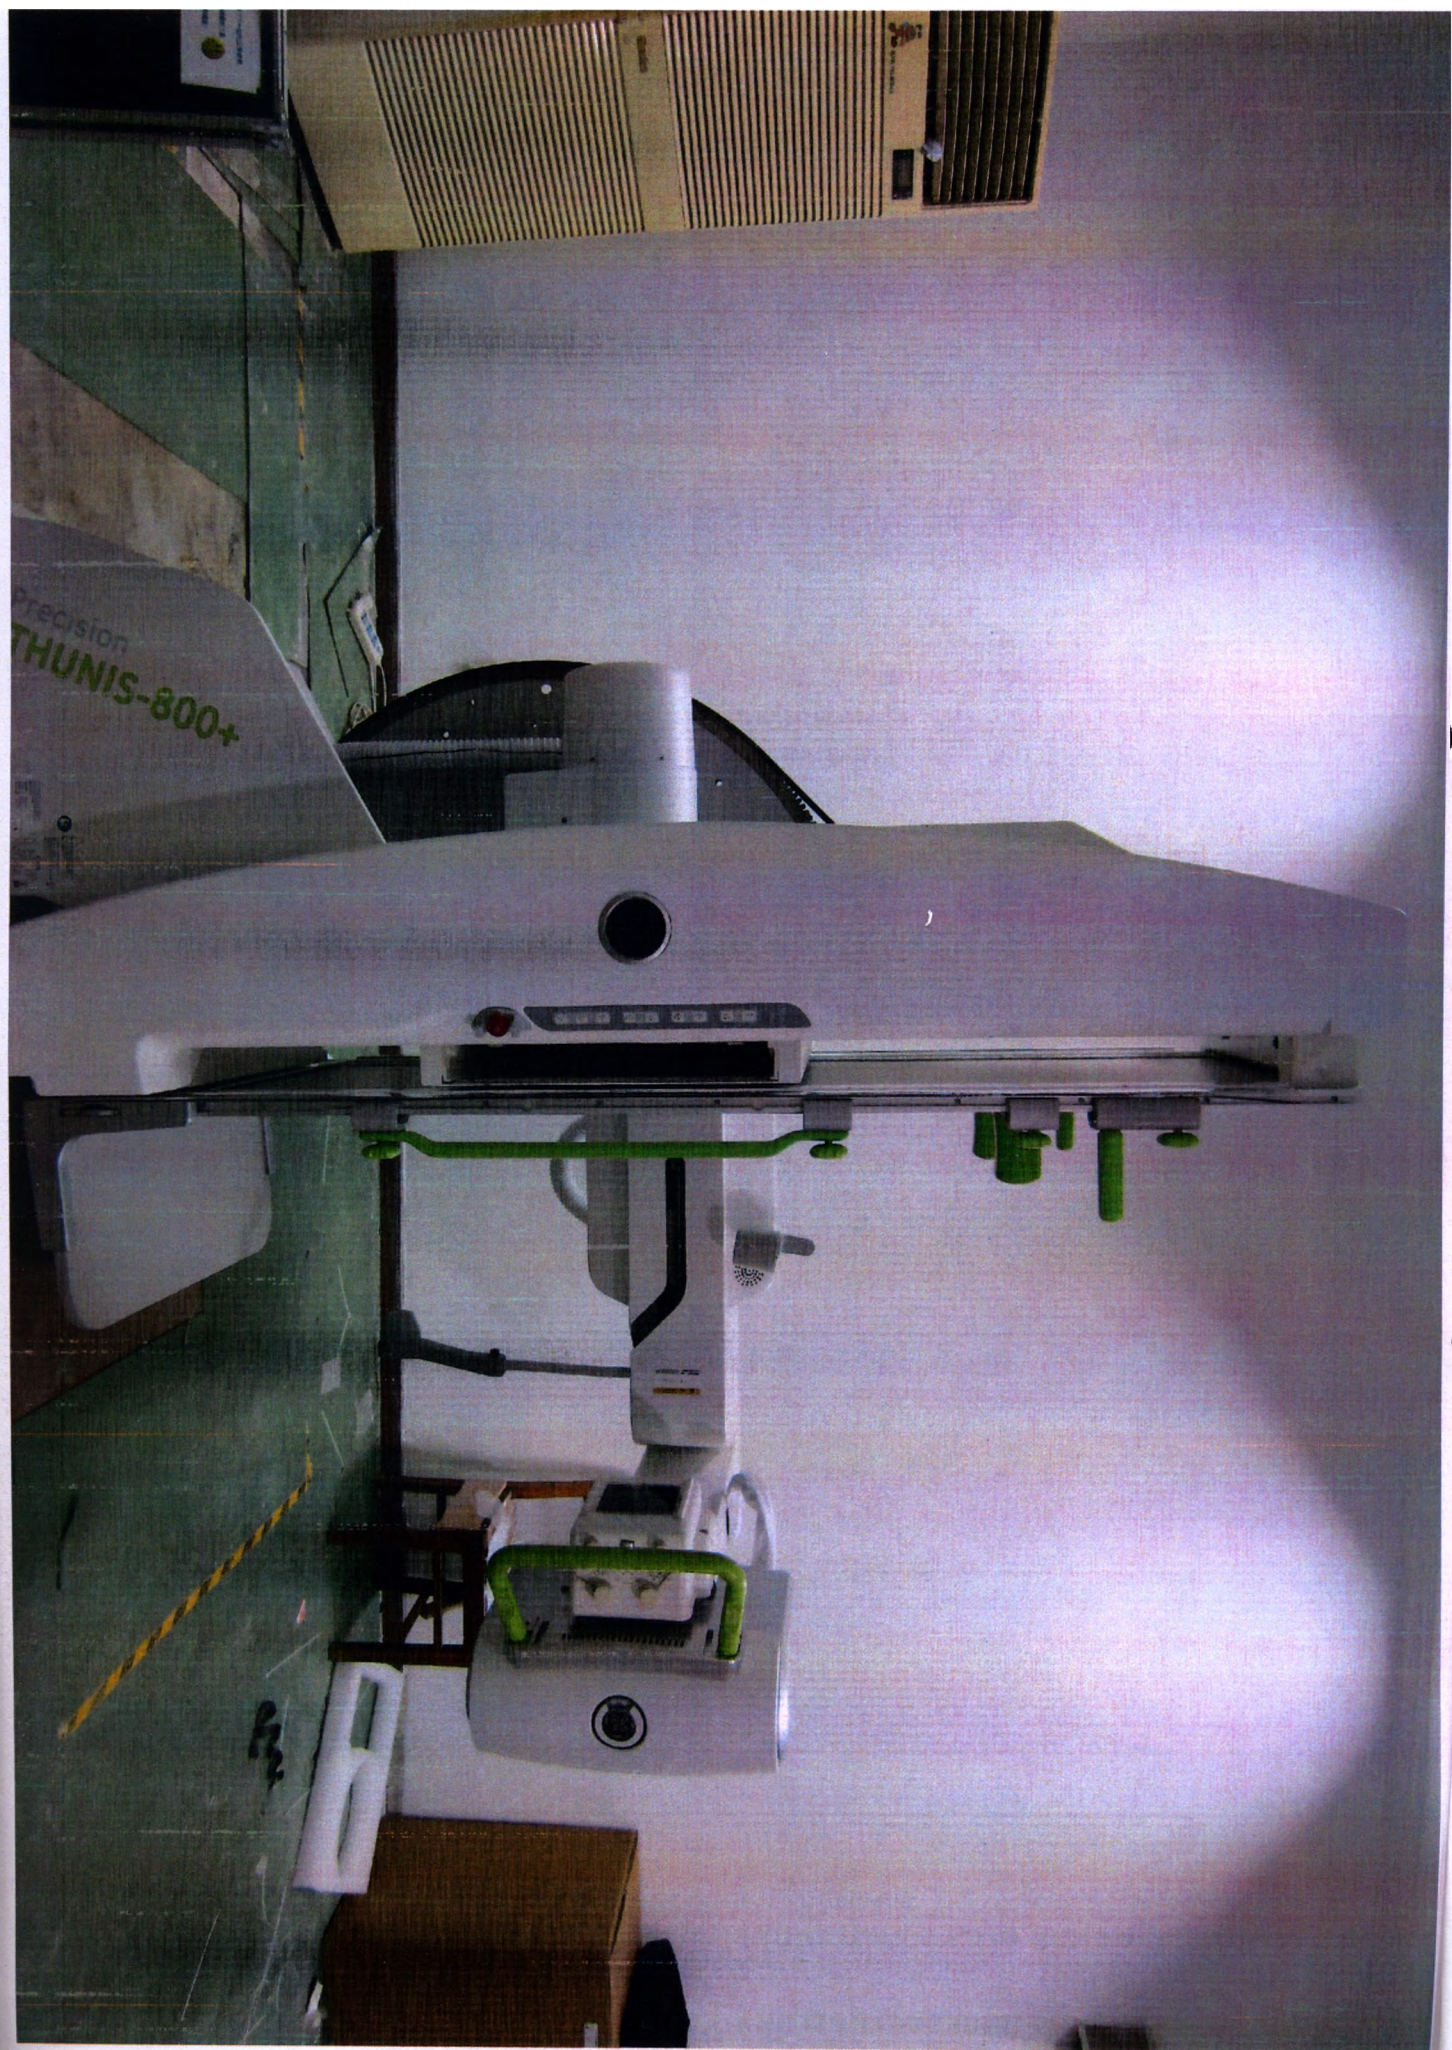


I. Система медицинская диагностическая Precision THUNIS - 800 + вариант исполнения I:


1. Рентгенографический стол с дистанционным управлением.




2. Генератор высокого напряжения: 50 кВт.

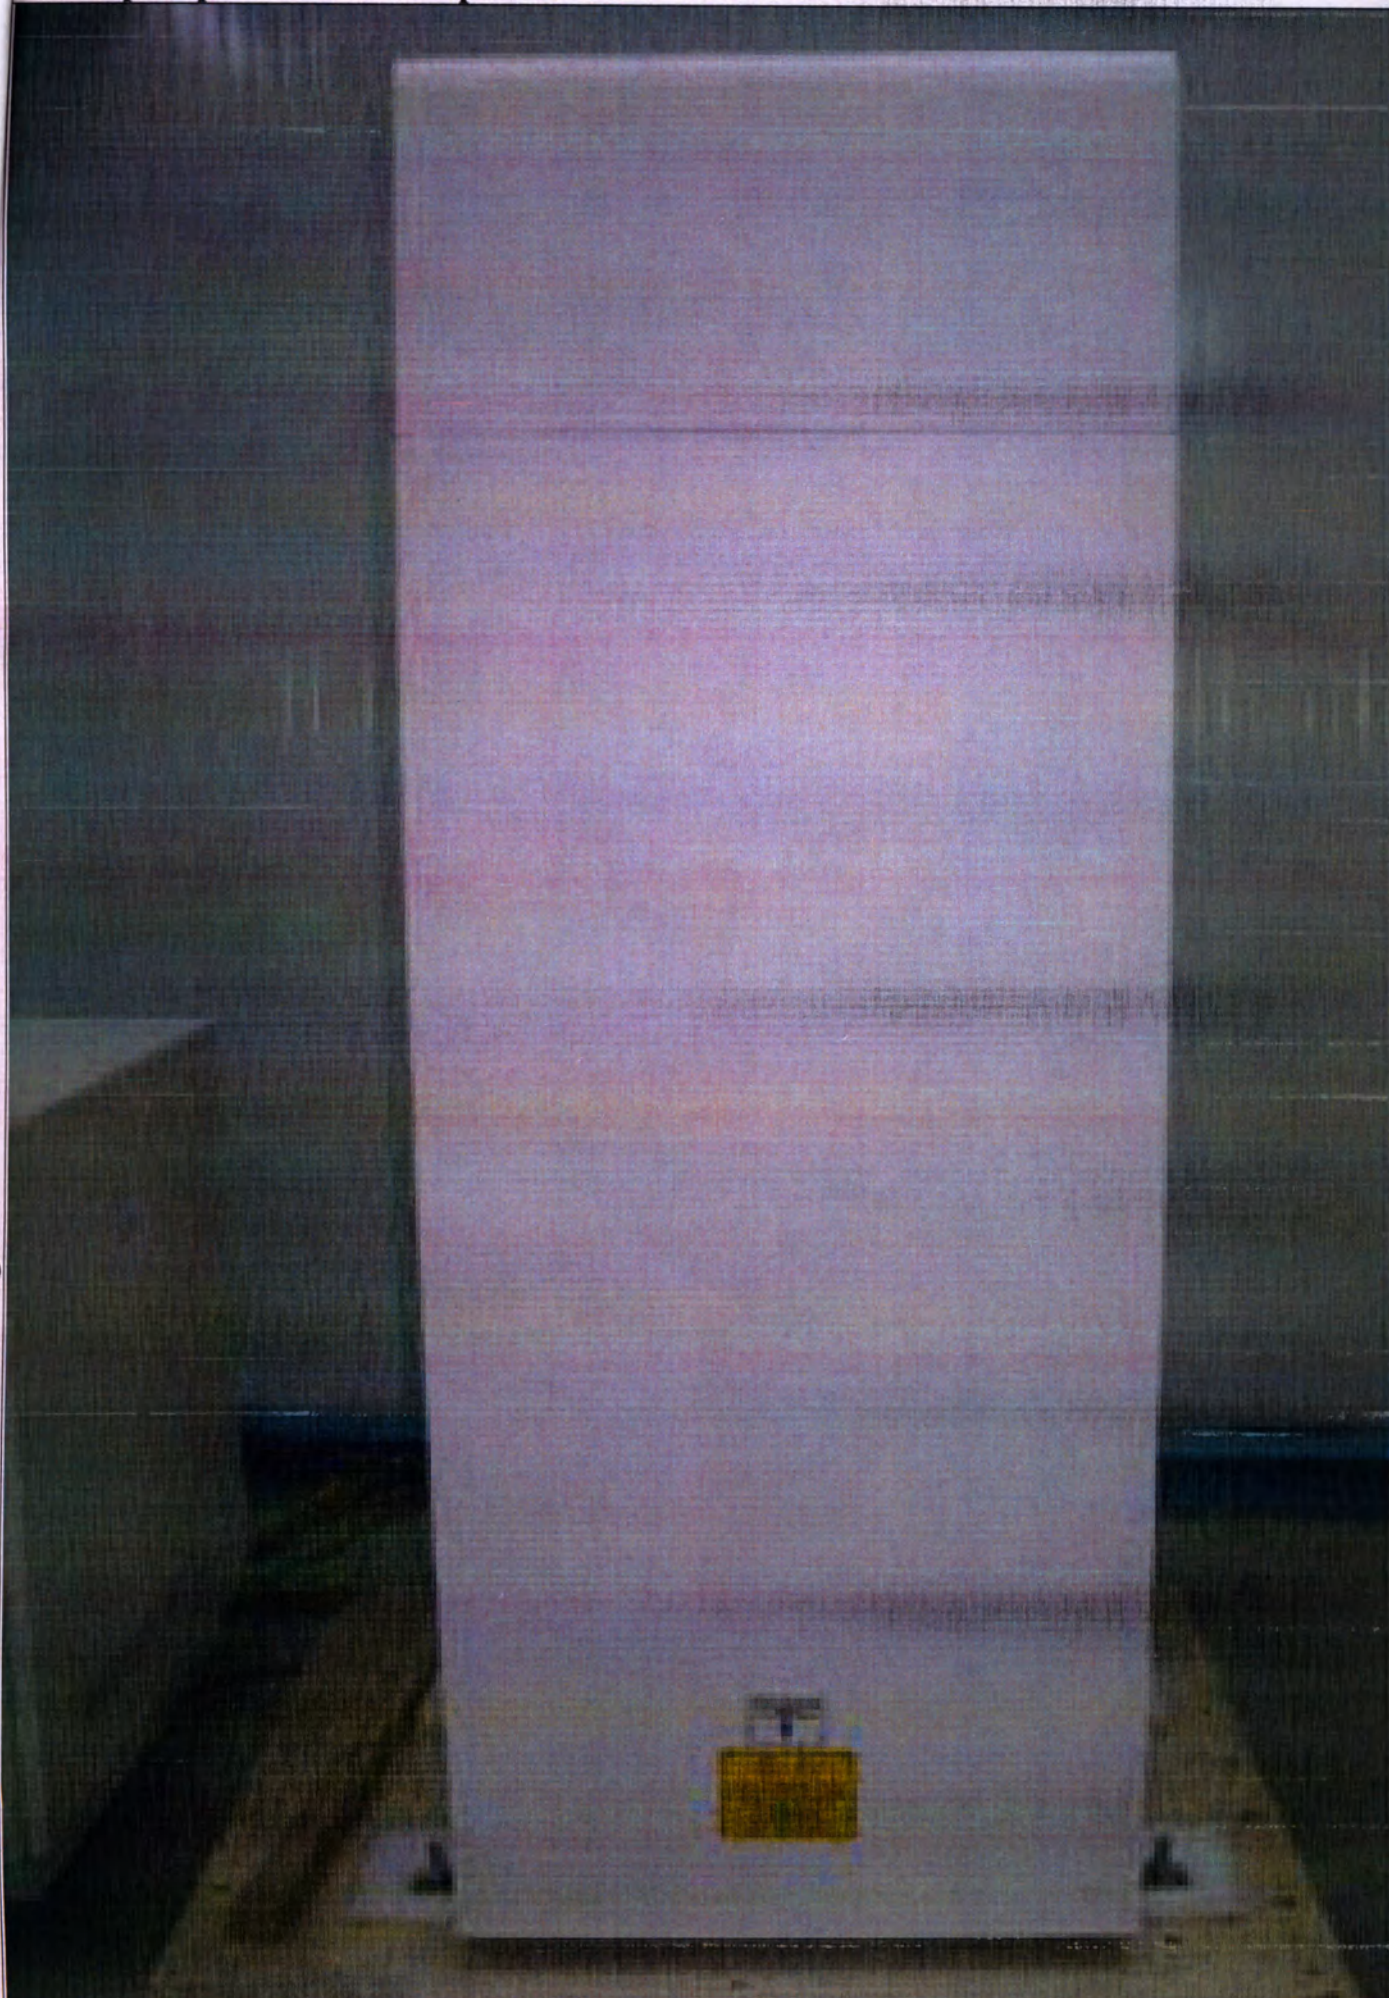


Коллиматор.

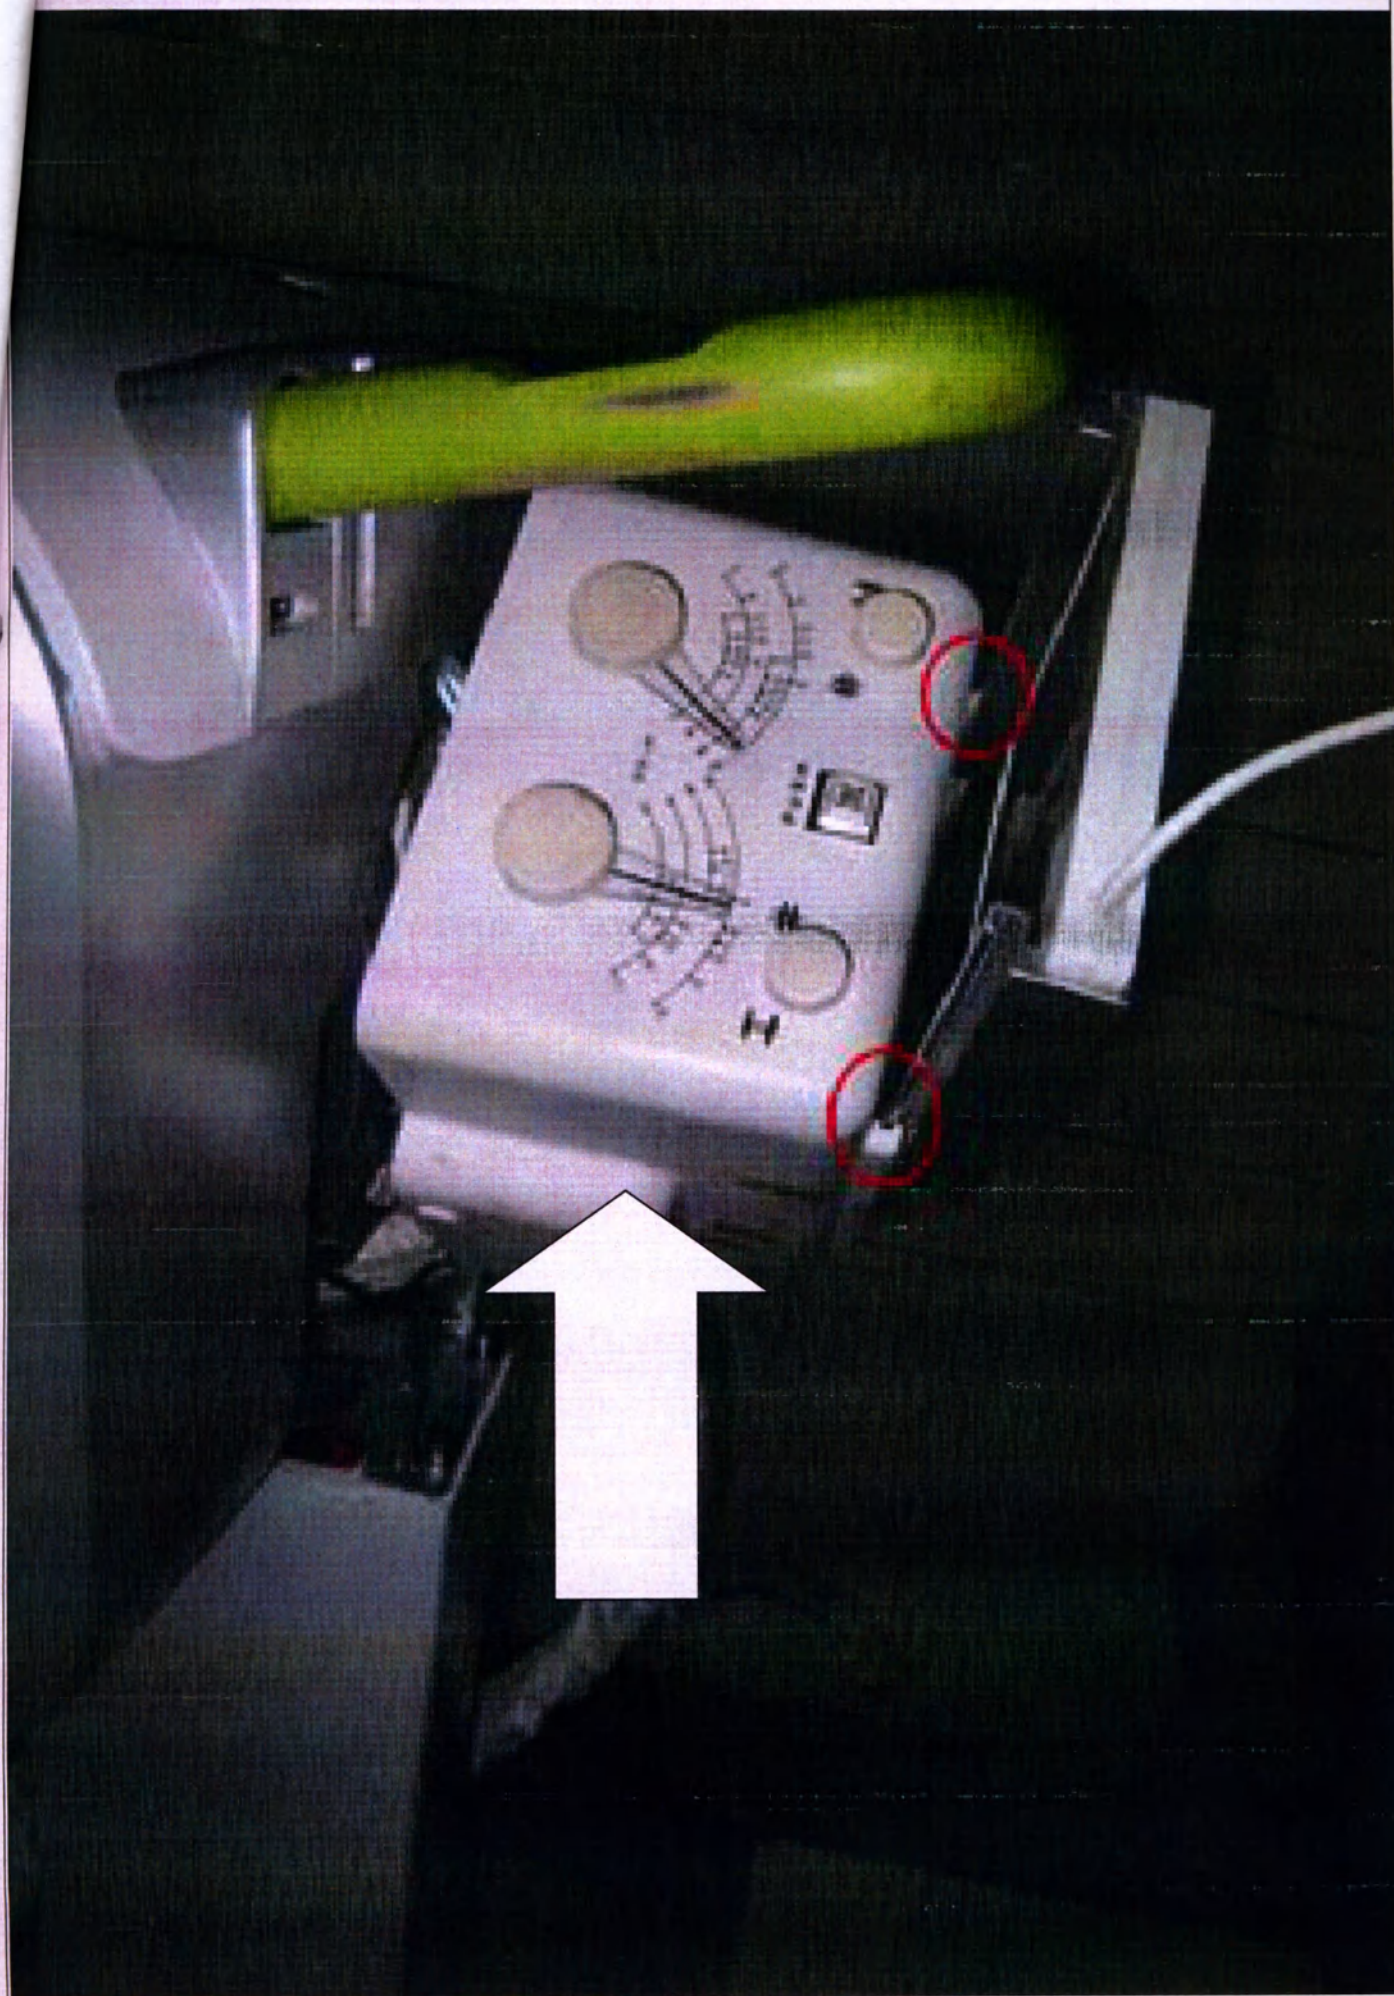


Консоль управления.

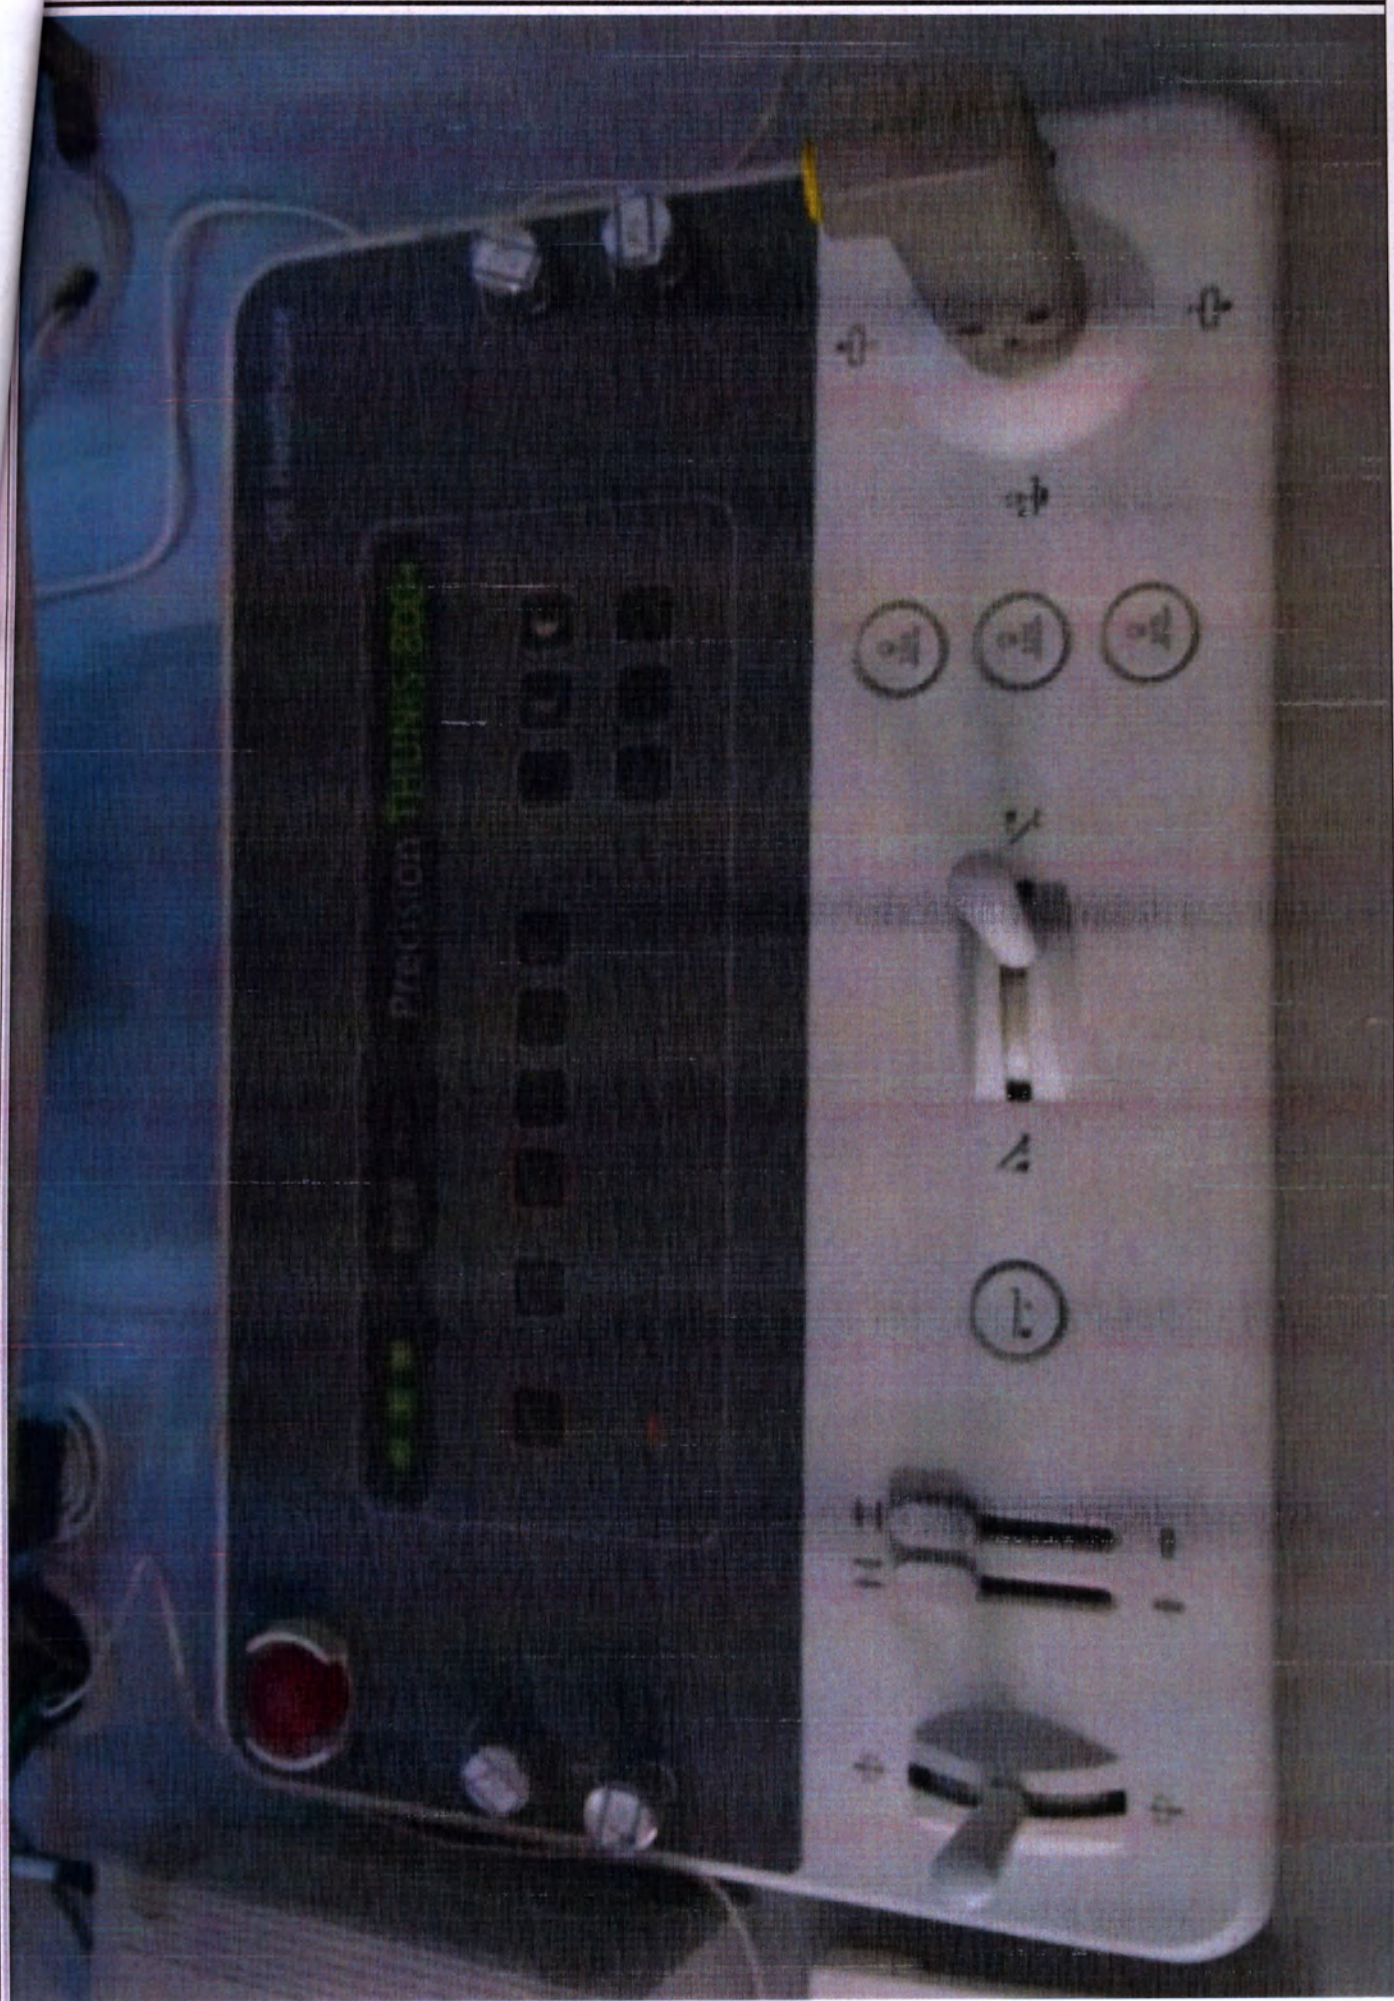


Рентгеновский излучатель.

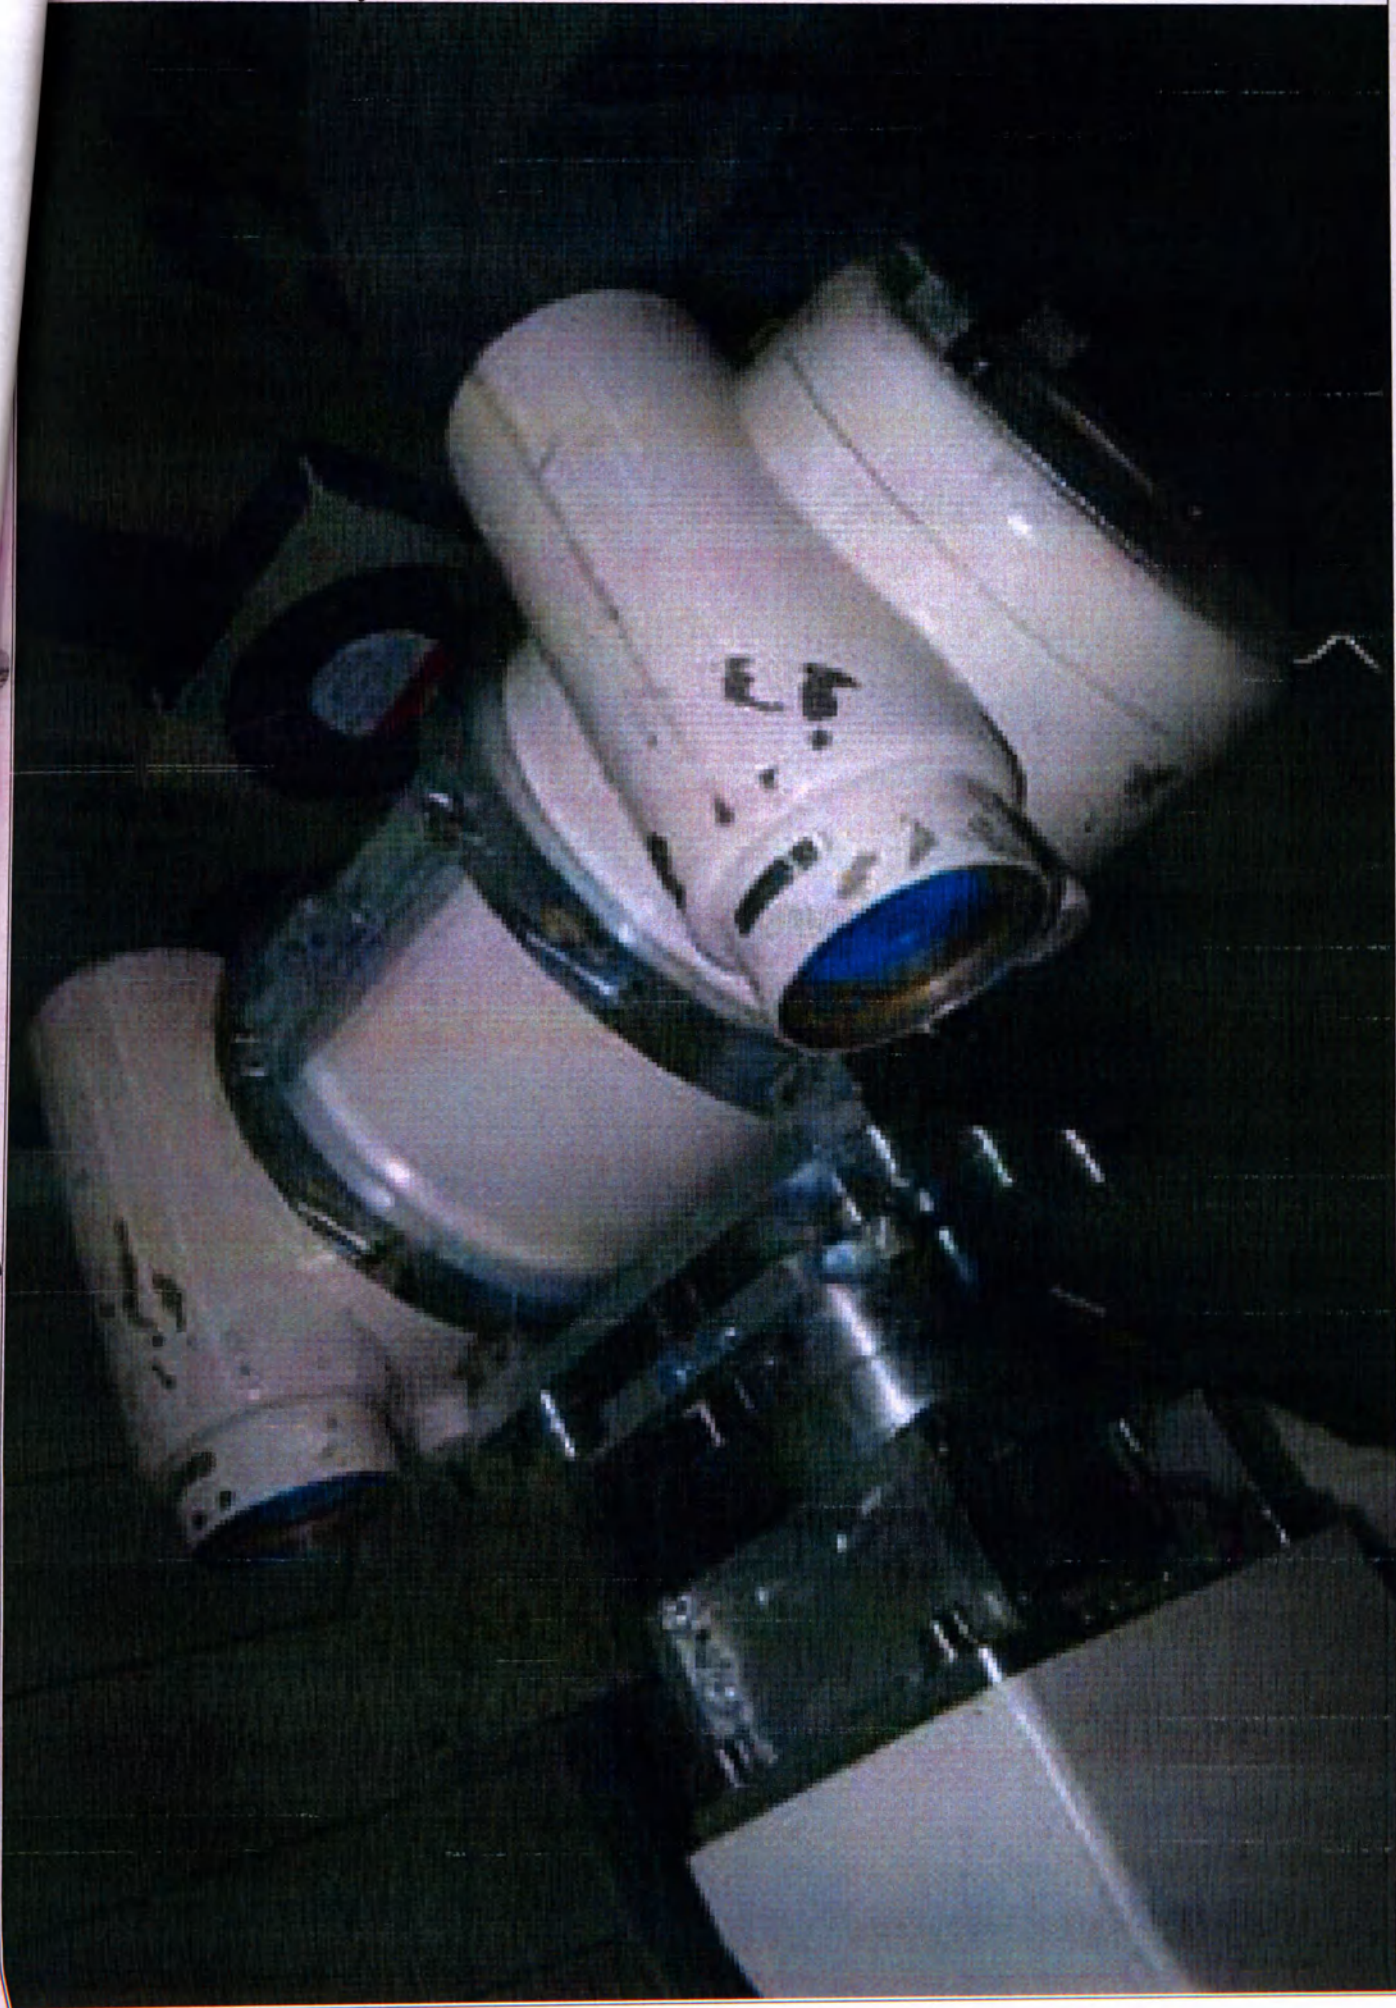

Усилитель рентгеновского изображения.

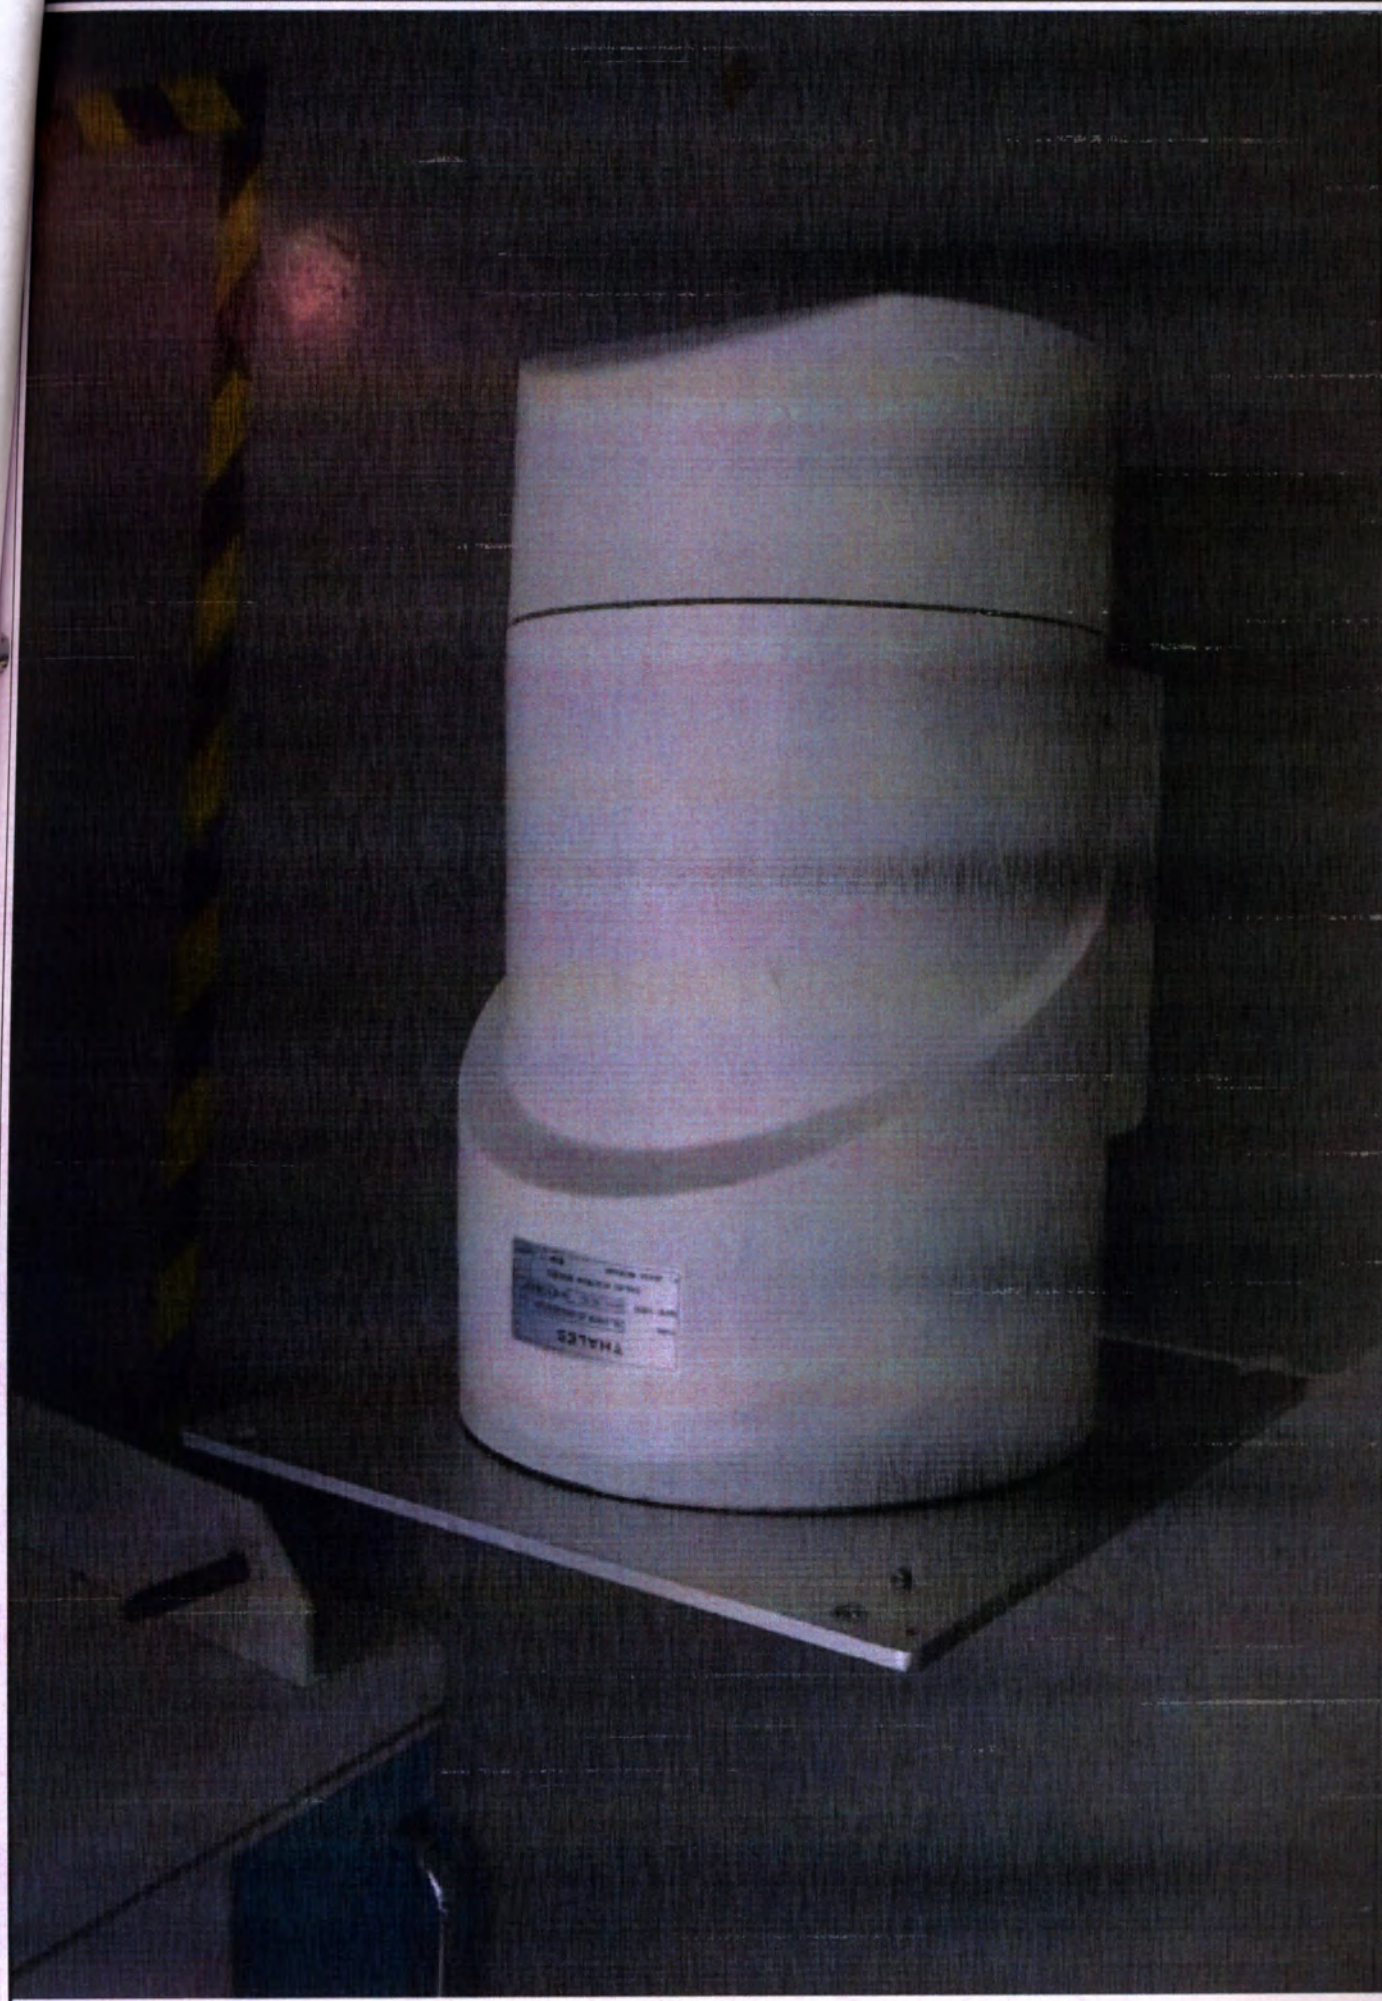

7. Распределительный блок питания.

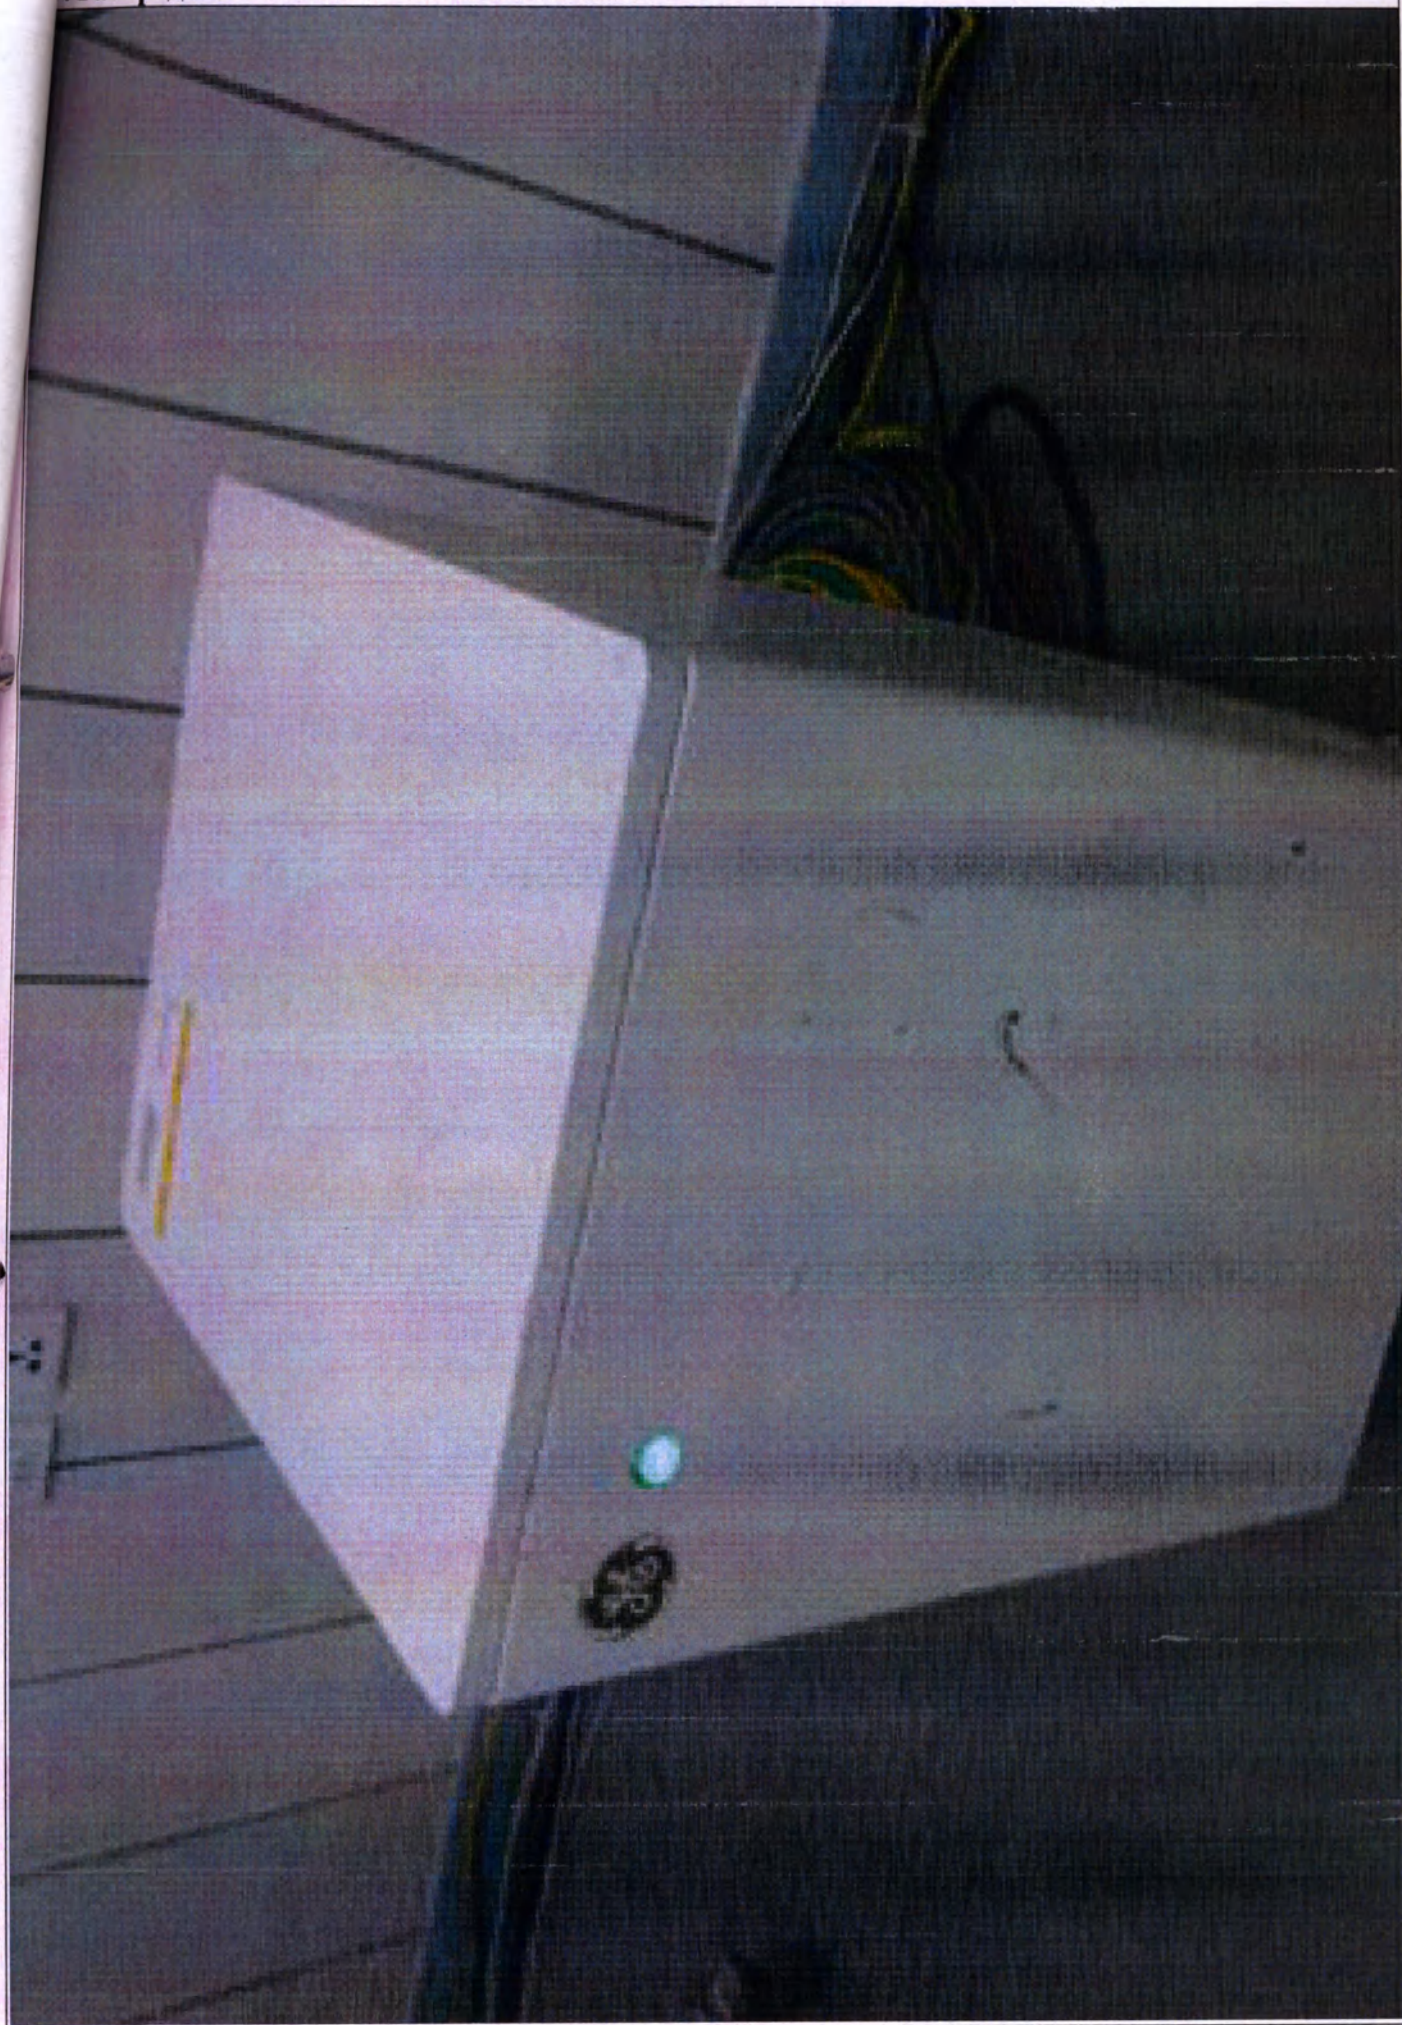


II. Принадлежности:


1. Колонна для трубки.





2. Ионизационные камеры для индикатора дозы (не более 2 шт.).

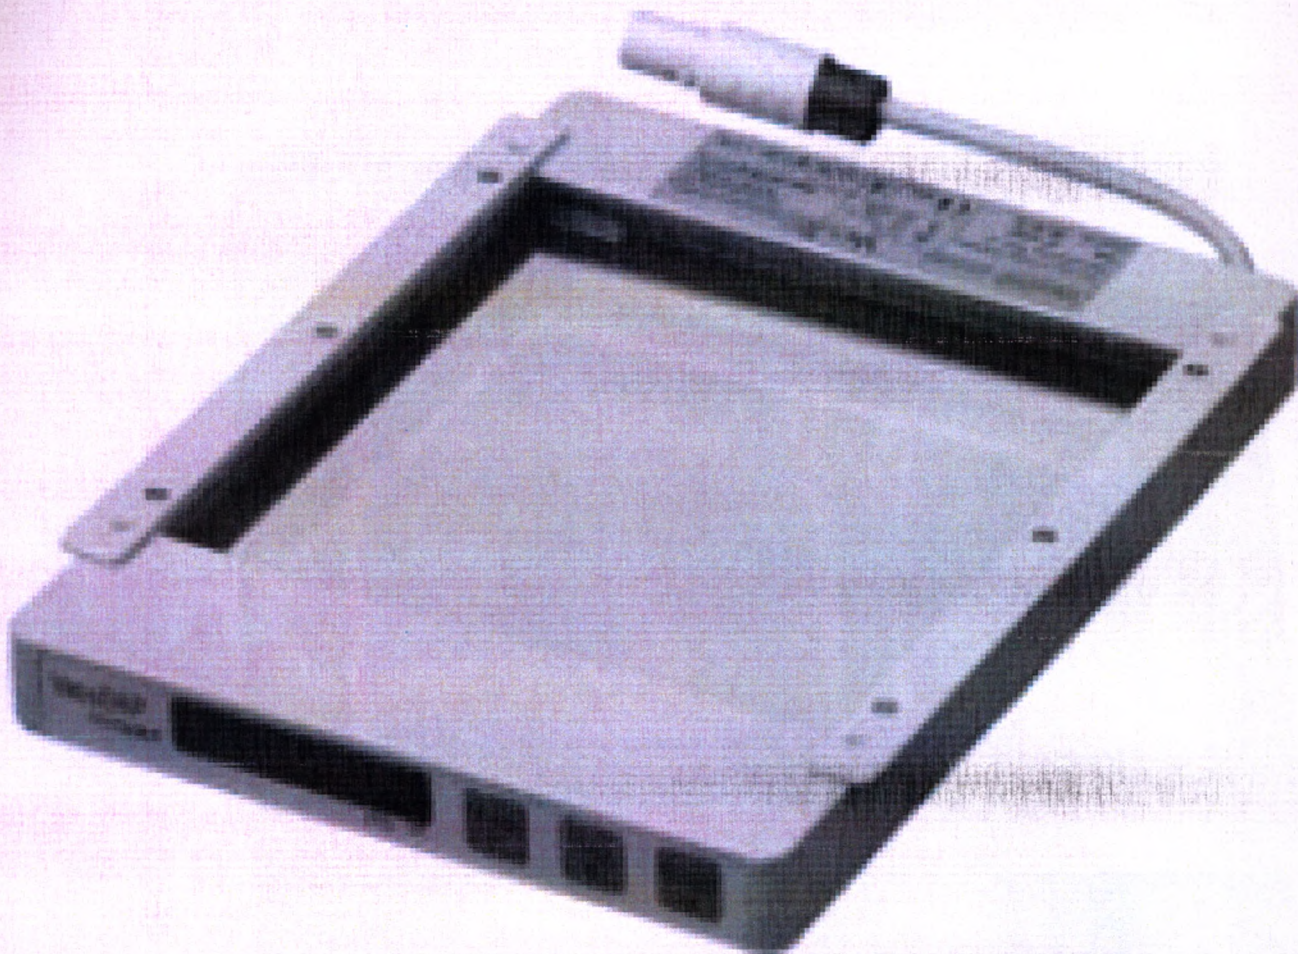


3. Мониторы жидкокристаллические (не более 4 шт.).

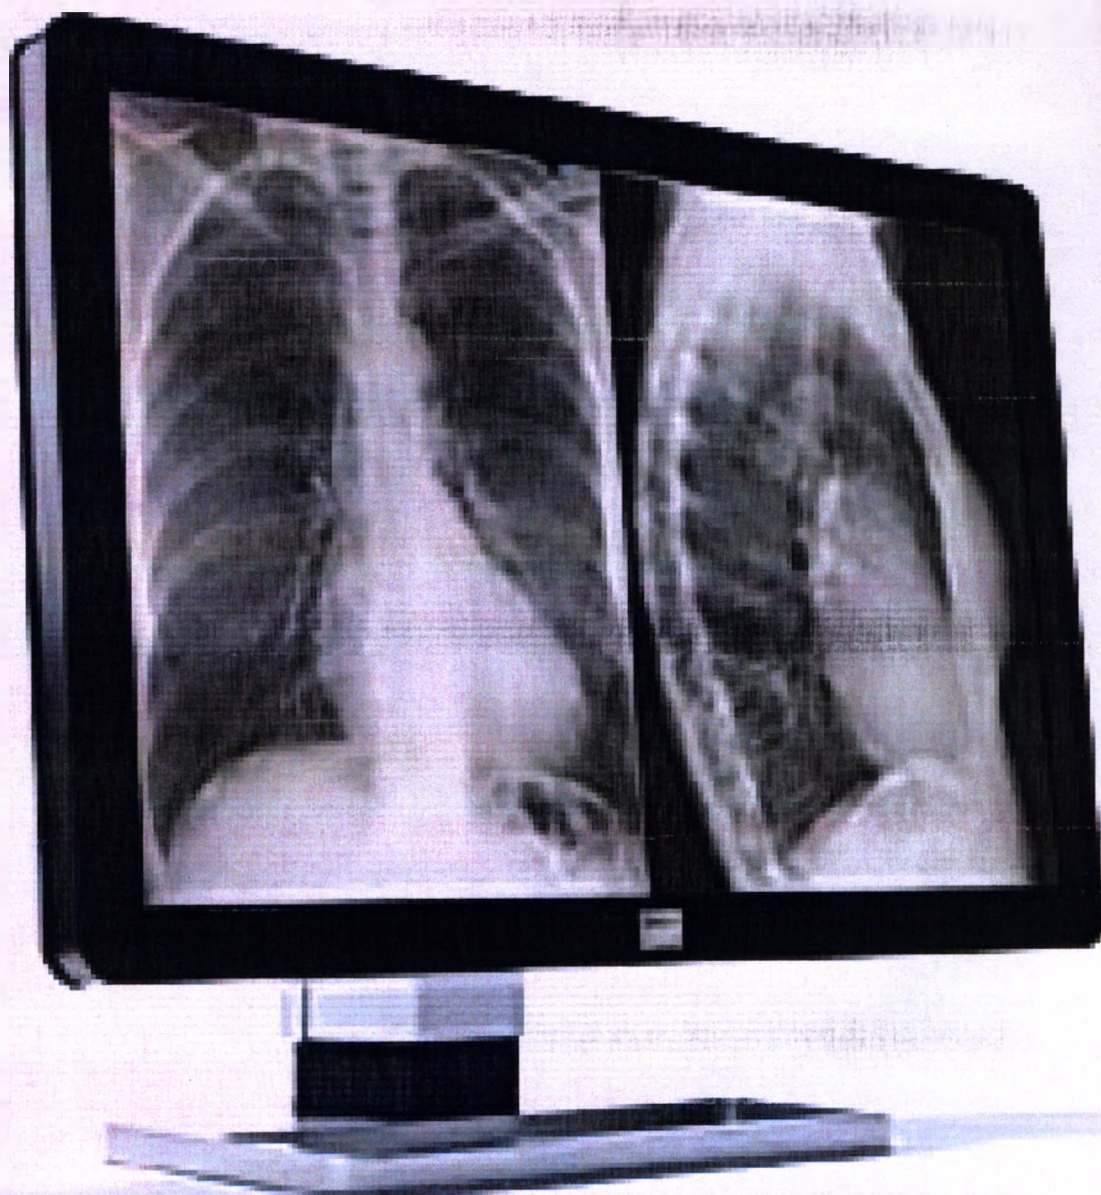

4. Индикатор дозы.

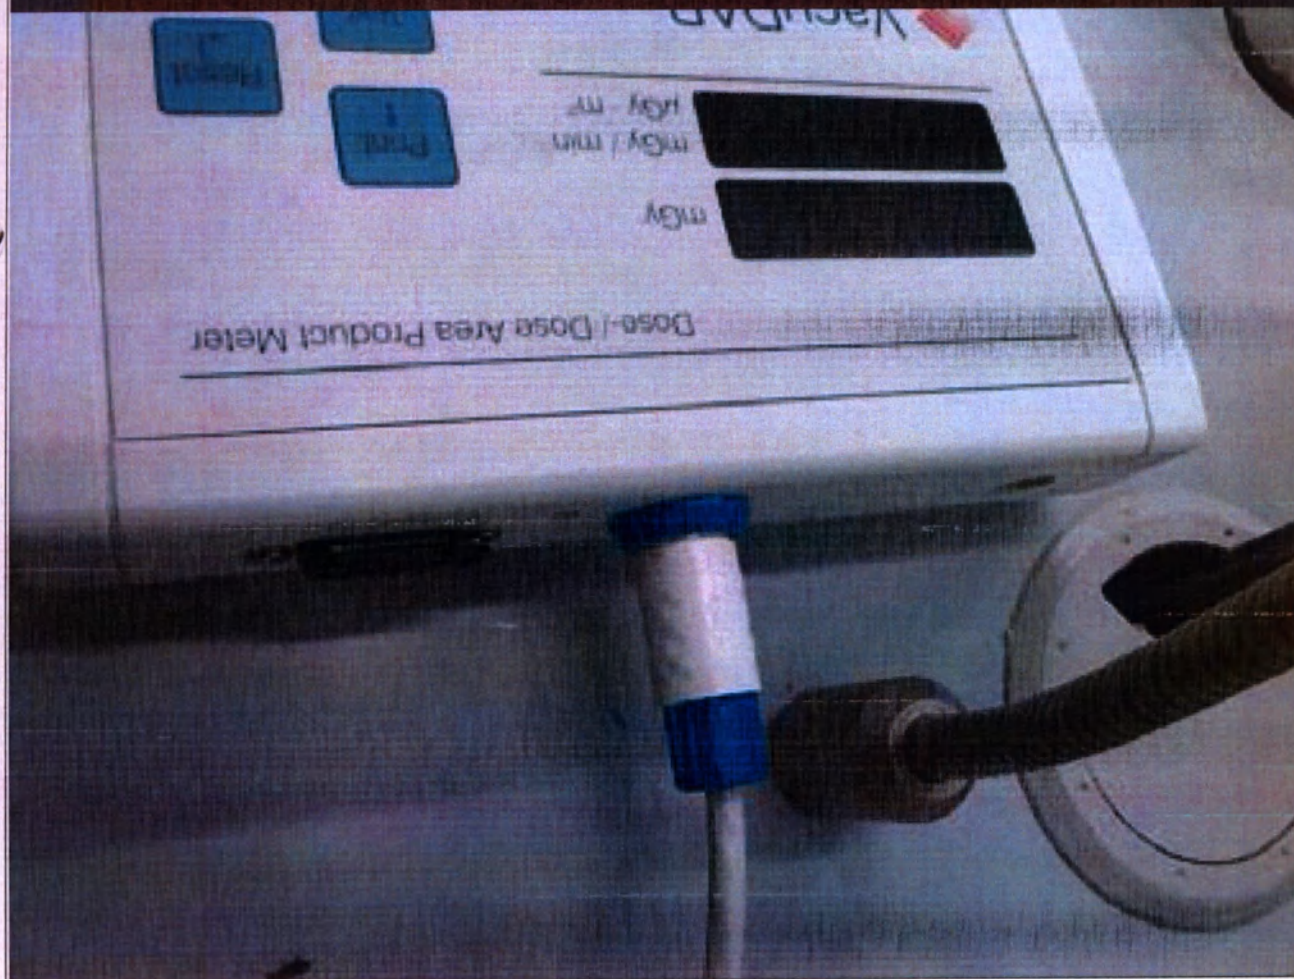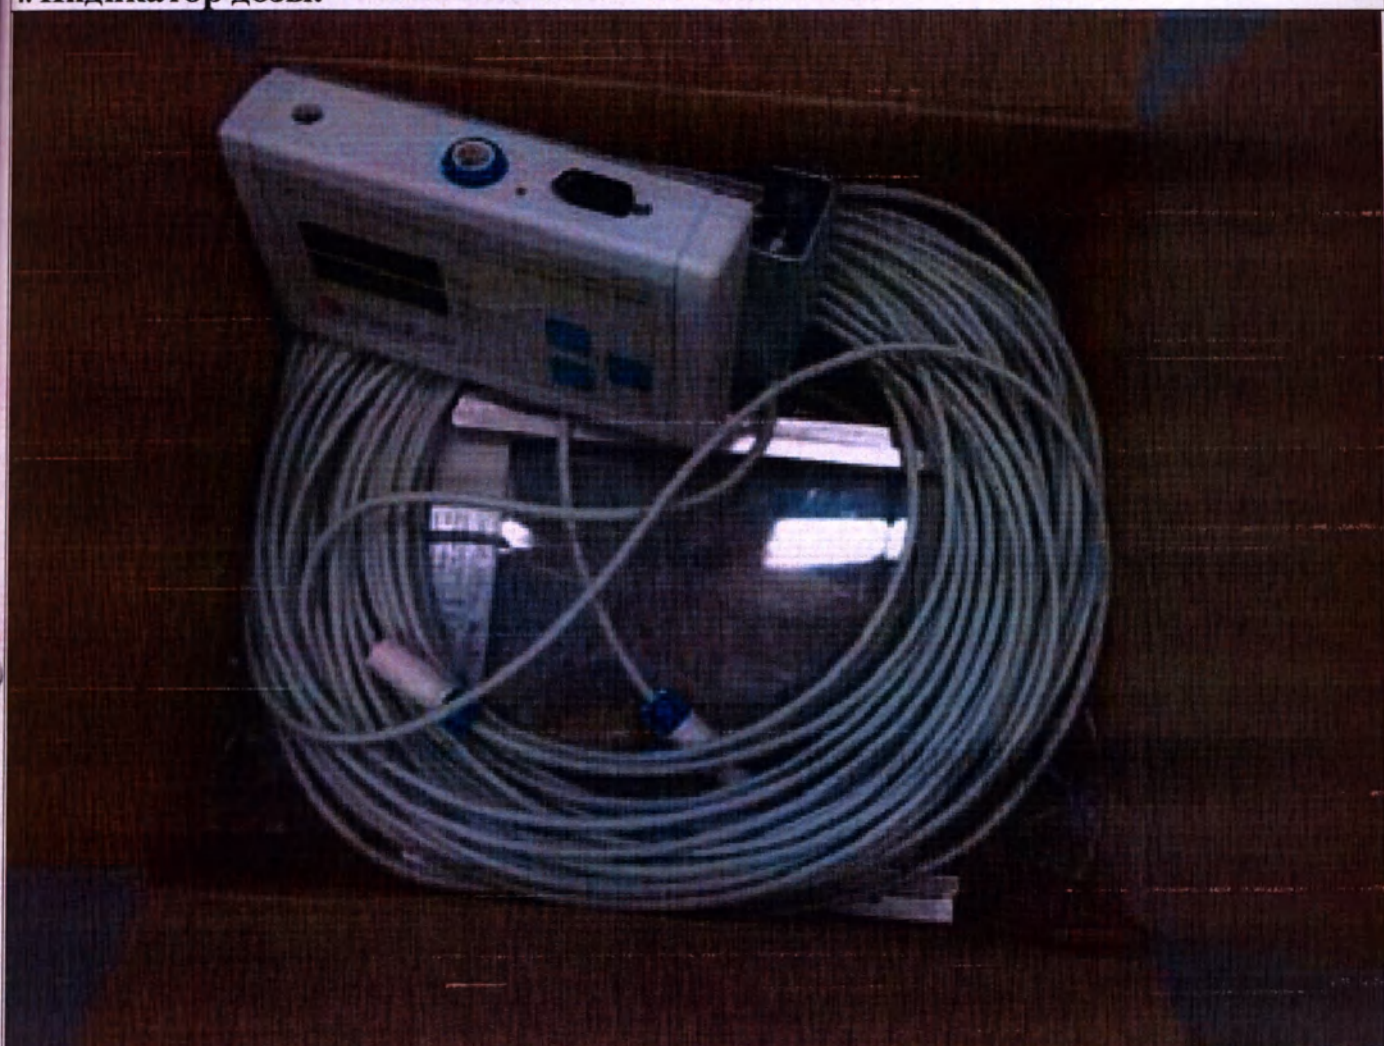

5. Источник бесперебойного питания.

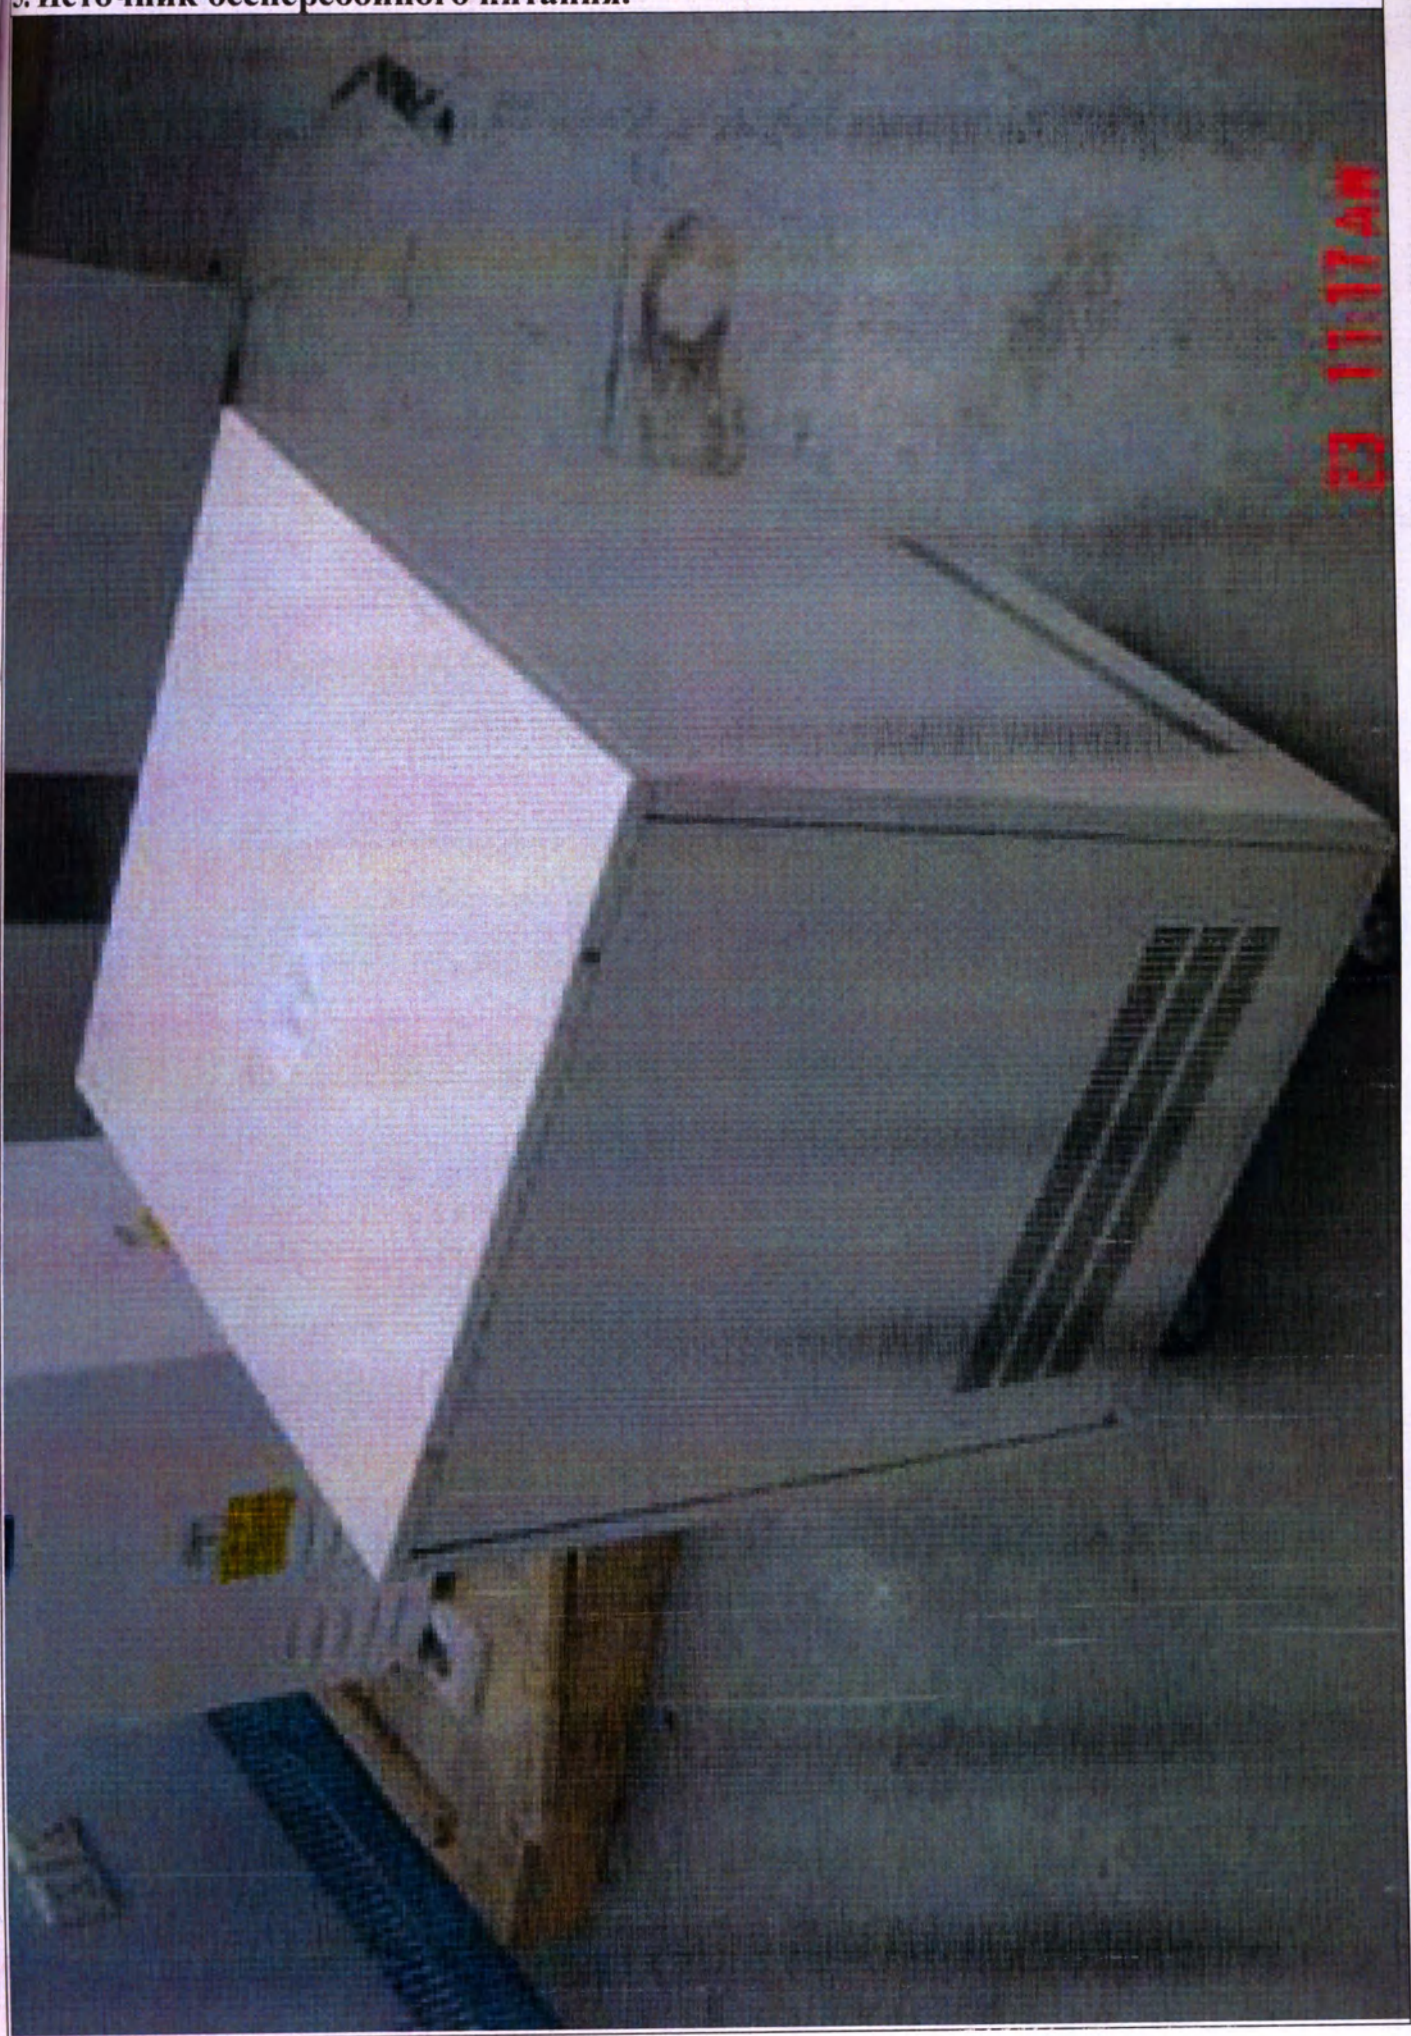

6. Тележка для процедурной.




Станция врача компьютеризированная рабочая




8. Станция оператора компьютеризированная рабочая.




9. Вертикальная стойка

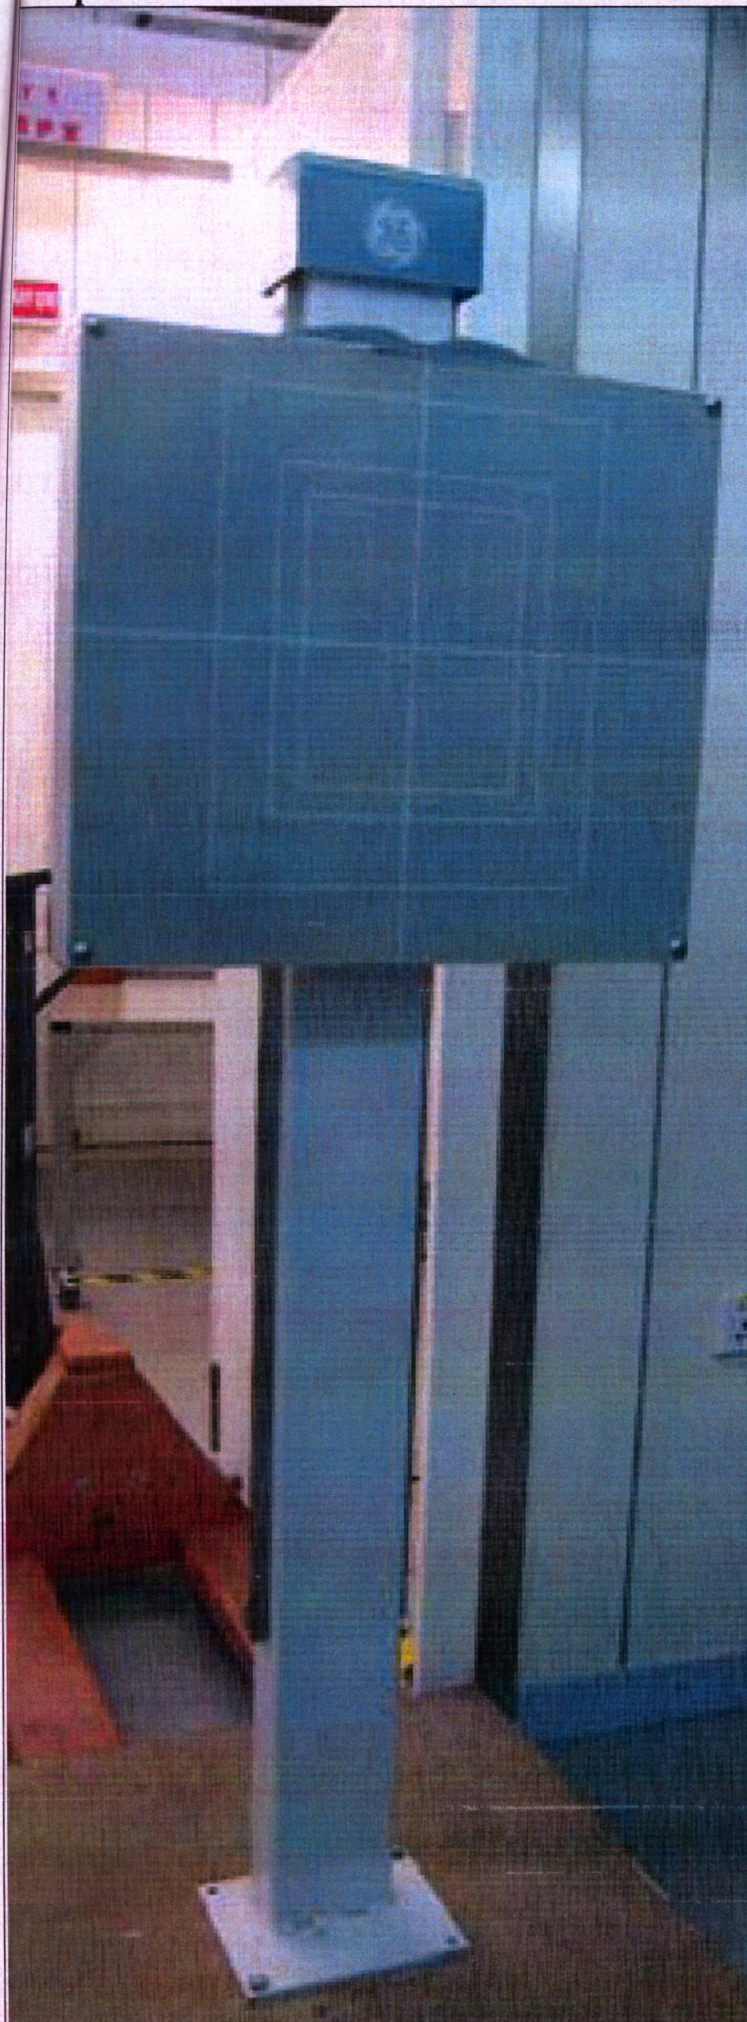


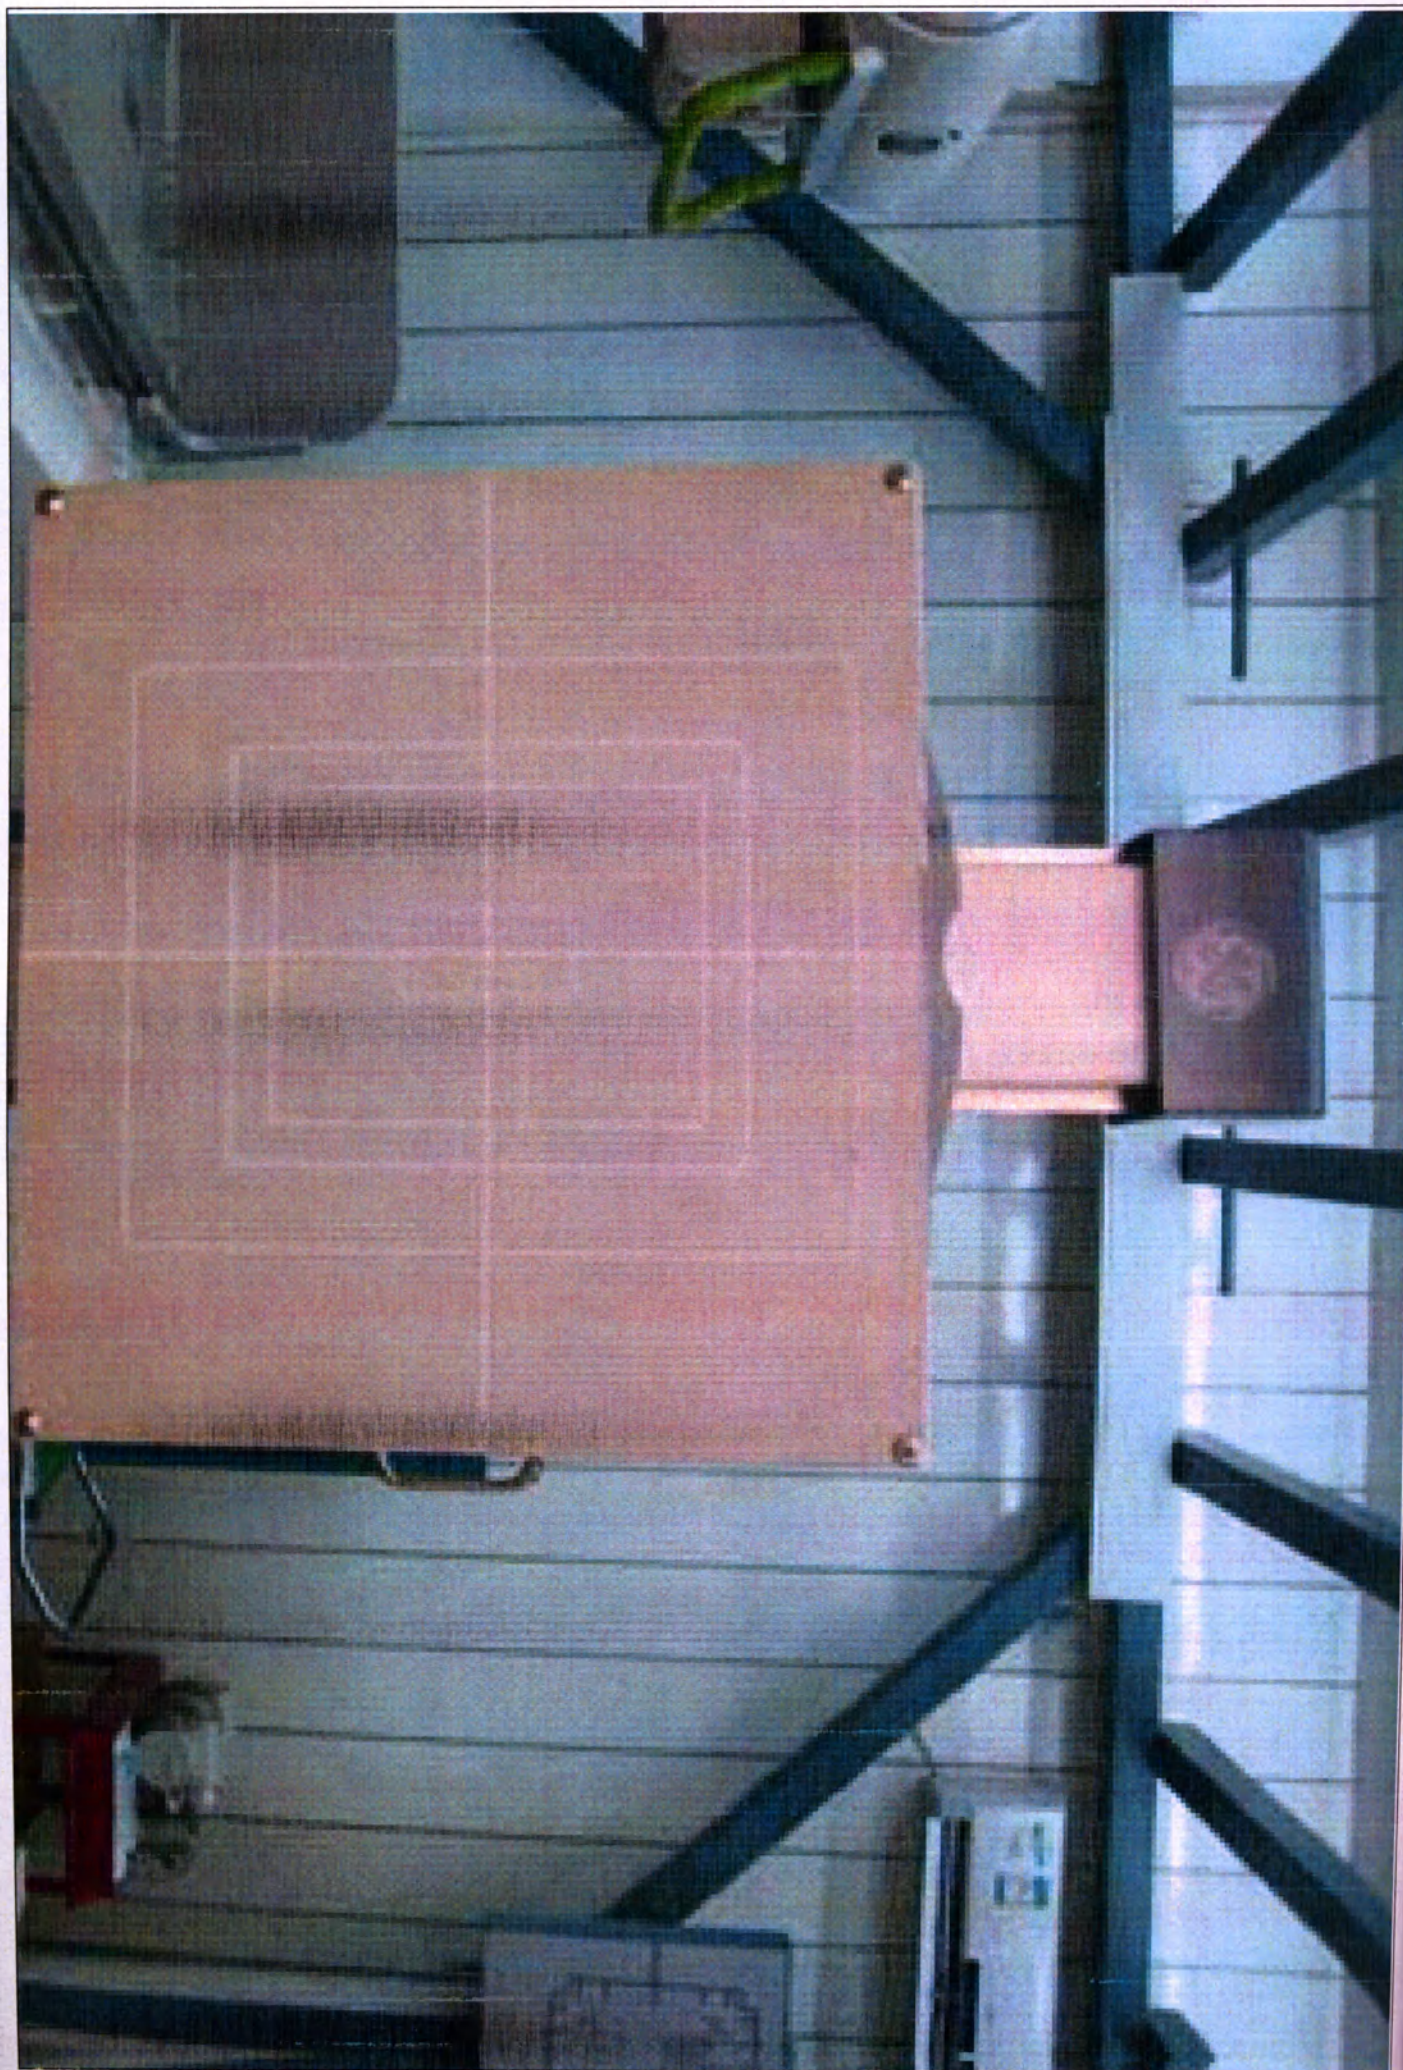


10. Держатель для рук на стойке снимков.

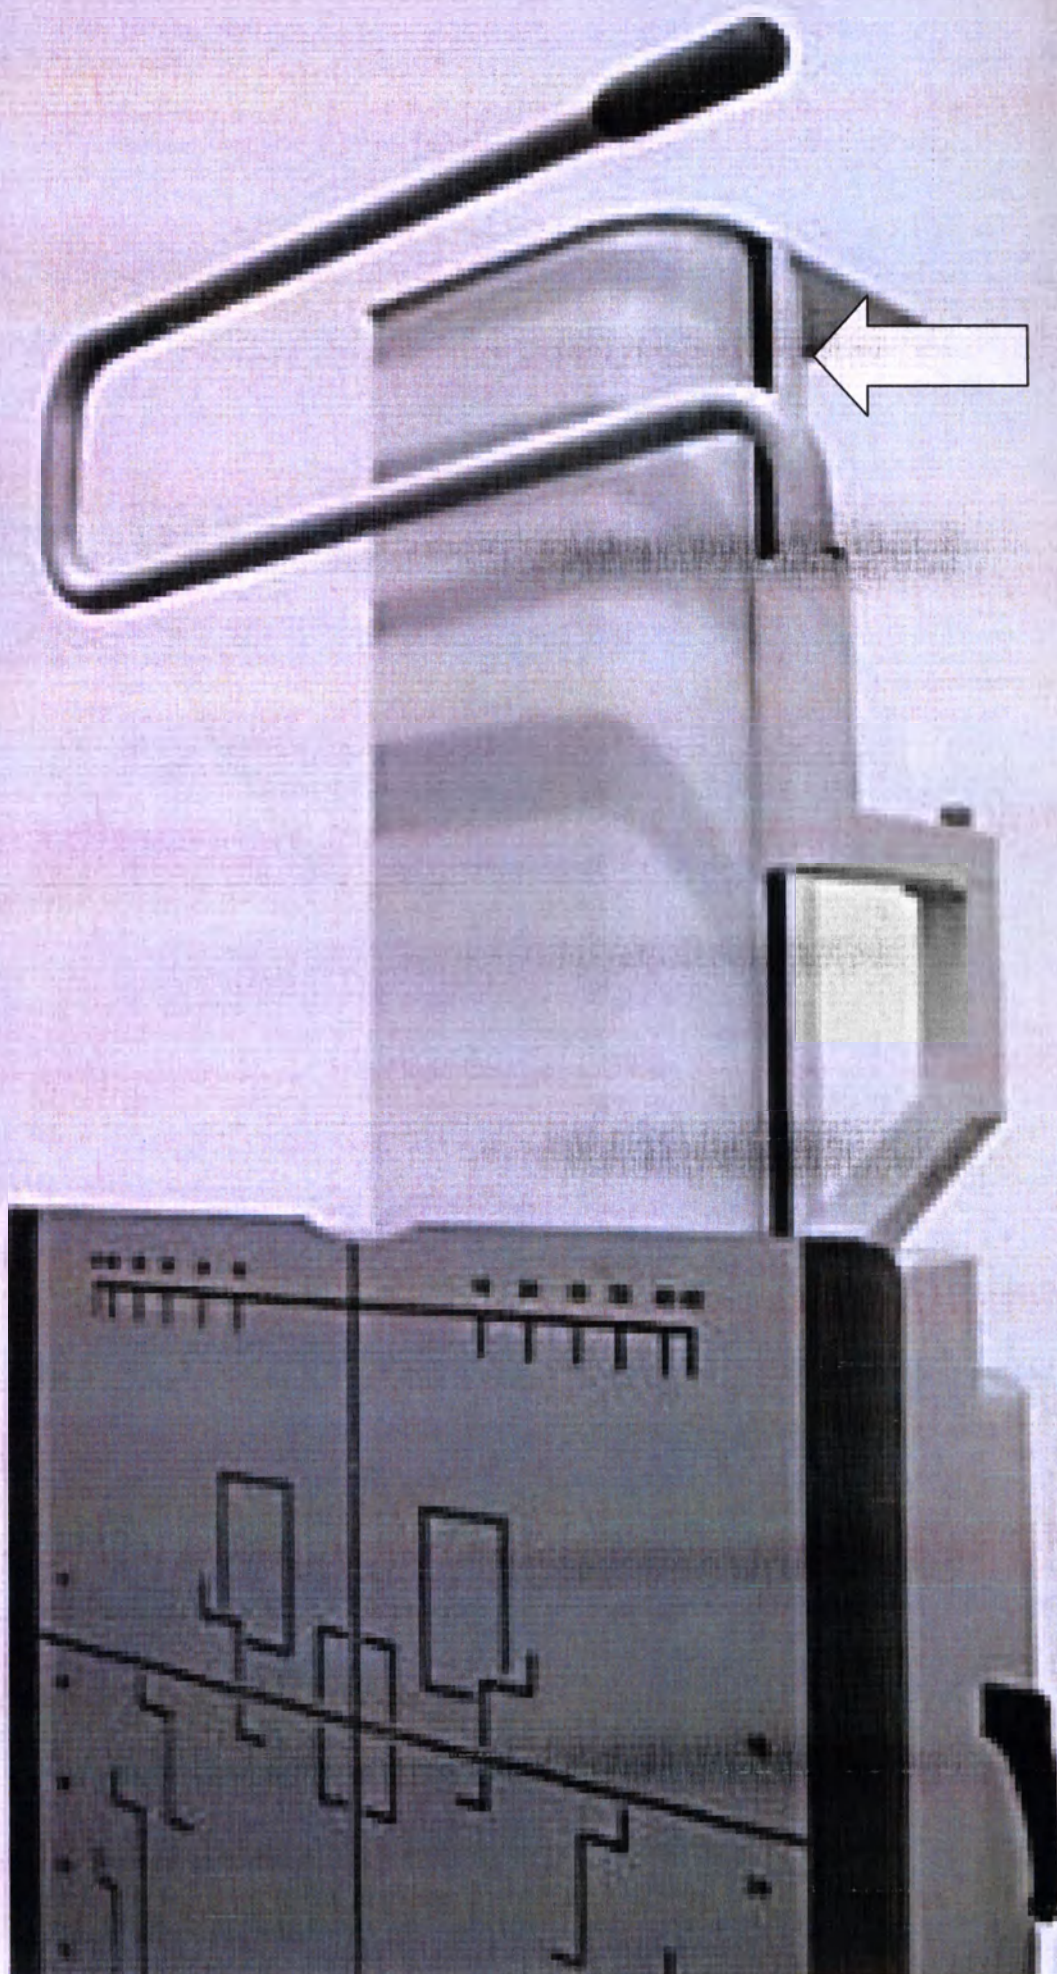


11. ПЗС камера.

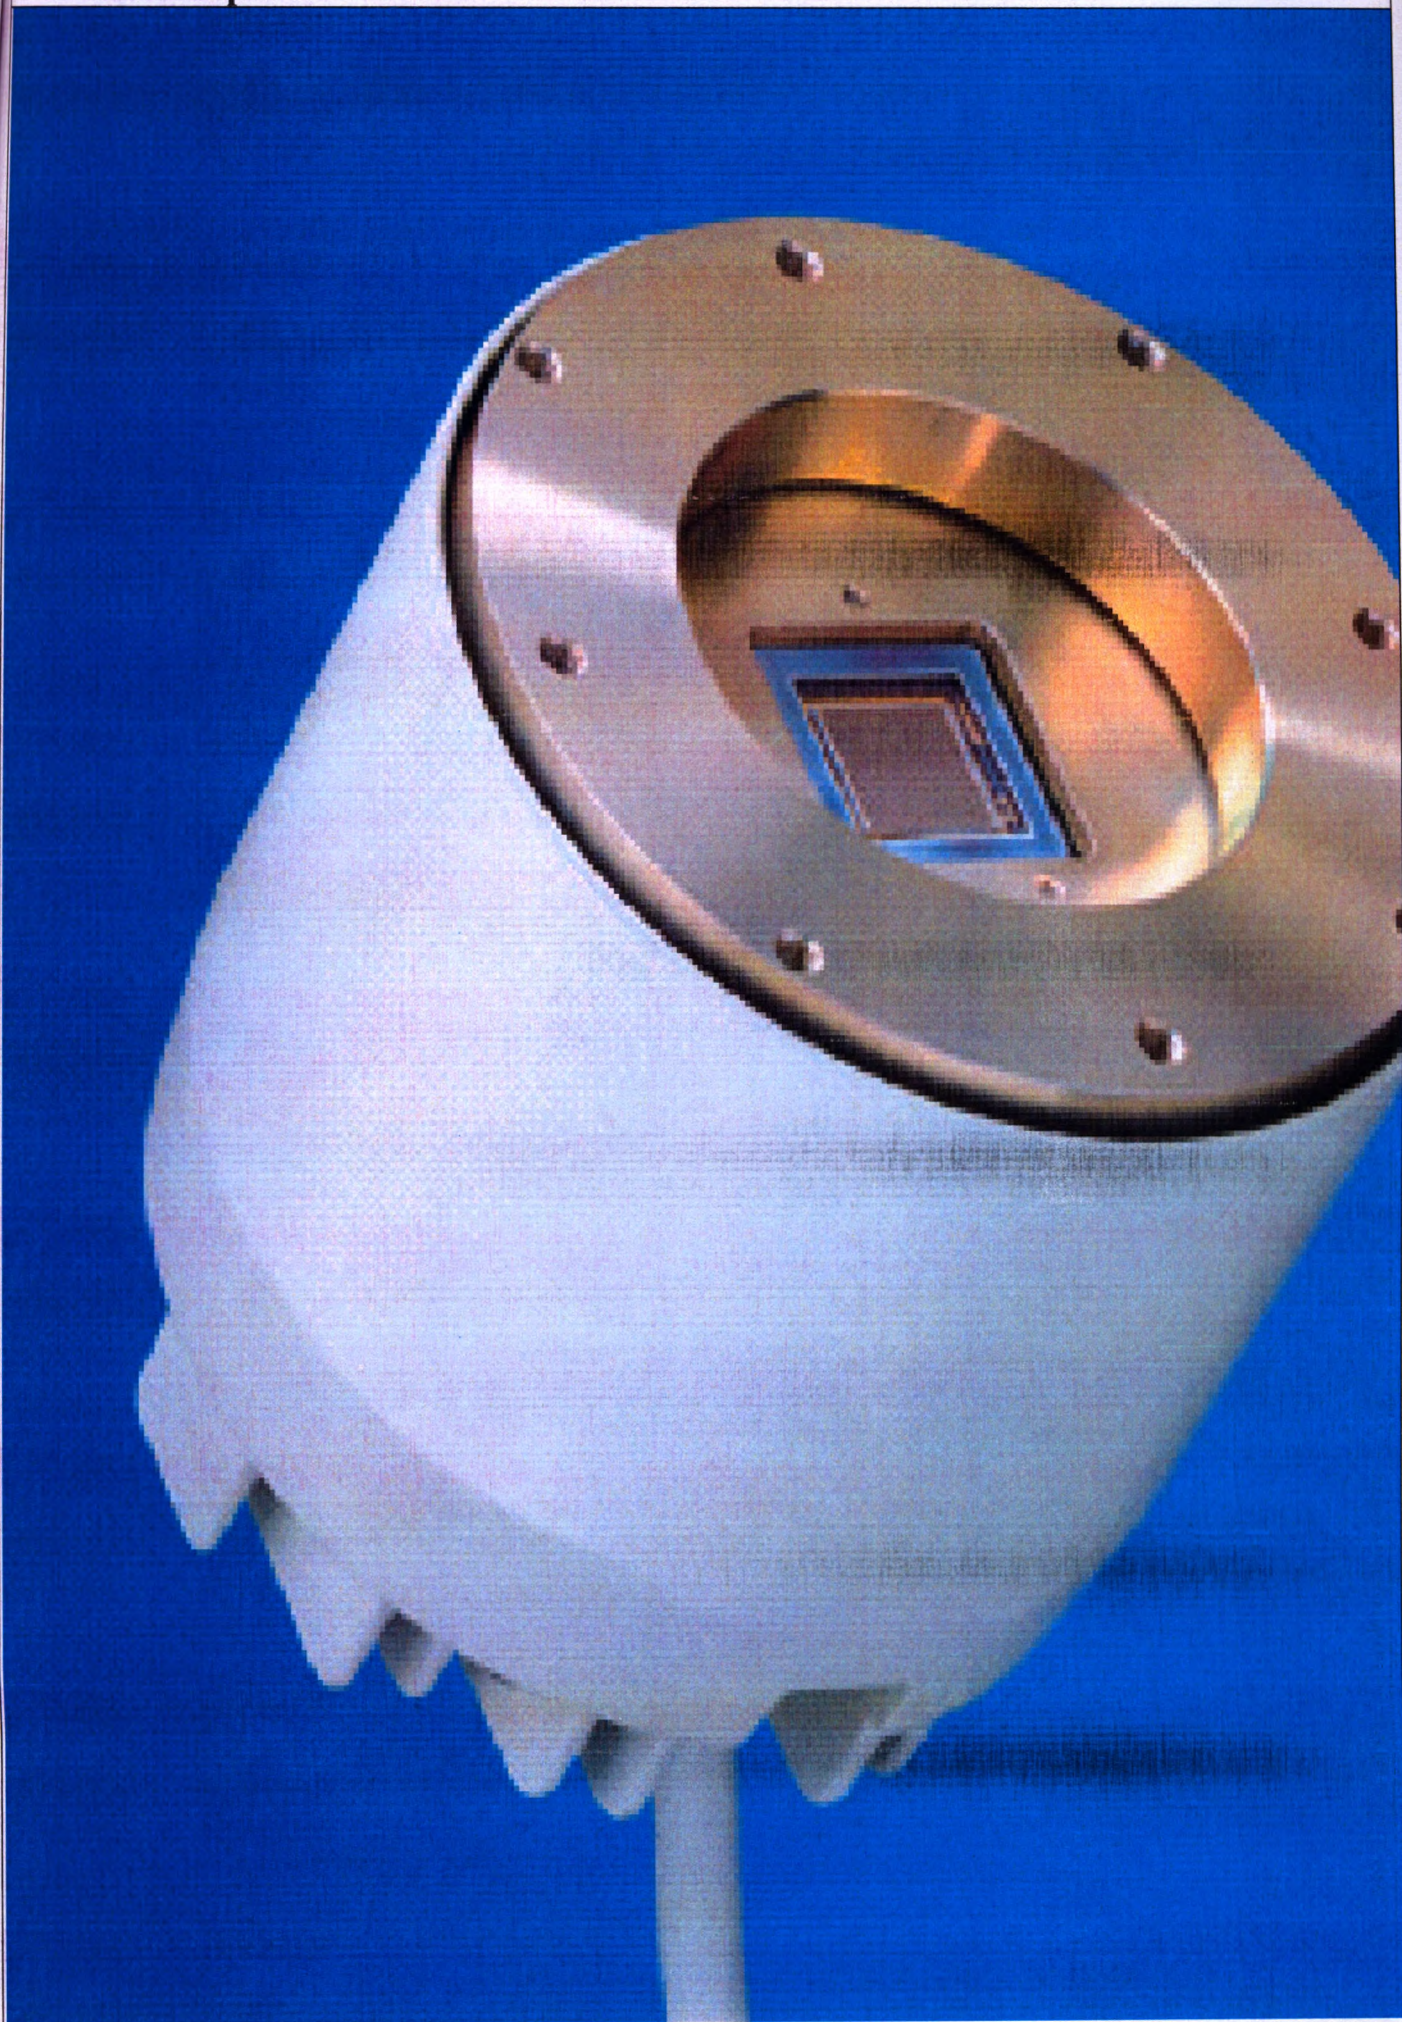

12. Устройство DICOM.

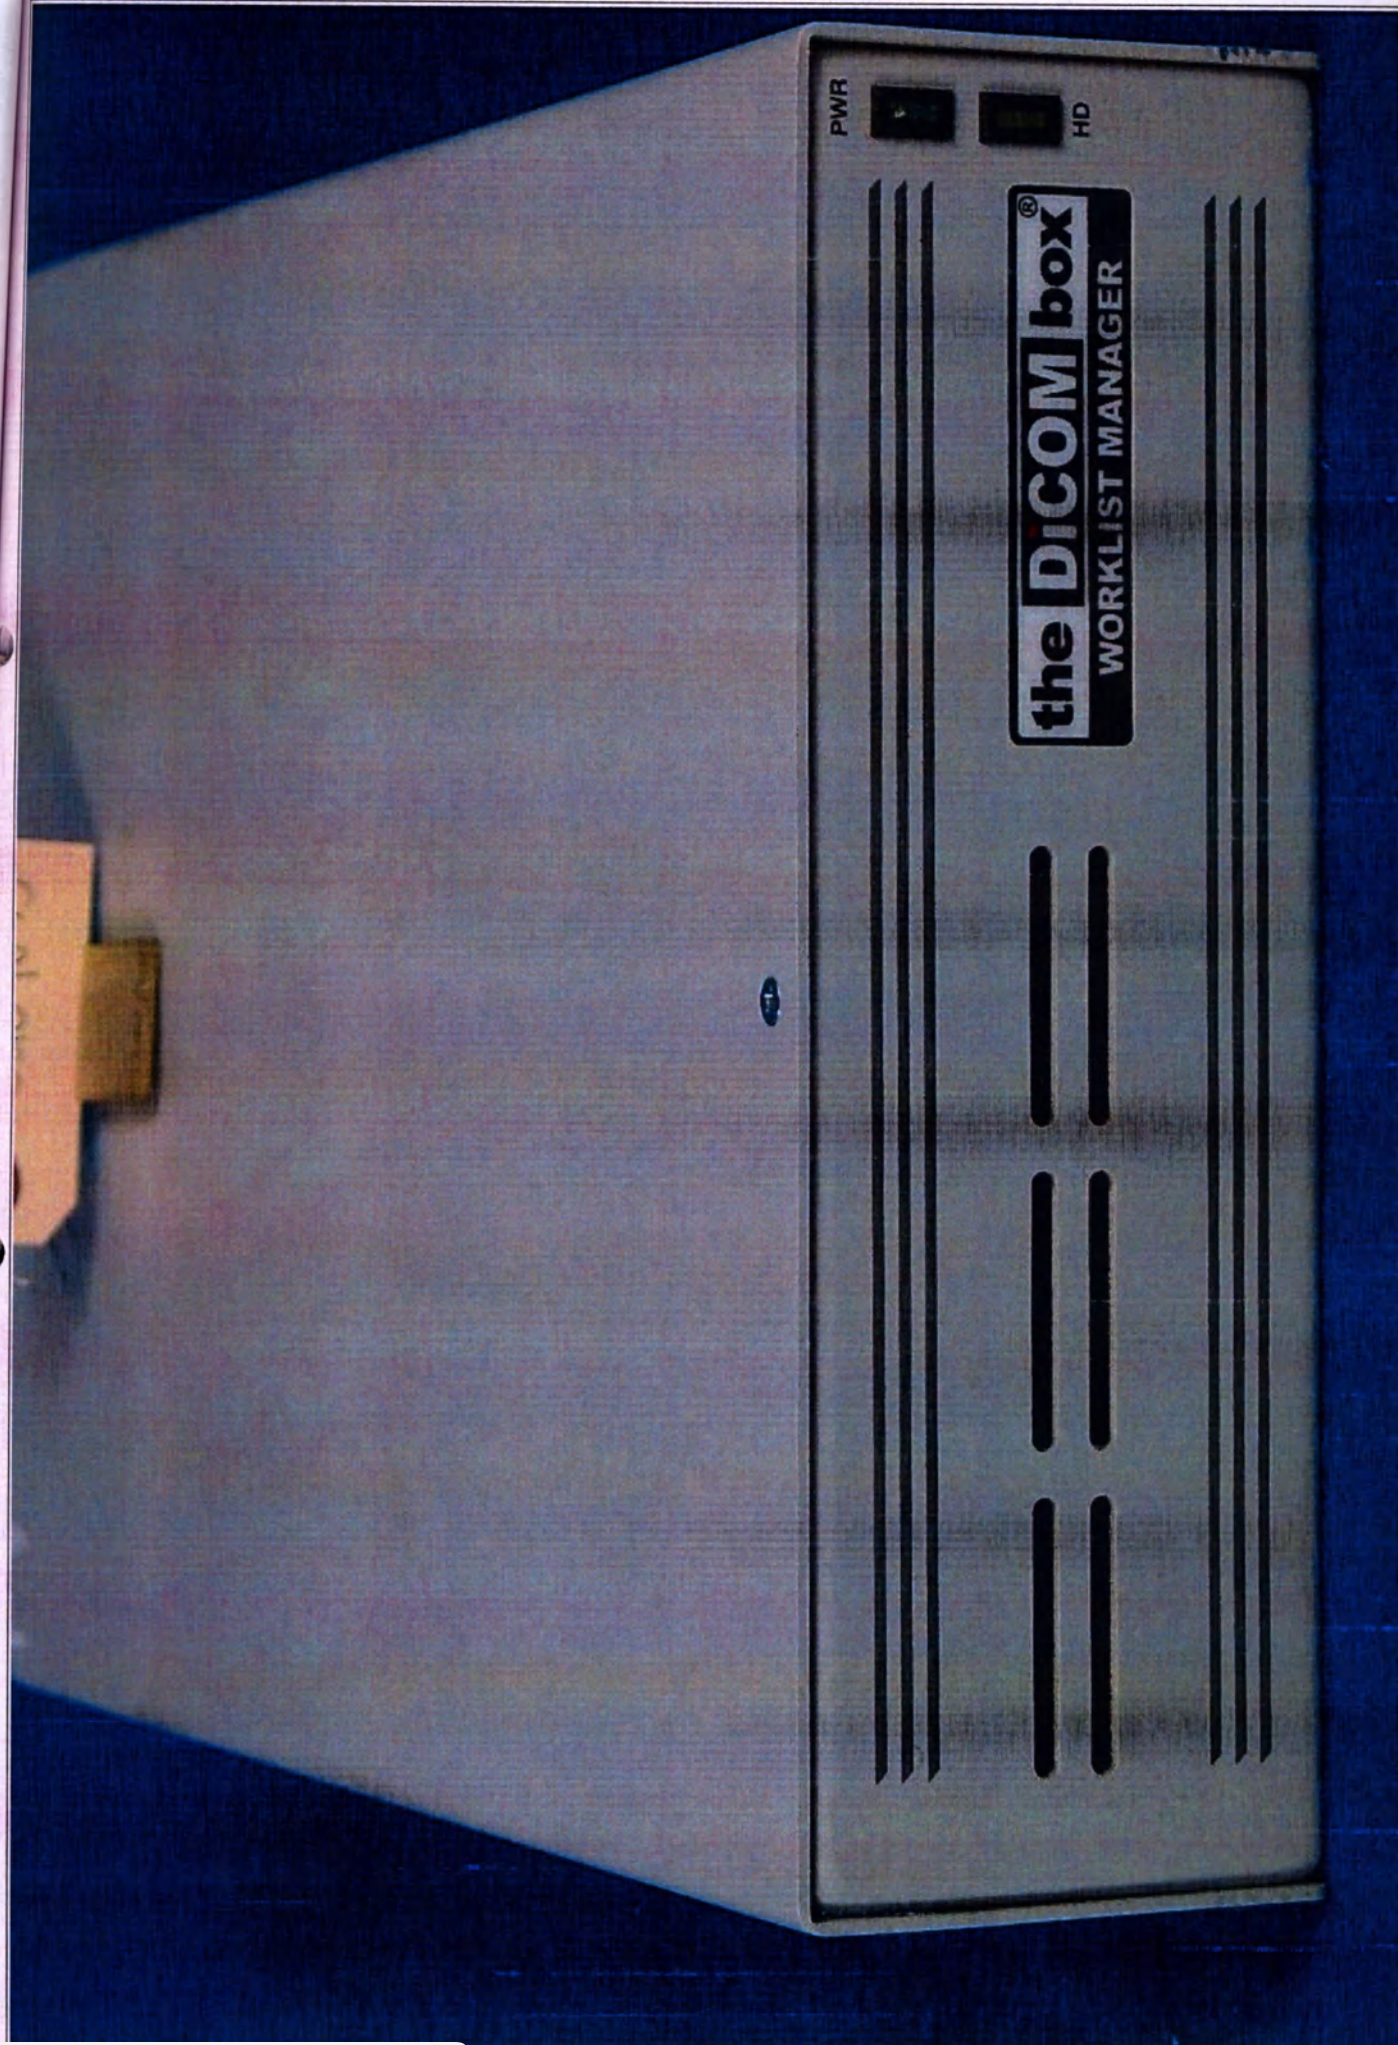


13. Подставка для стакана с барием.

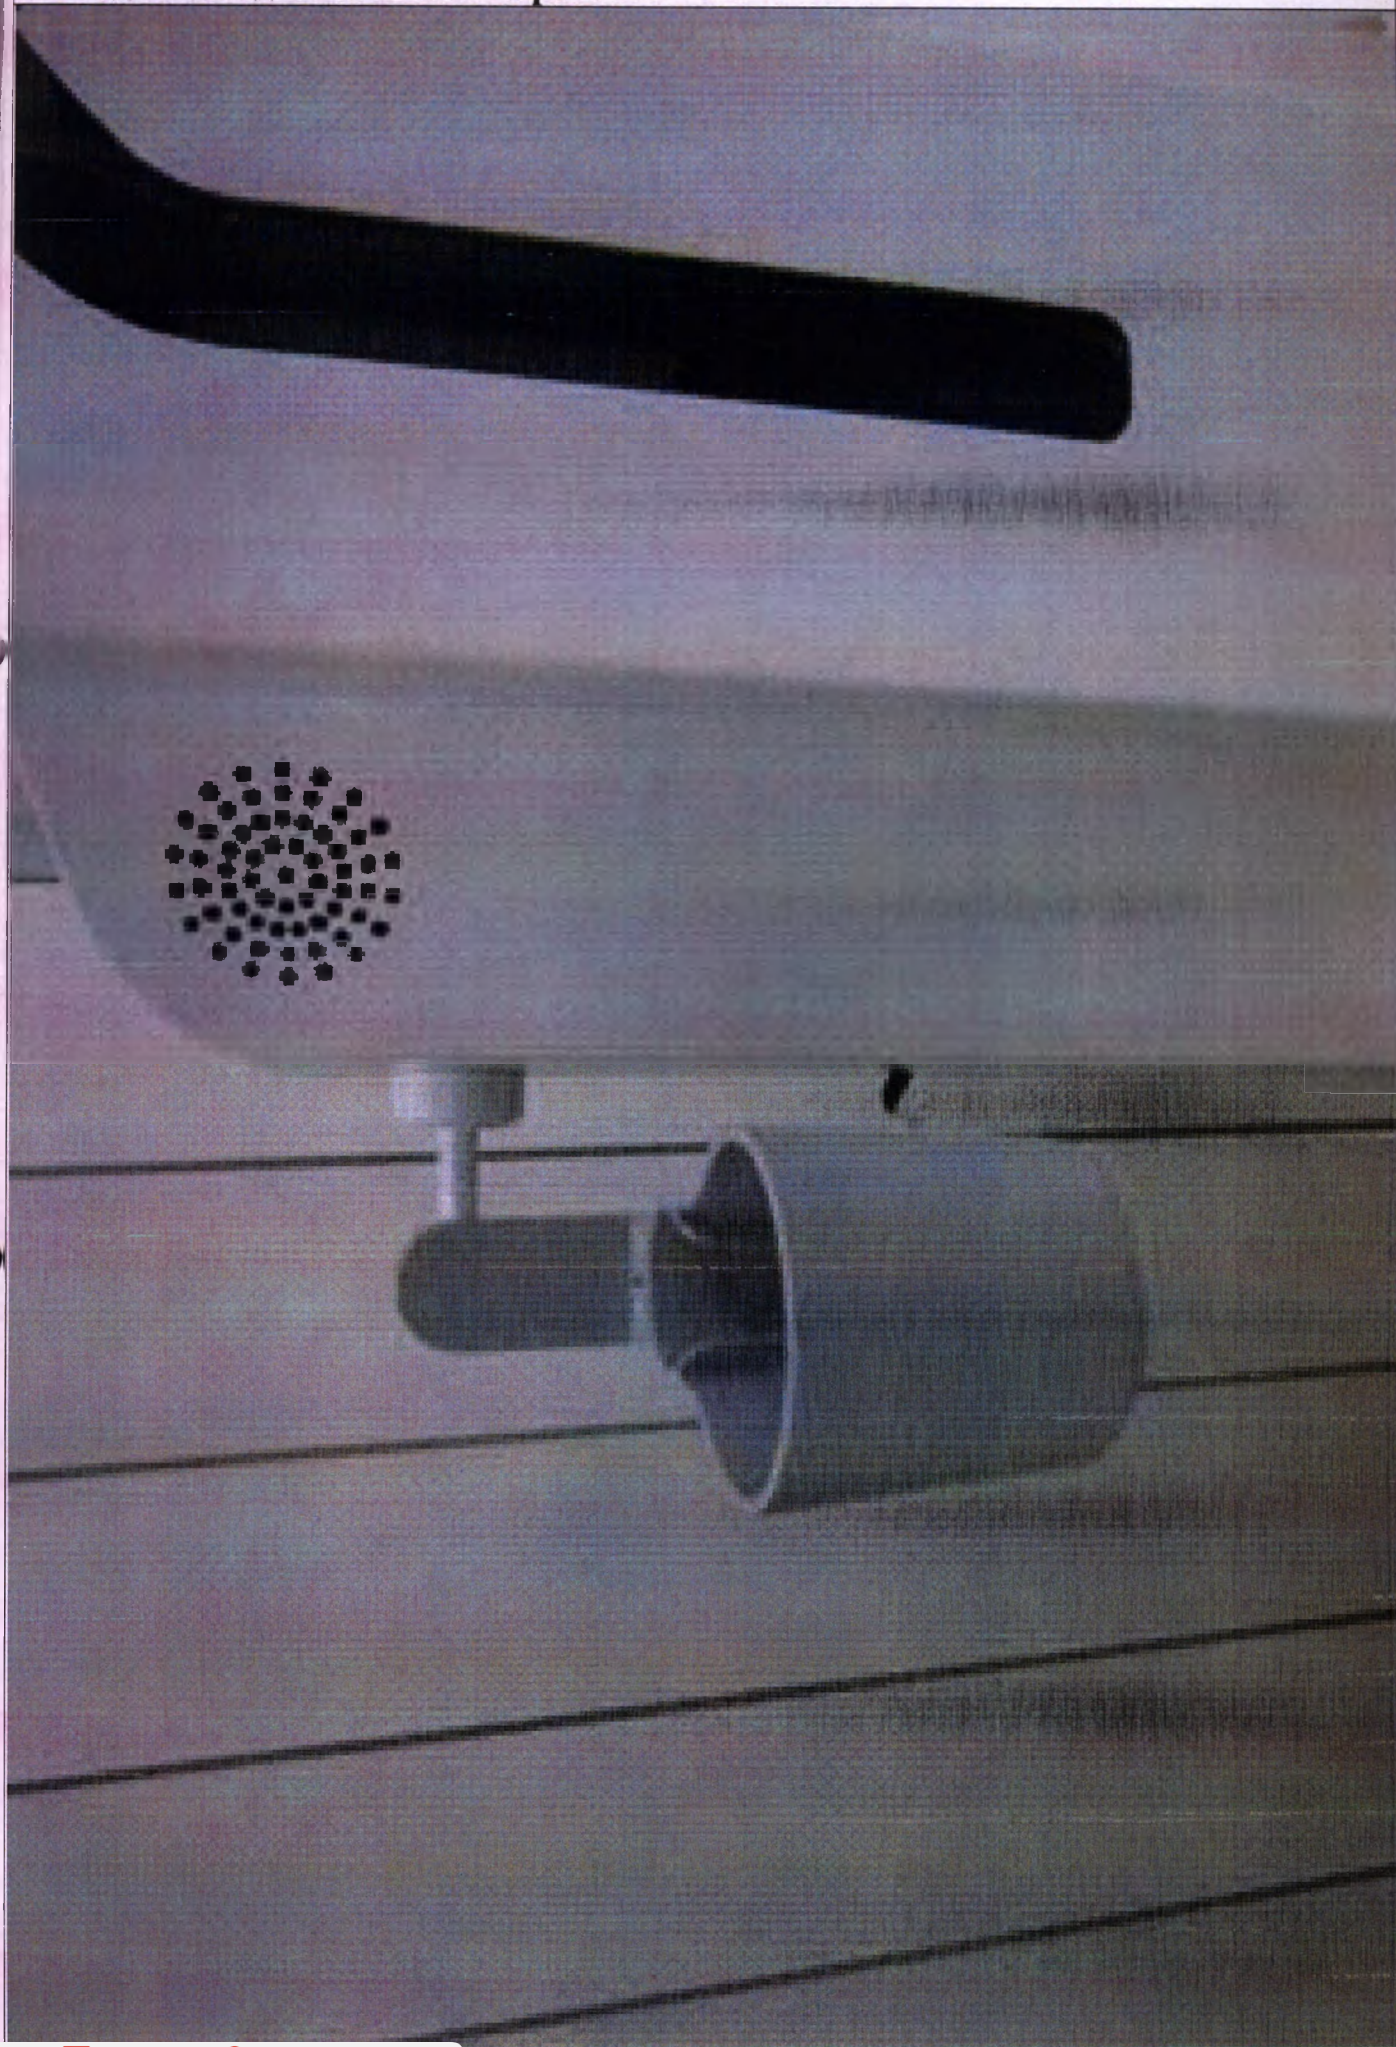


14. Ножная педаль.




15. Компрессионная лента.

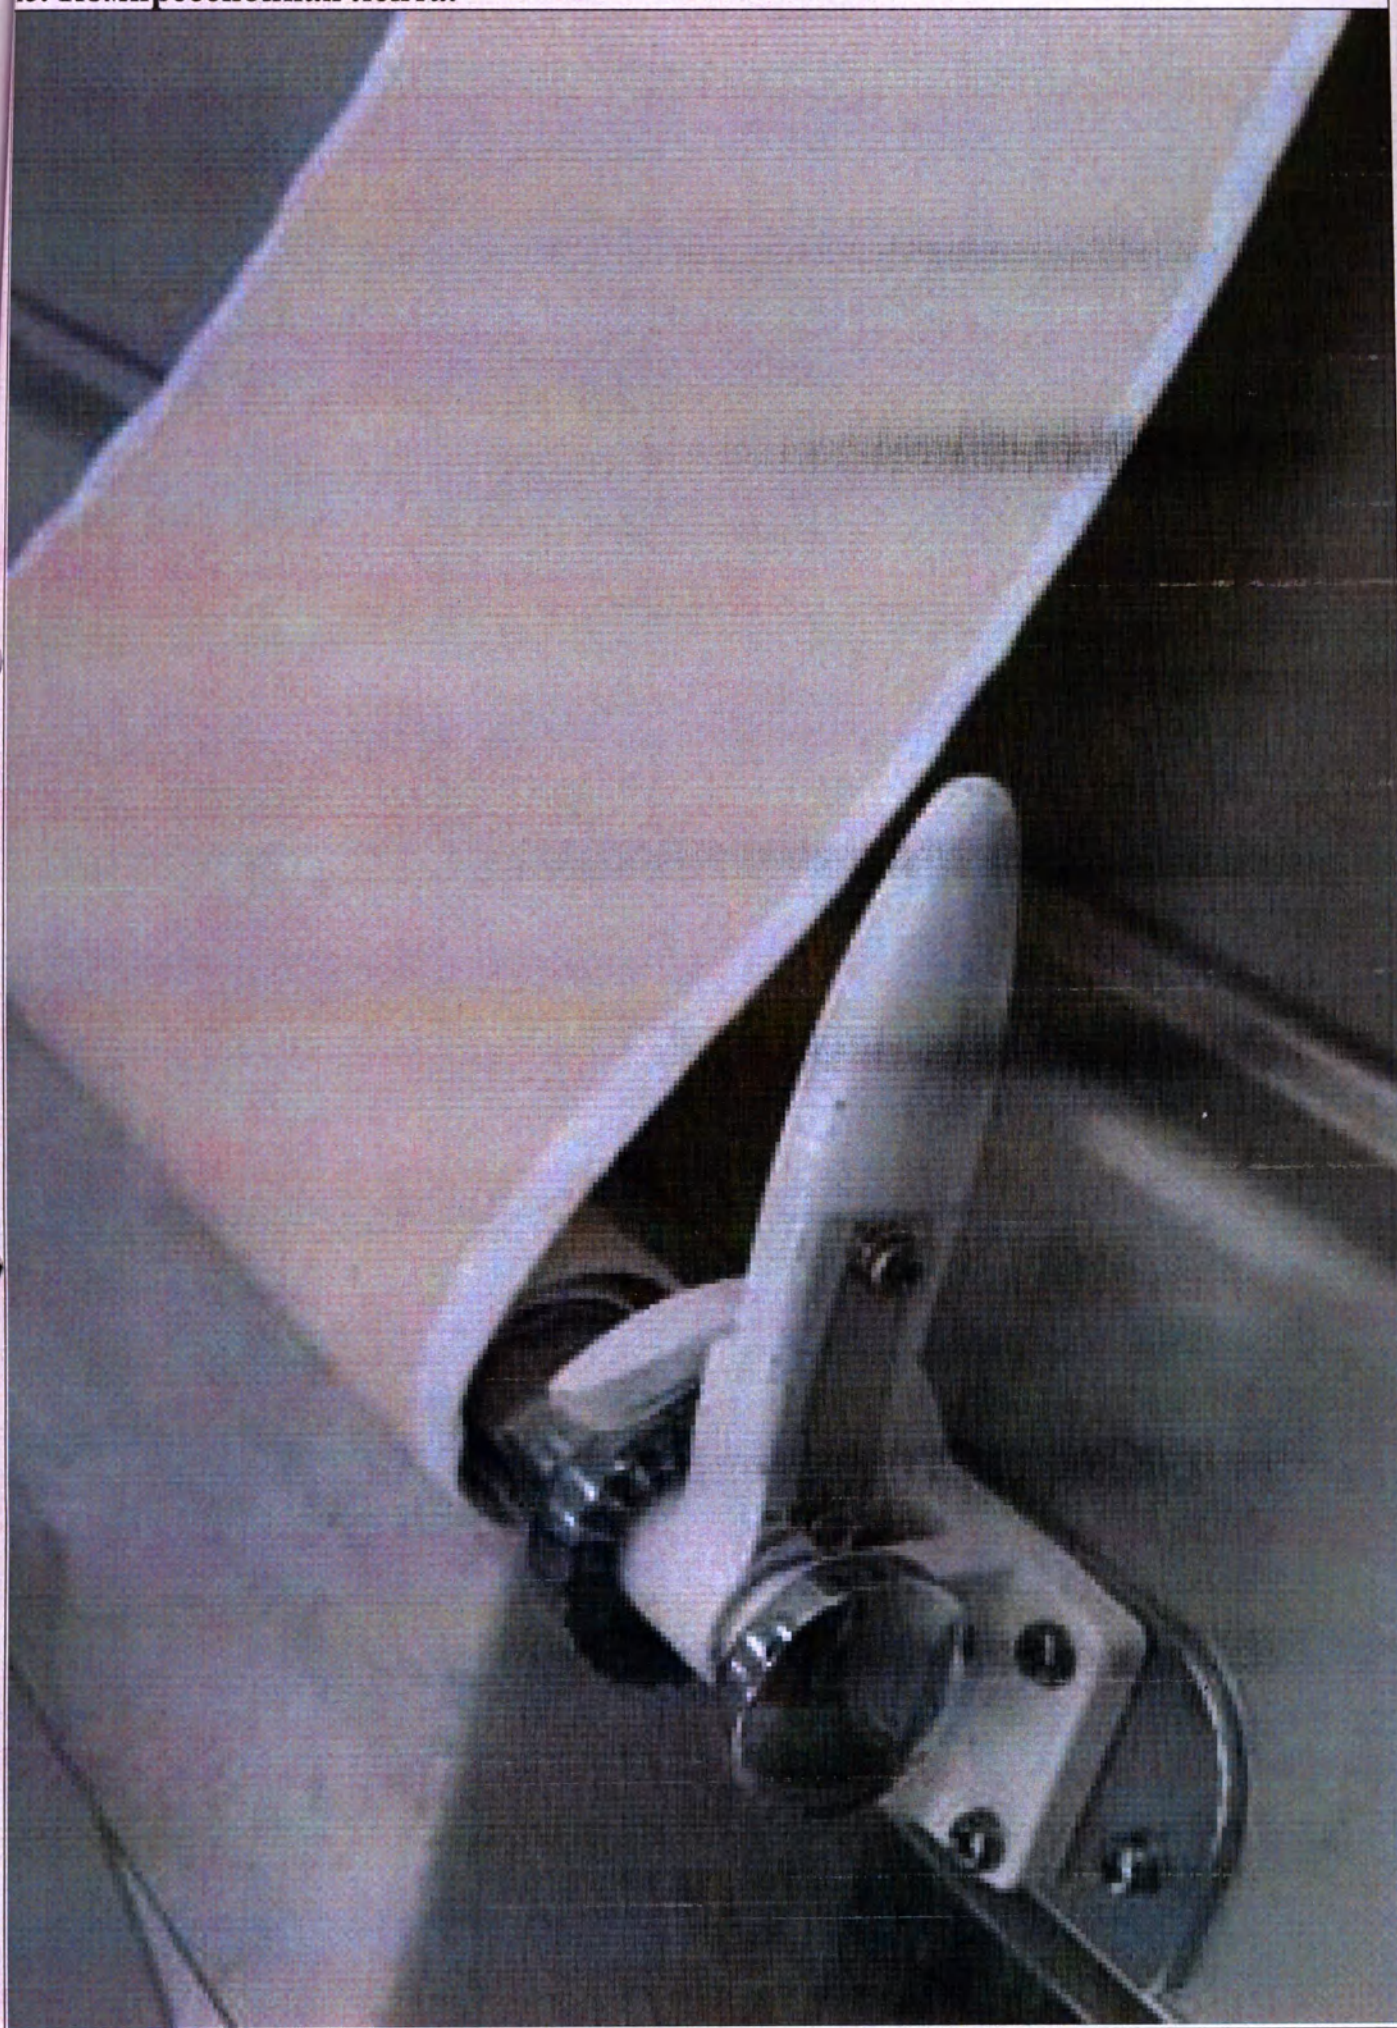

16. Джойстик для управления позиционированием.

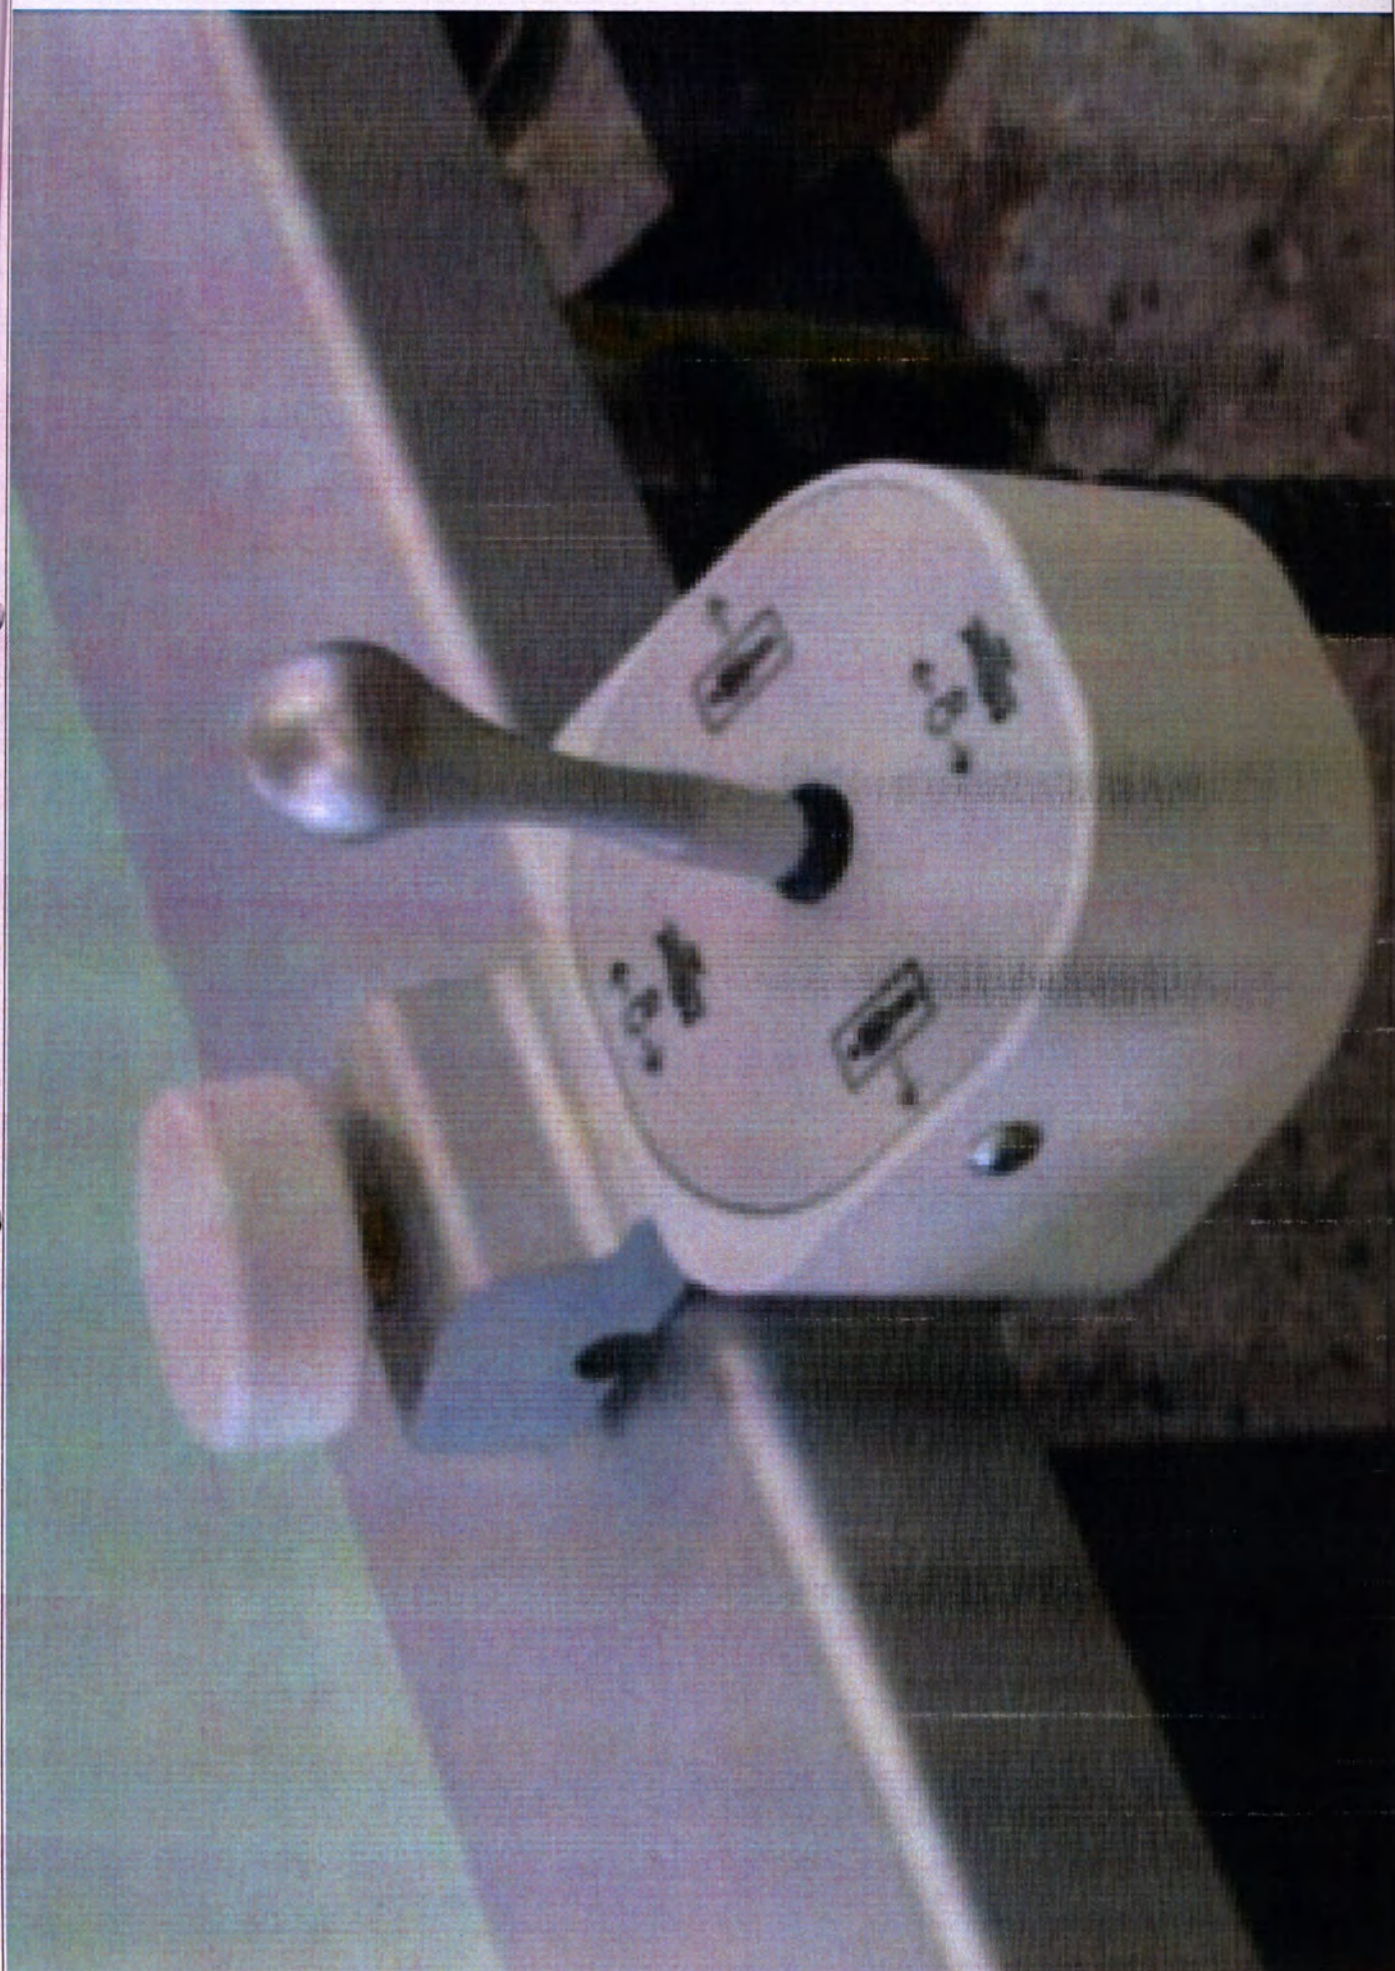

17. Кассетодержатель.

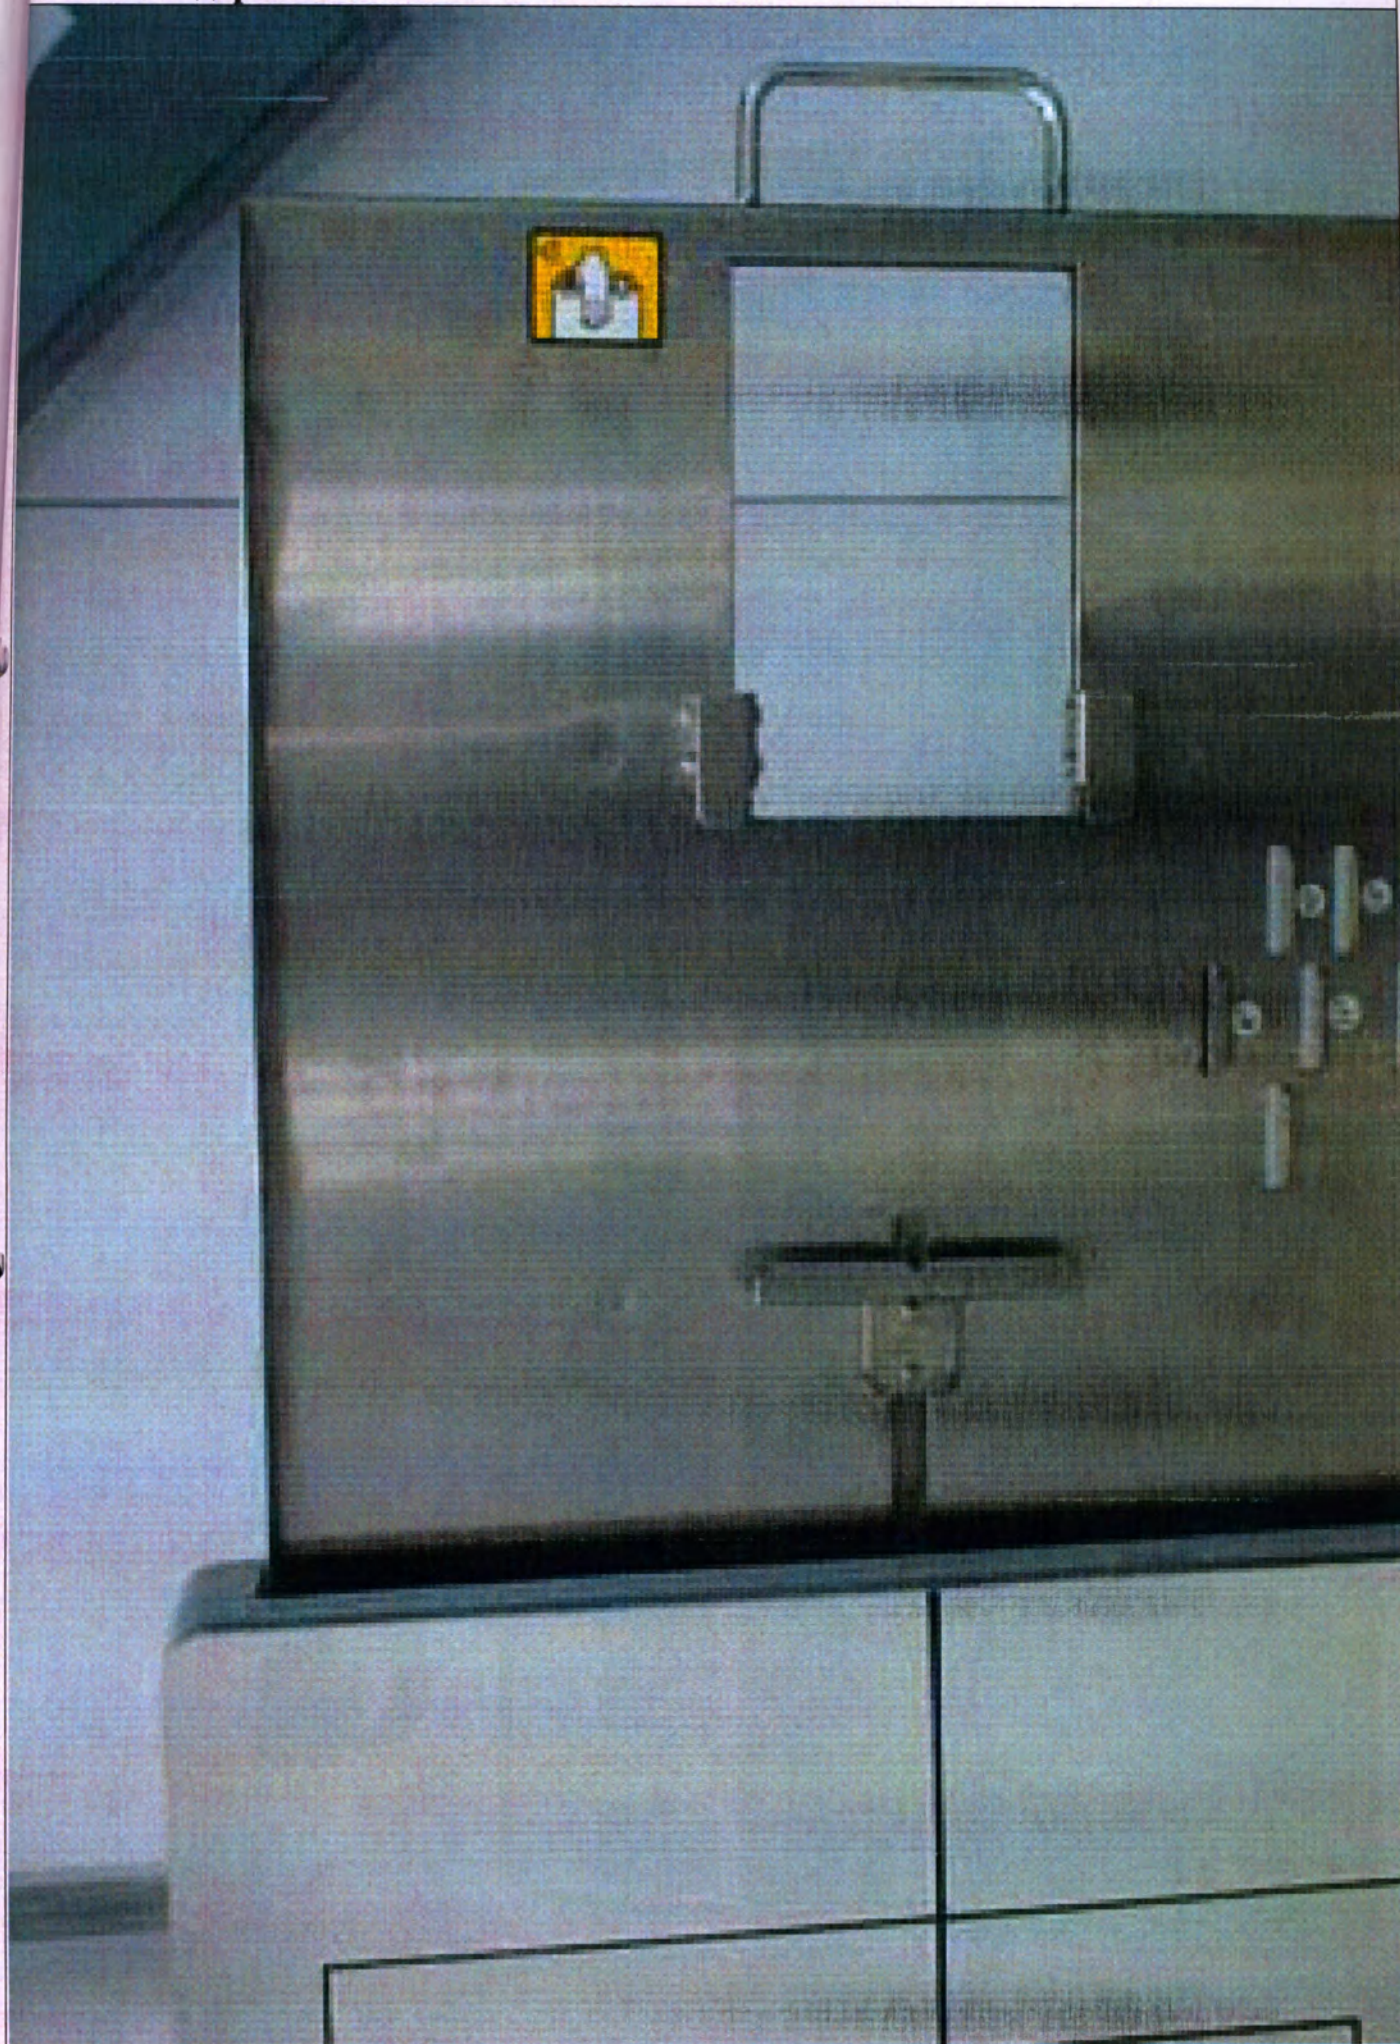

8. Клавиатура для рабочей станции (не более 3 шт.).





GE Healthcare

Техническая публикация

Документ 5445574-1RU

Редакция 2

Руководство по эксплуатации рентгенологической системы Precision THUNIS-800+

Авторские права © 2013
General Electric Company, Inc.
Все права защищены.

Руководство по эксплуатации



Кенгура



Компания GE Medical Systems

Техническая документация

Документ 5445574-1RU

Ред. 1

Система рентгенографии и рентгеноскопии Precision THUNIS-800+. Руководство оператора

Авторские права © 2013
Компания General Electric
Все права защищены.

Эксплуатационная документация




1. Громкоговоритель.



2. Кабели соединительные (не более 10 шт.)




3. Стекло рентгенозащитное с рамой.

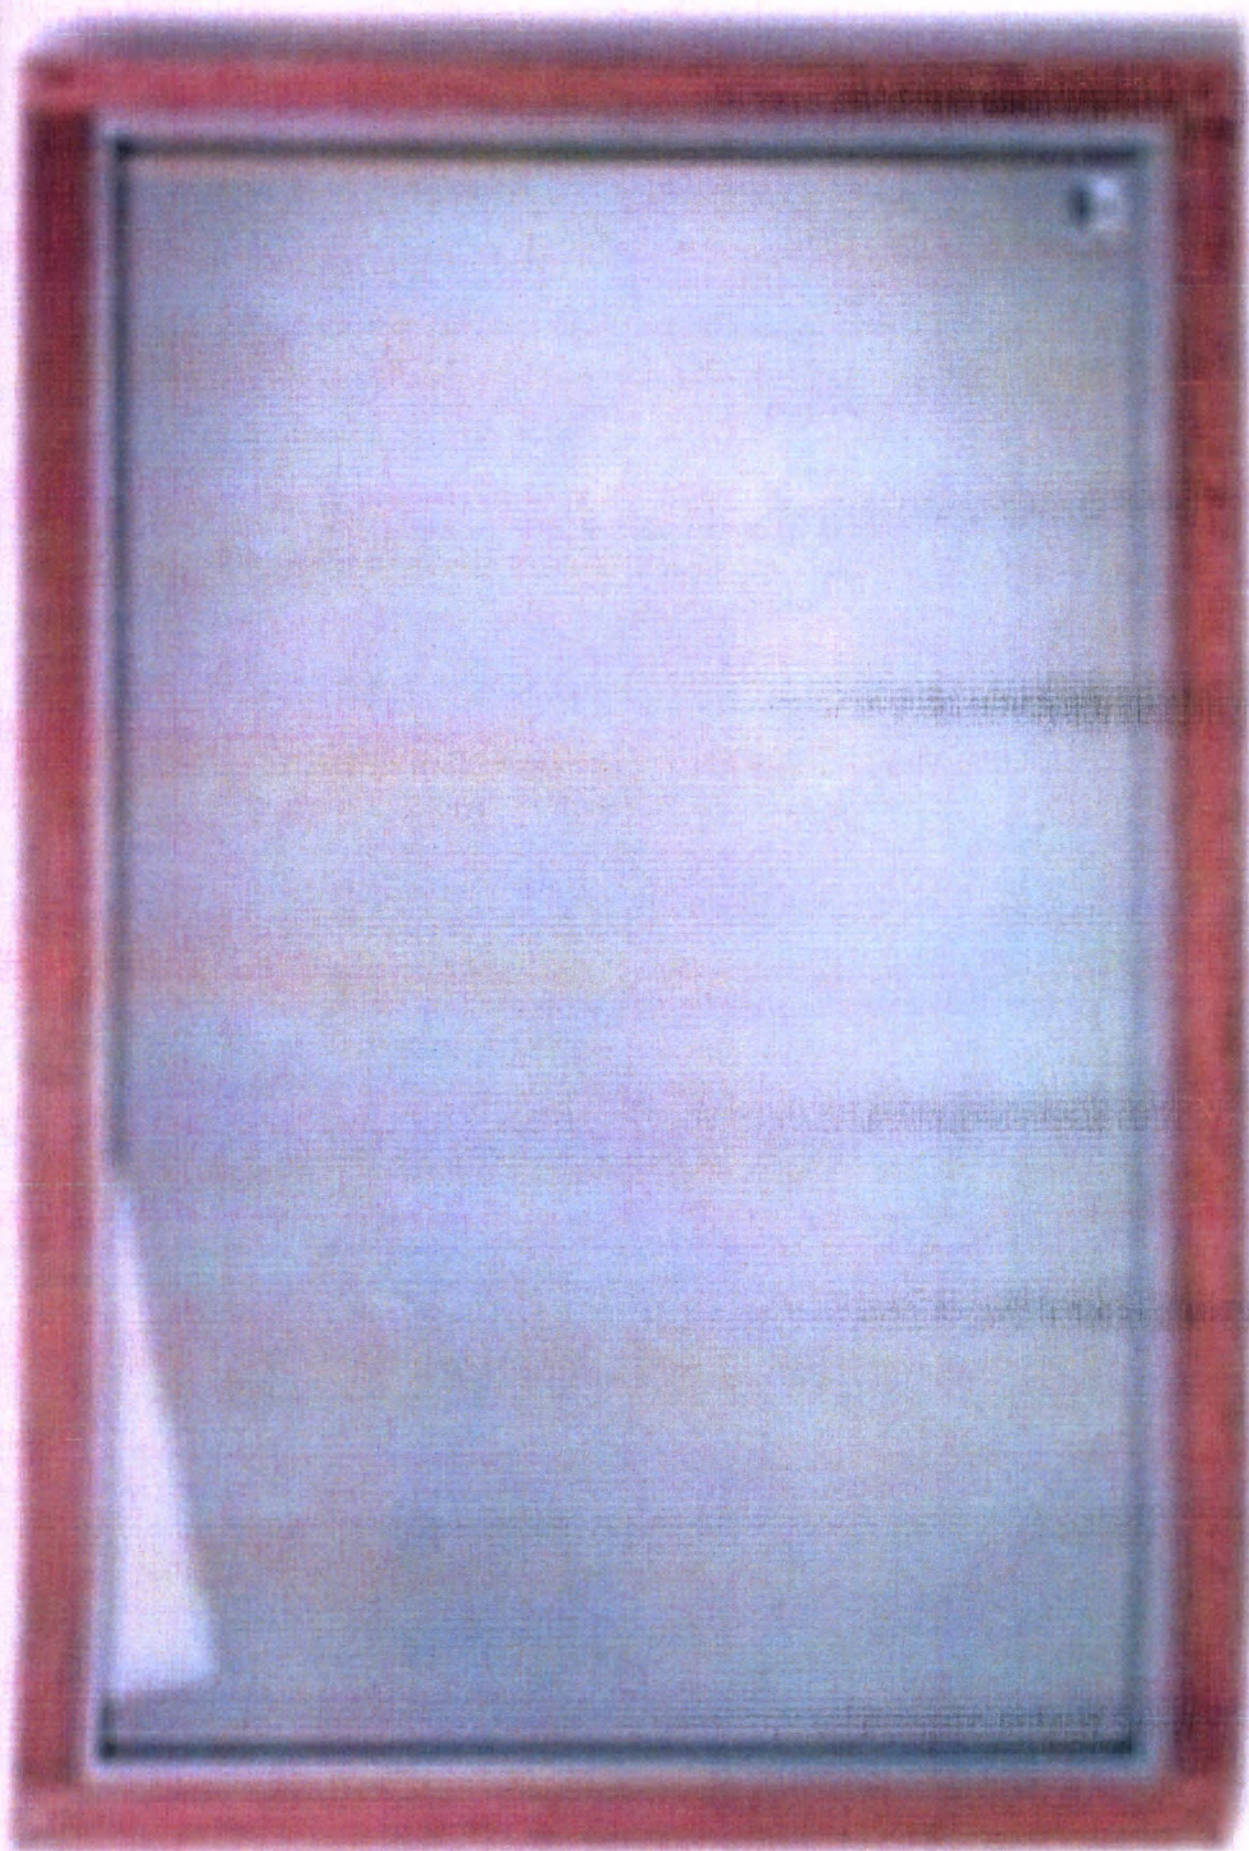


4. Фильтры рентгеновского излучения (не более 5 шт.)



8. Кассетный детектор (не более 3 шт.)

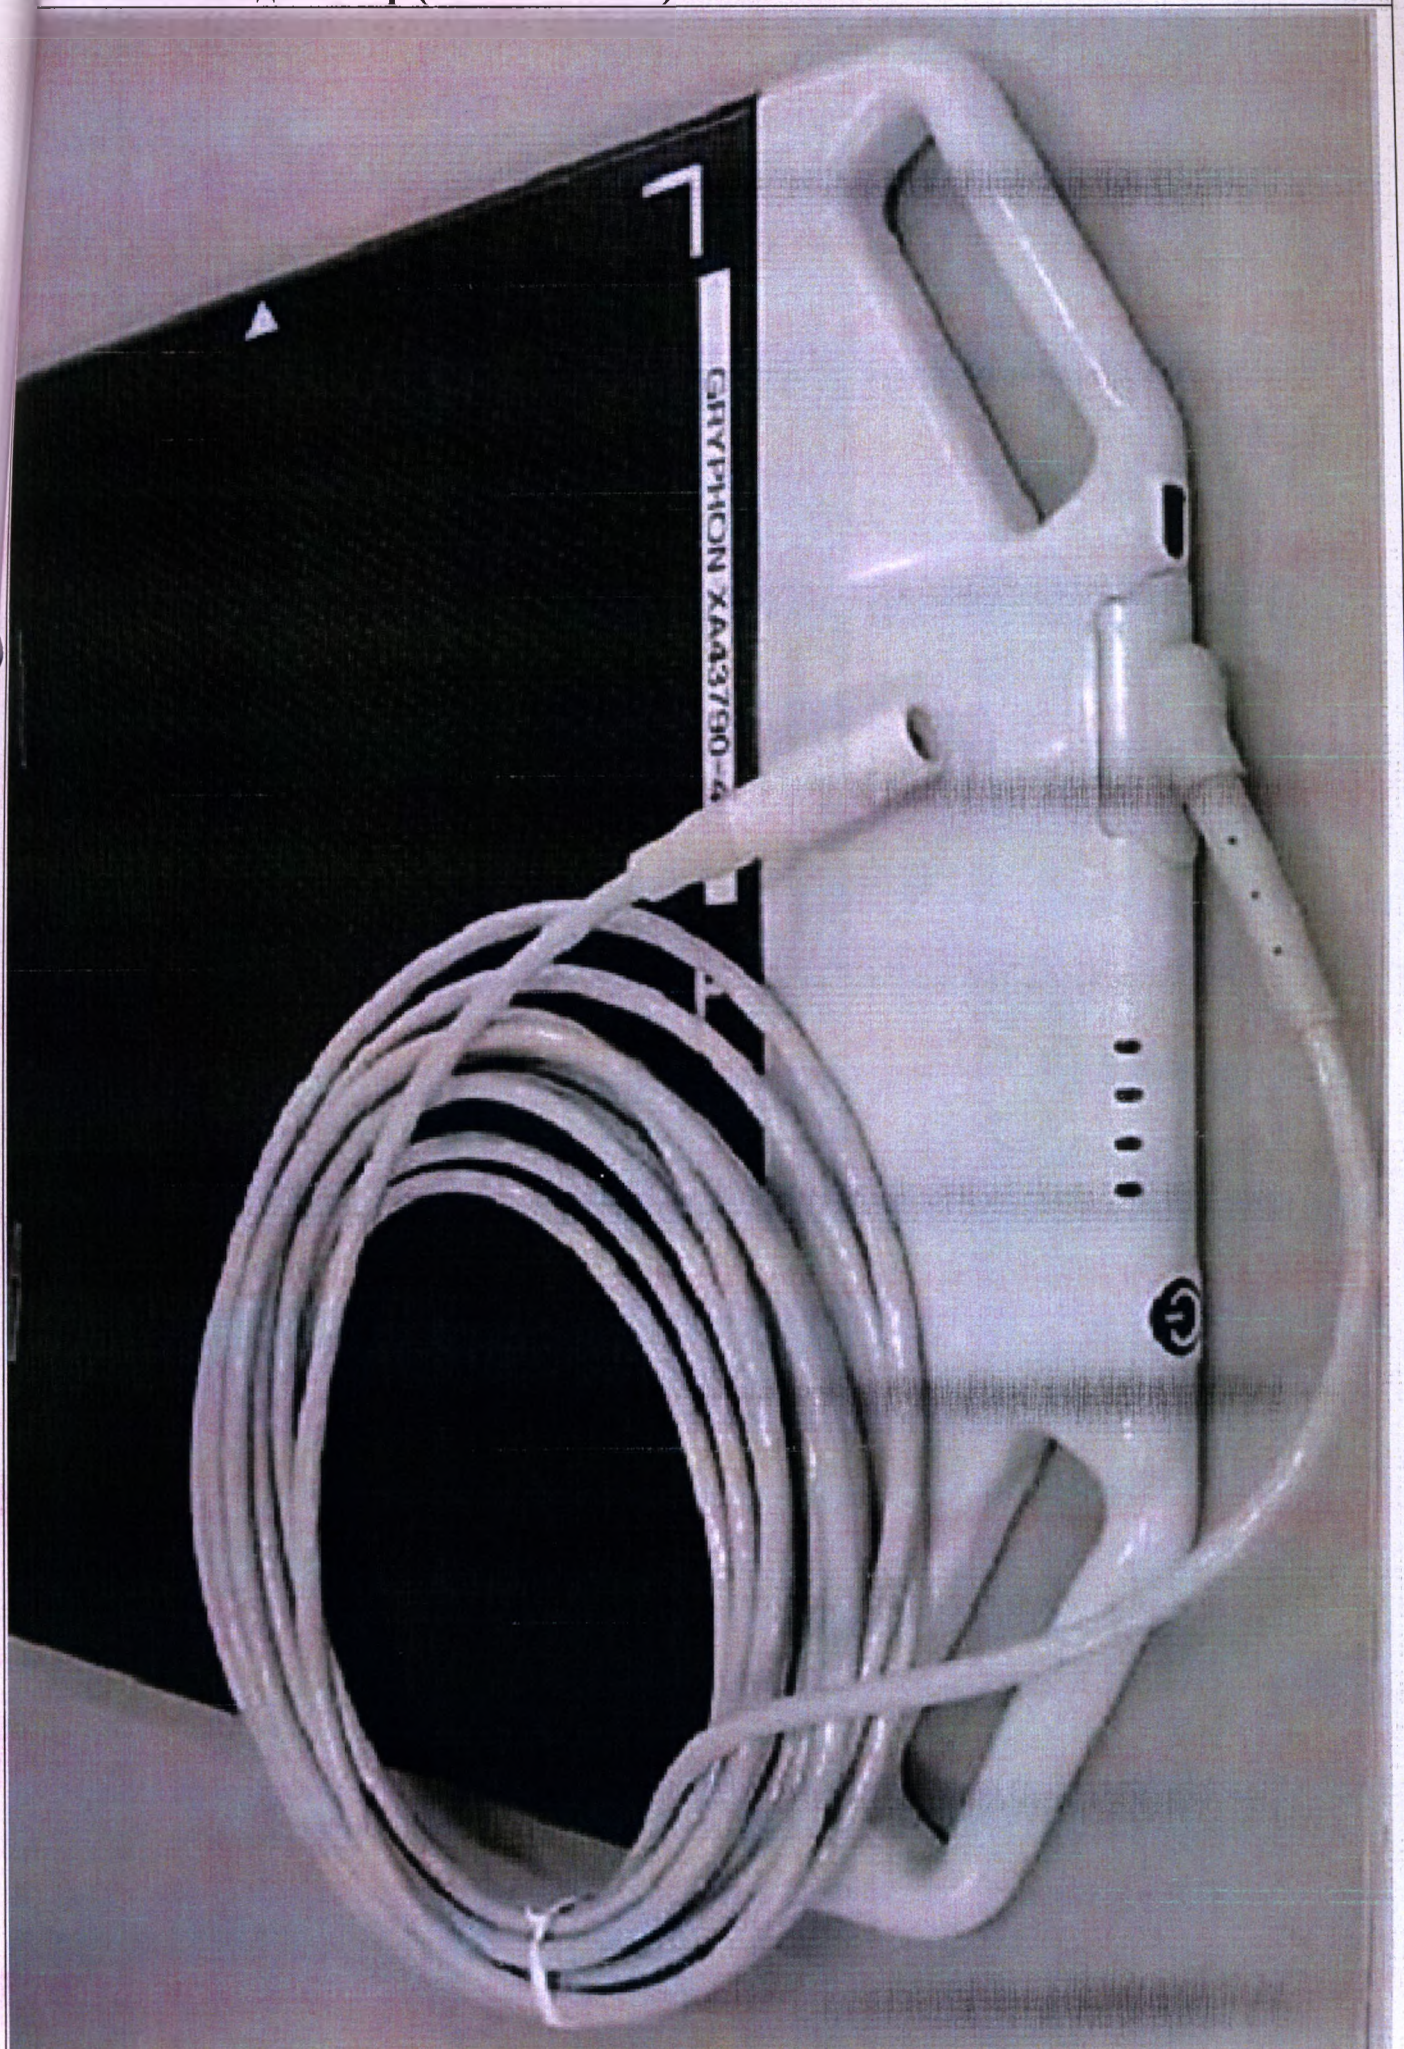


Аккумуляторы (не более 4 шт.).

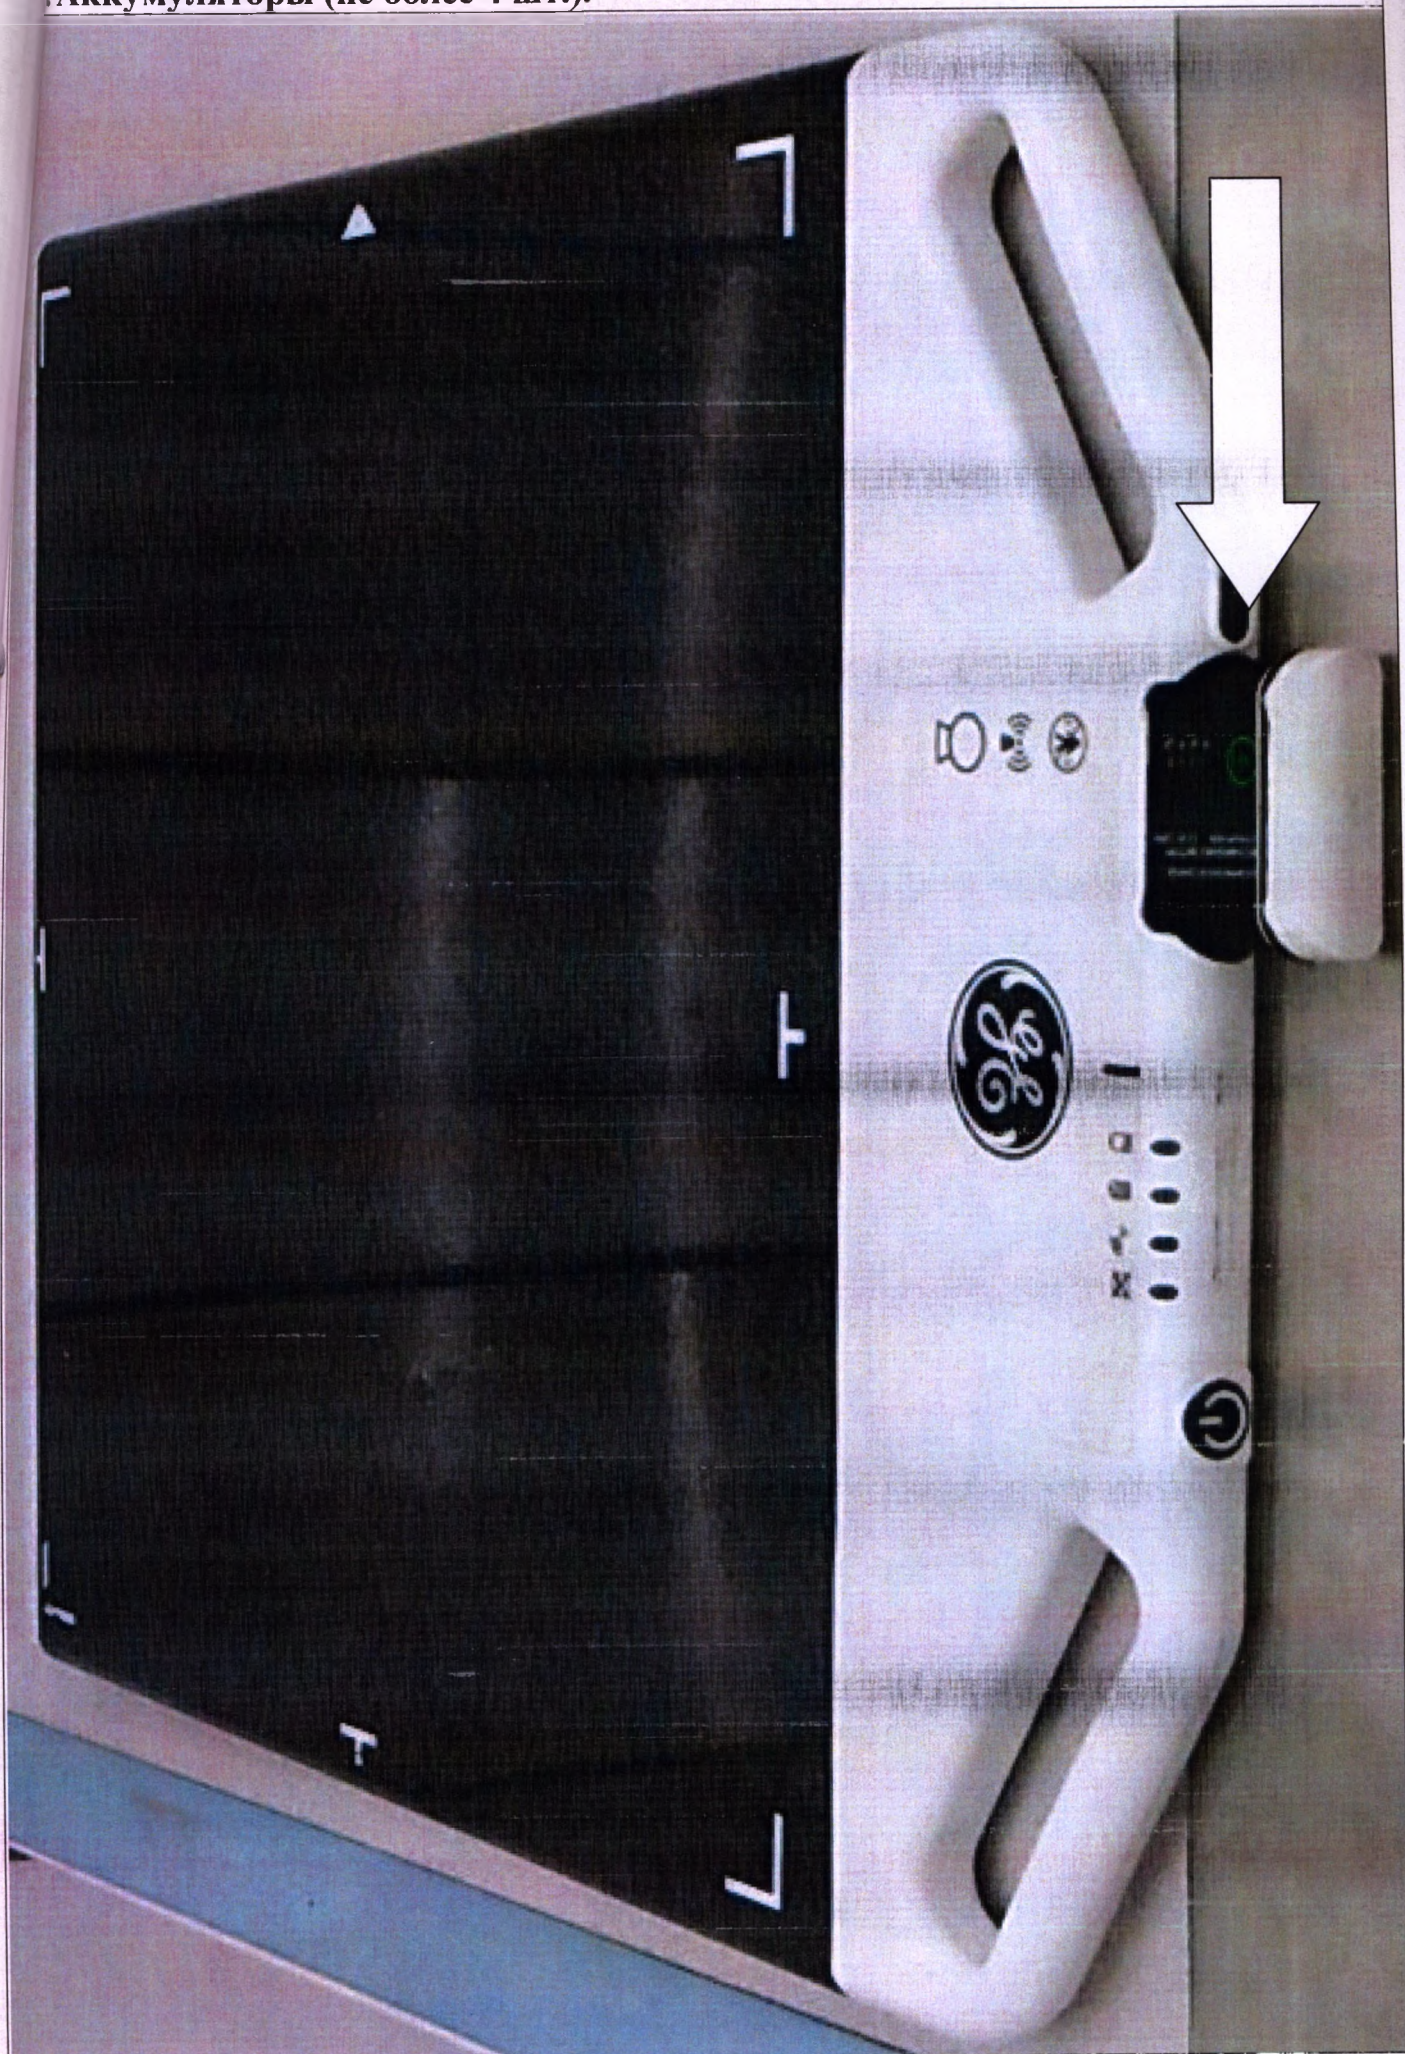


Зарядные устройства для аккумуляторов (не более 2 шт.).




В. Крепления специальные (не более 50 шт.)

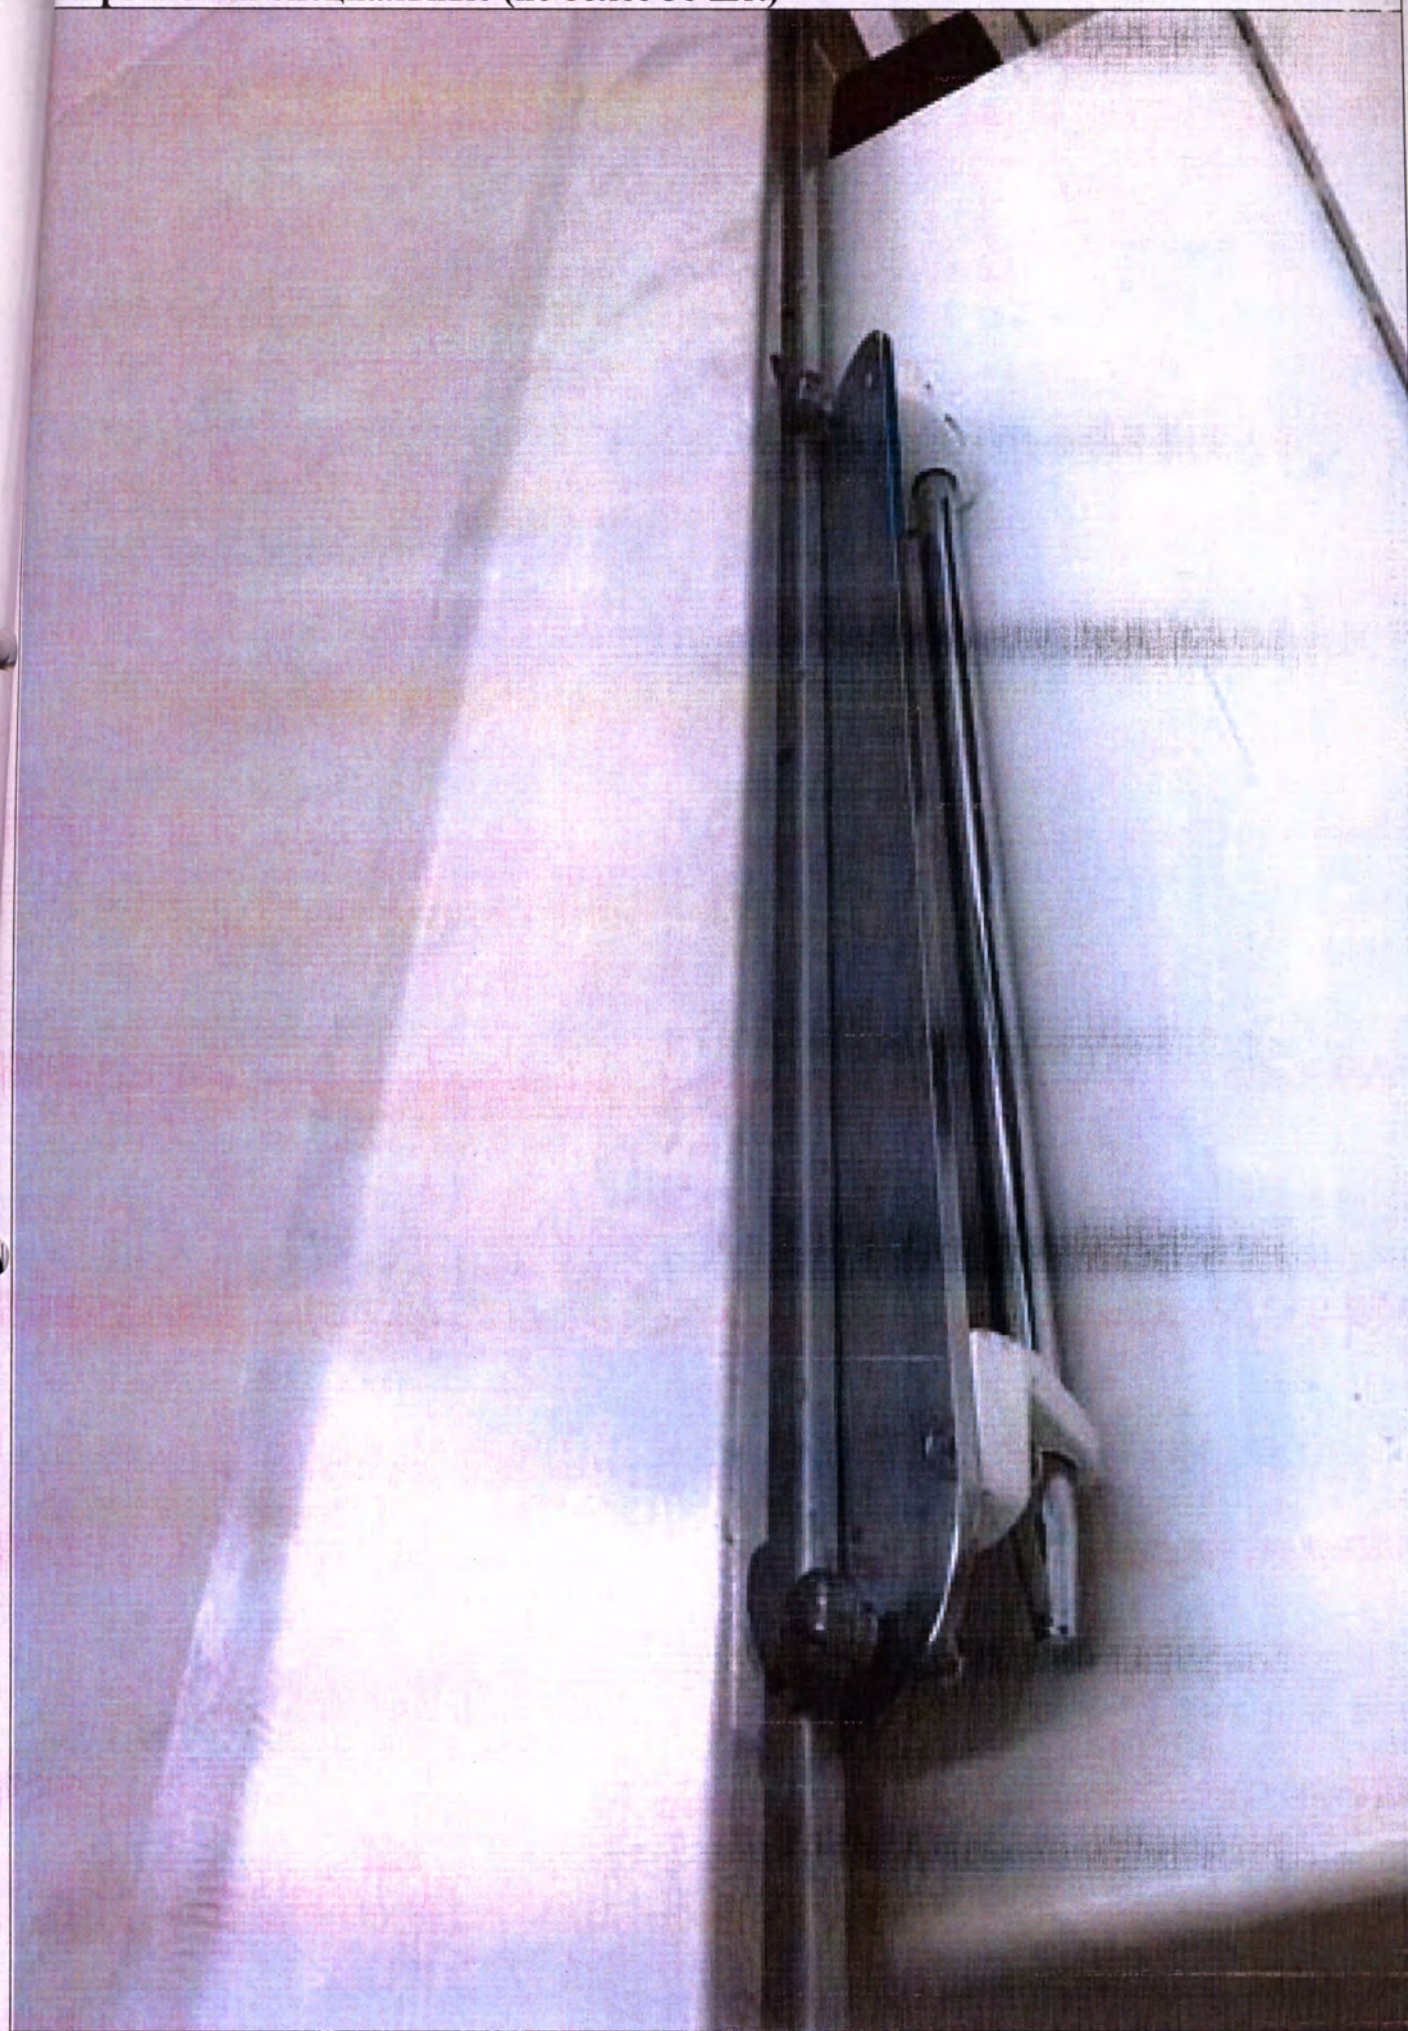

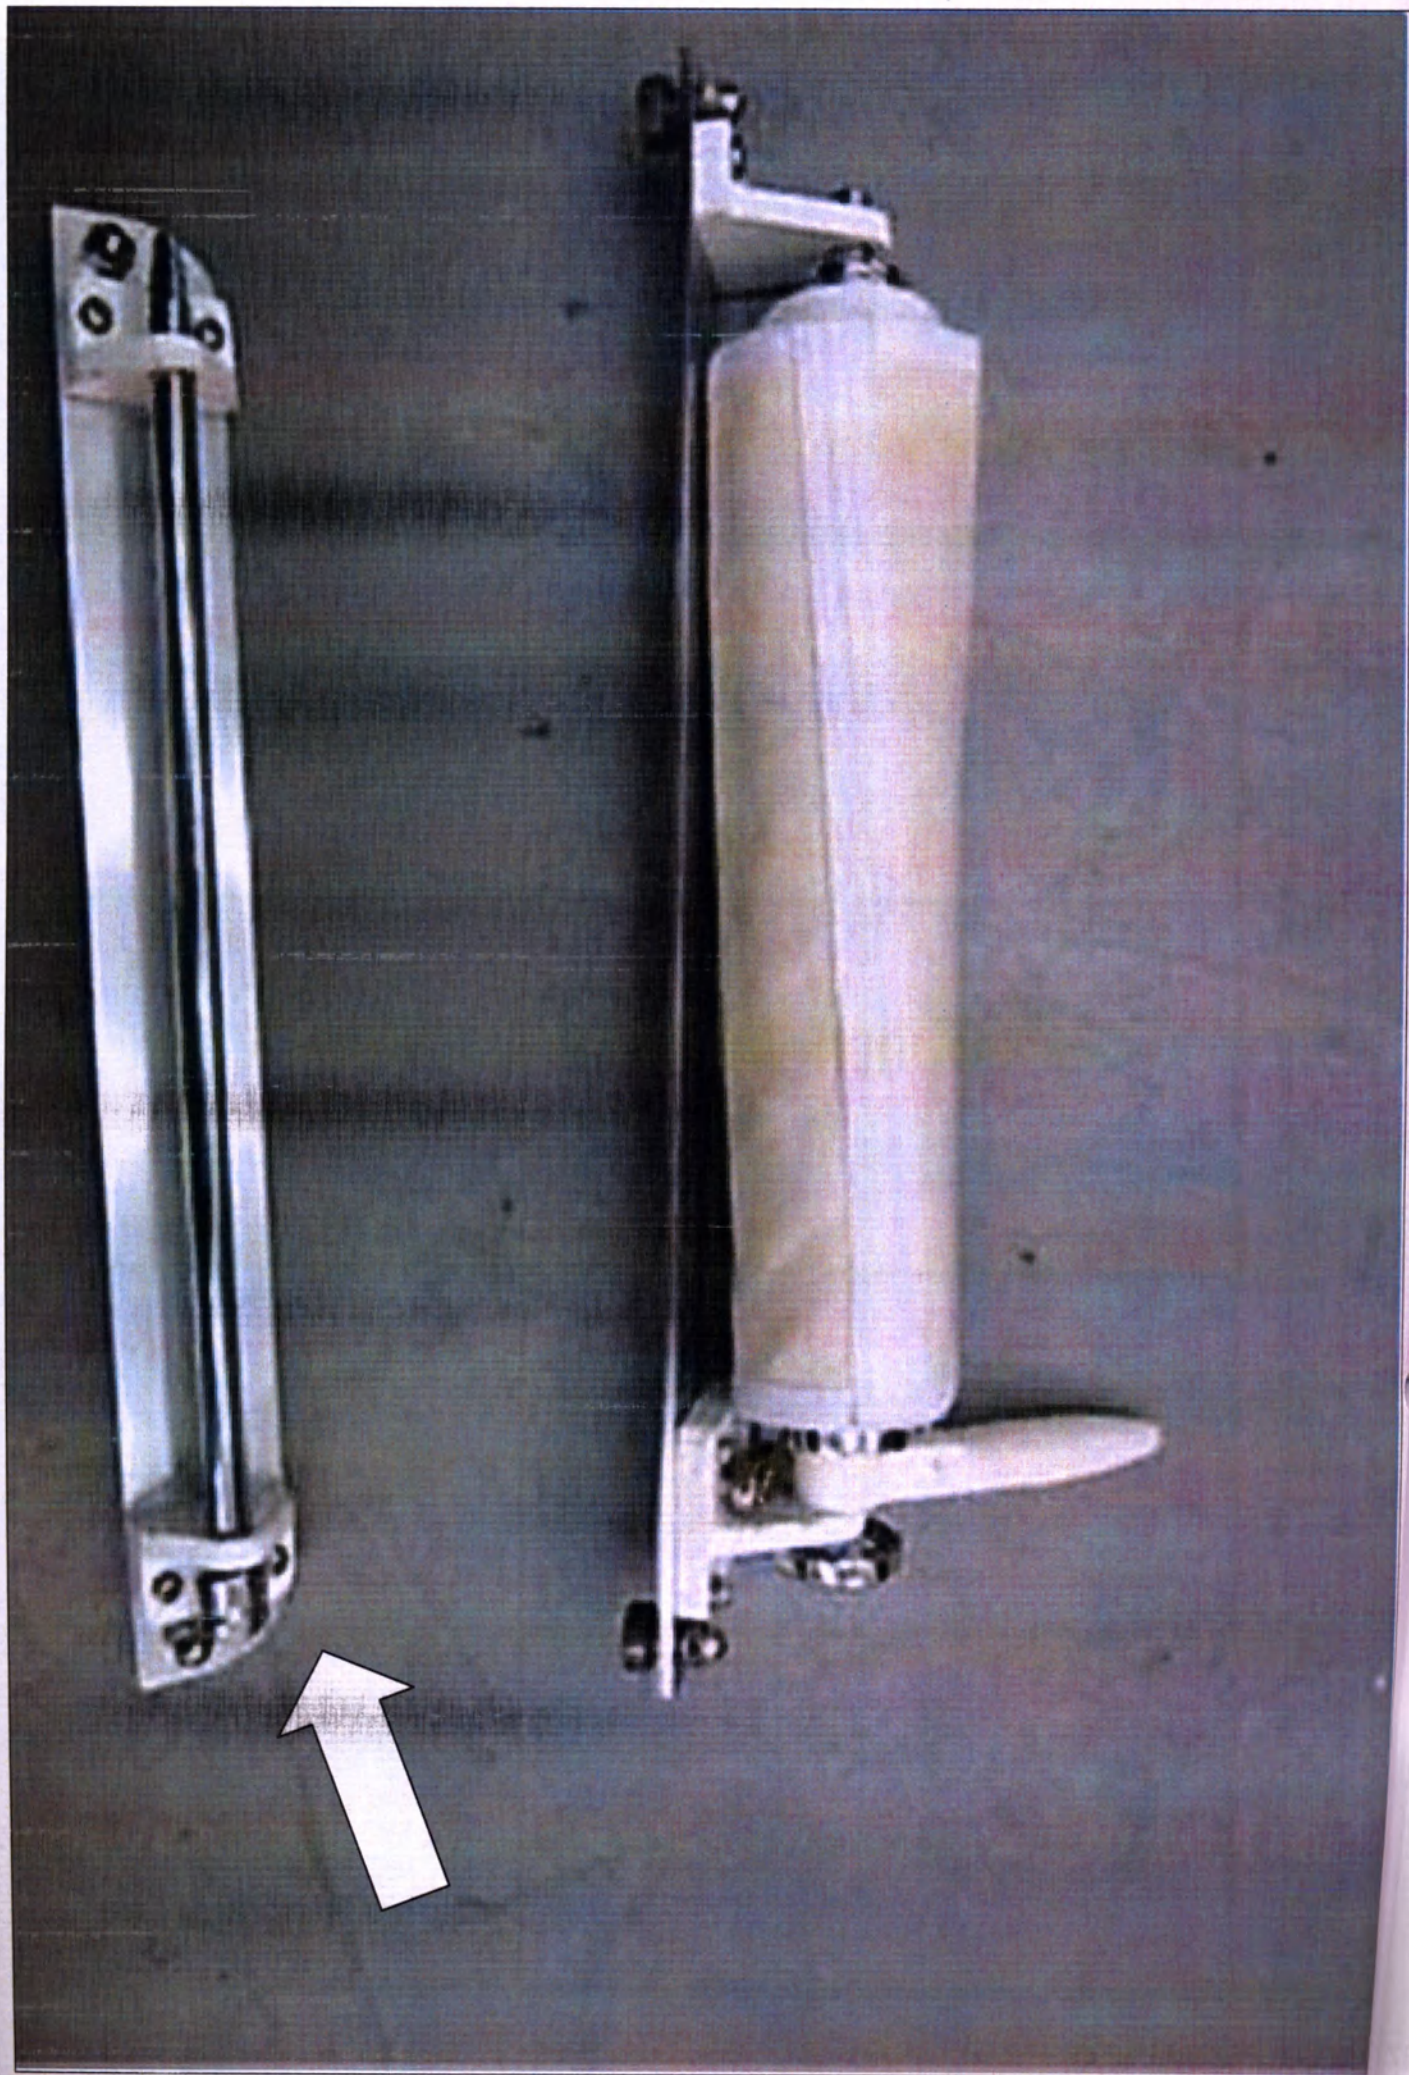


NOTICE	⚠ CAUTION	⚠ WARNING	⚠ DANGER	
 keep_up	 magnetic	 biohazard	 compressgas	 ppe-hearing
 fragile	 impact	 corrosive	 heavyobject	 ppe-2people
 static_elec	 heat	 general	 laser	 ppe-respiratory
				

1. Компрессор.

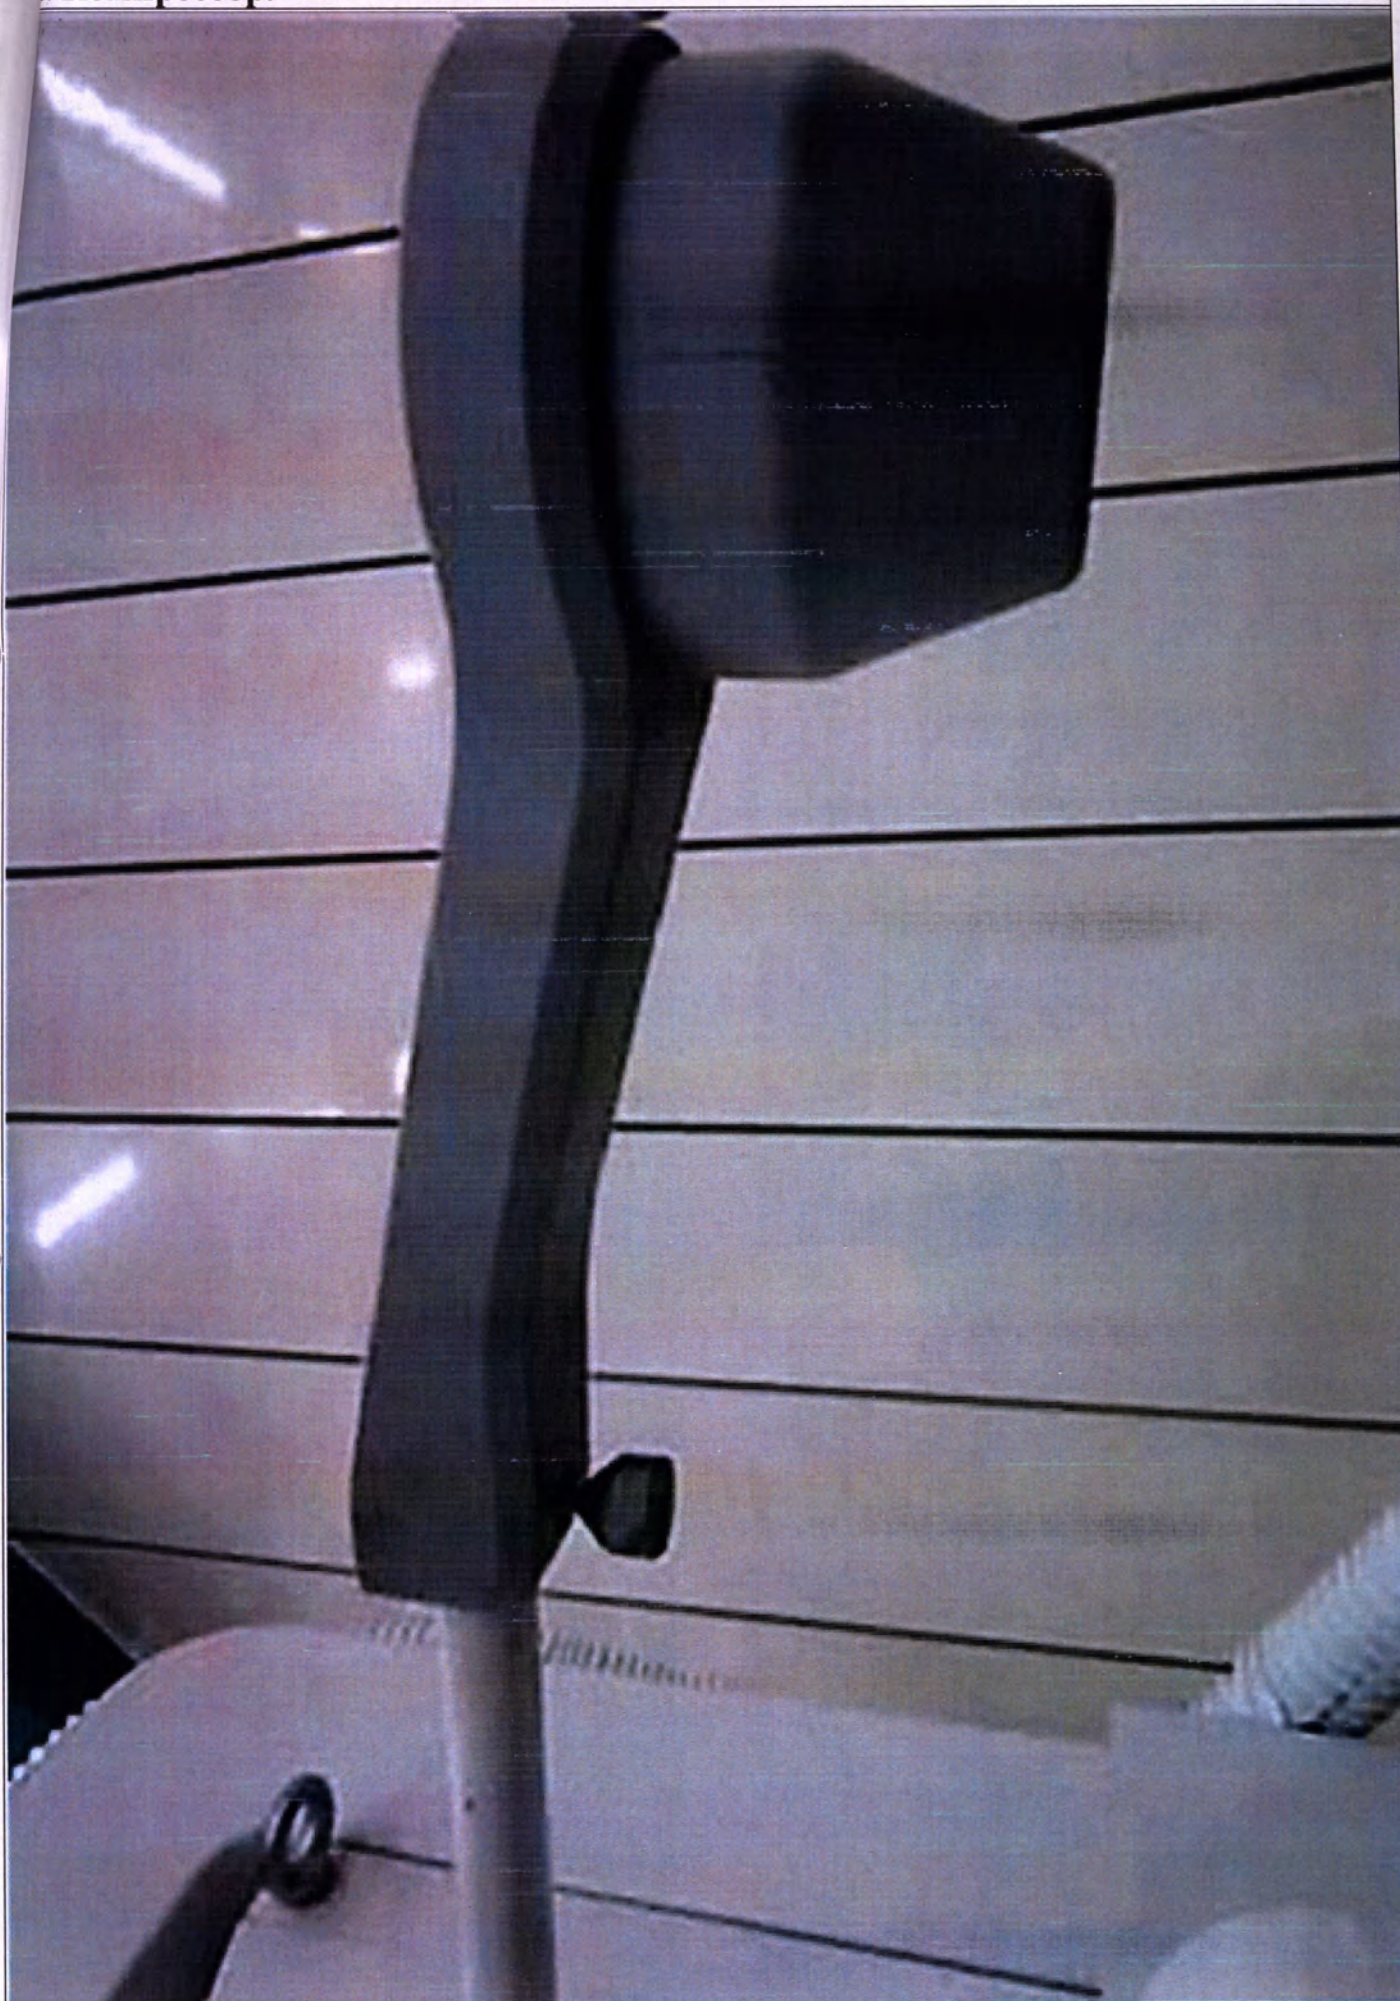

1. Ключ активации программного обеспечения вызова листа пациентов DICOM Worklist (не более 5 шт.).

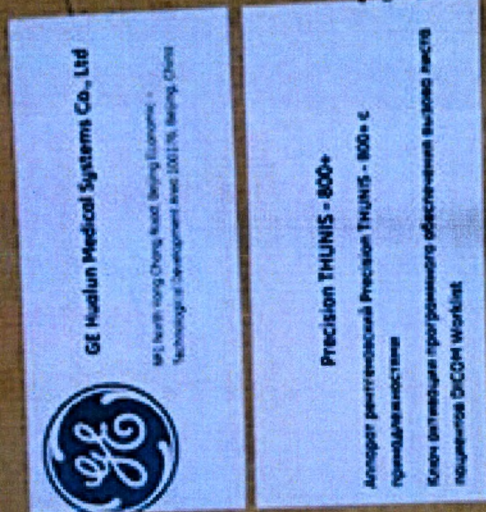

2. Ключ активации программного обеспечения для различных анатомических областей (не более 5 шт.).




GE Healthcare Medical Systems Co., Ltd

1st Floor, 10th Floor, 11th Floor, Beijing Economic
Technological Development Area 100176, Beijing, China


Precision THUNIS - 800+

Ключ активации программного обеспечения для различных анатомических областей



8851SPP

3. Ключ активации программного обеспечения для автопротоколирования (не более 5 шт.).



B8645PP



GE Hualun Medical Systems Co., Ltd

1st North Hong Chang Road, Beijing Economic
Technological Development Area 100176, Beijing, China

Precision THUNIS - 800+

Аппарат рентгеновский Precision THUNIS - 800+ с
примодельностью

Ключ активации программного обеспечения для
автопротоколирования

4. Ключ активации программного обеспечения для снижения дозы (не более 5 шт.).



GE Healthcare Medical Systems Co., Ltd

MP1 North Yang Chang Road, Beijing Economic
Technological Development Area 100176, Beijing, China

Precision THUNIS - 800+

Универсальный рентгеновский Precision THUNIS - 800+ с
трансформатором


Ключ активации программного обеспечения для снижения
дозы



B8645PP

5. Устройство позиционирования.



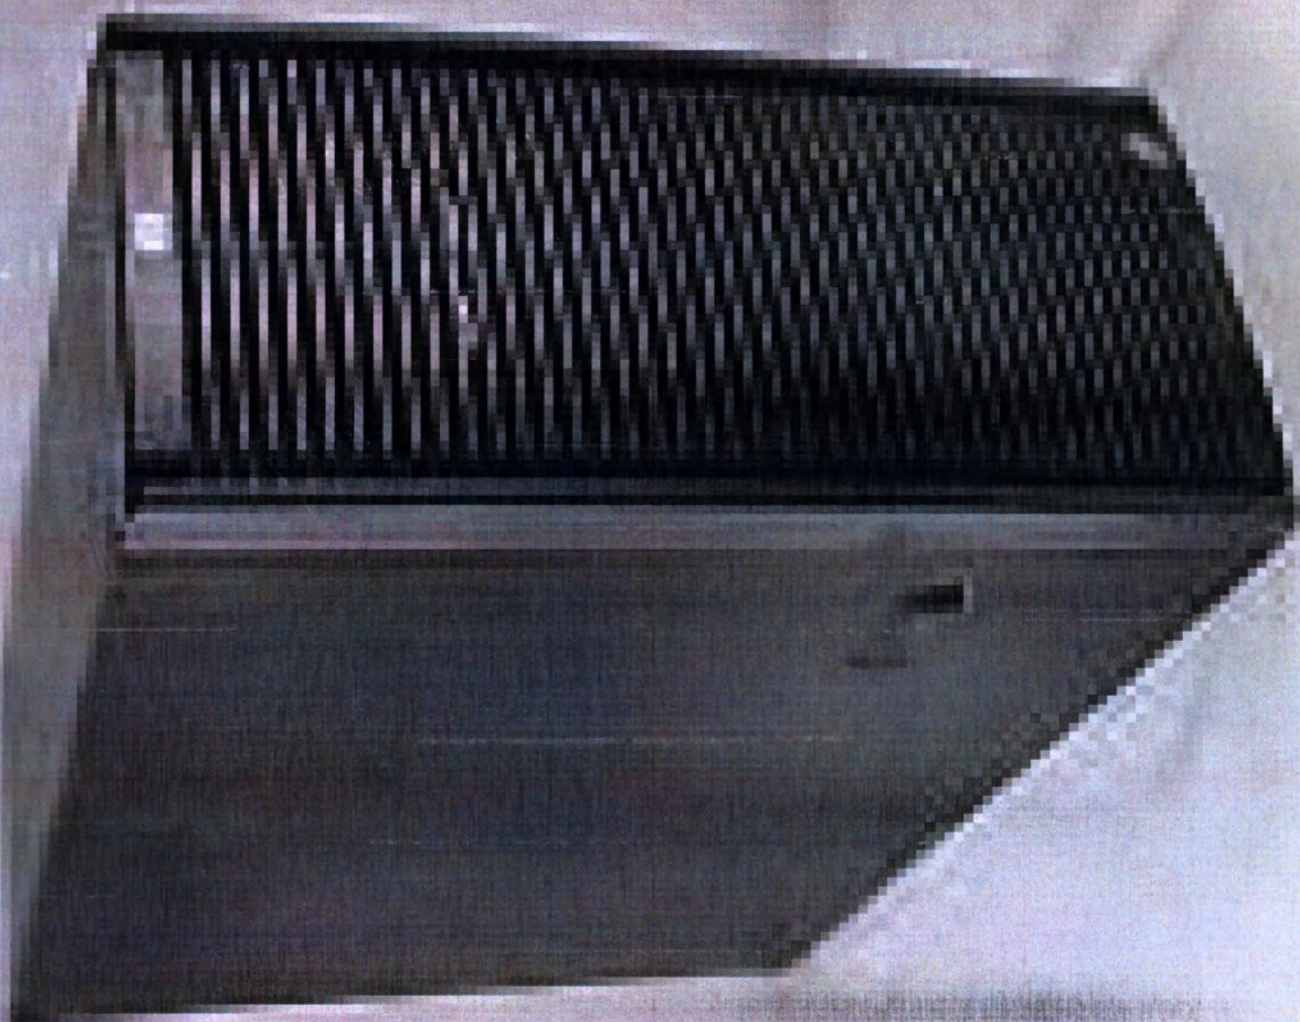

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО.
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
48 (сорок **ЛИСТА (ОВ)**
восьми)

