



11.2014



FV500



1051/11



1287

230V~ 100mA 50/60Hz
2 x 125 mA T

115V~ 200mA 50/60Hz
2 x 250 mA T

ICP-Monitor

Монитор для измерения
внутричерепного давления

Spiegelberg
(GmbH & Co.) KG
Tempowerkring 4
21079 Hamburg
Germany



Датчик ВЧД эпидуральный

Датчик ВЧД эпидуральный

Изделие одноразового использования для подключения к монитору для измерения внутричерепного давления ICP-Monitor (FV 500)

REF SN013.1.12/PV531P

LOT 37454

 2012-08

 2015-08



CE
0 2 9 7

Нетоксично. Апирогенно.

Производитель:
Spiegelberg (GmbH & Co.) KG
Tempowerkring 4
21079 Hamburg
Germany



Датчик ВЧД интравентрикулярный

Датчик ВЧД интравентрикулярный

Изделие одноразового использования для подключения к монитору для измерения внутричерепного давления ICP-Monitor (FV 500)

REF SN013.1.13/PV532P


LOT 23256

 2012-09 2015-09

CE
0297

Нетоксично. Апирогенно.

Производитель:
Spiegelberg (GmbH & Co.) KG
Tempowerkring 4
21079 Hamburg
Germany

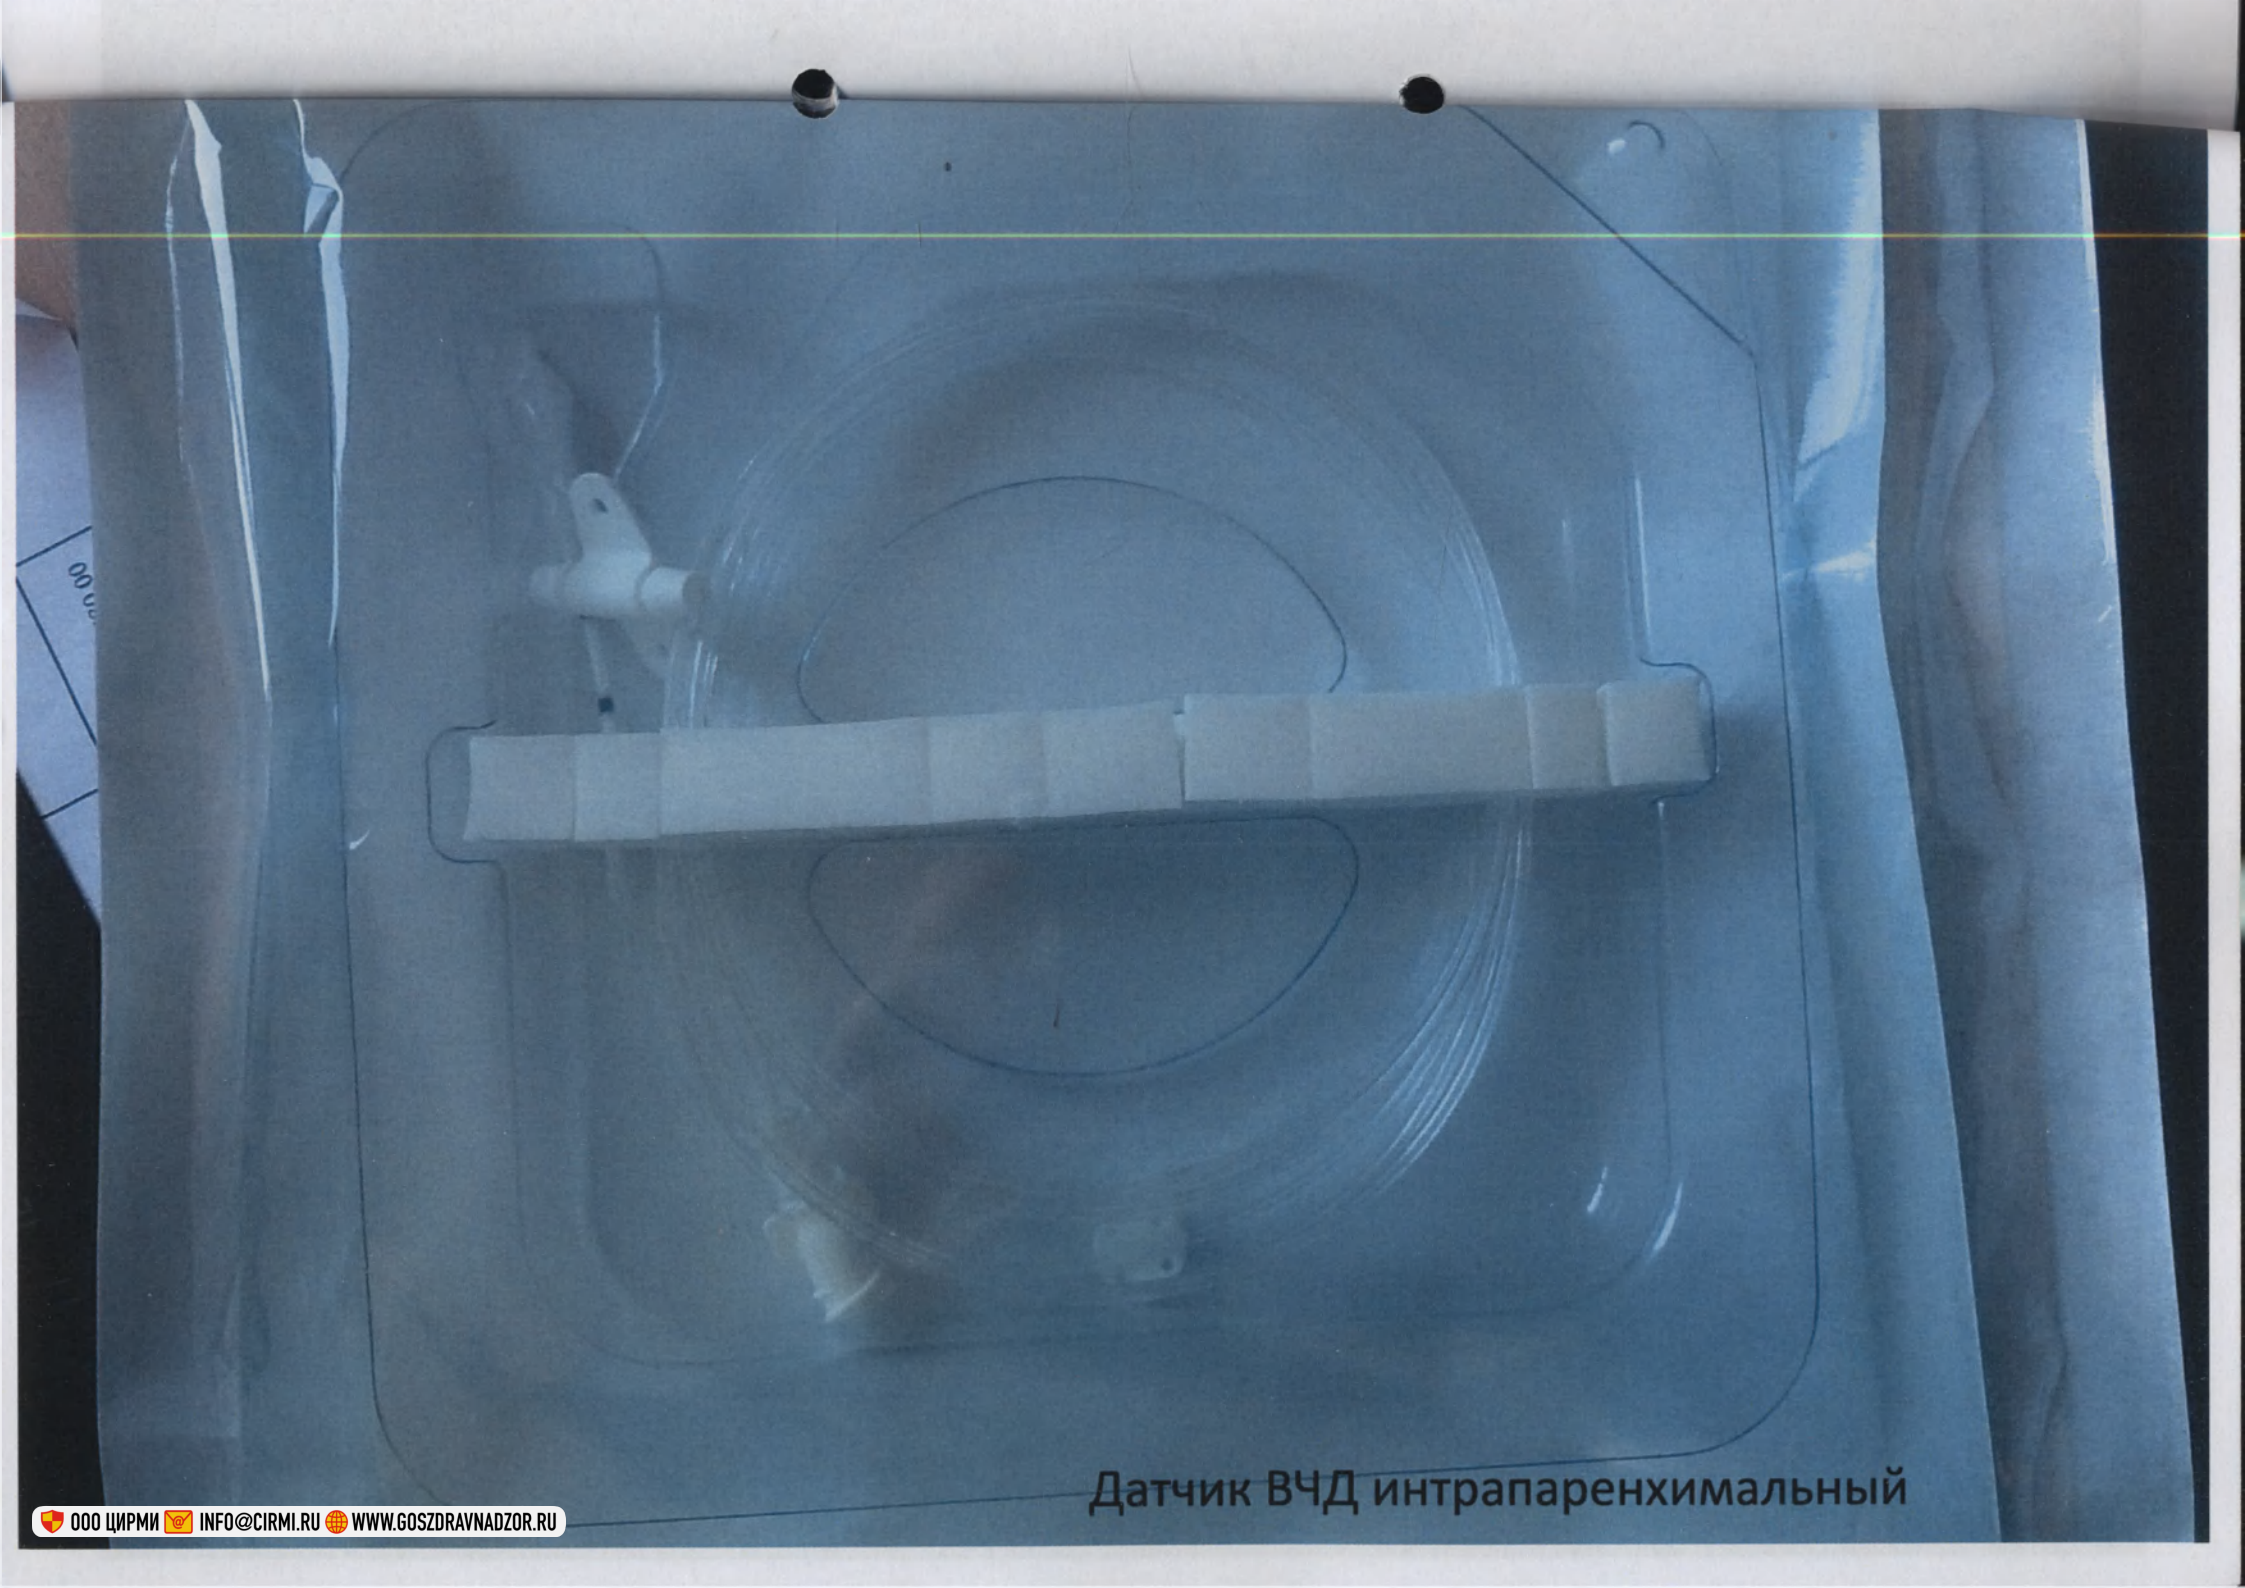

Датчик ВЧД интрапаренхимальный

Датчик ВЧД интрапаренхимальный


Изделие одноразового использования для подключения к монитору для измерения внутричерепного давления ICP-Monitor (FV 500)

REF SN013.1.53/PV534P

LOT 19930

 2012-11

 2015-11



STERILE EO 


CE
0287

Нетоксично. Апиrogenно.

Производитель:
Spiegelberg (GmbH & Co.) KG
Tempowerkring 4
21079 Hamburg
Germany



Кабель сетевой

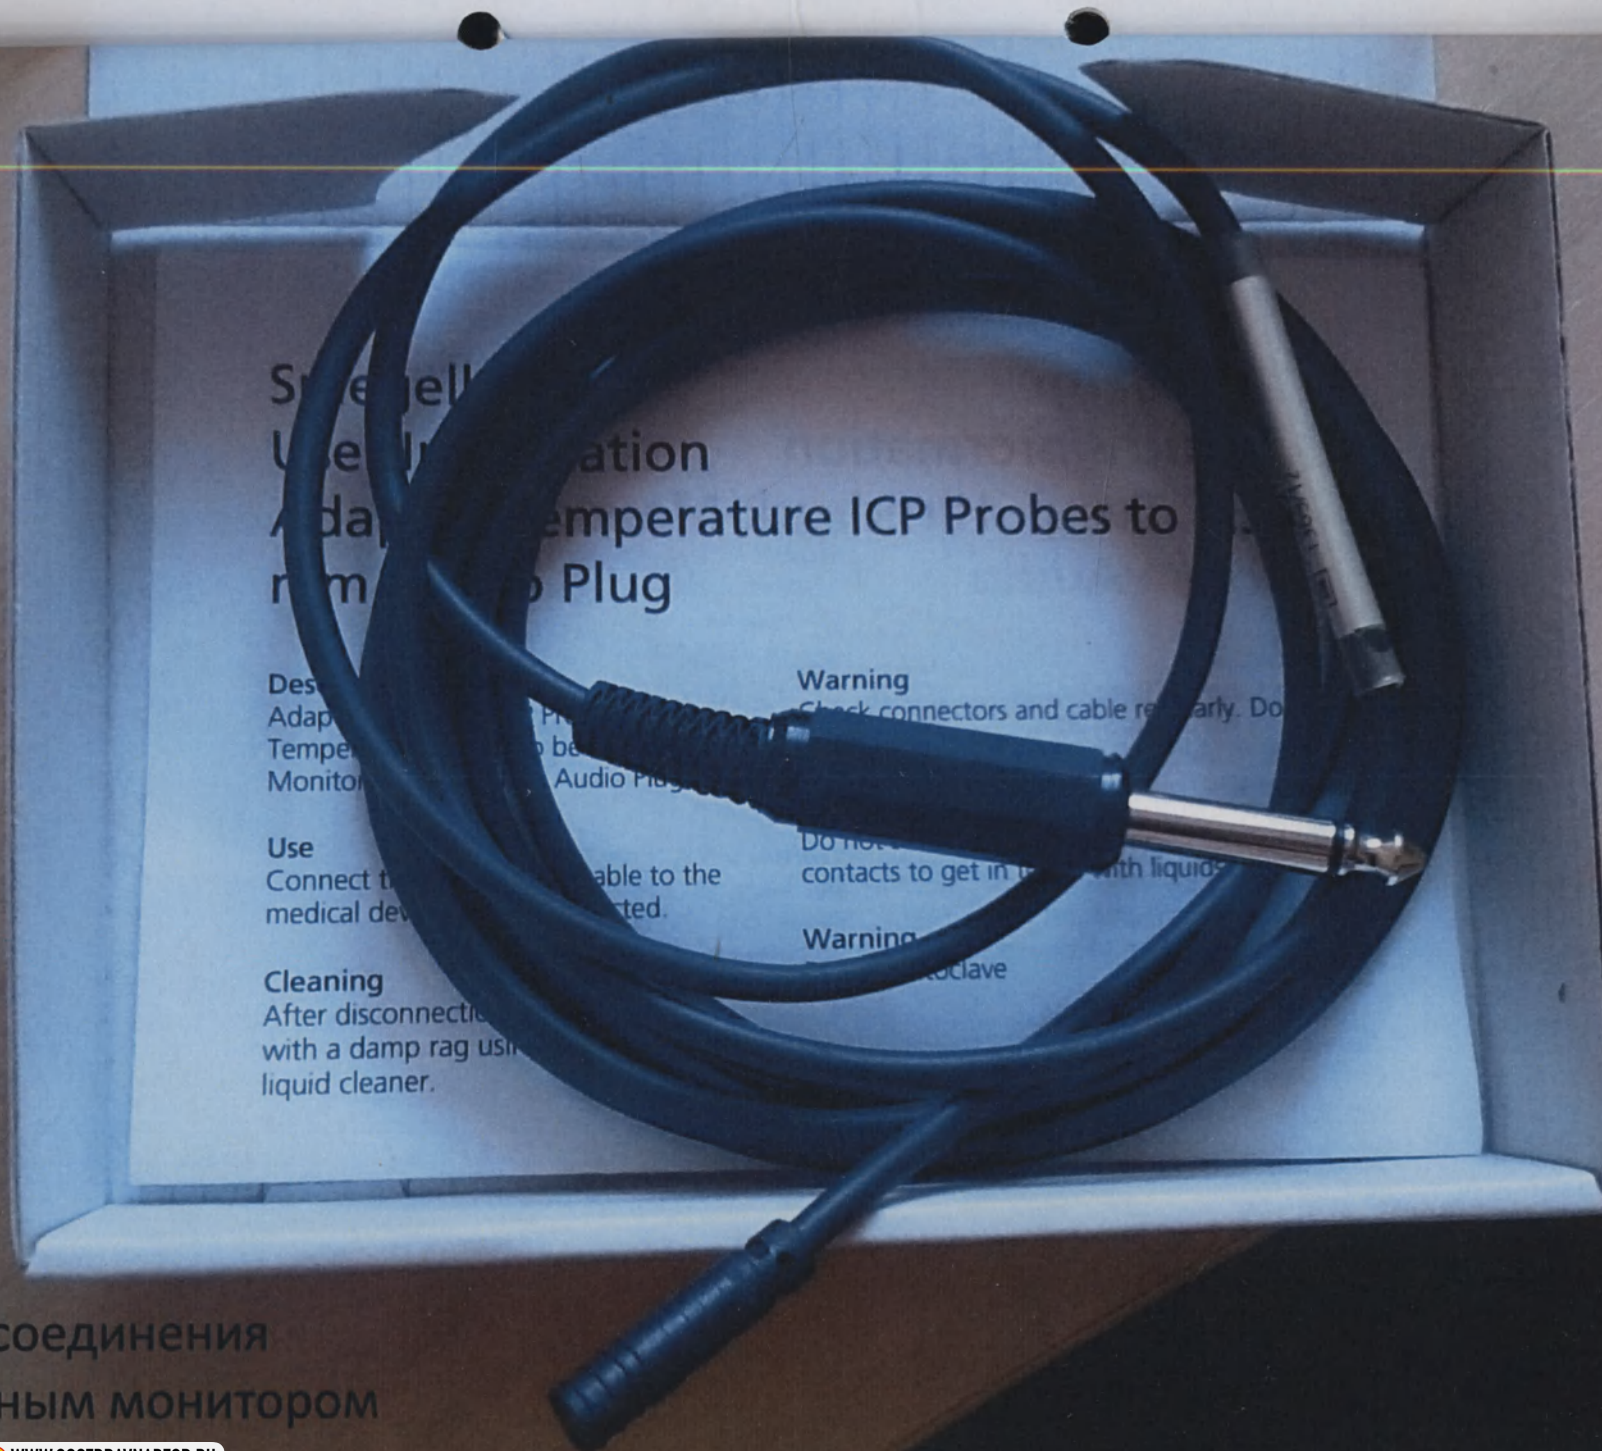

Stimell
Use Information
Adapt Temperature ICP Probes to
mm to Plug

Des
Adap
Temp
Monitor
Audio Plug

Use
Connect the cable to the
medical device.

Cleaning
After disconnection
with a damp rag using
liquid cleaner.

Warning
Check connectors and cable regularly. Do

Do not
contacts to get in touch with liquid.

Warning
Sterilize

Кабель для соединения
с прикроватным монитором



Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

11 (одинадцать)) лист 06



Чебурашкин Д.М.