

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Флогистон-МЕД»



С.П. Сердюков

«02» апреля 2015 г.

ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система роботизированная Walkbot для восстановления функции
ходьбы, с принадлежностями**



МОДУЛЬ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА





Walkbot
Rehabilitation System


МОДУЛЬ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА



1.4 Hip
joint manual
length
adjustment

РЕГУЛЯТОР ДЛИНЫ КОЛЕНА

1.5 Knee
joint manual
length
adjustment

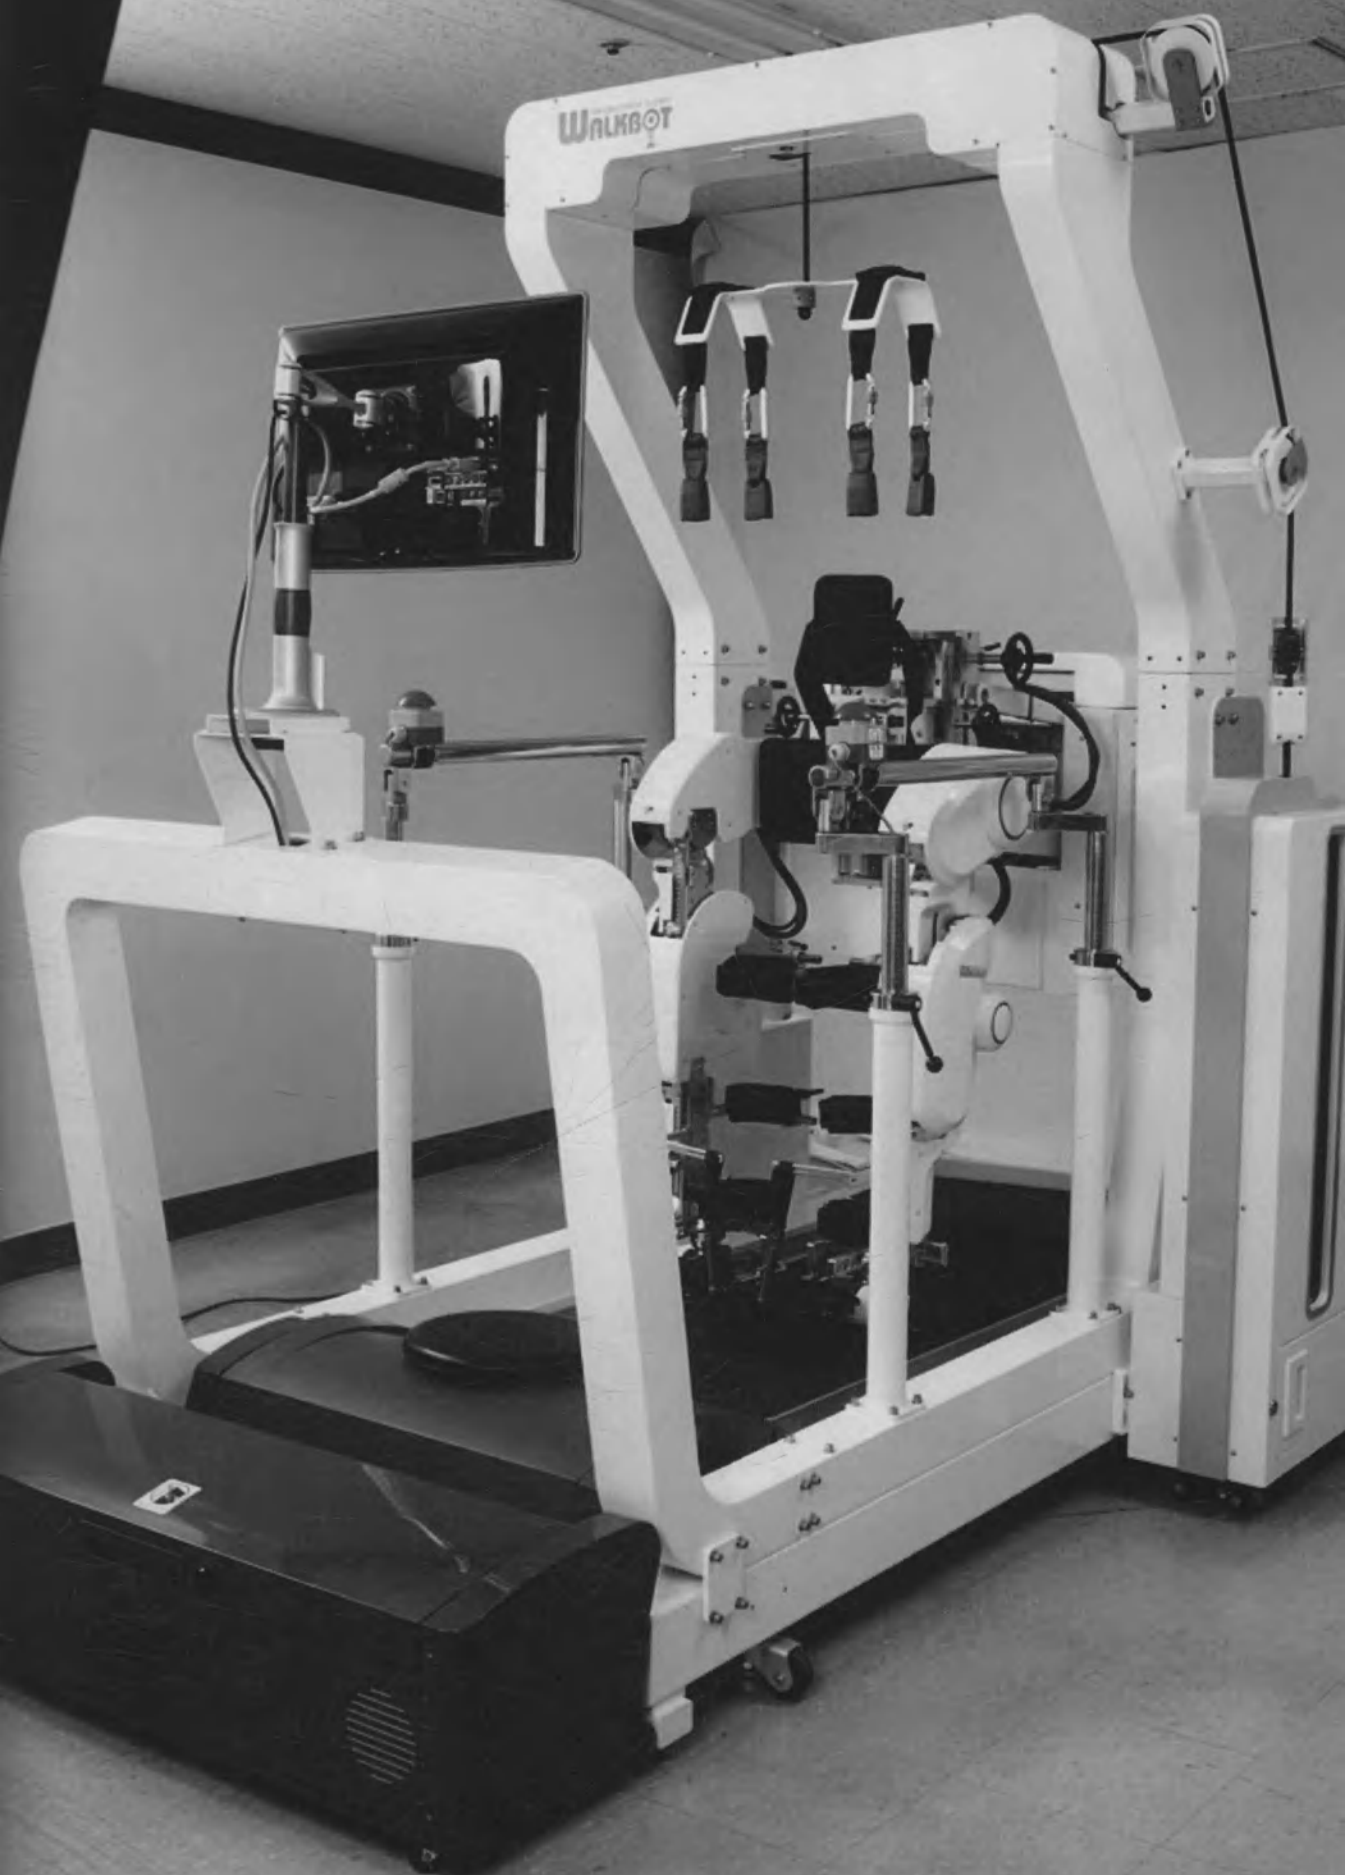


ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ





ОПОРНЫЕ БРУСЬЯ

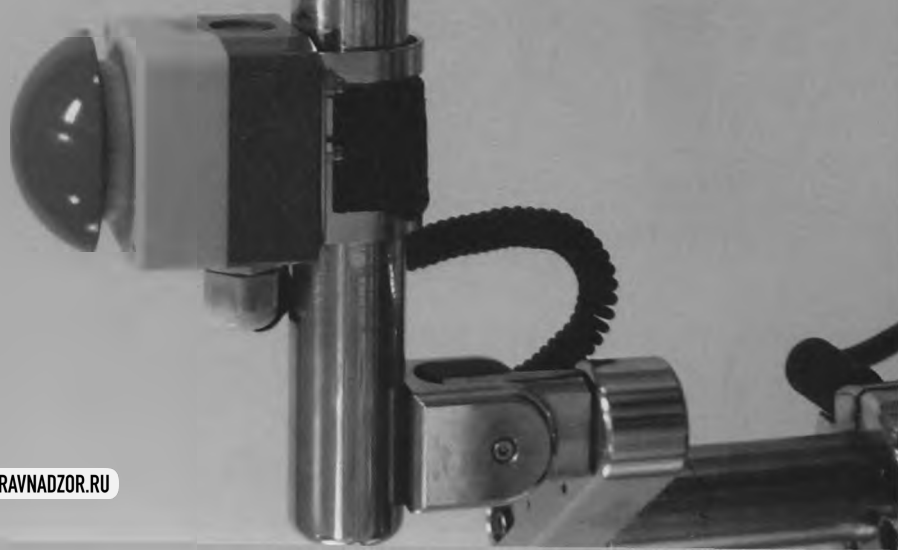

КНОПКА ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ



ДЕРЖАТЕЛЬ МОНИТОРА





КРЕПЛЕНИЕ МЯЧА

5cm

10cm

15cm

20cm

2.7 Bar

LOTUS

БЛОК ОПЕРАТОРА



МОНИТОР ОПЕРАТОРА

3.1 OP
monitor

Walkbot Rehabilitation System Version 2.0 - PBS Mechanics Co., Ltd. (Walkbot_5 MODE)

Walkbot Rehabilitation System

Patient Info

Evaluation

Training

Data

Connecting to the System...

Treadmill Connected

Stop


12/19/2013

11:48 AM

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПК;
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ;
КНОПКА ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ.



3.5 OP connector panel

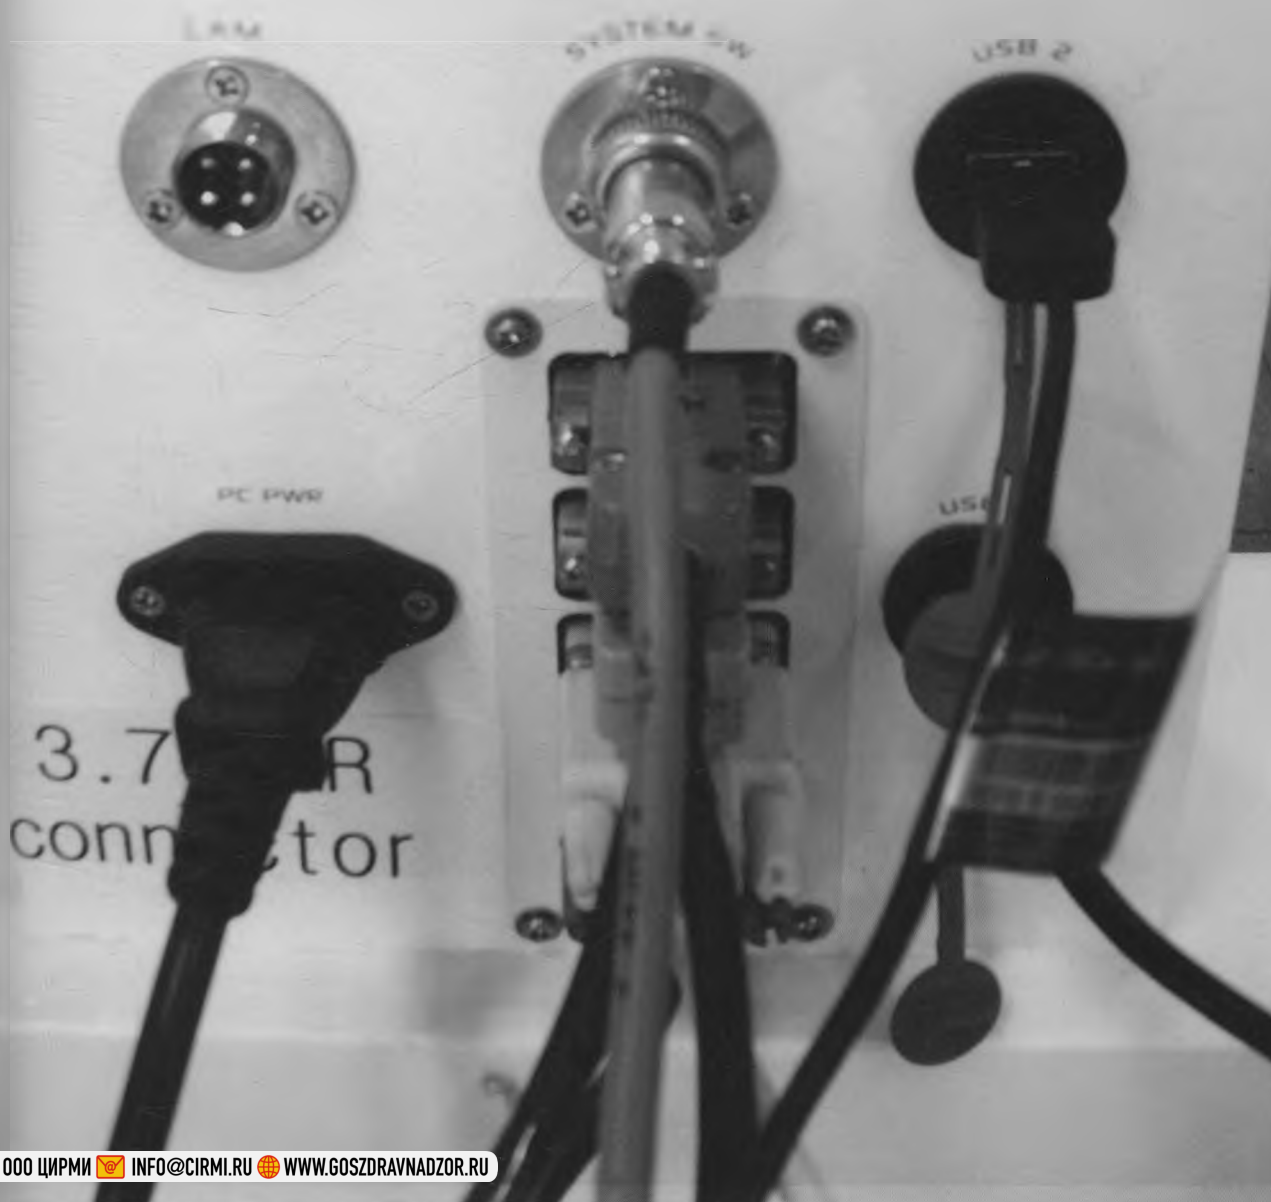



EMR KOHHEKTOP

PC PWR

3.7 ER
connector

CA15a

lesen Sie Gebrauch Bedienungsanleitung.
se refer to and manual for important operating and mo

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ







PC COM1

REMOCON


PC COM2

SYSTEM

TREADMILL COM

MONITOR IN

РАЗЪЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

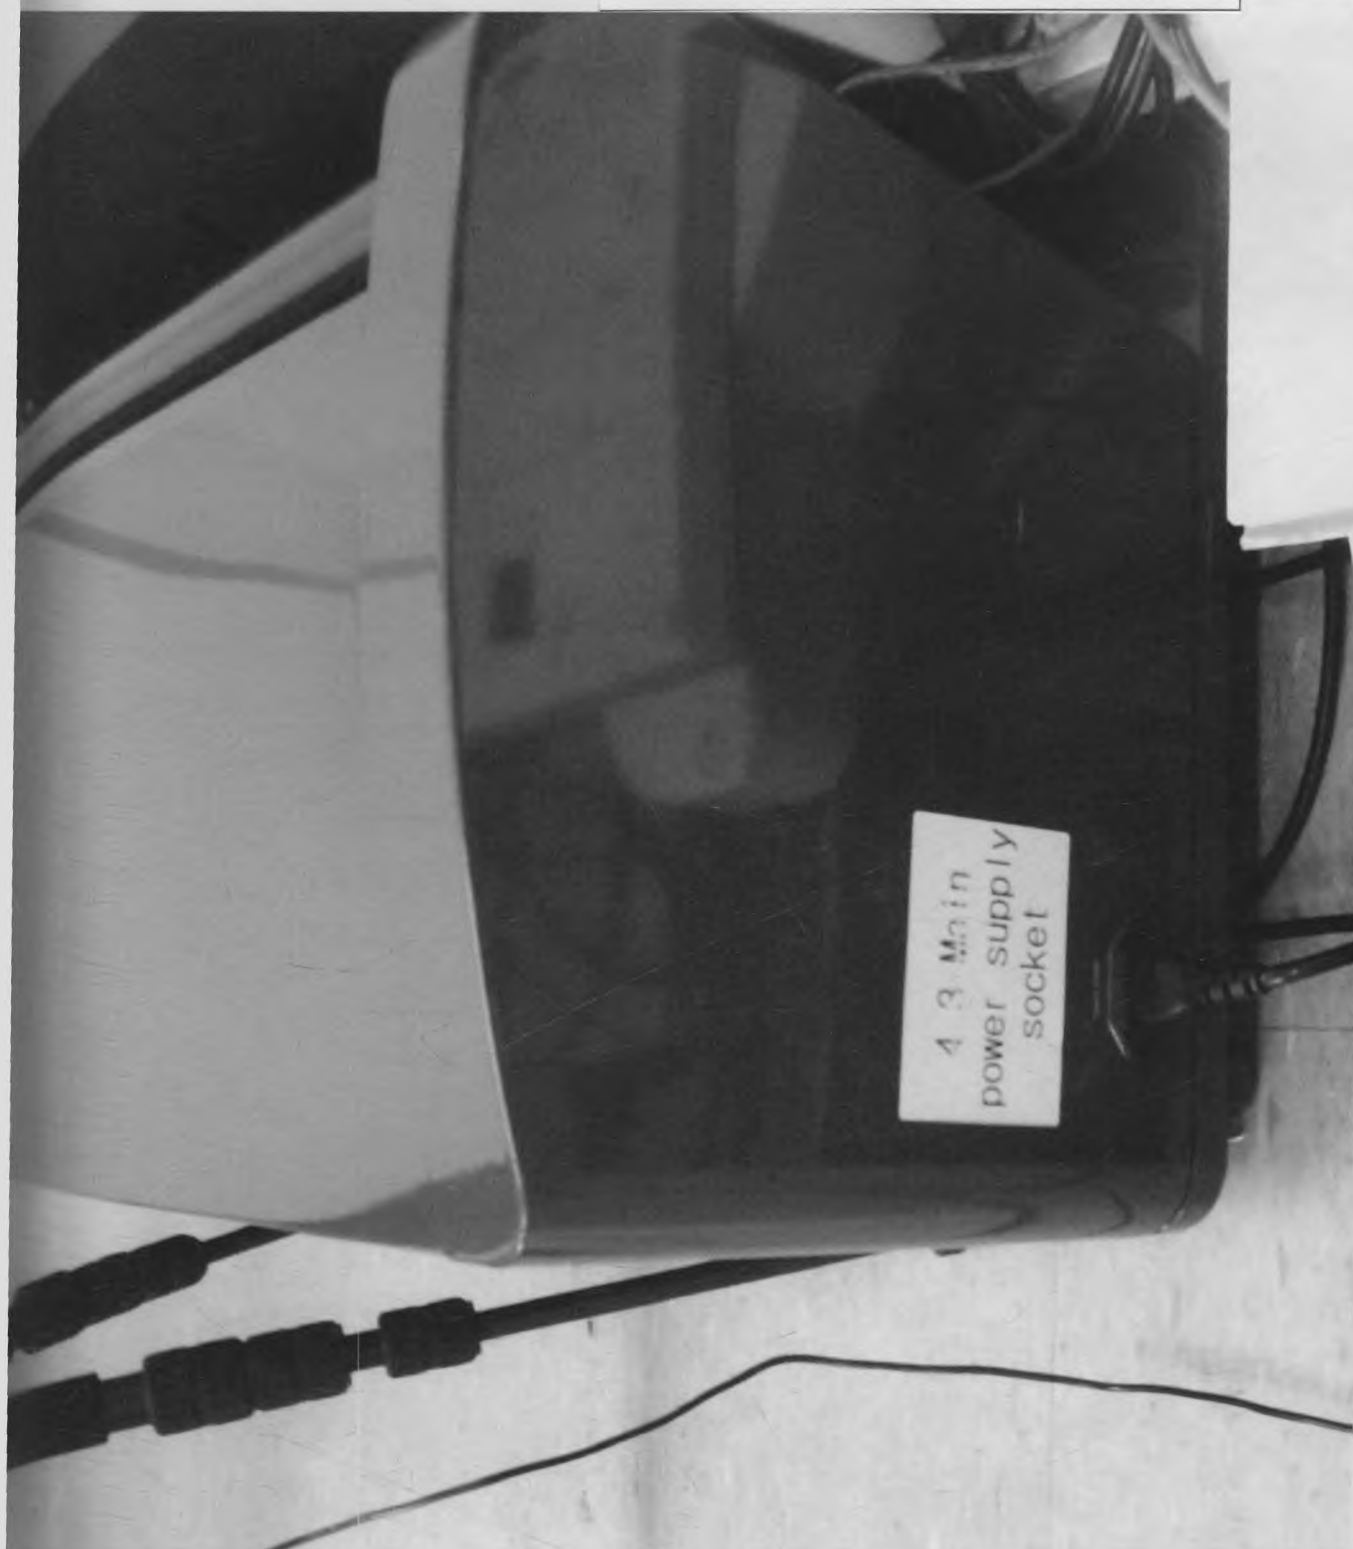

Walkbot
Rehabilitation
system

WALKBOT




절대 열지 마시오.




rhodus

ШТИФТ

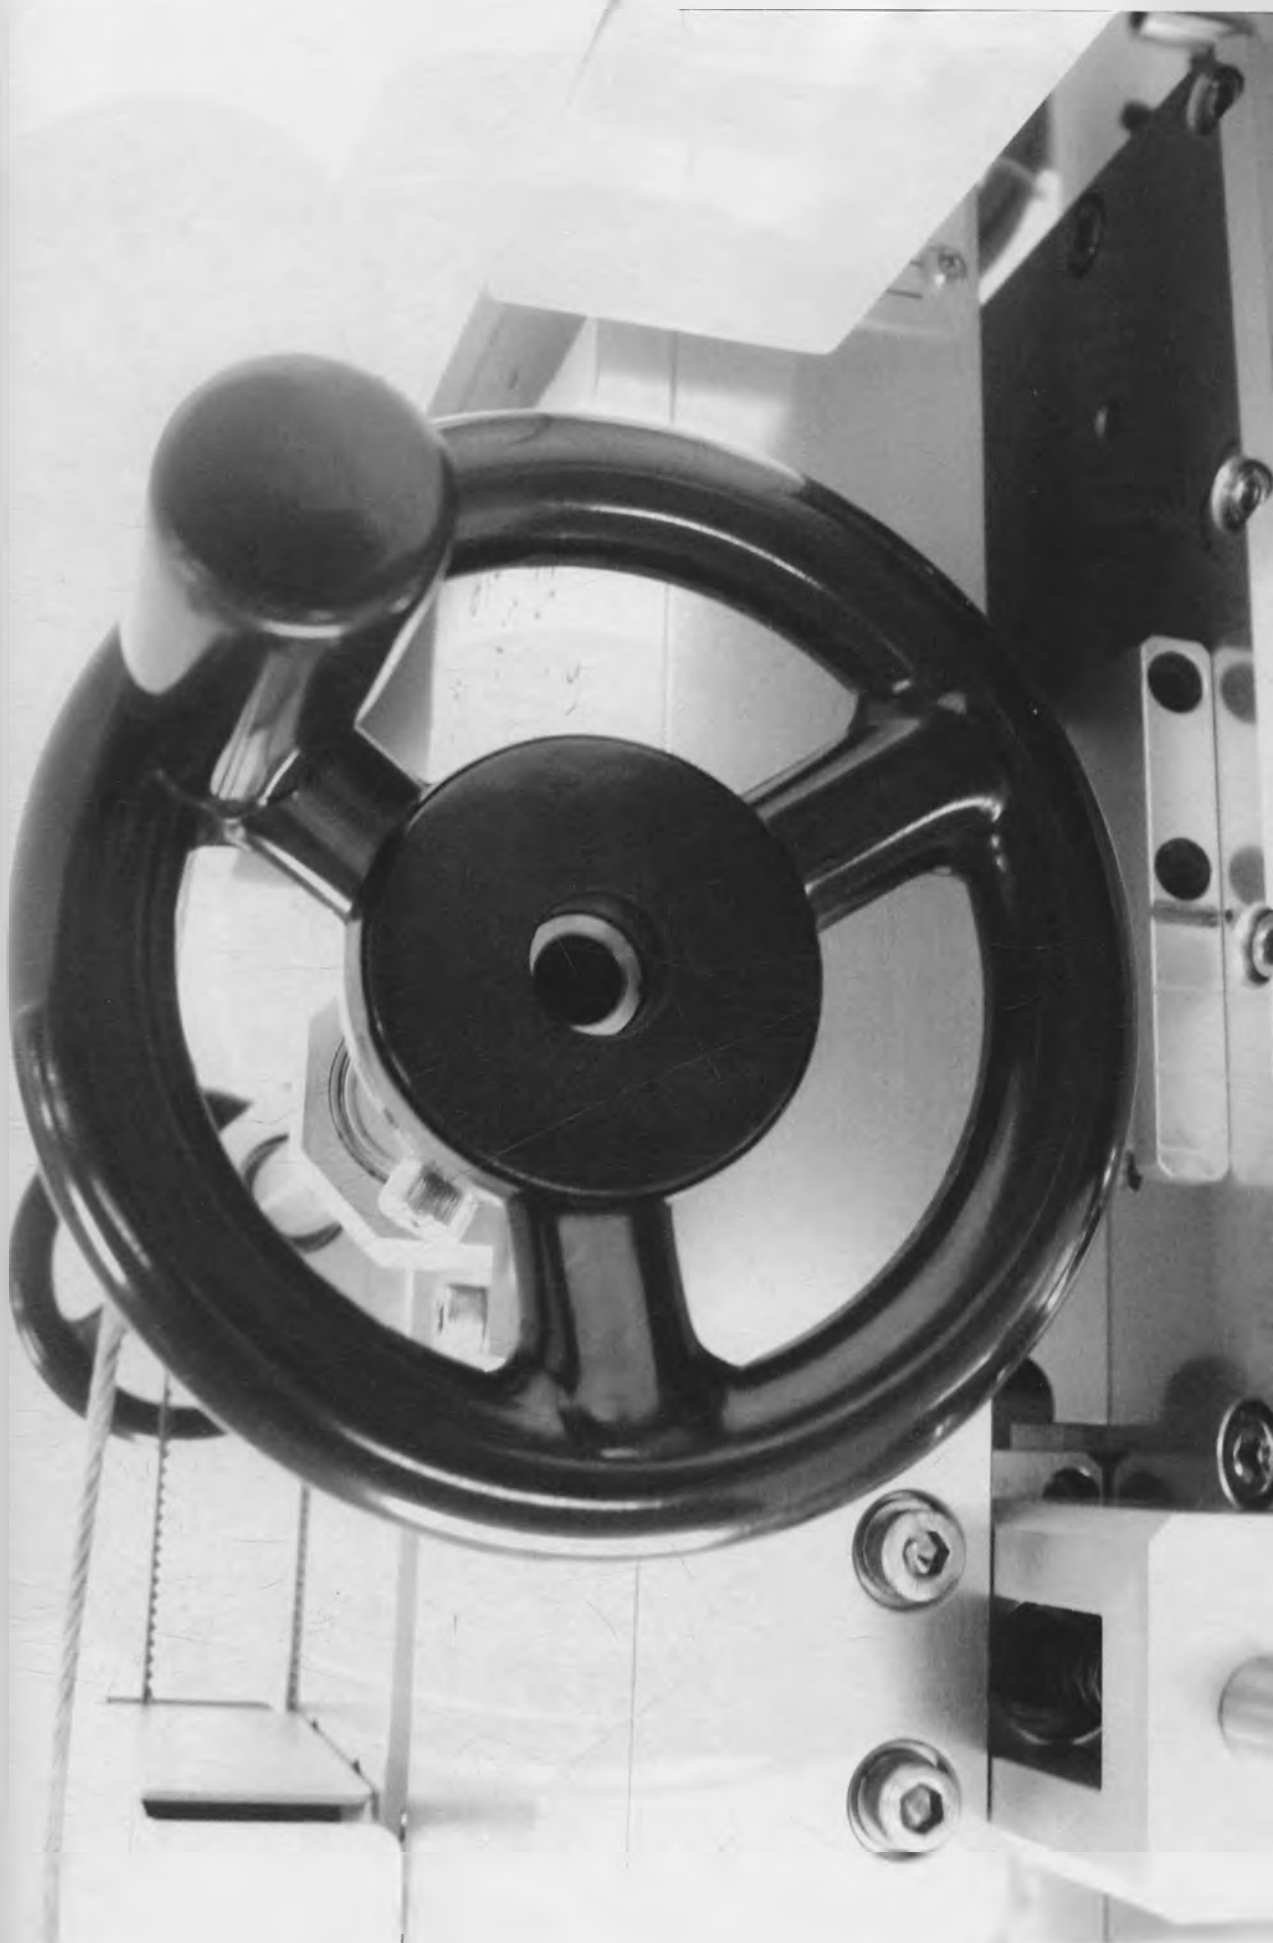

РУЧКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ

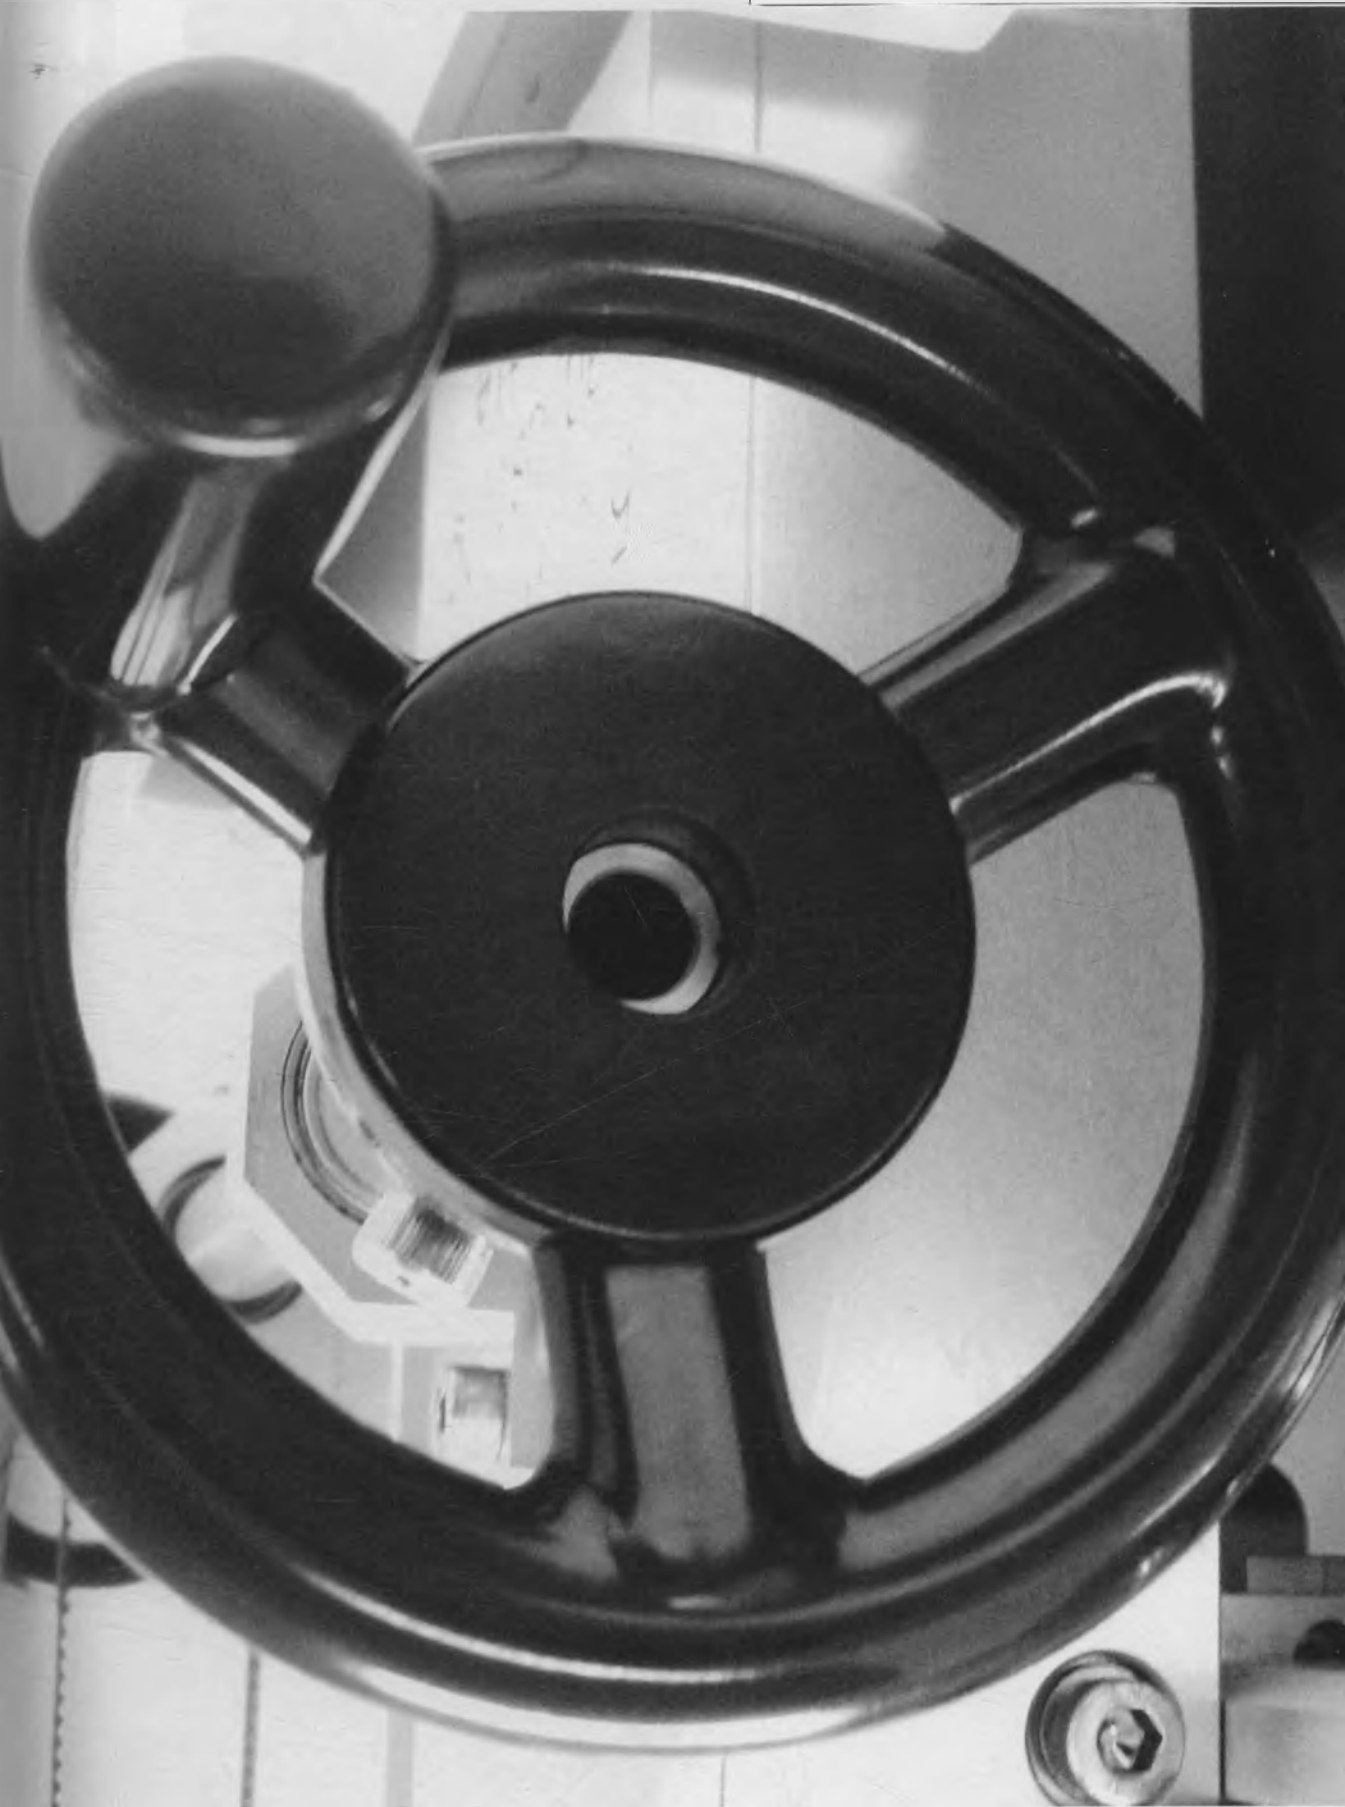


РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ

5.3 Width
adjusting
handle



РУЧКА КРЕПЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

ФИКСАТОР

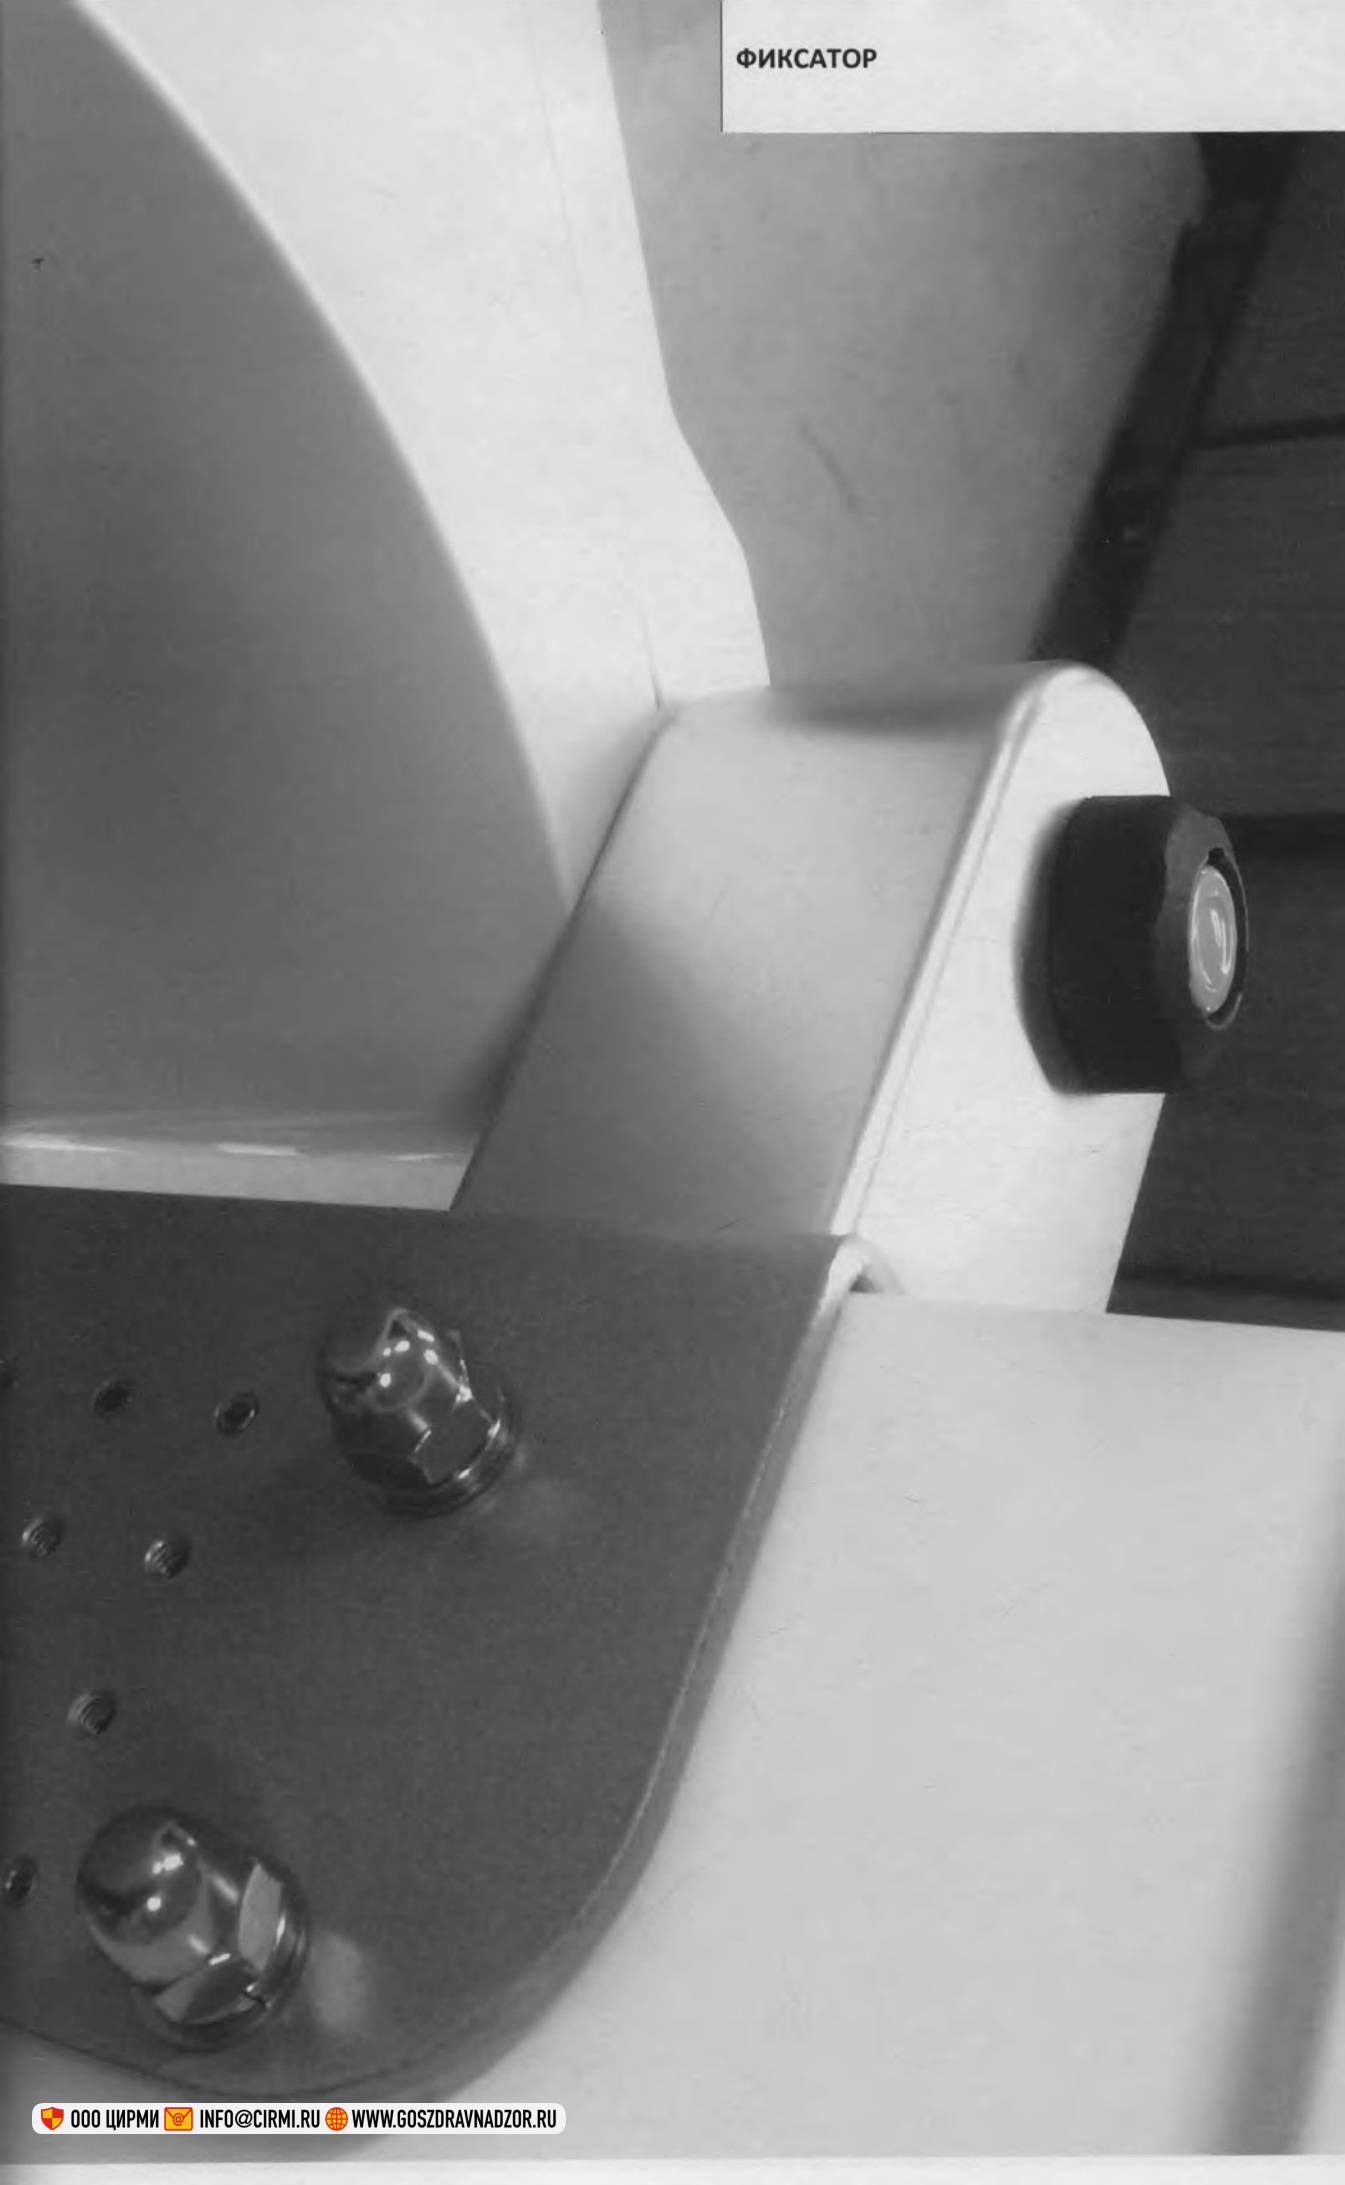

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА



КОНТРАГЙКА;
РУЧКА ДЛЯ НАСТРОЙКИ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД-
НАЗАД.

5.8 Locknut



5.9 Back
and forth
adjusting
handle

МОДУЛЬ ПРОТИВОВЕСА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

6. Weight
support
module
for patient

6.3 Fixing
pin

ЗАЖИМ

spinlock

PXR

8-10mm
5/16-3/8"
ALLOY

5.4 Correct
assembly
locking
rod

ПРОТИВОВЕС 0,5 КГ (8 ШТ.)

ШТИФТ КРЕПЛЕНИЯ



РУЧКА ДВЕРЦЫ



ПРОТИВОВЕС (19 ШТ.)

6.5 5kg
weight

5

10

15

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

6.3 l
p

МОДУЛЬ ПРОТИВОВЕСА ДЛЯ РОБОТА

7. Weight
support
module
for robot



DO NOT LIFT



ПРОТИВОБЕЗ (4 ШТ.)

ТРЕДБАН



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.
Please read the manual for important operating and maintenance instructions.
Veuillez lire le mode d'emploi pour l'usage, s'il vous plait.

Warning!
Gefahr in der Umgebung von entzündlichen oder brennbaren Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten.
Hochspannung. Vermeidung von Stromschlägen. Gerät nicht öffnen. Es befinden sich Wechselstrom.
Gerät nicht abdecken. Abstand zu anderen Geräten 60 mm, einhalten.

Attention!
Danger of explosion in the presence of flammable anaesthetics, with flammable gases or liquids.
High voltage. To prevent the risk of electrical shock do not open the device to service the parts inside.
Do not cover the device. Clearance 60 mm minimum on any side, keep this side.

Attention!
Danger of explosion autour des gaz, vapeurs, remèdes d'anesthésie, gaz inflammables ou combustibles.
Danger de tension. N'ouvrez pas l'appareil pour éviter des chocs électriques. Il n'y a pas des parts à changer dans l'appareil.
Ne pas couvrir l'appareil. Moindre distance aux autres appareils 60 mm.


 Nur in trockenen Räumen verwenden.
Only for use in dry rooms!
Utilisez-le seulement dans des chambres sèches.

9. Isolation transformer

ИЗОЛИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

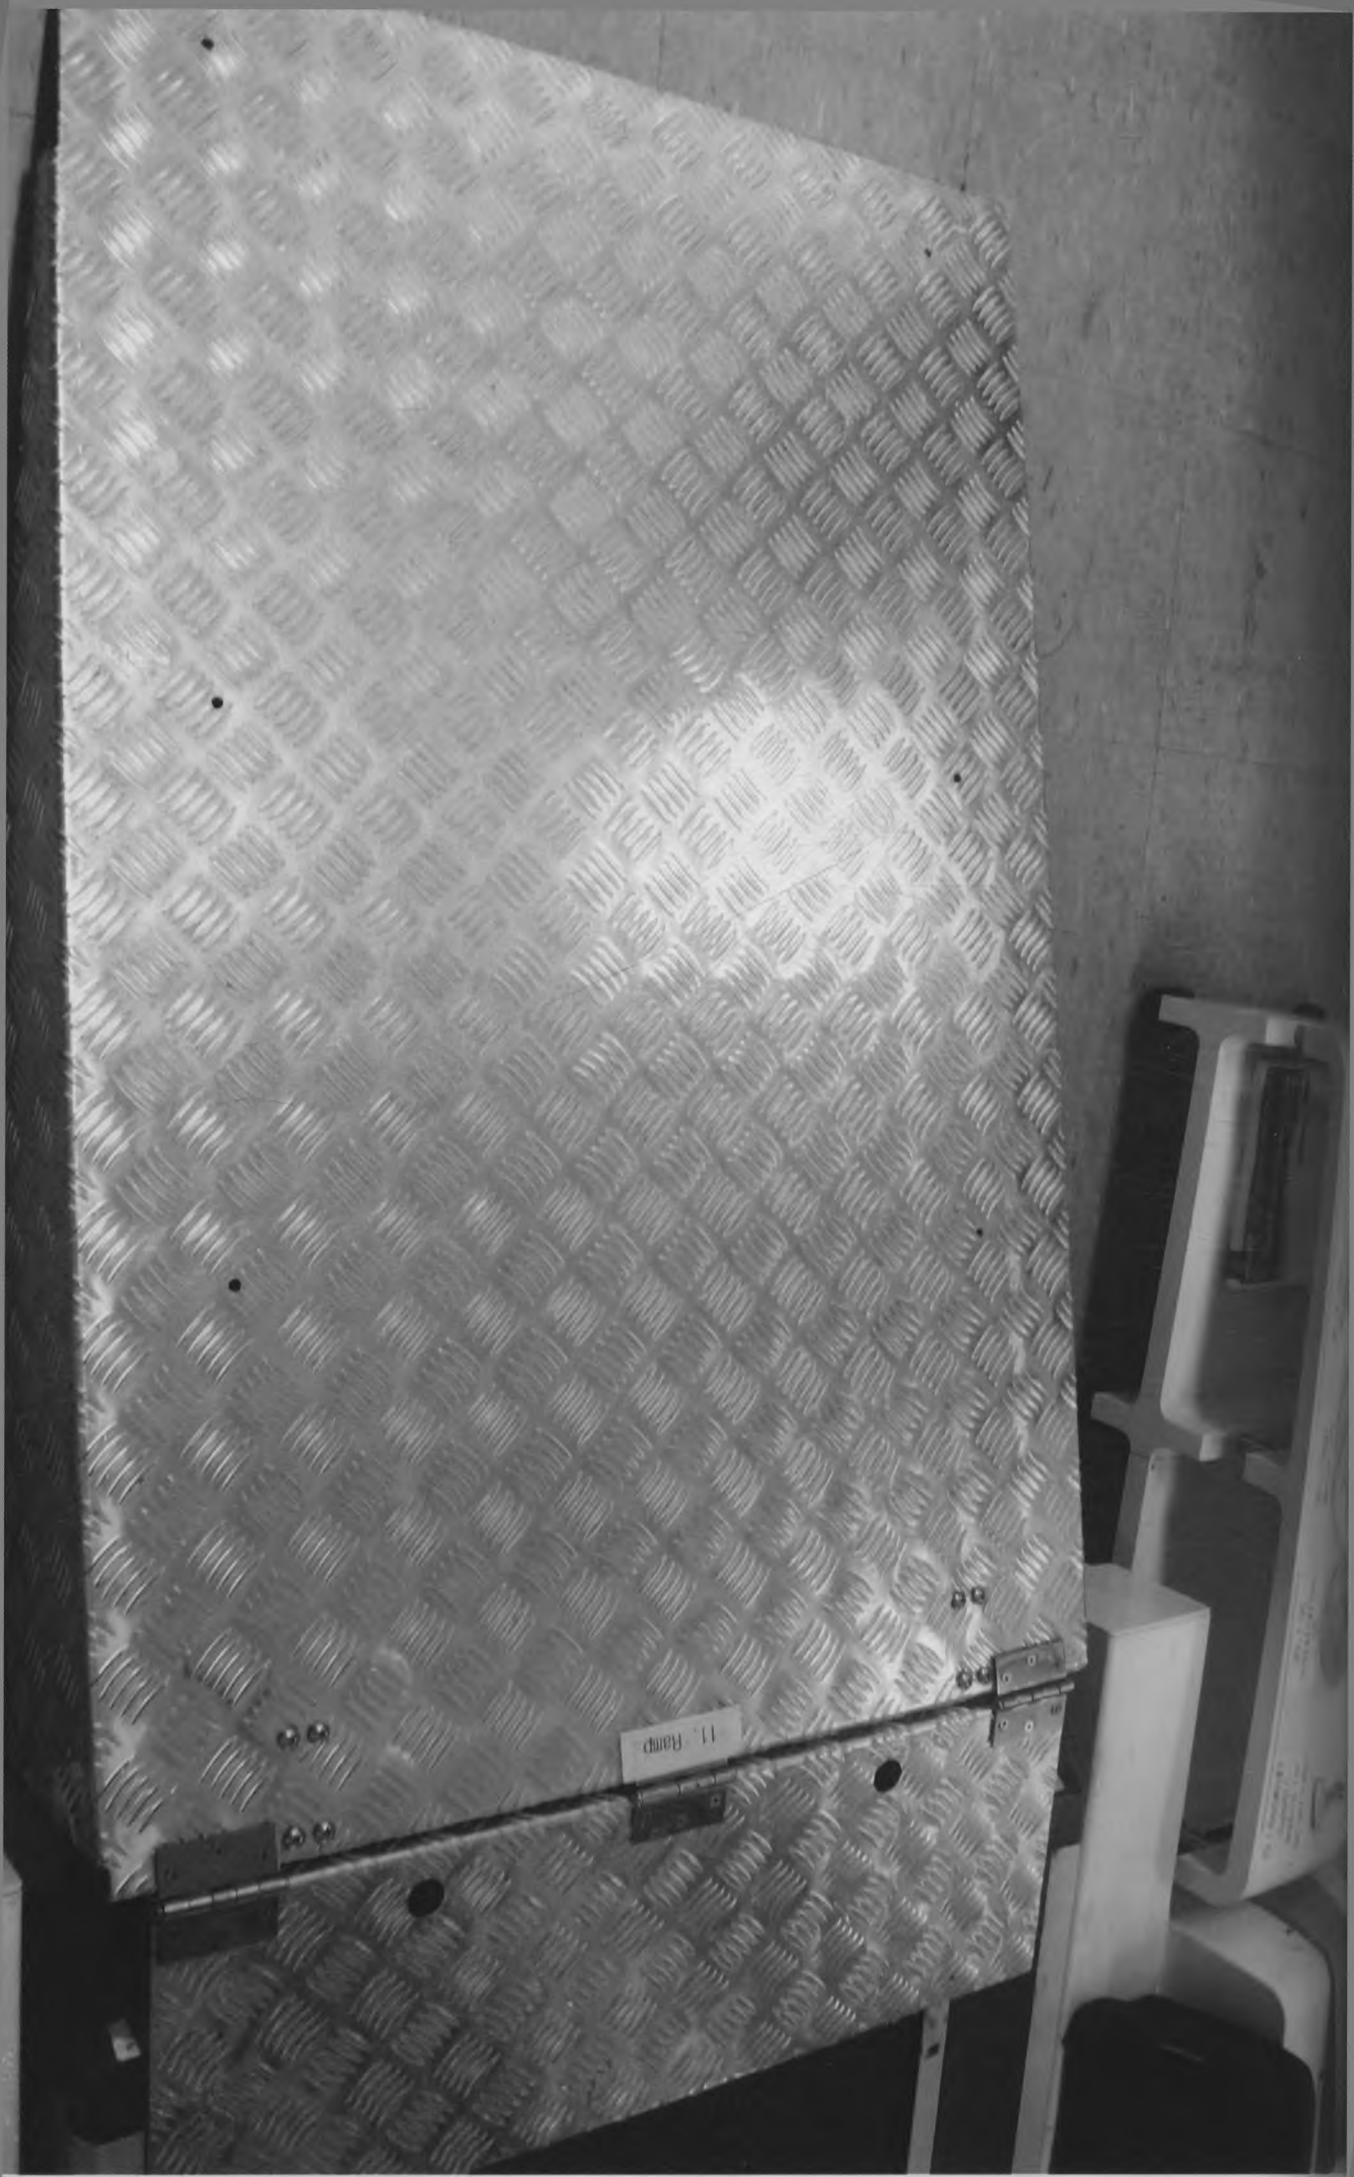



12.2 height
adjusting
and licking
device


СТОЙКА



УСТРОЙСТВО НАСТРОЙКИ И ФИКСАЦИИ
ВЫСОТЫ



ШНУР ПИТАНИЯ

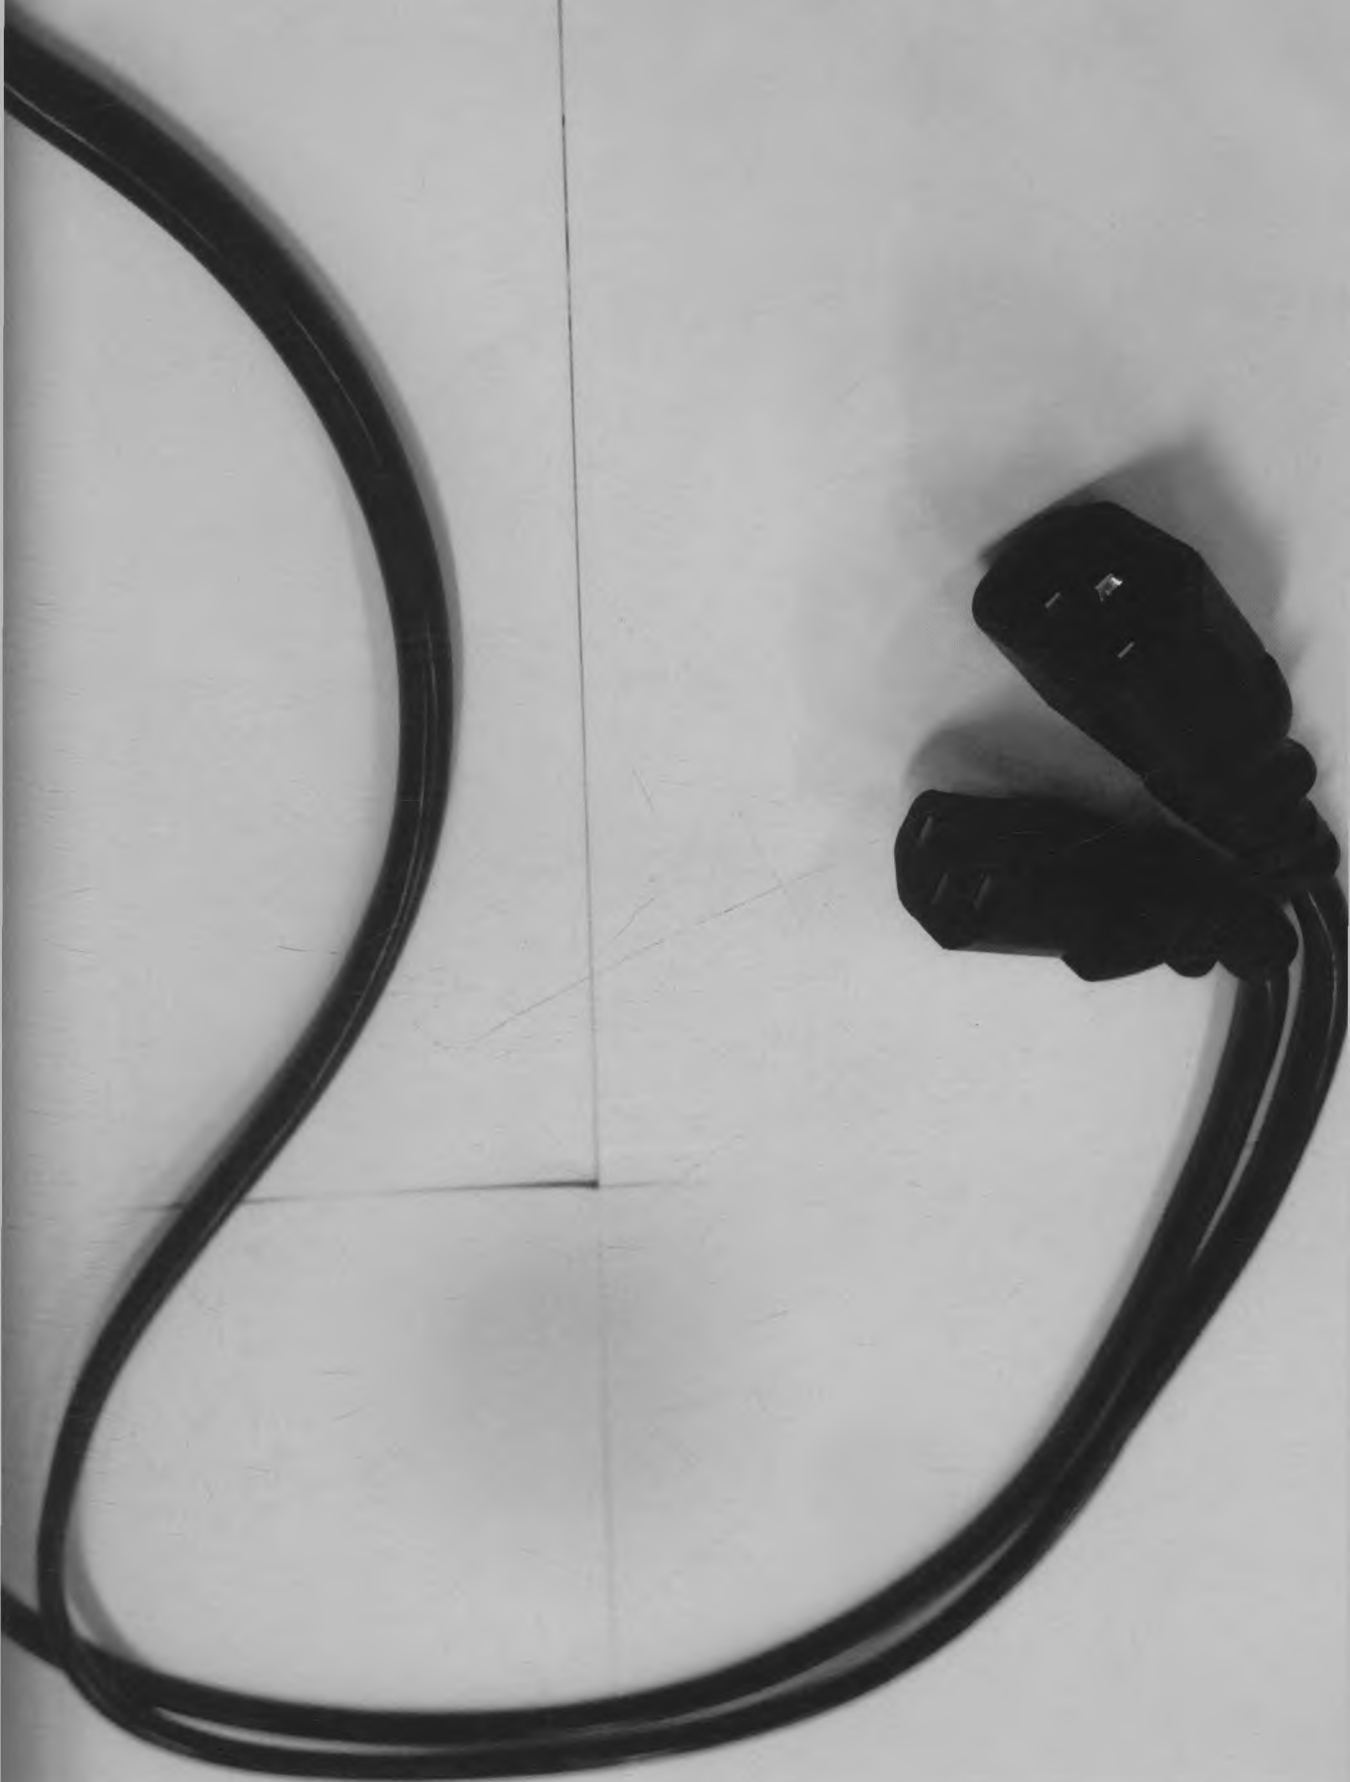

PC 입력

안테나 입력

컴포넌트 입력

- 음성 -

진

Pr

Pb

Y

SERVICE

영상

Dolby Laboratories의 사용허가 아래 제
Dolby ,  은 Dolby Laboratories의 상
TruSurround HD, SRS 와  상
SRS Labs, Inc. 의 등록 상표임

PS BN64-01094C

КАМЕРА
ЛИНЗА



ТРЕНОГА



ДЕРЖАТЕЛЬ БЕДРА



ДЕРЖАТЕЛЬ ГОЛЕНИ





ДЕРЖАТЕЛЬ СТУПНИ



ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕЛА







УСТАНОВОЧНЫЙ ДИСК С ОПЕРАЦИОННОЙ
СИСТЕМОЙ MICROSOFT WINDOWS O/S
INSTALLATION DISK



Robot-assisted
gait training system
Application program

Walkbot_K children

...ING IS BELIEVING

WALKBOT

Copyright © 2012 P&S Mechanics Co., Ltd. All rights reserved. <http://www.walkbot.co.kr>

Robot-assisted
gait training system
Application program

Walkbot_S Adult

...ING IS BELIEVING

WALKBOT

Copyright © 2012 P&S Mechanics Co., Ltd. All rights reserved. <http://www.walkbot.co.kr>



RIDING IS BELIEVING

Robot-Assisted Gait Training System USER MANUAL

Walkbot_K Children



RIDING IS BELIEVING

Robot-Assisted Gait Training System USER MANUAL

Walkbot_S Adult



Троку меровано, прошеето
скреплено печатом
64 листа (шестдесет и чети
рета)

Генерални директор
ООО „ФЛОГИСТОН-МЕР“

С. П. Сердюков

