




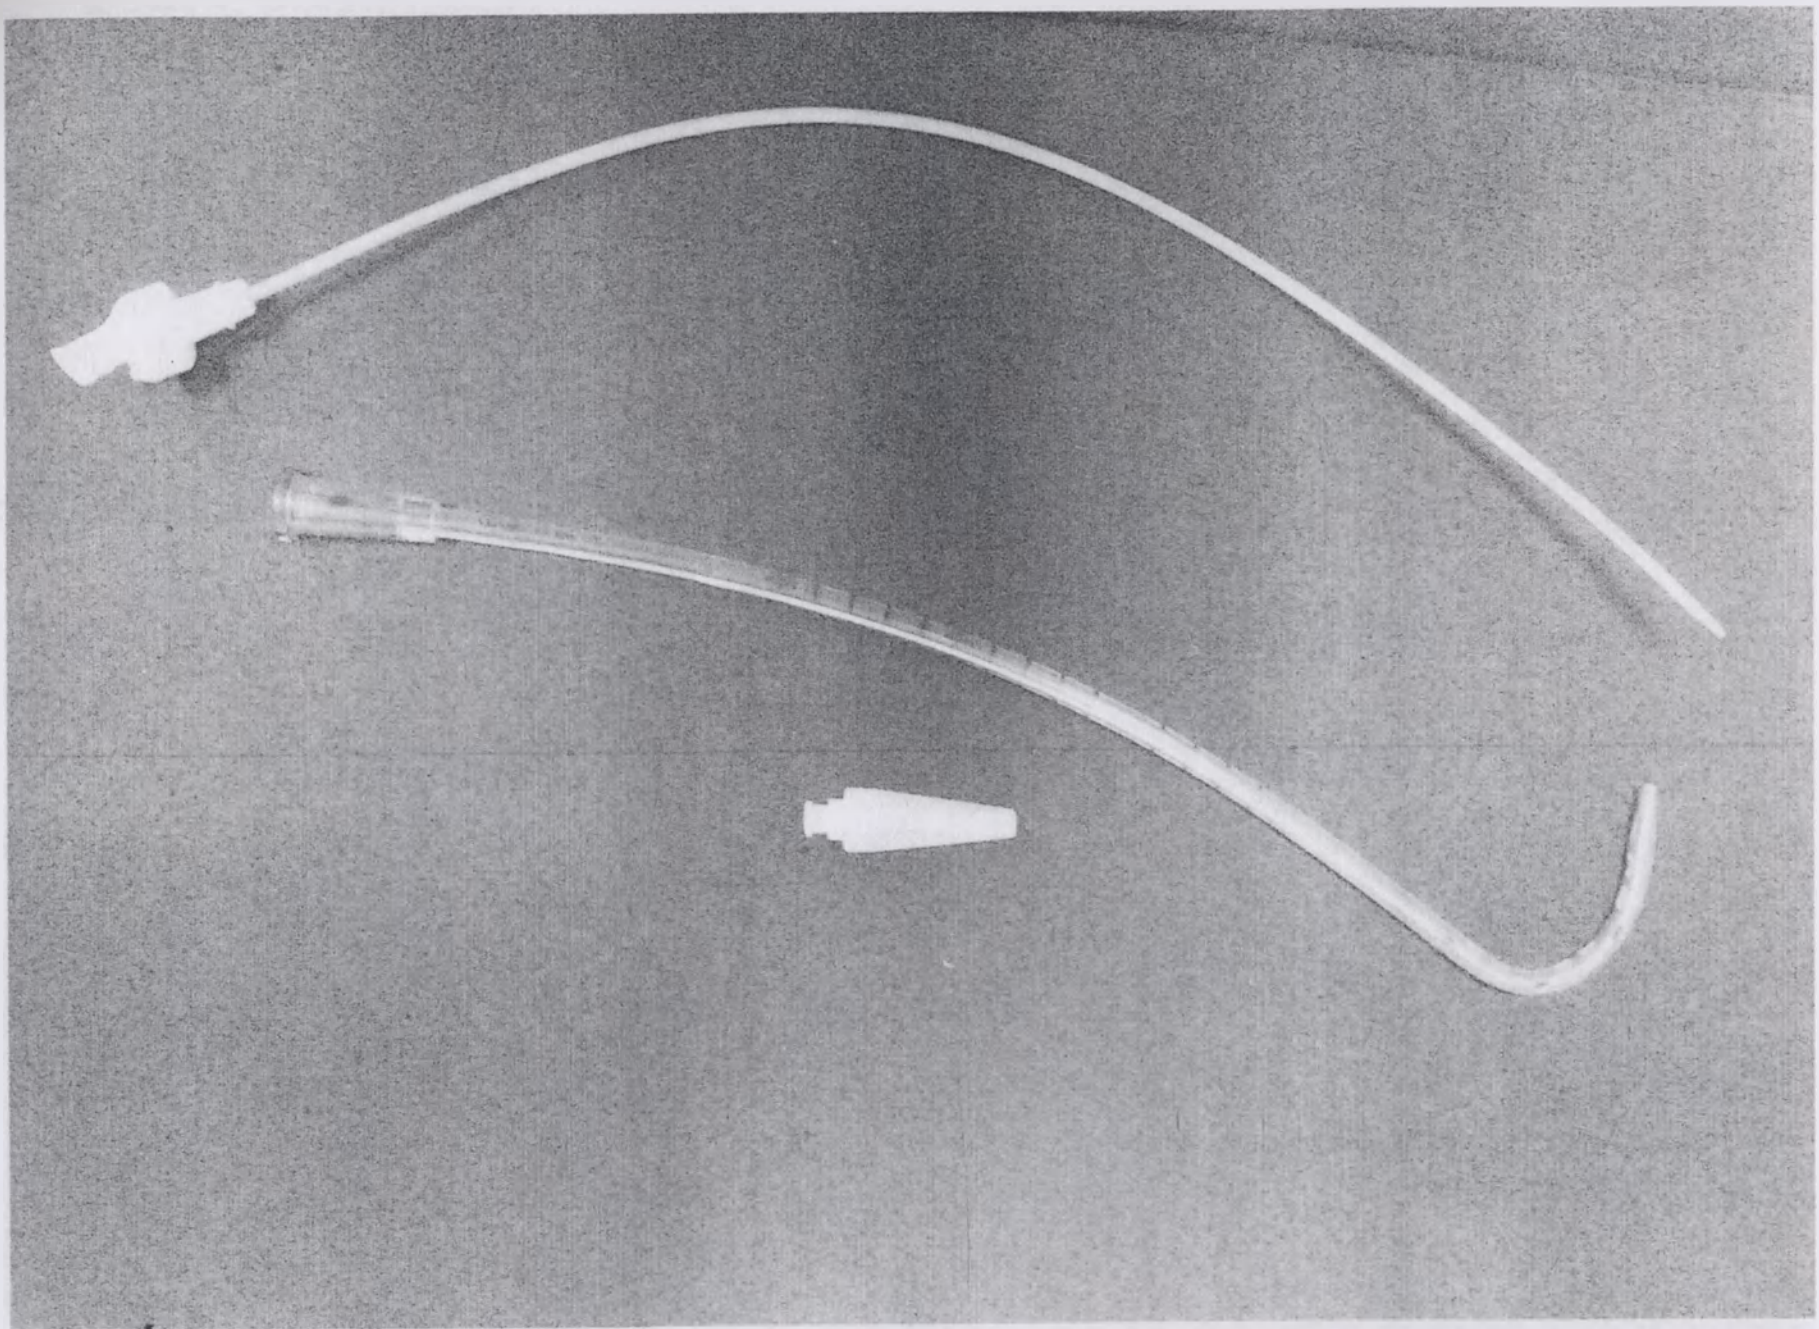


ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Адаптер для дренирования плевральных полостей: TQT-14.0-41 с адаптером, 1 шт.; obturatorом, 1 шт.

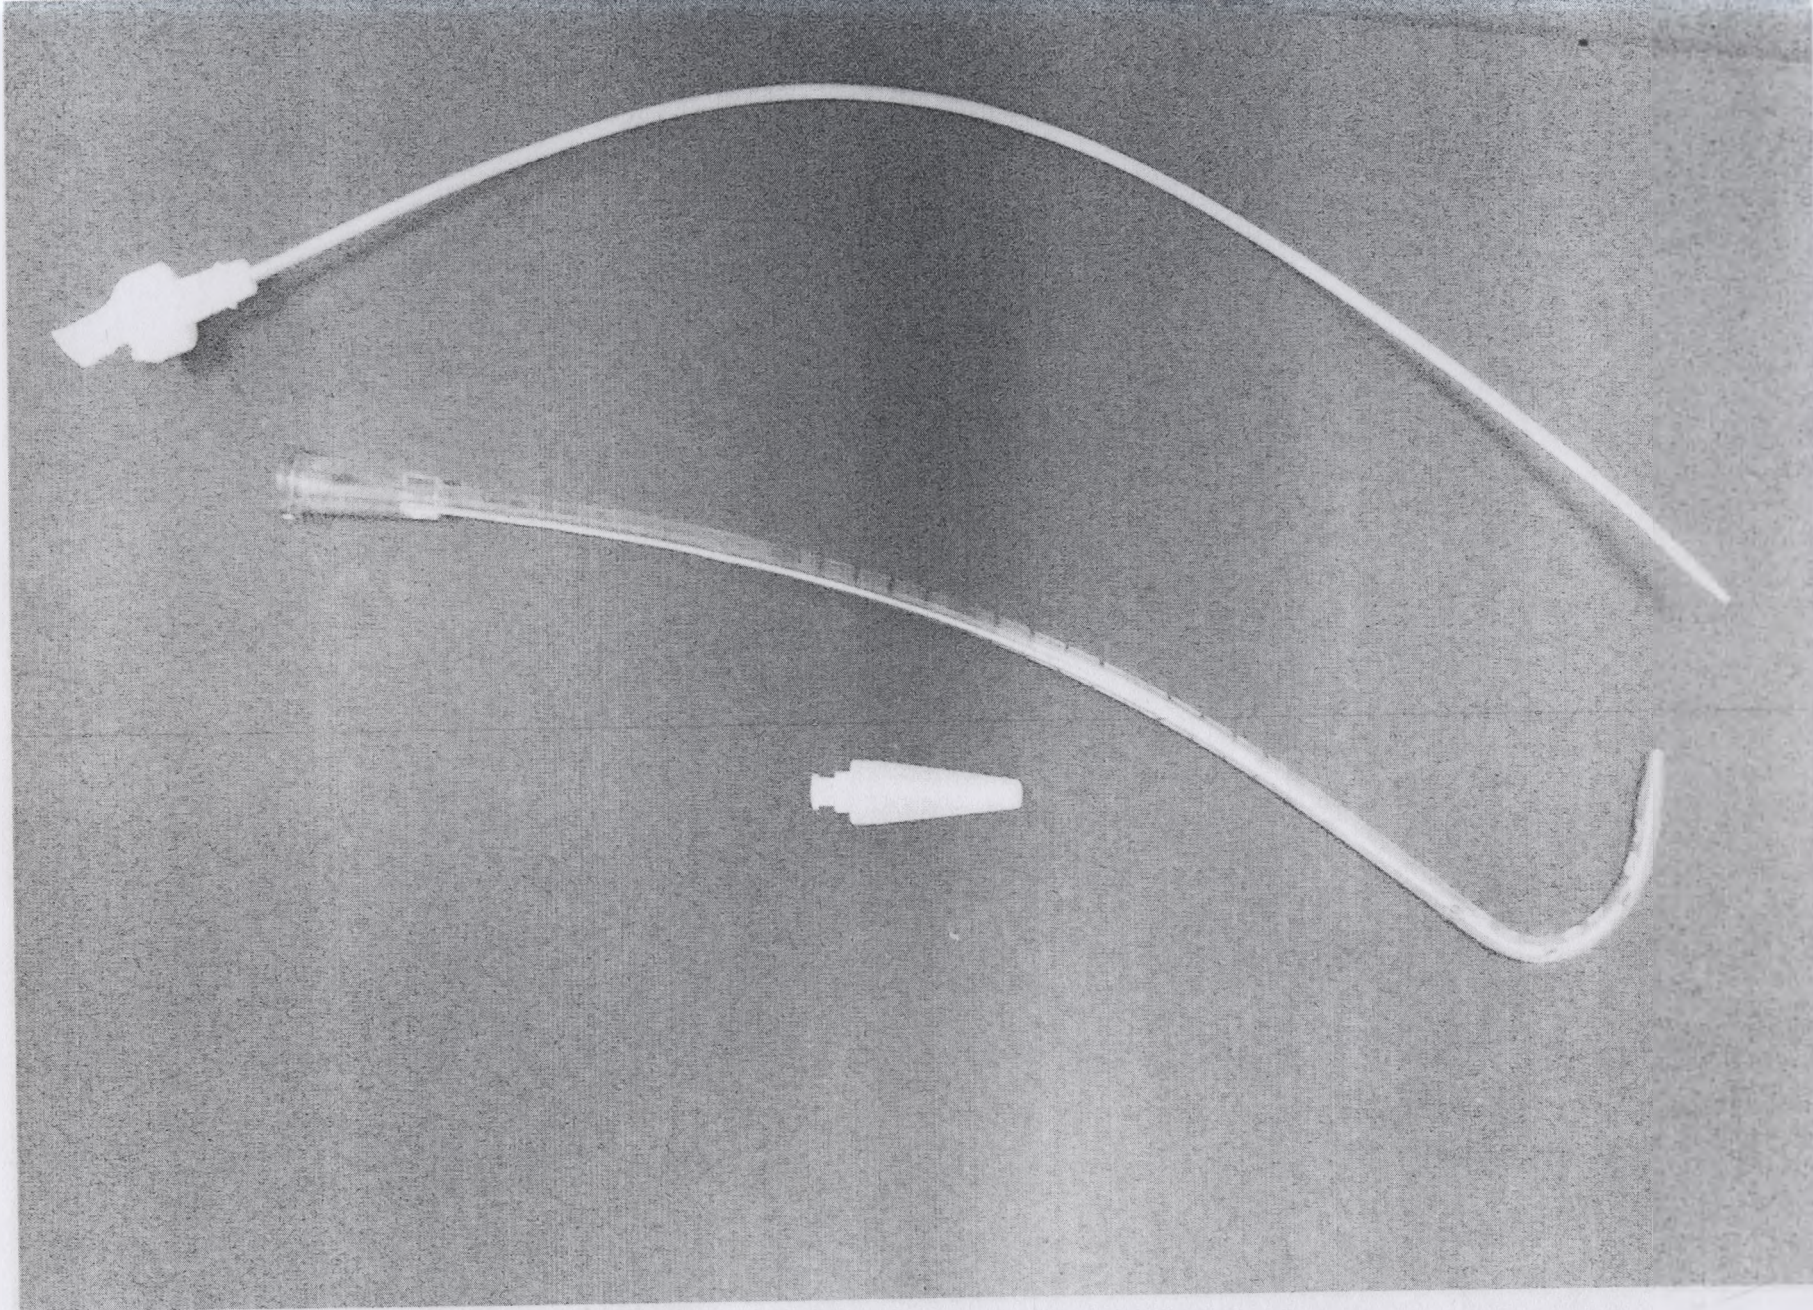


Катетеры для чрескожного дренирования плевральных полостей: TQT-16.0-41 с адаптером, 1 шт.; обтуратором, 1 шт.

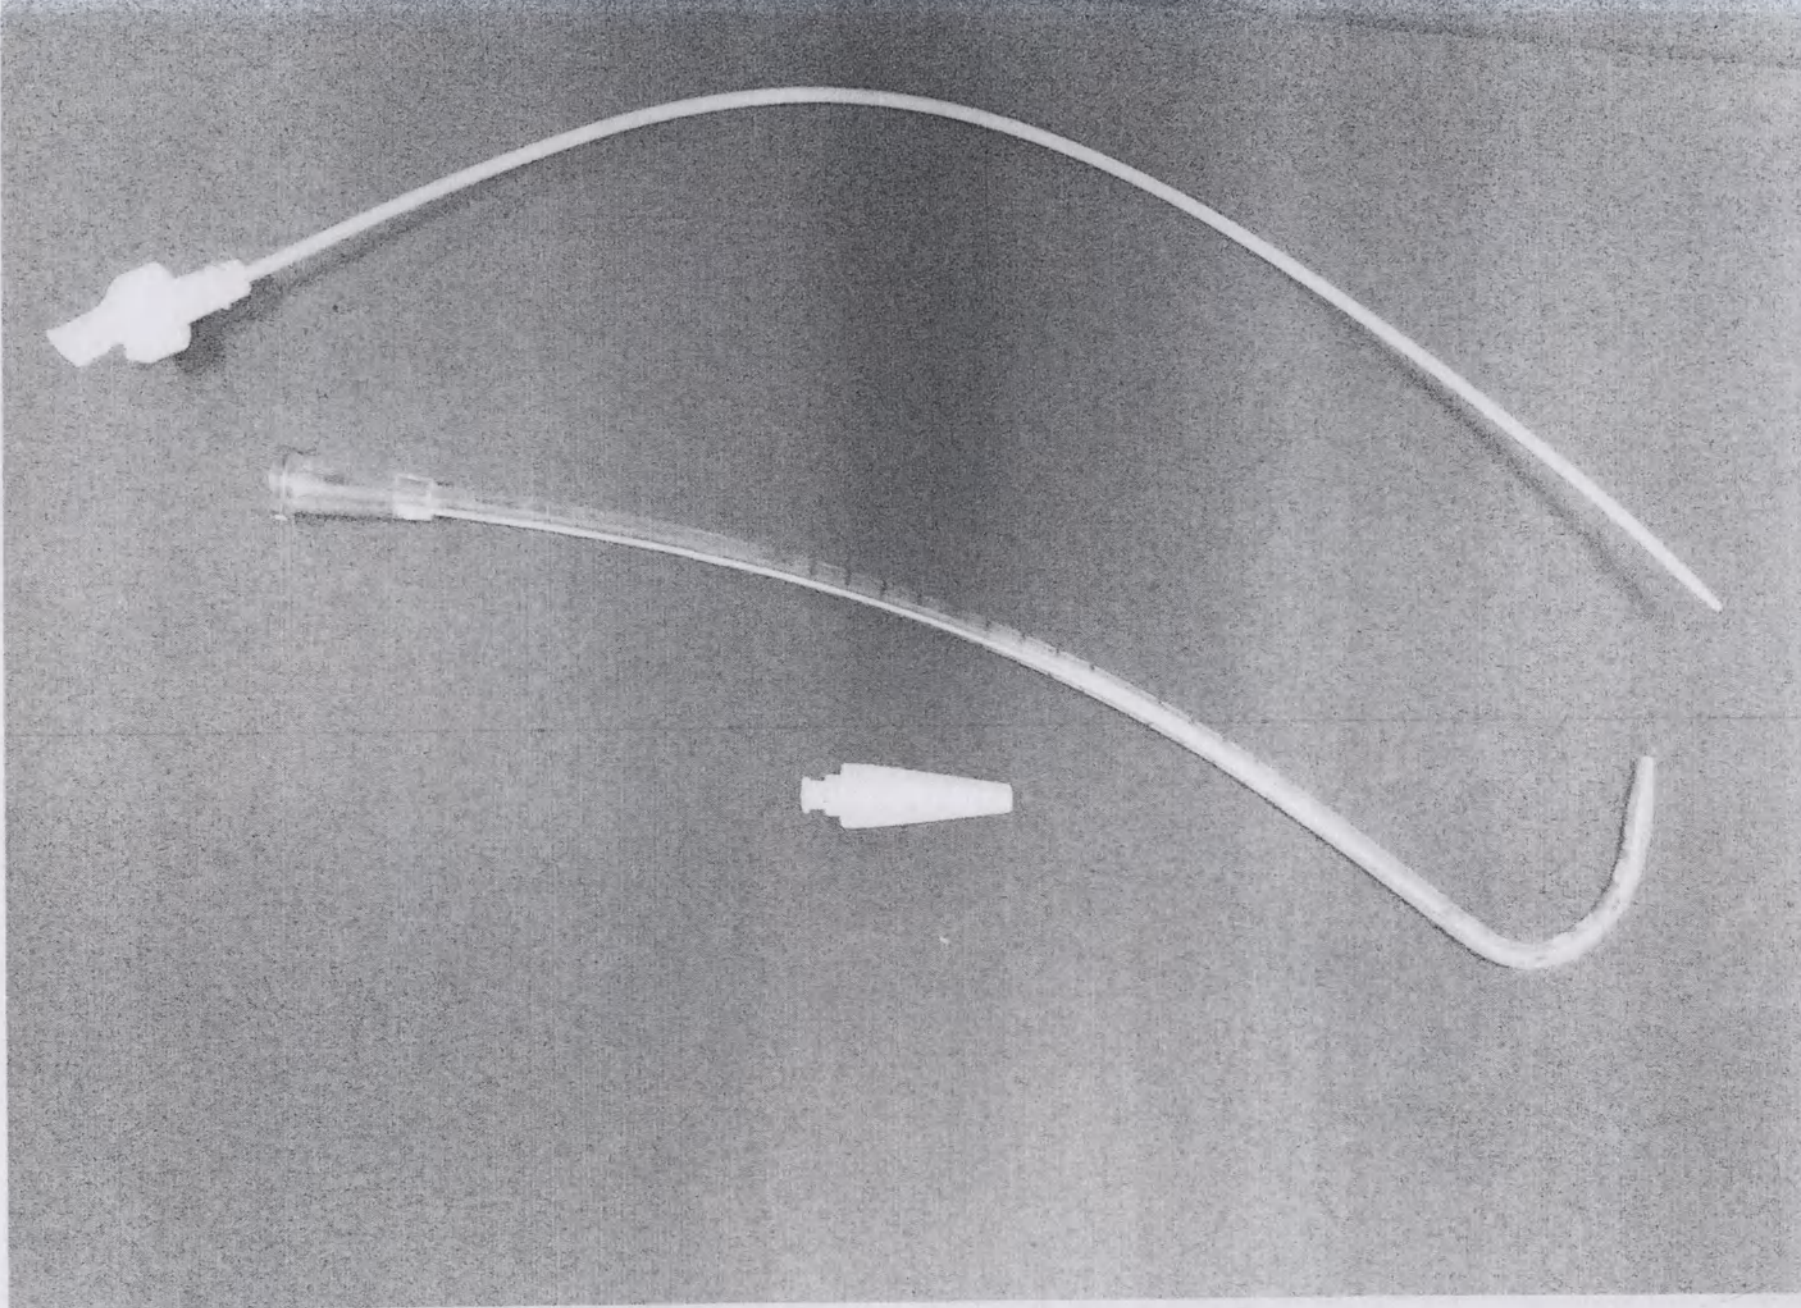


Катетеры для чрескожного дренирования плевральных полостей: TQT-18.0-41 с адаптером, 1 шт.; обтуратором, 1 шт.

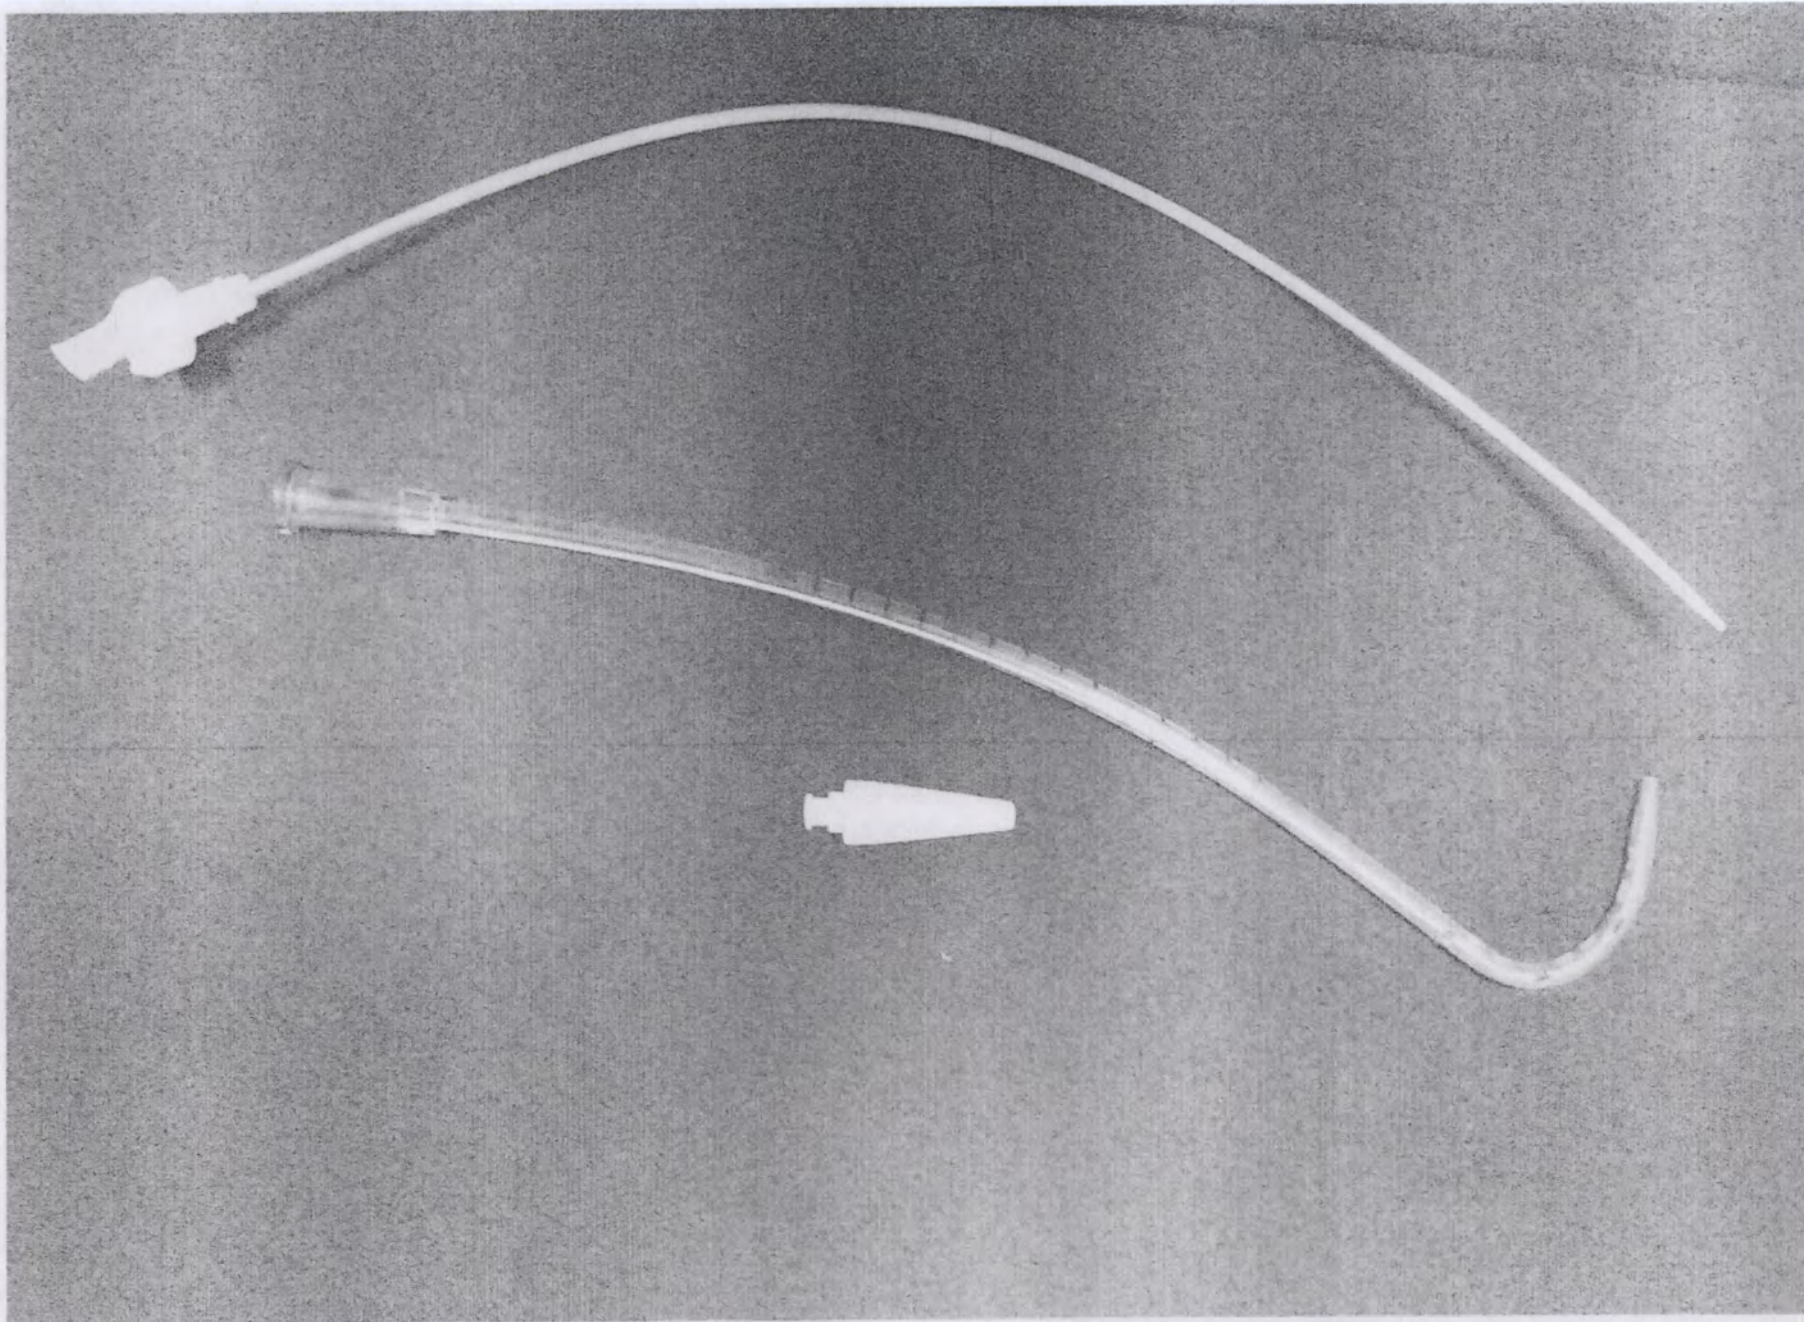


Катетеры для чрескожного дренирования плевральных полостей: TQT-24.0-41 с адаптером, 1 шт.; обтуратором, 1 шт.

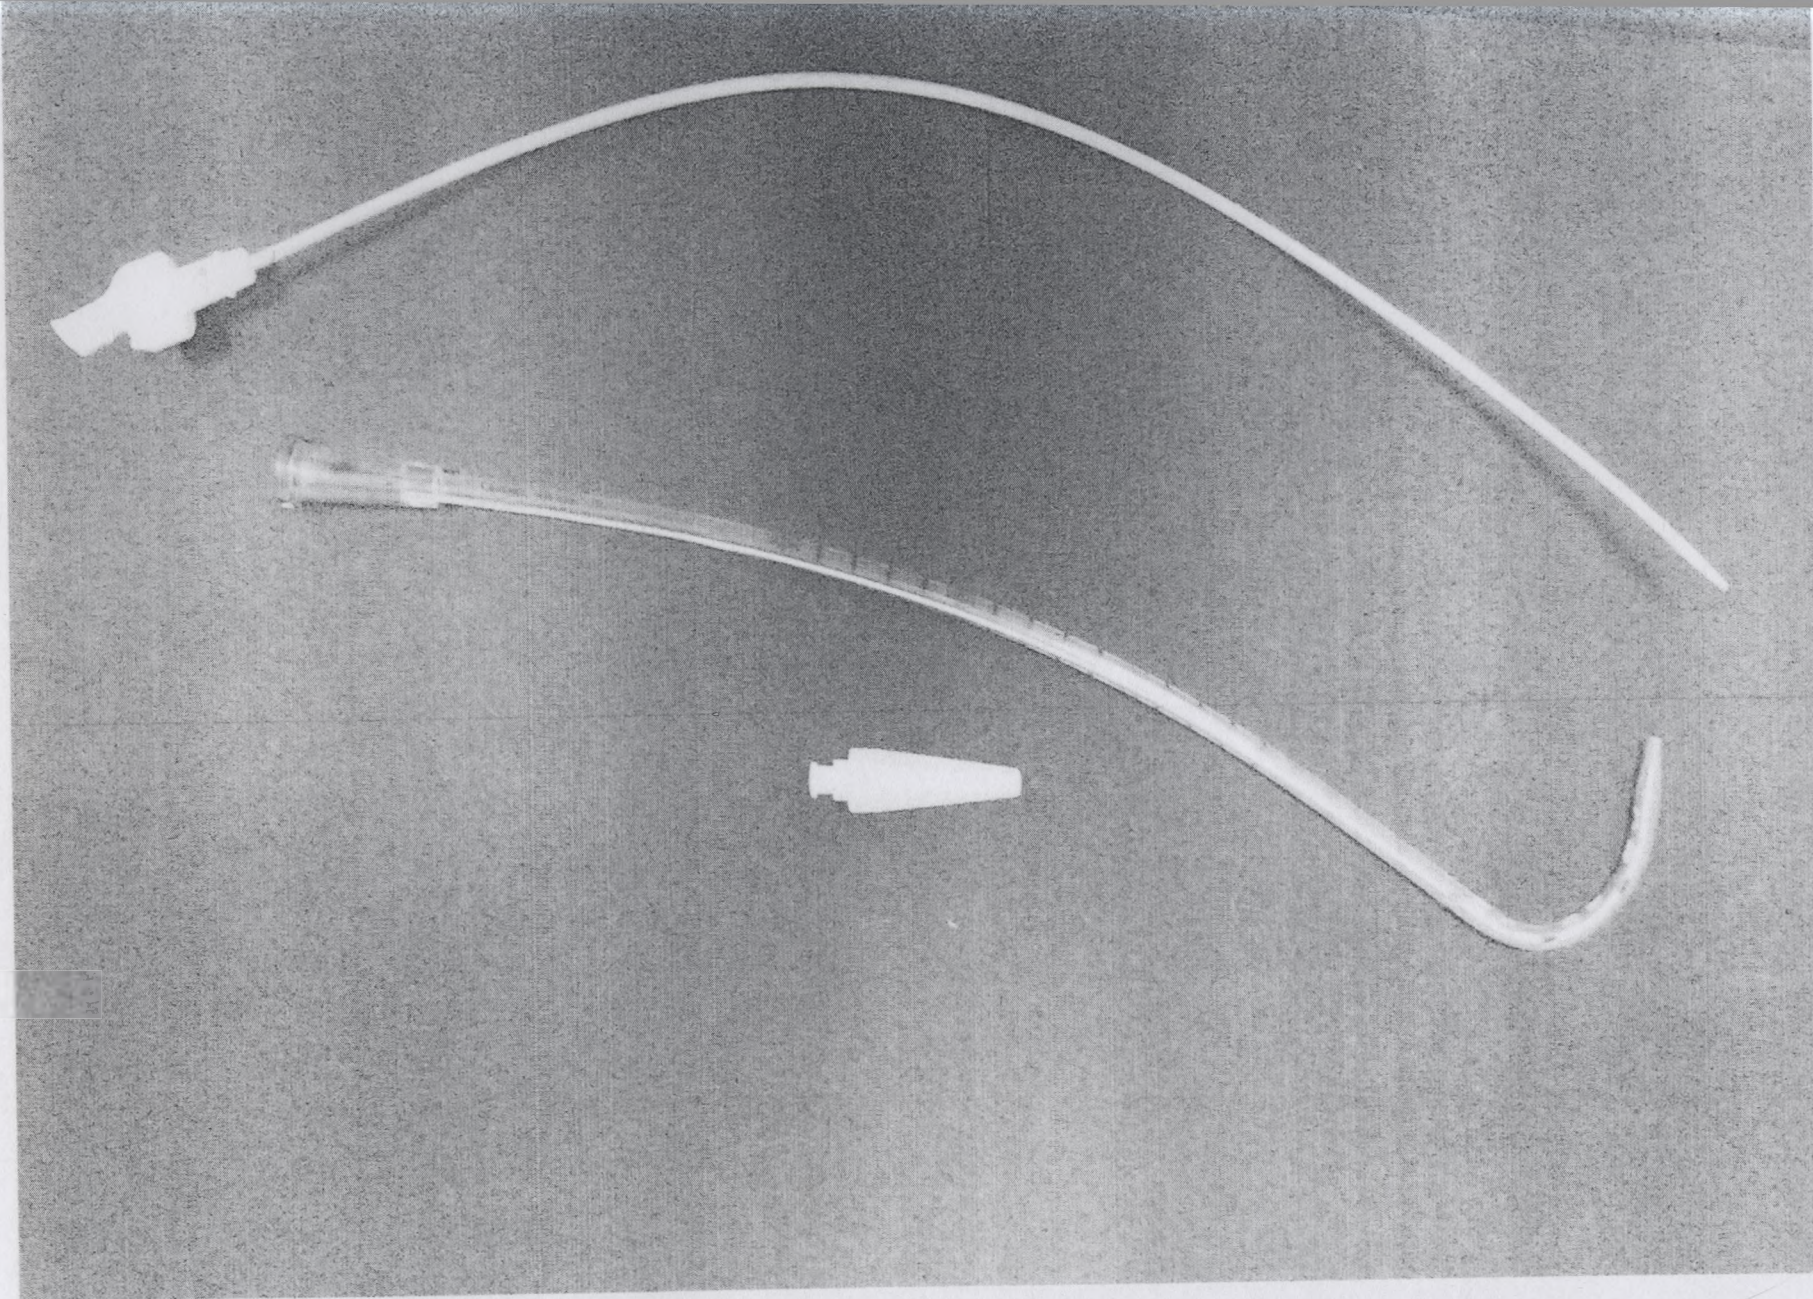

Катетеры для чрескожного дренирования плевральных полостей: TQT-28.0-41 с адаптером, 1 шт.; обтуратором, 1 шт.

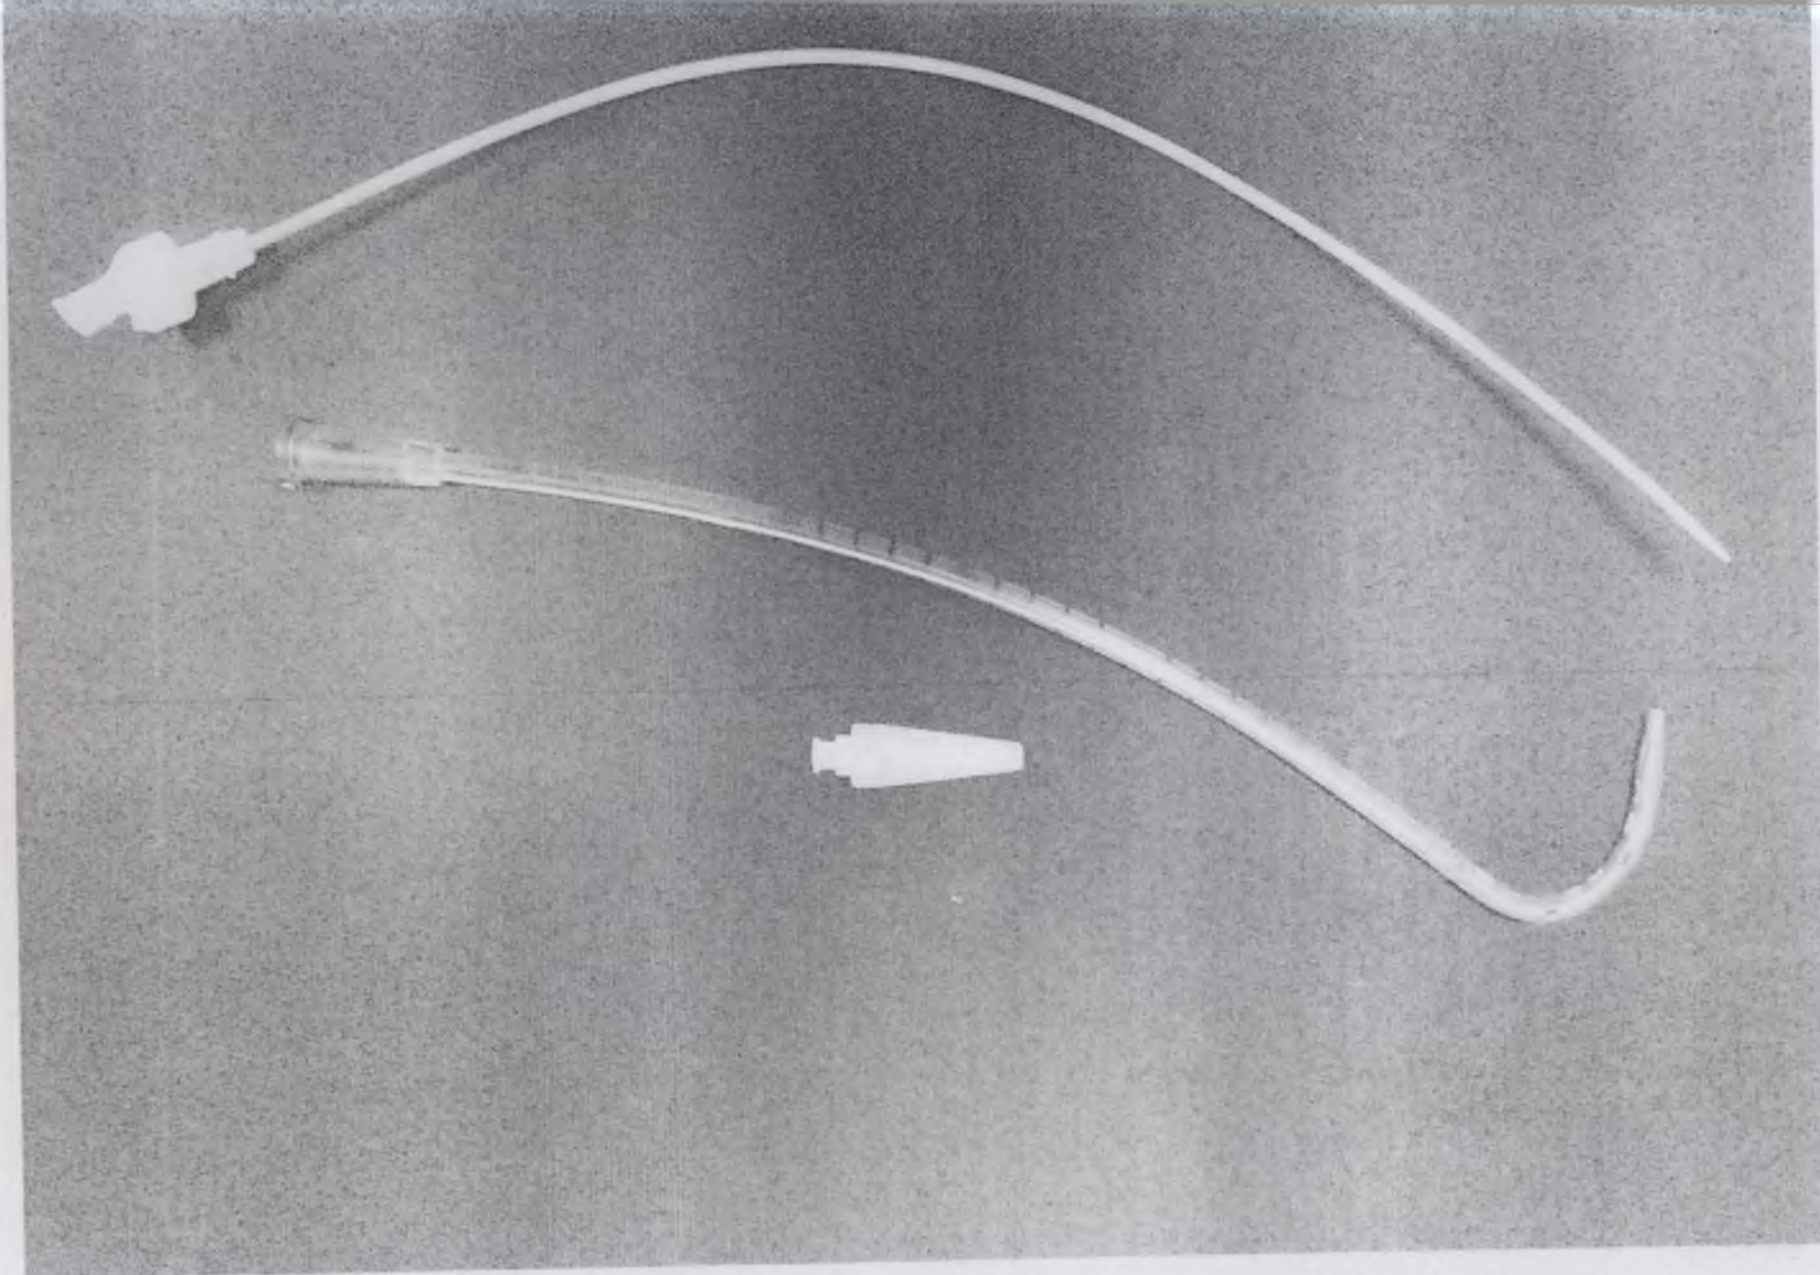

Катетеры для чрескожного дренирования плевральных полостей: TQT-32.0-41 с адаптером, 1 шт.; obturatorом, 1 шт.

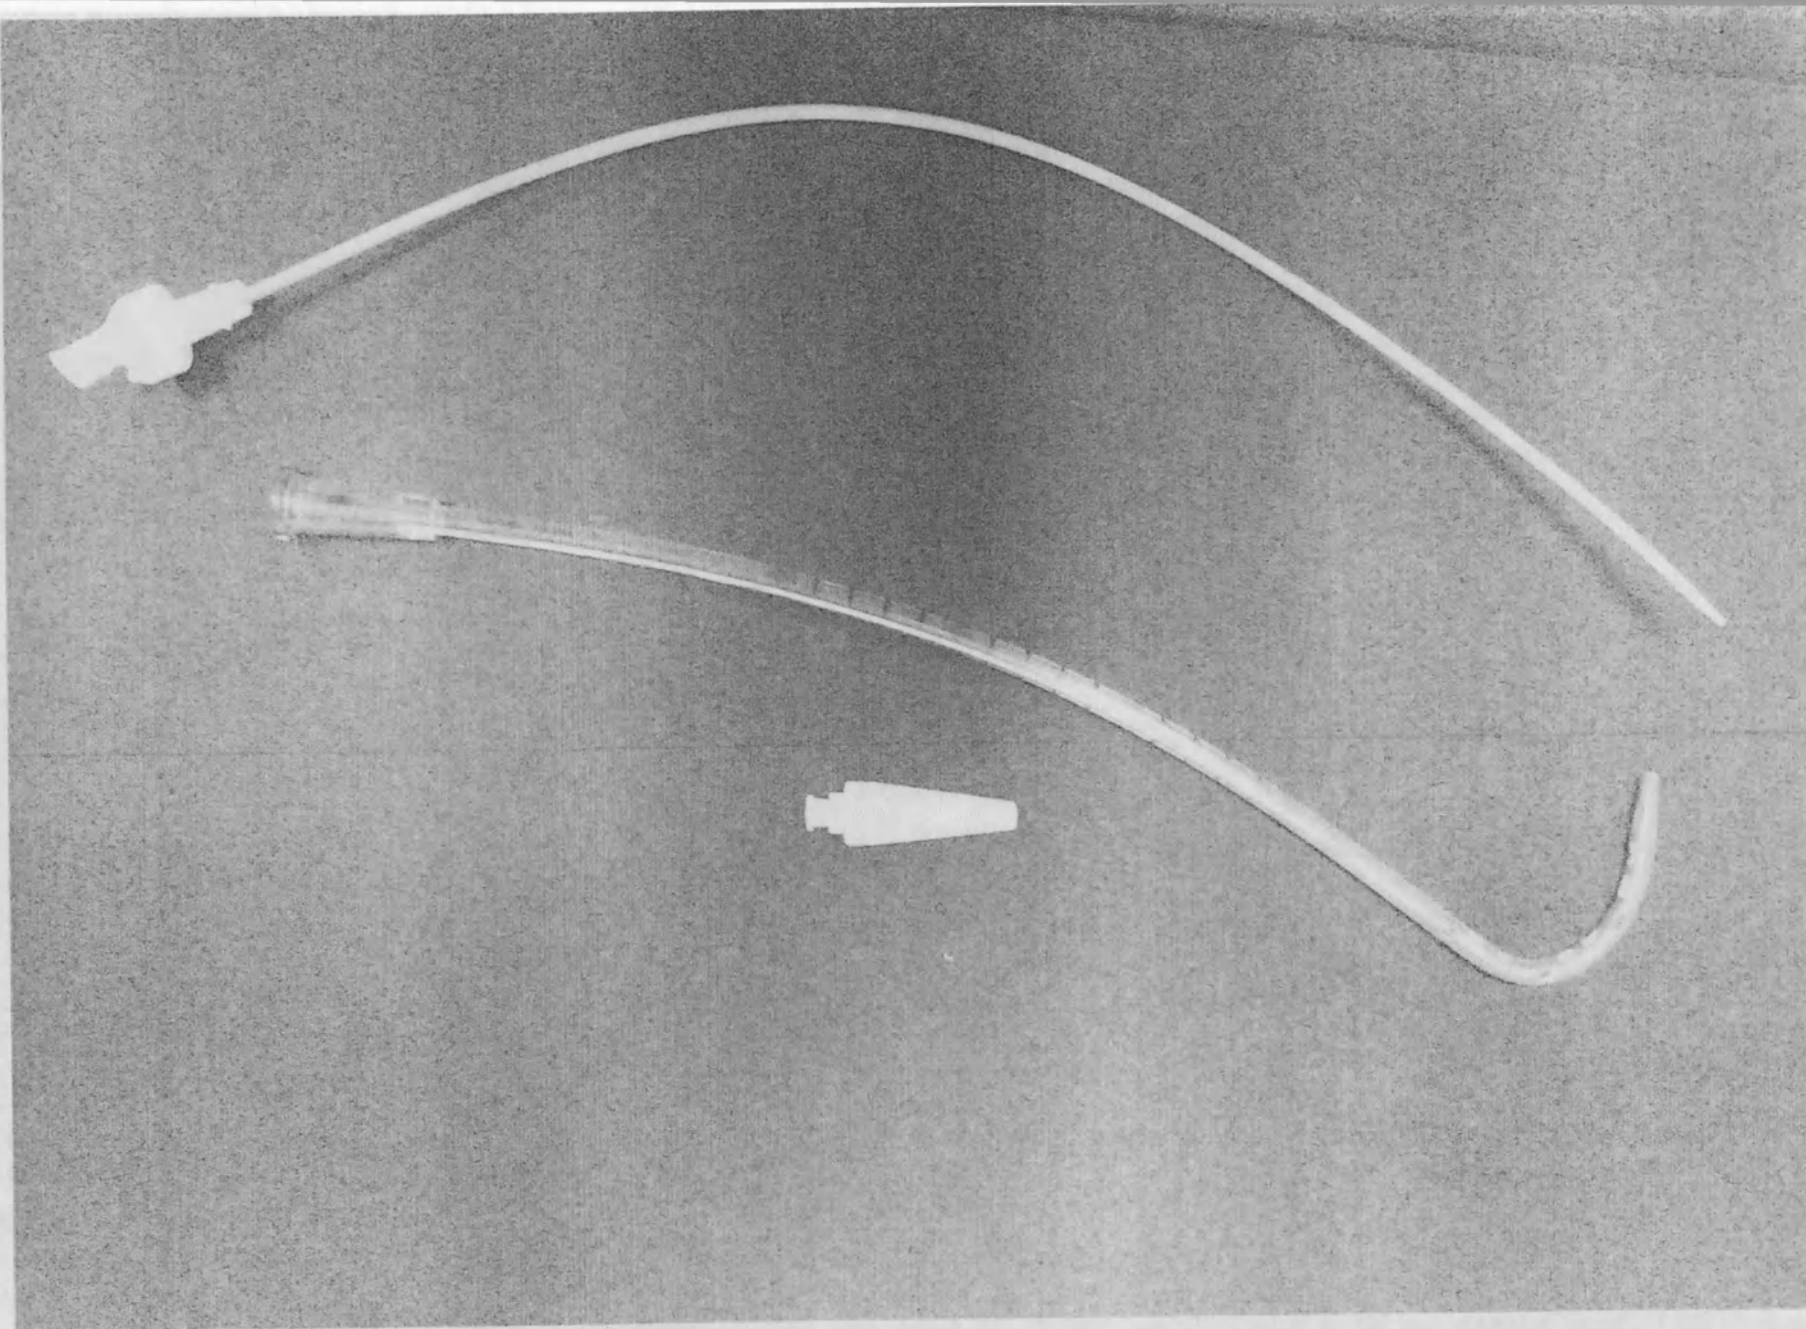

Катетеры для чрескожного дренирования плевральных полостей: TQT-36.0-41 с адаптером, 1 шт.; обтуратором, 1 шт.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 лист(ов)

Генеральный директор ЗАО

"ШАГ"

С.Н. Курин

С.Н.Курин

