


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


Система рентгенографическая медицинская FlexiDiagnost с принадлежностями

Система рентгенографическая медицинская FlexiDiagnost в составе


1. Кронштейн с блоком рентгеновской трубки SRO 33100 ROT 360 / RO 1750 ROT 360.

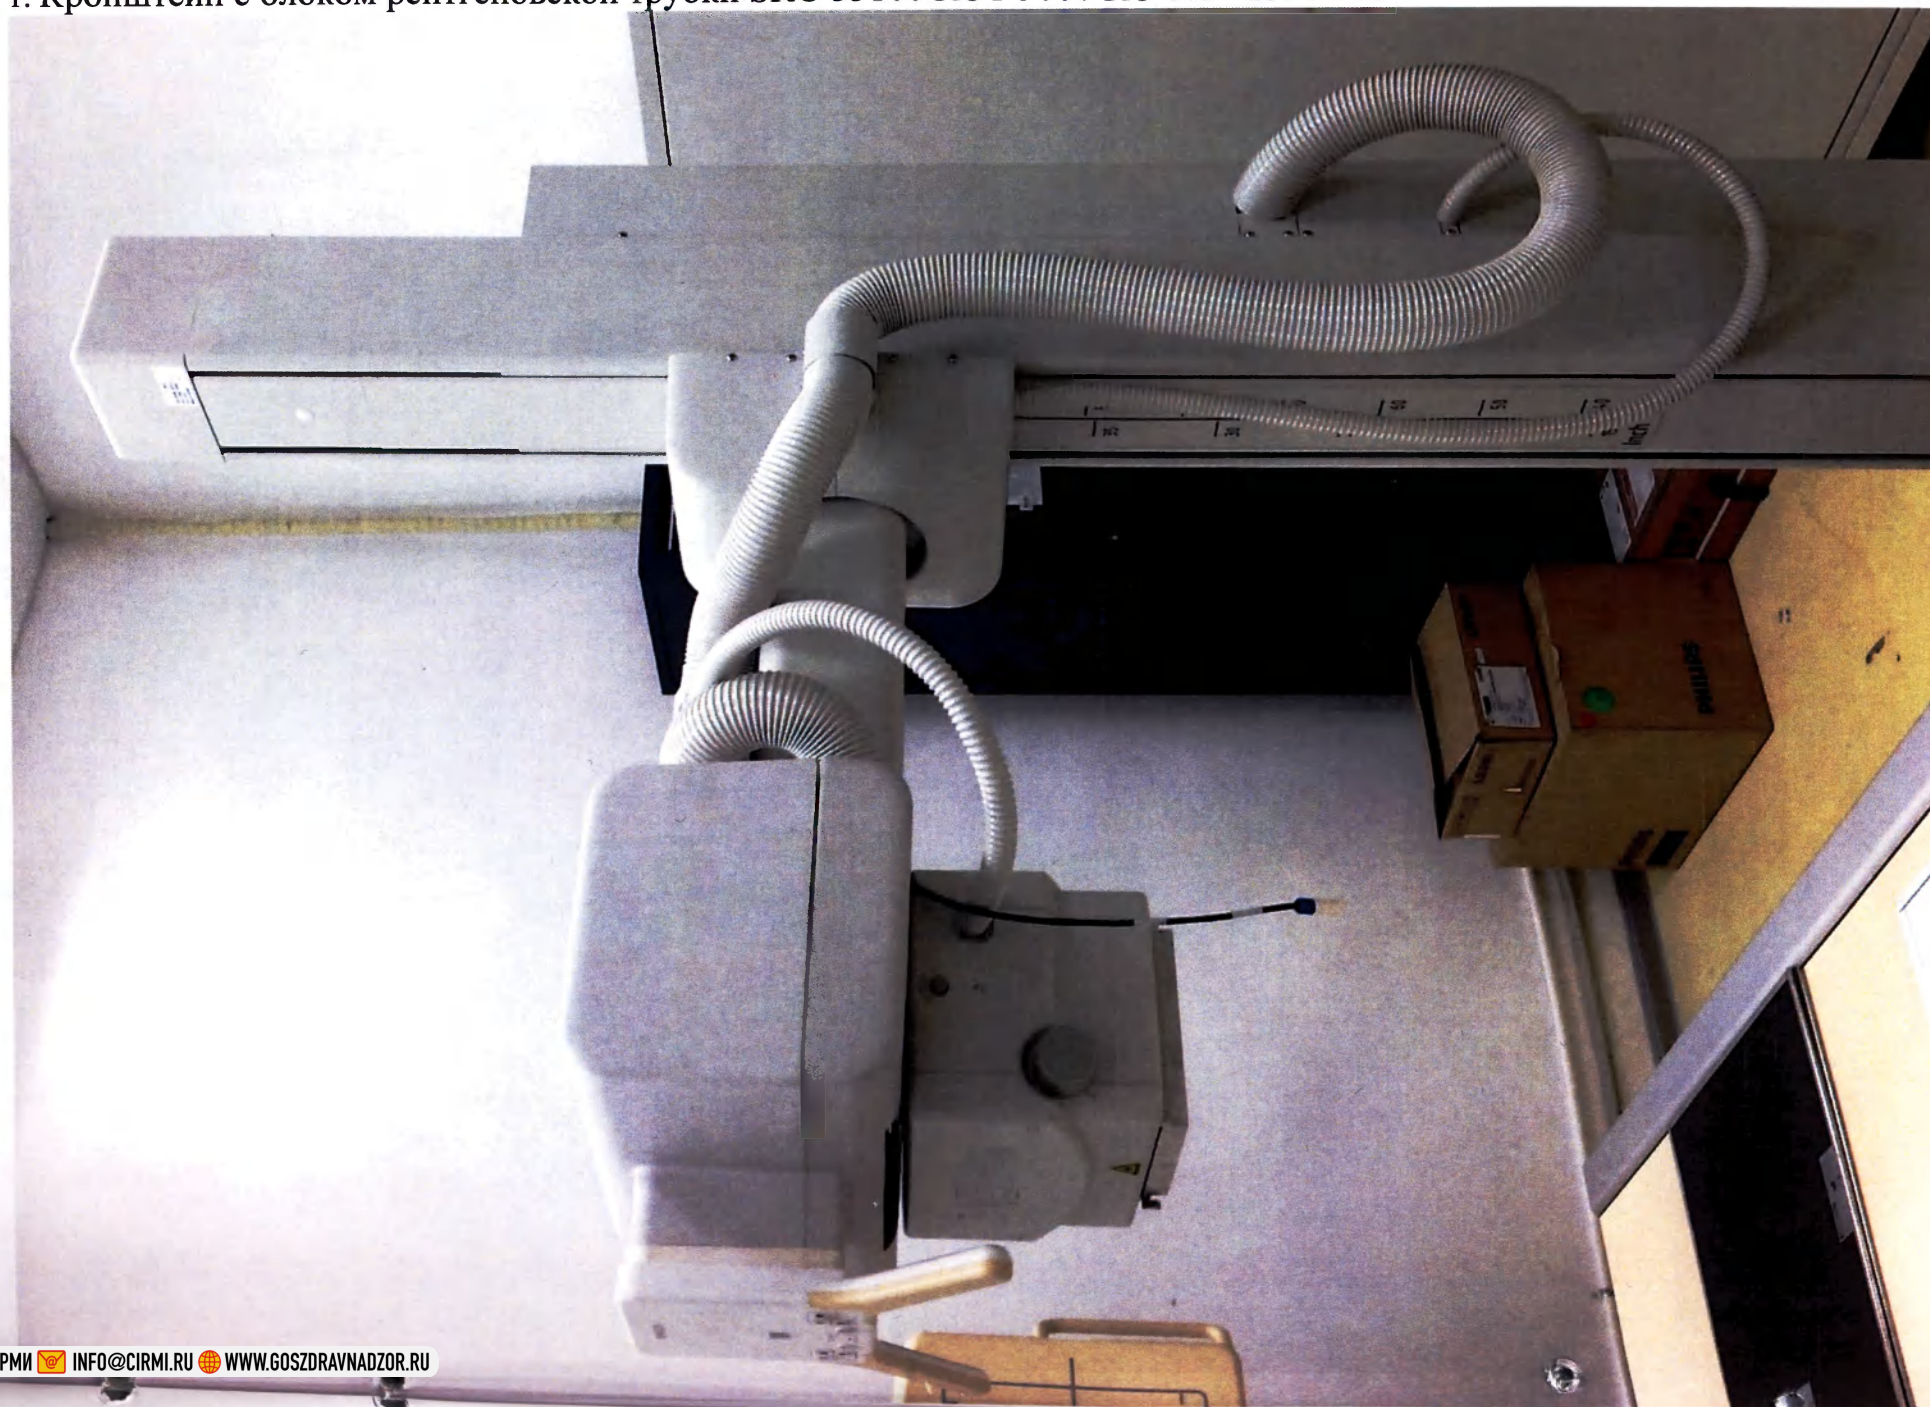


2. Стойка с опорой детектора.

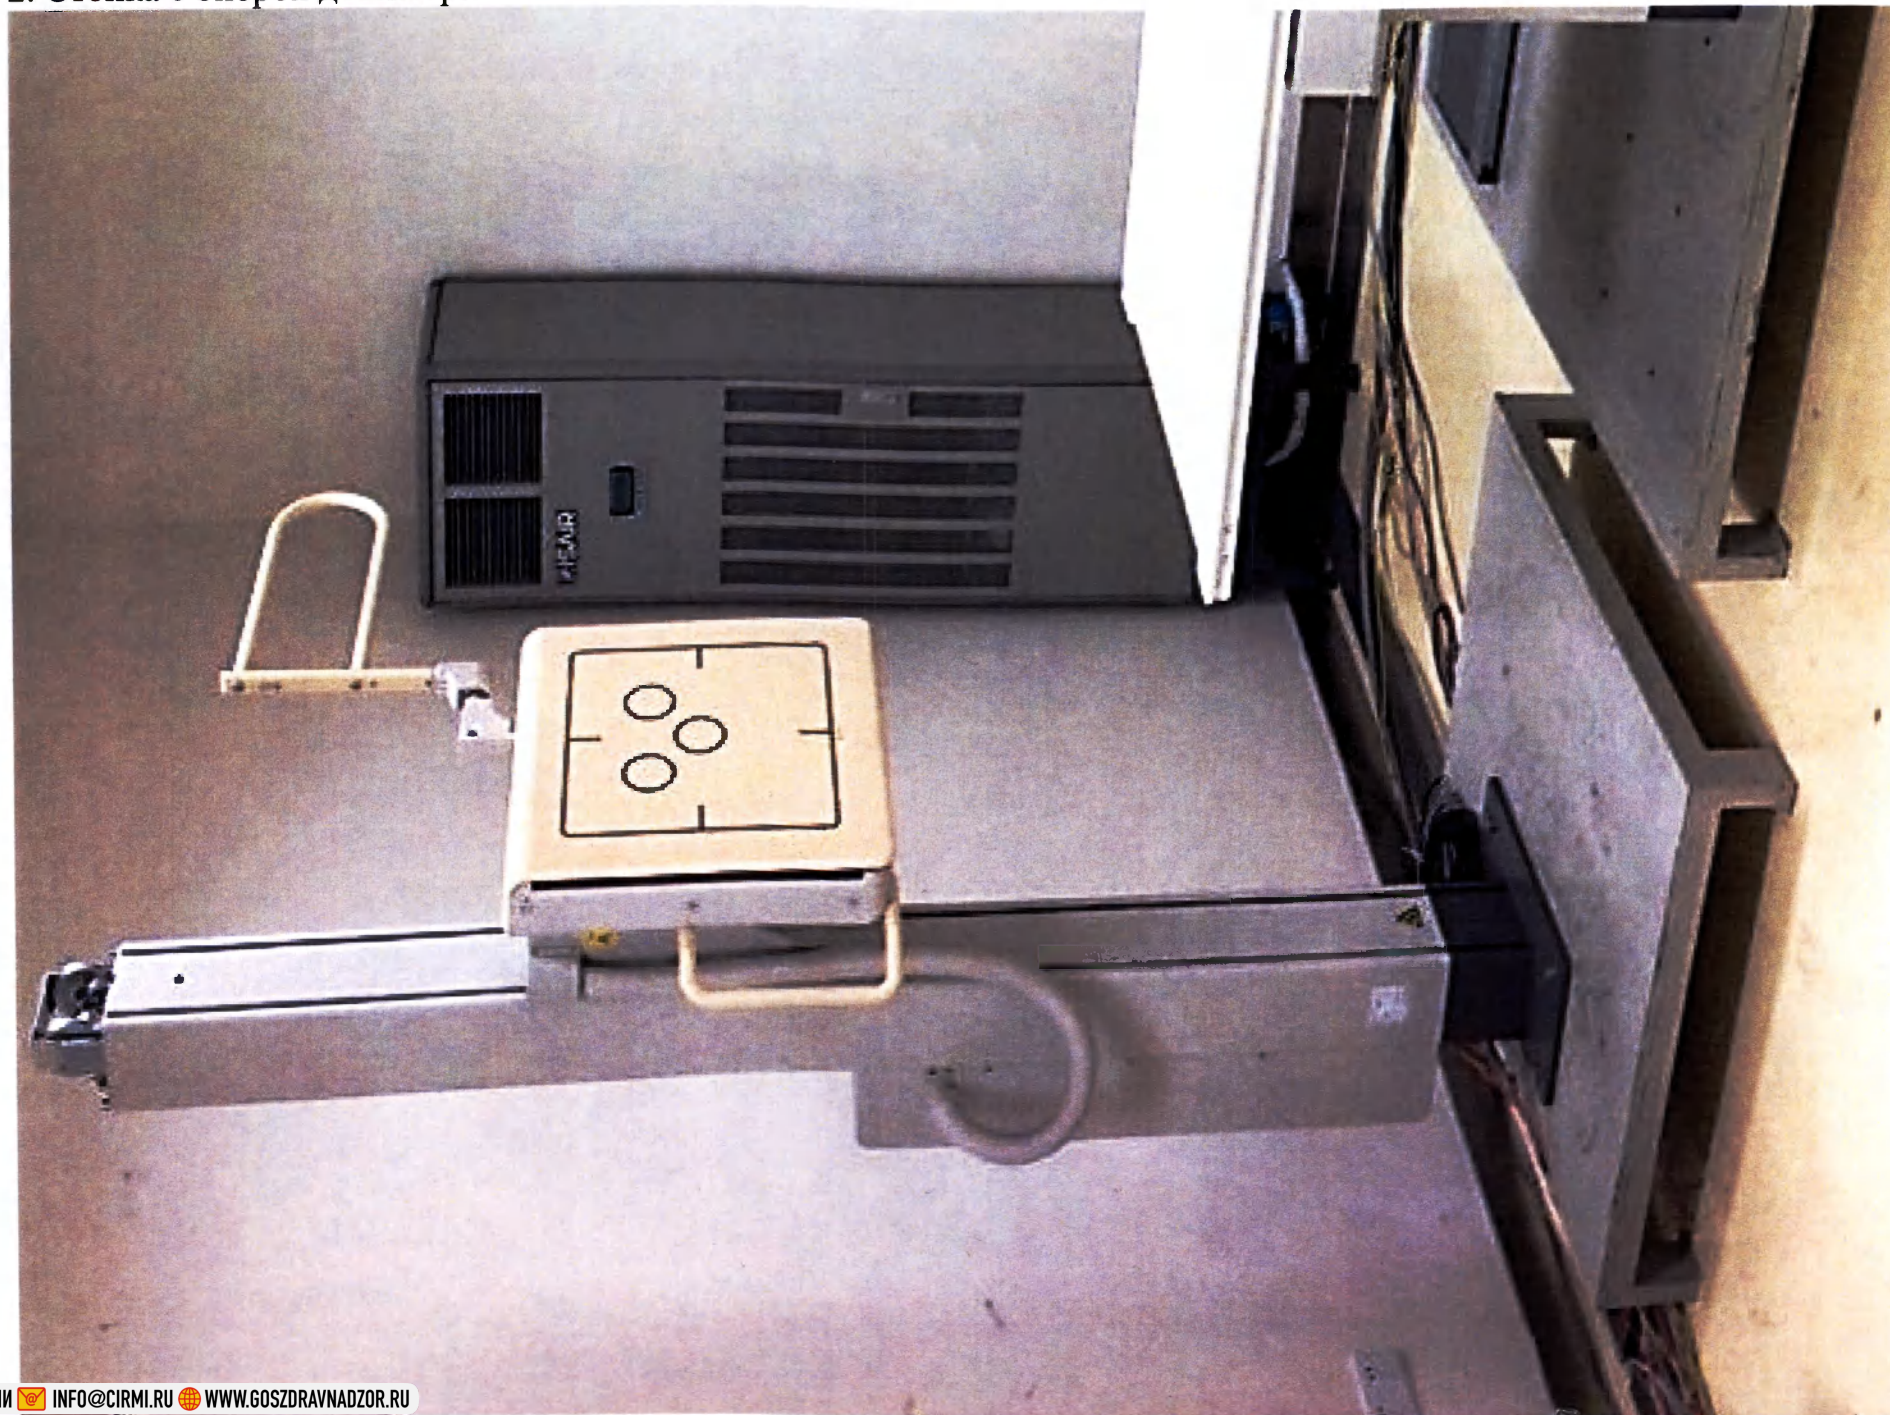

3. Стол пациента.

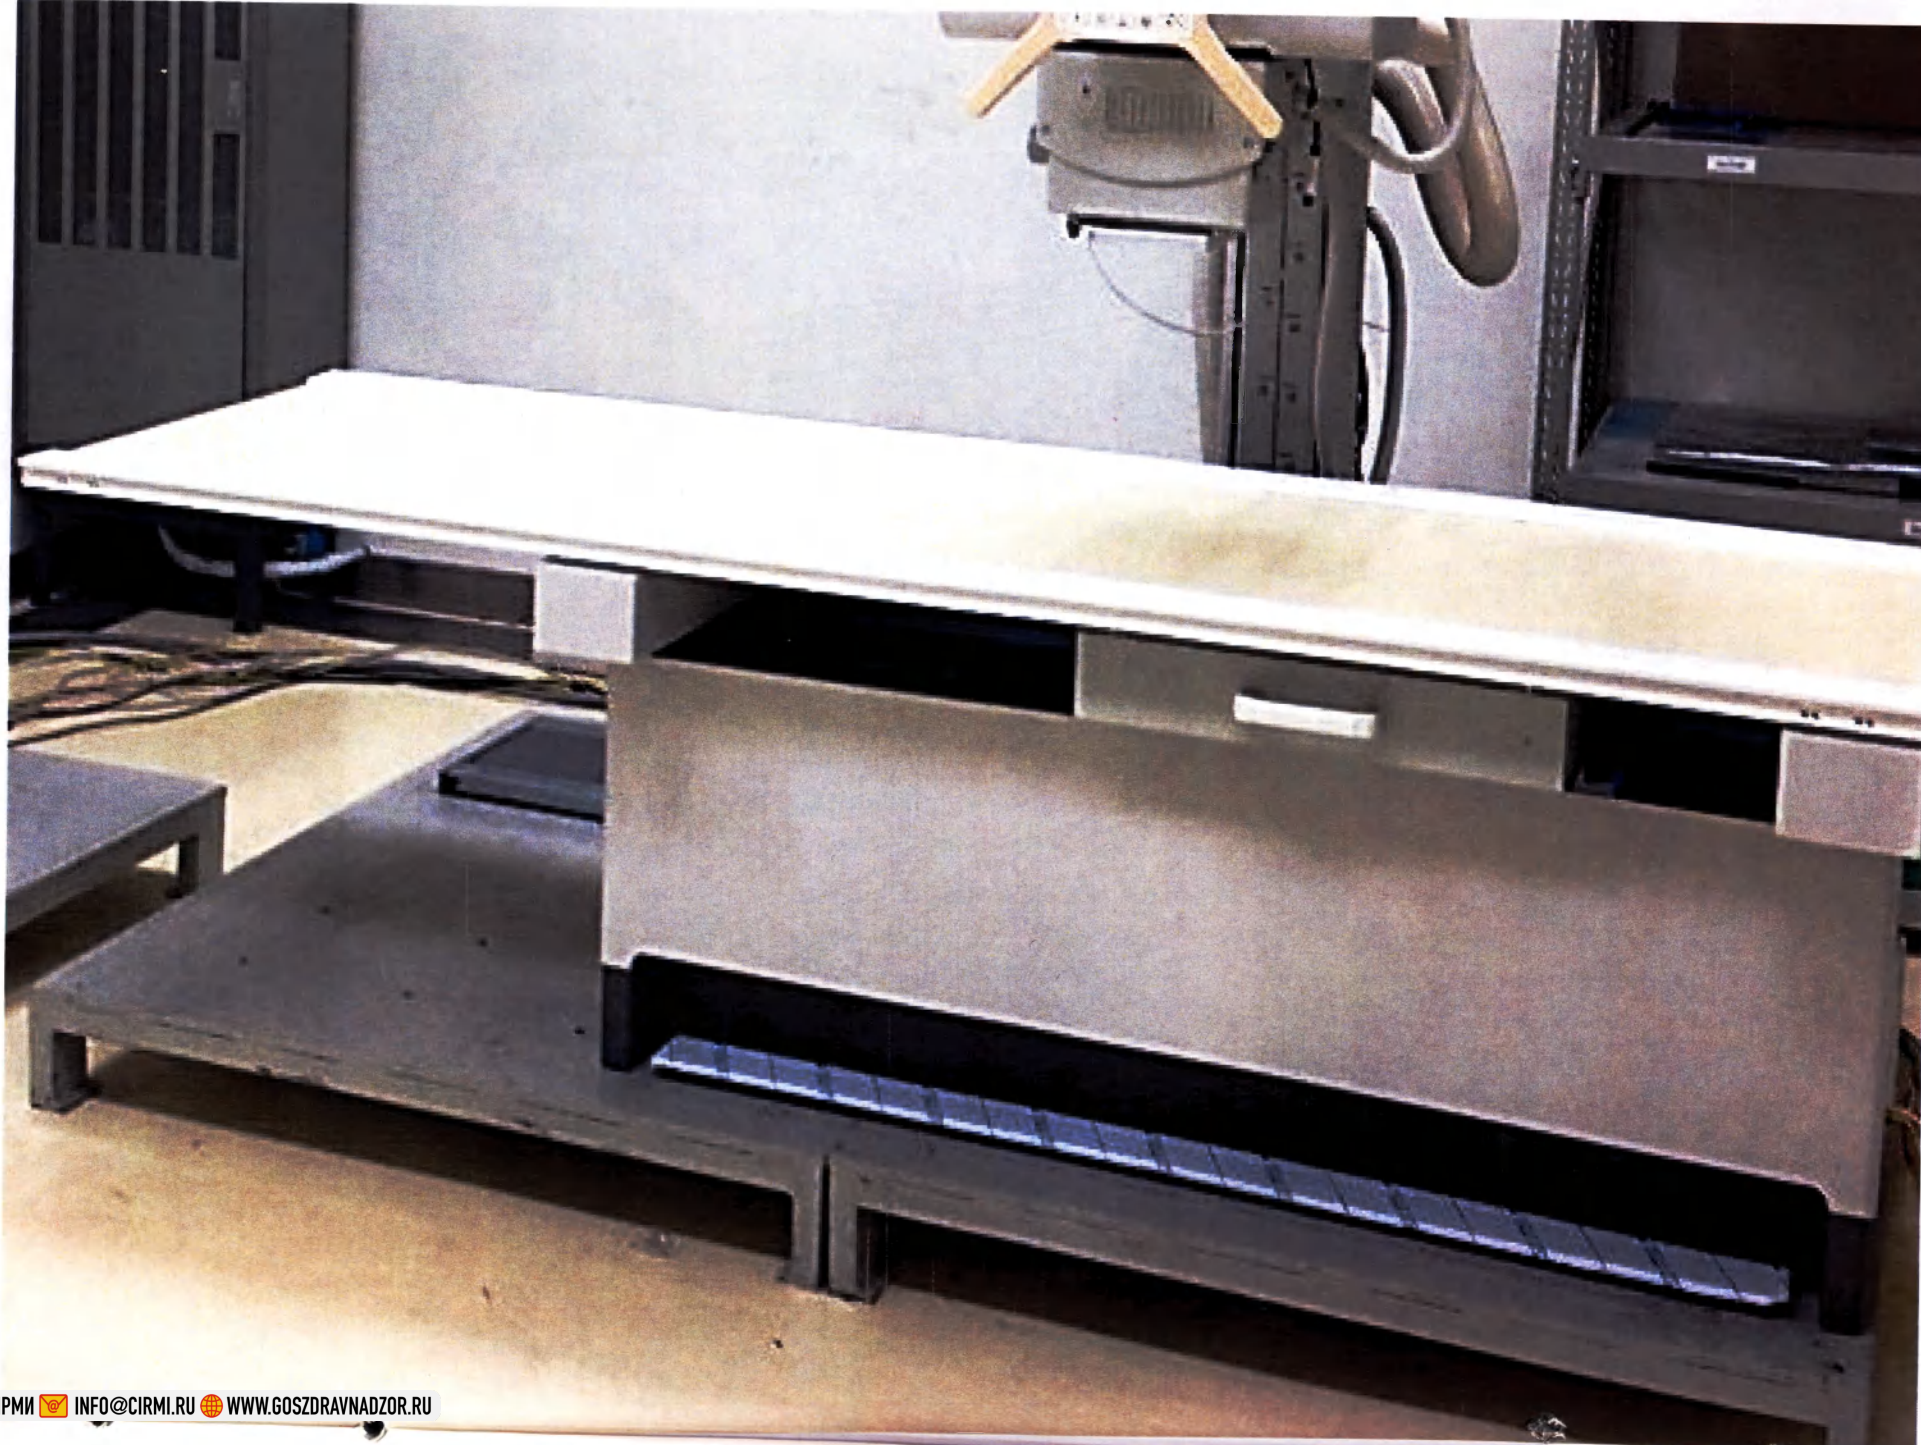

4. Генератор M-Cabinet CXA 50/65/80 кВт.

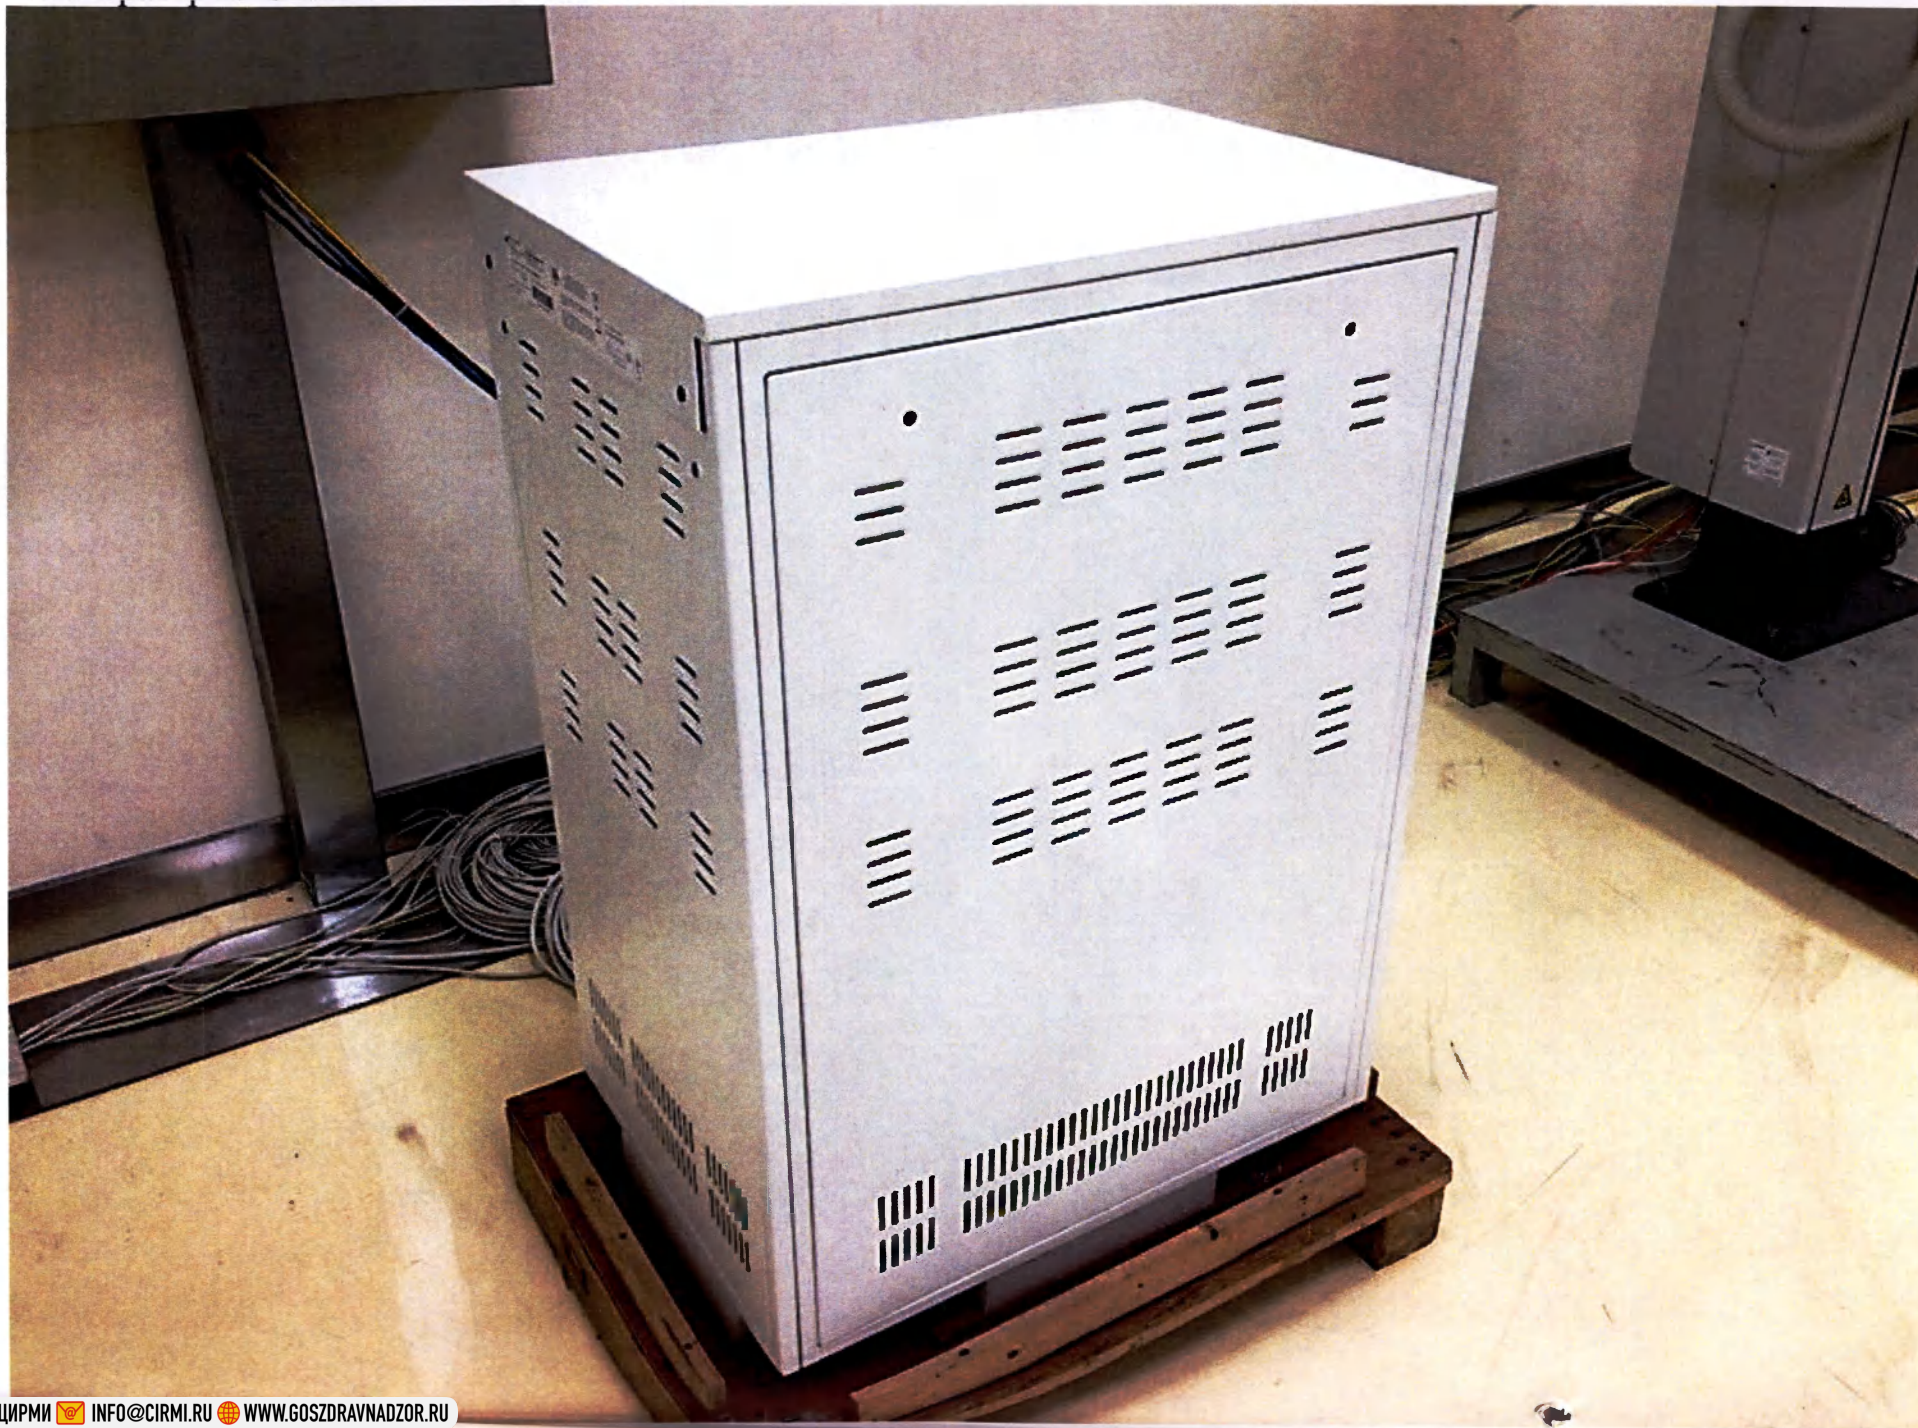

5. Рабочая станция Eleva Workspot.



5.1.Экран сенсорный;




5.2. Клавиатура;



5.3. Мышь;



5.4. Блок системный;

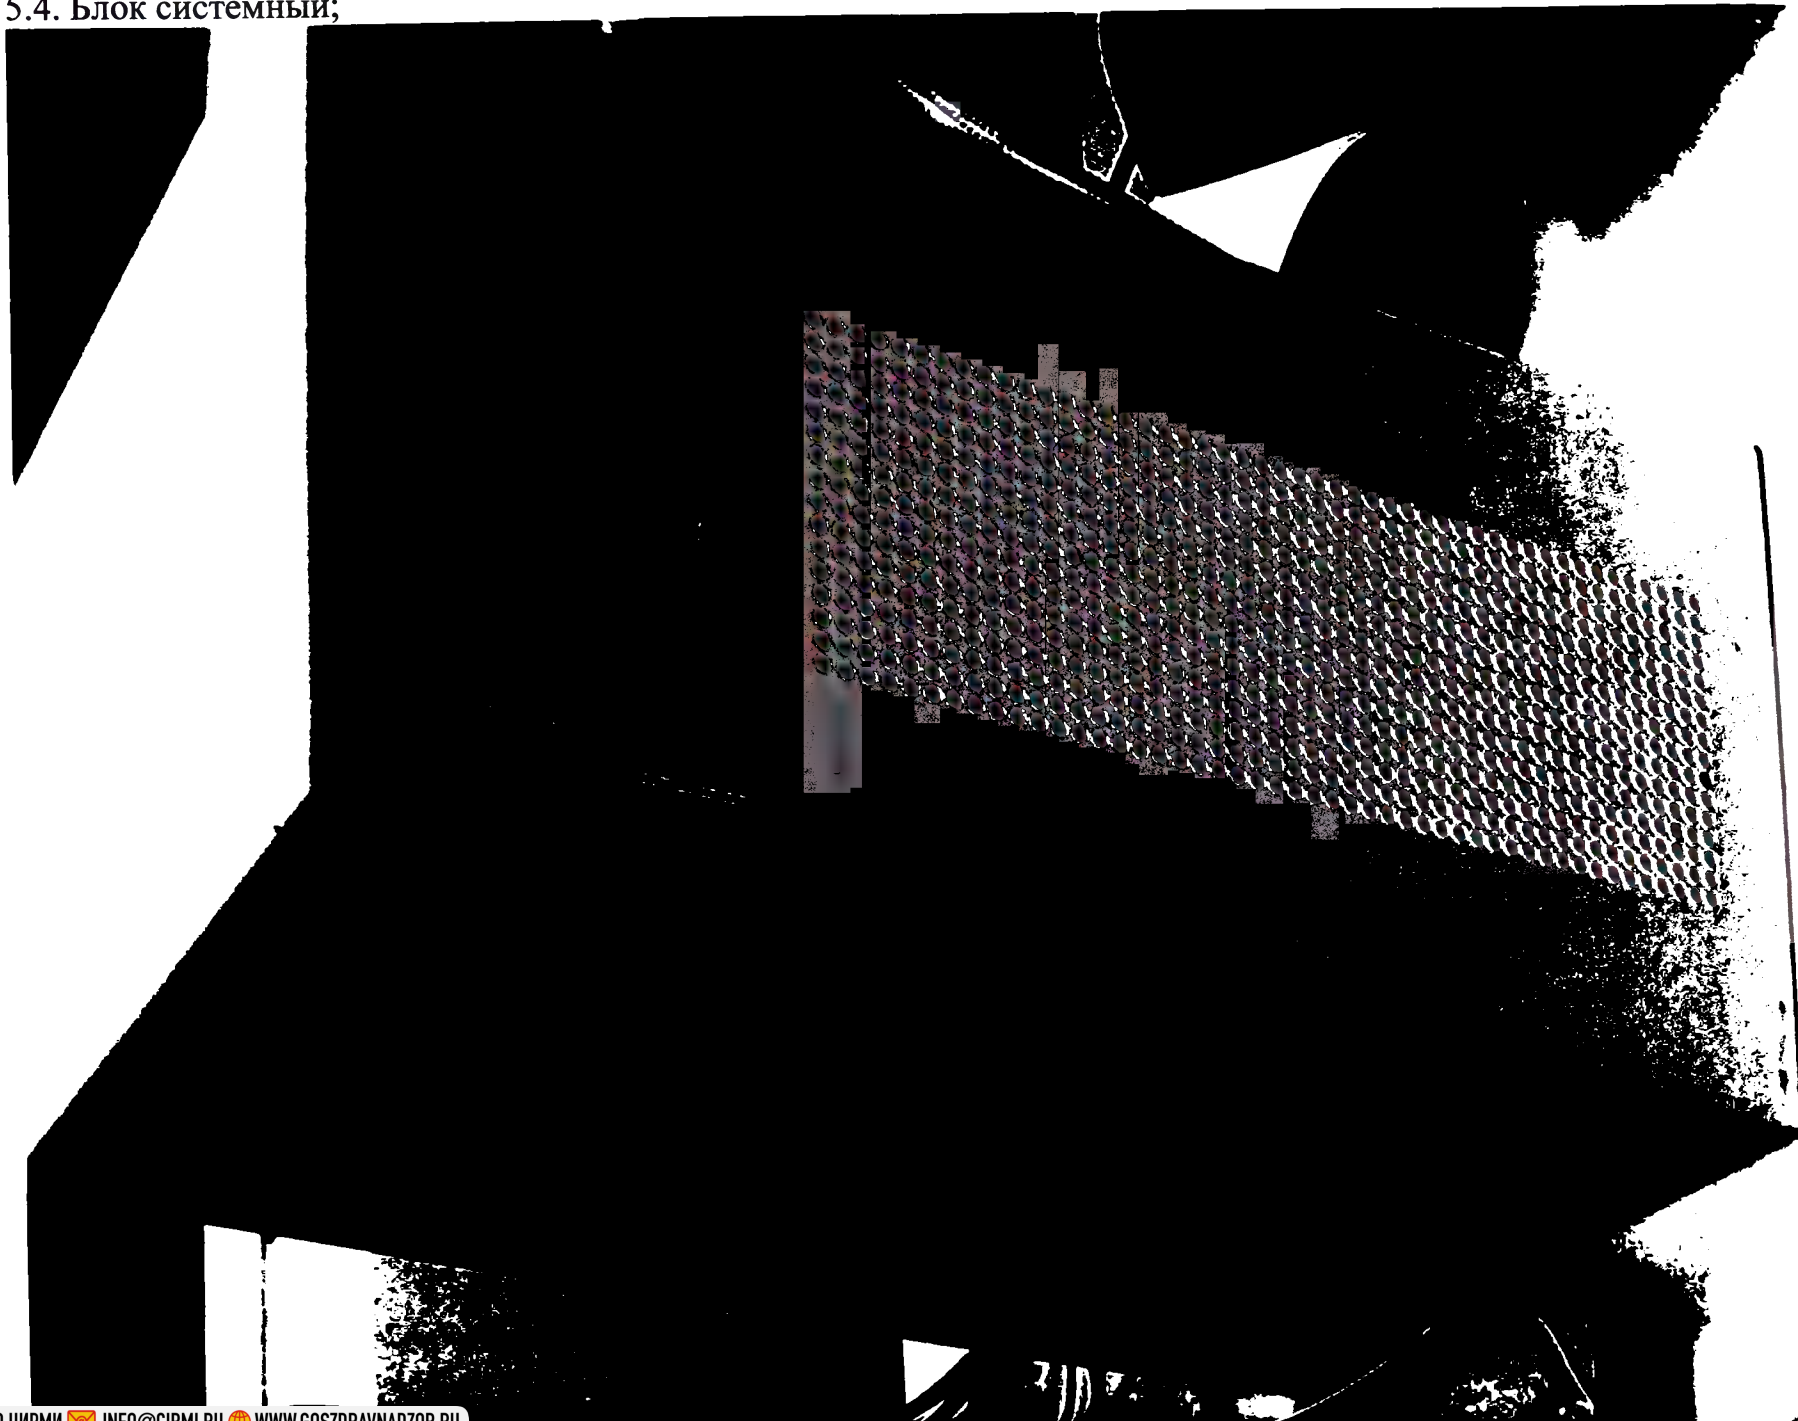

5.5. Переключатель экспозиции ручной.




Принадлежности: 1. Решетки отсеивающие сменные 40/12/110 (не более 2 шт.).




2. Решетки отсеивающие сменные 40/12/140 (не более 2 шт.).



3. Решетки отсеивающие сменные 40/12/180 (не более 2 шт.).

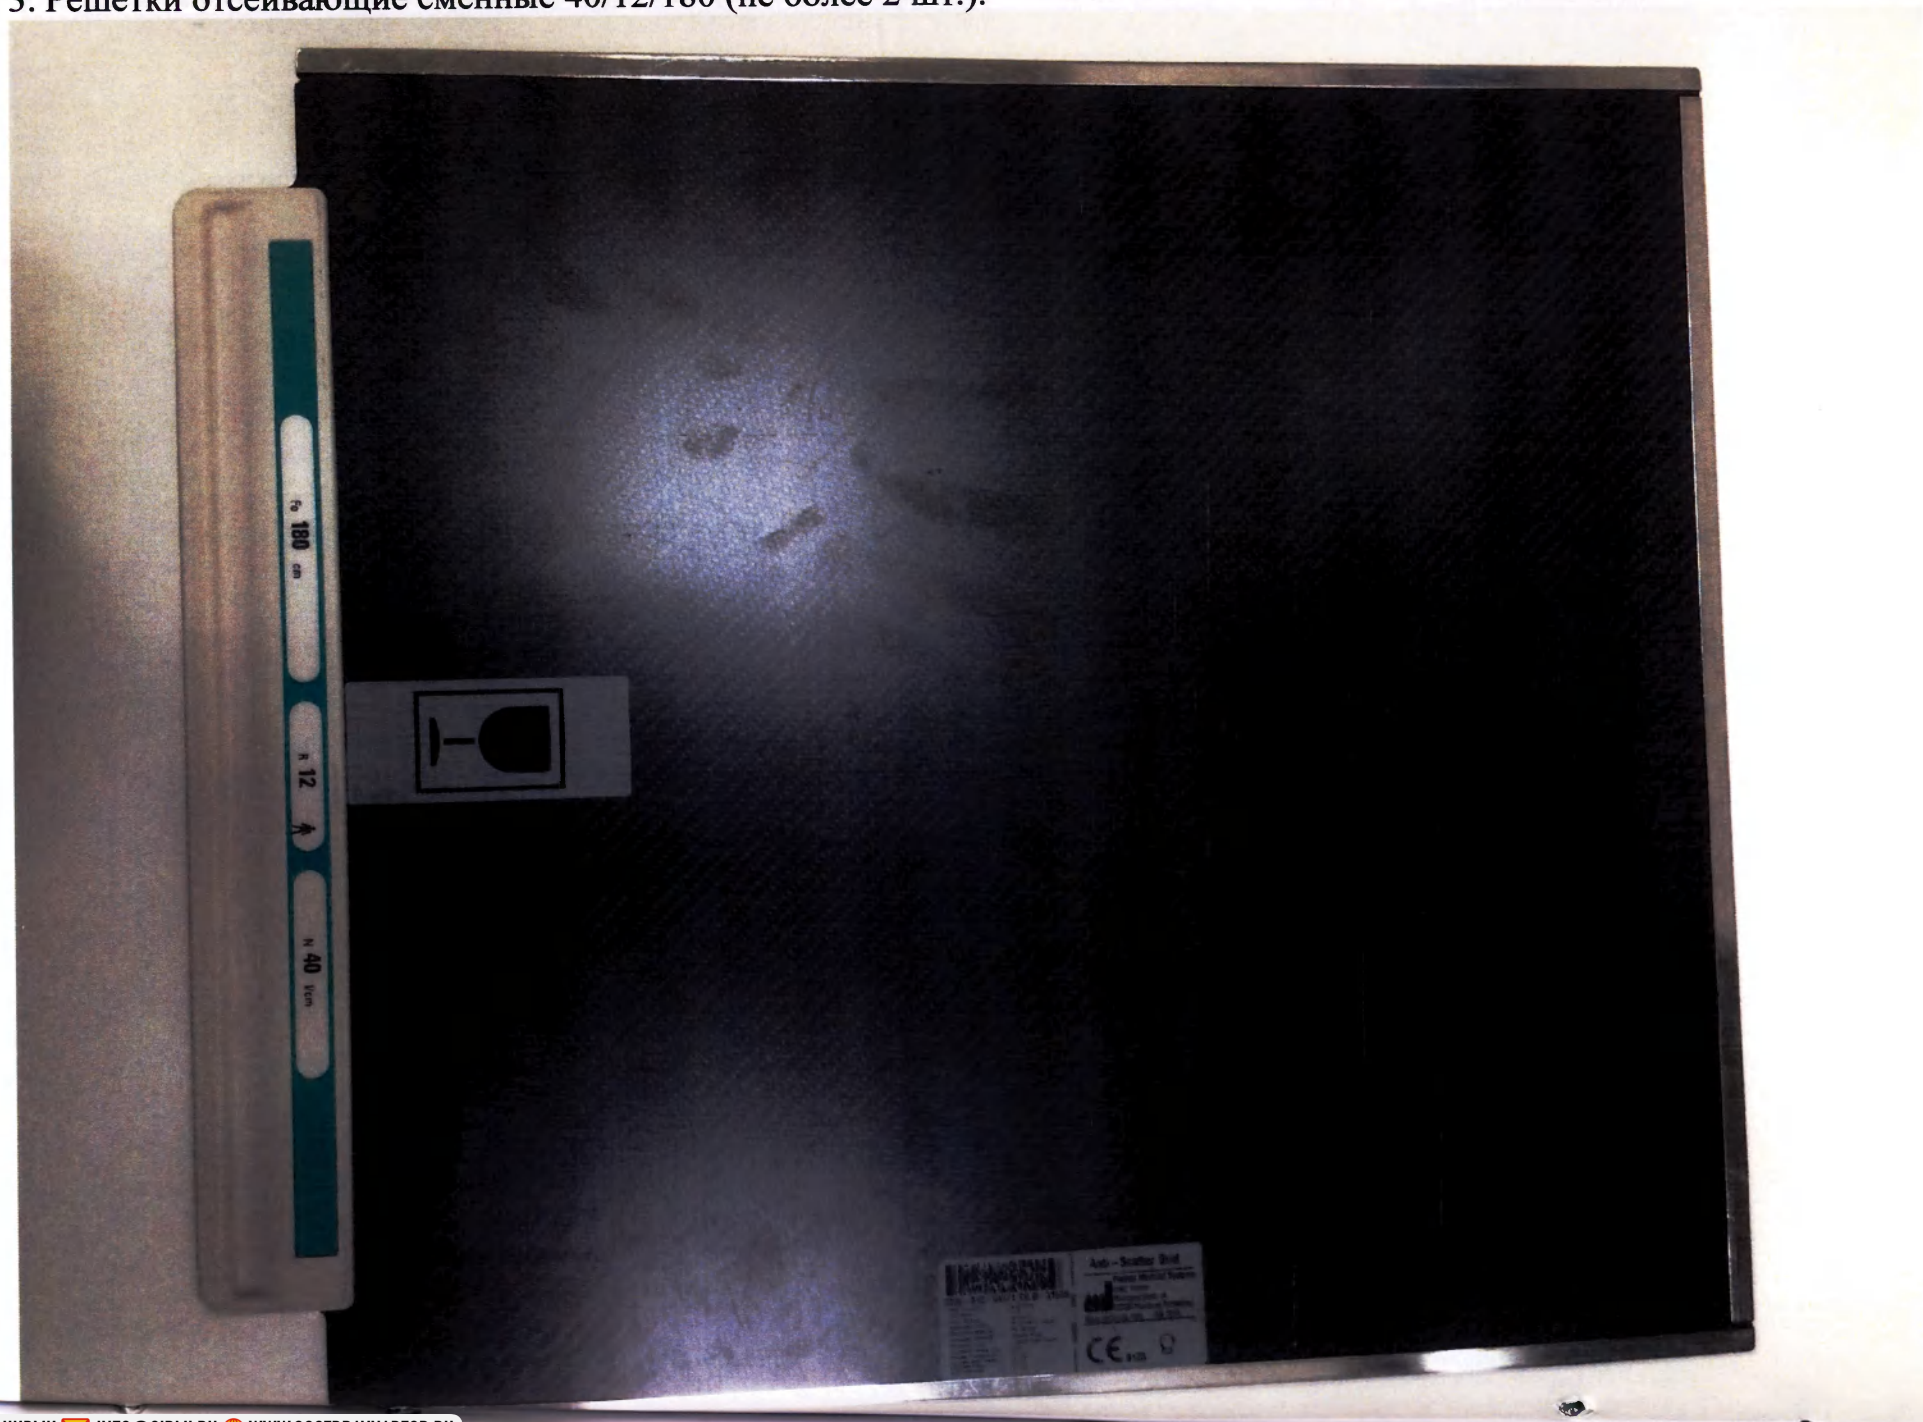

4. Решетки отсеивающие сменные 40/8/110 (не более 2 шт.).

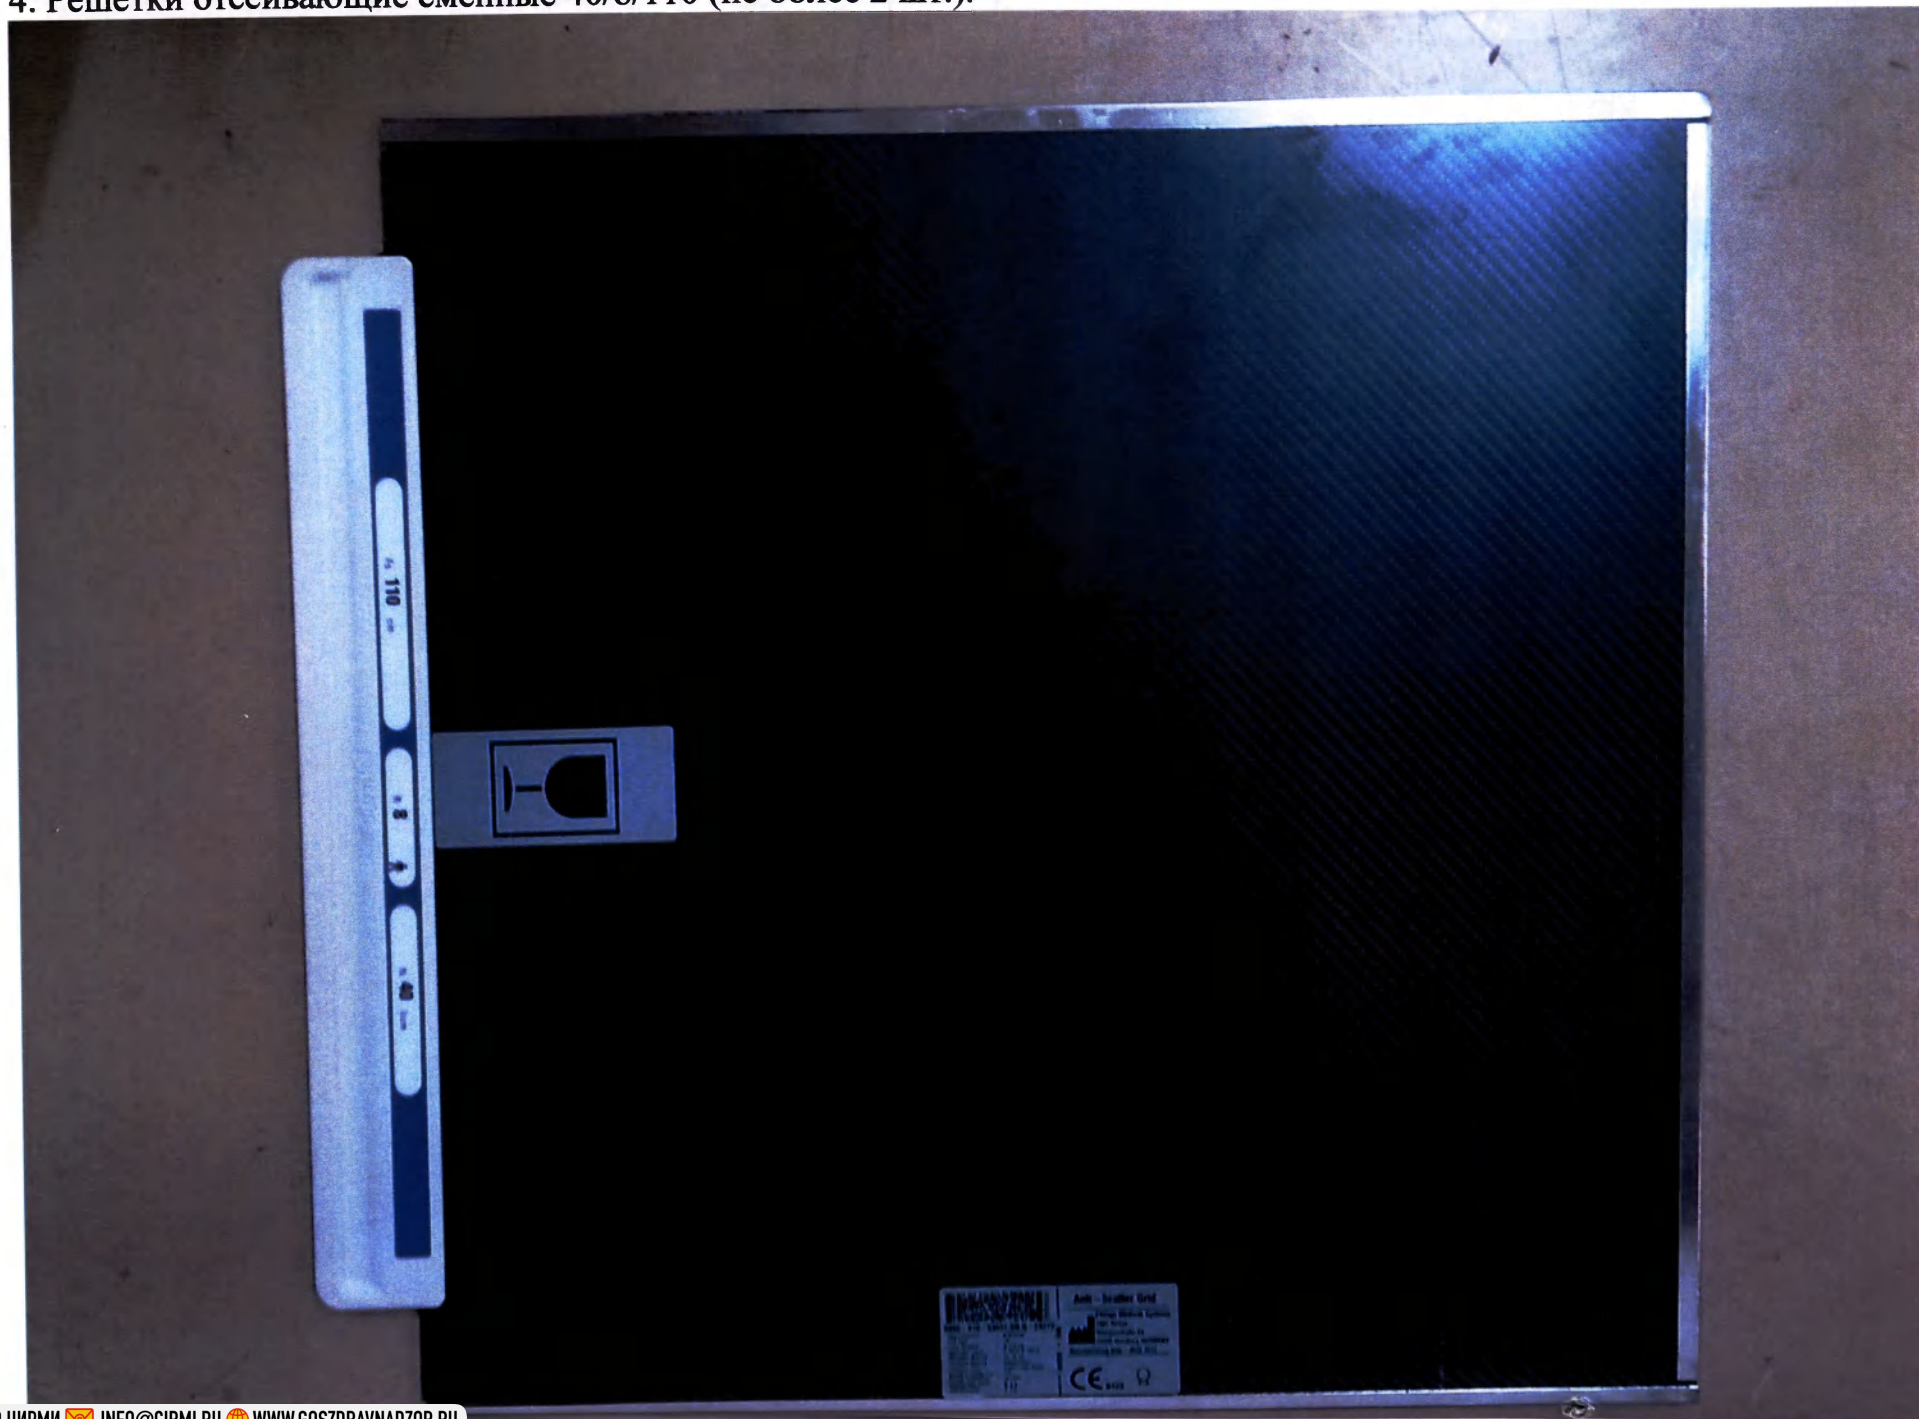


5. Решетки отсеивающие сменные 40/8/140 (не более 2 шт.).




6. Решетки отсеивающие сменные 60/10/110 (не более 2 шт.).




7. Решетки отсеивающие сменные 60/10/140 (не более 2 шт.).

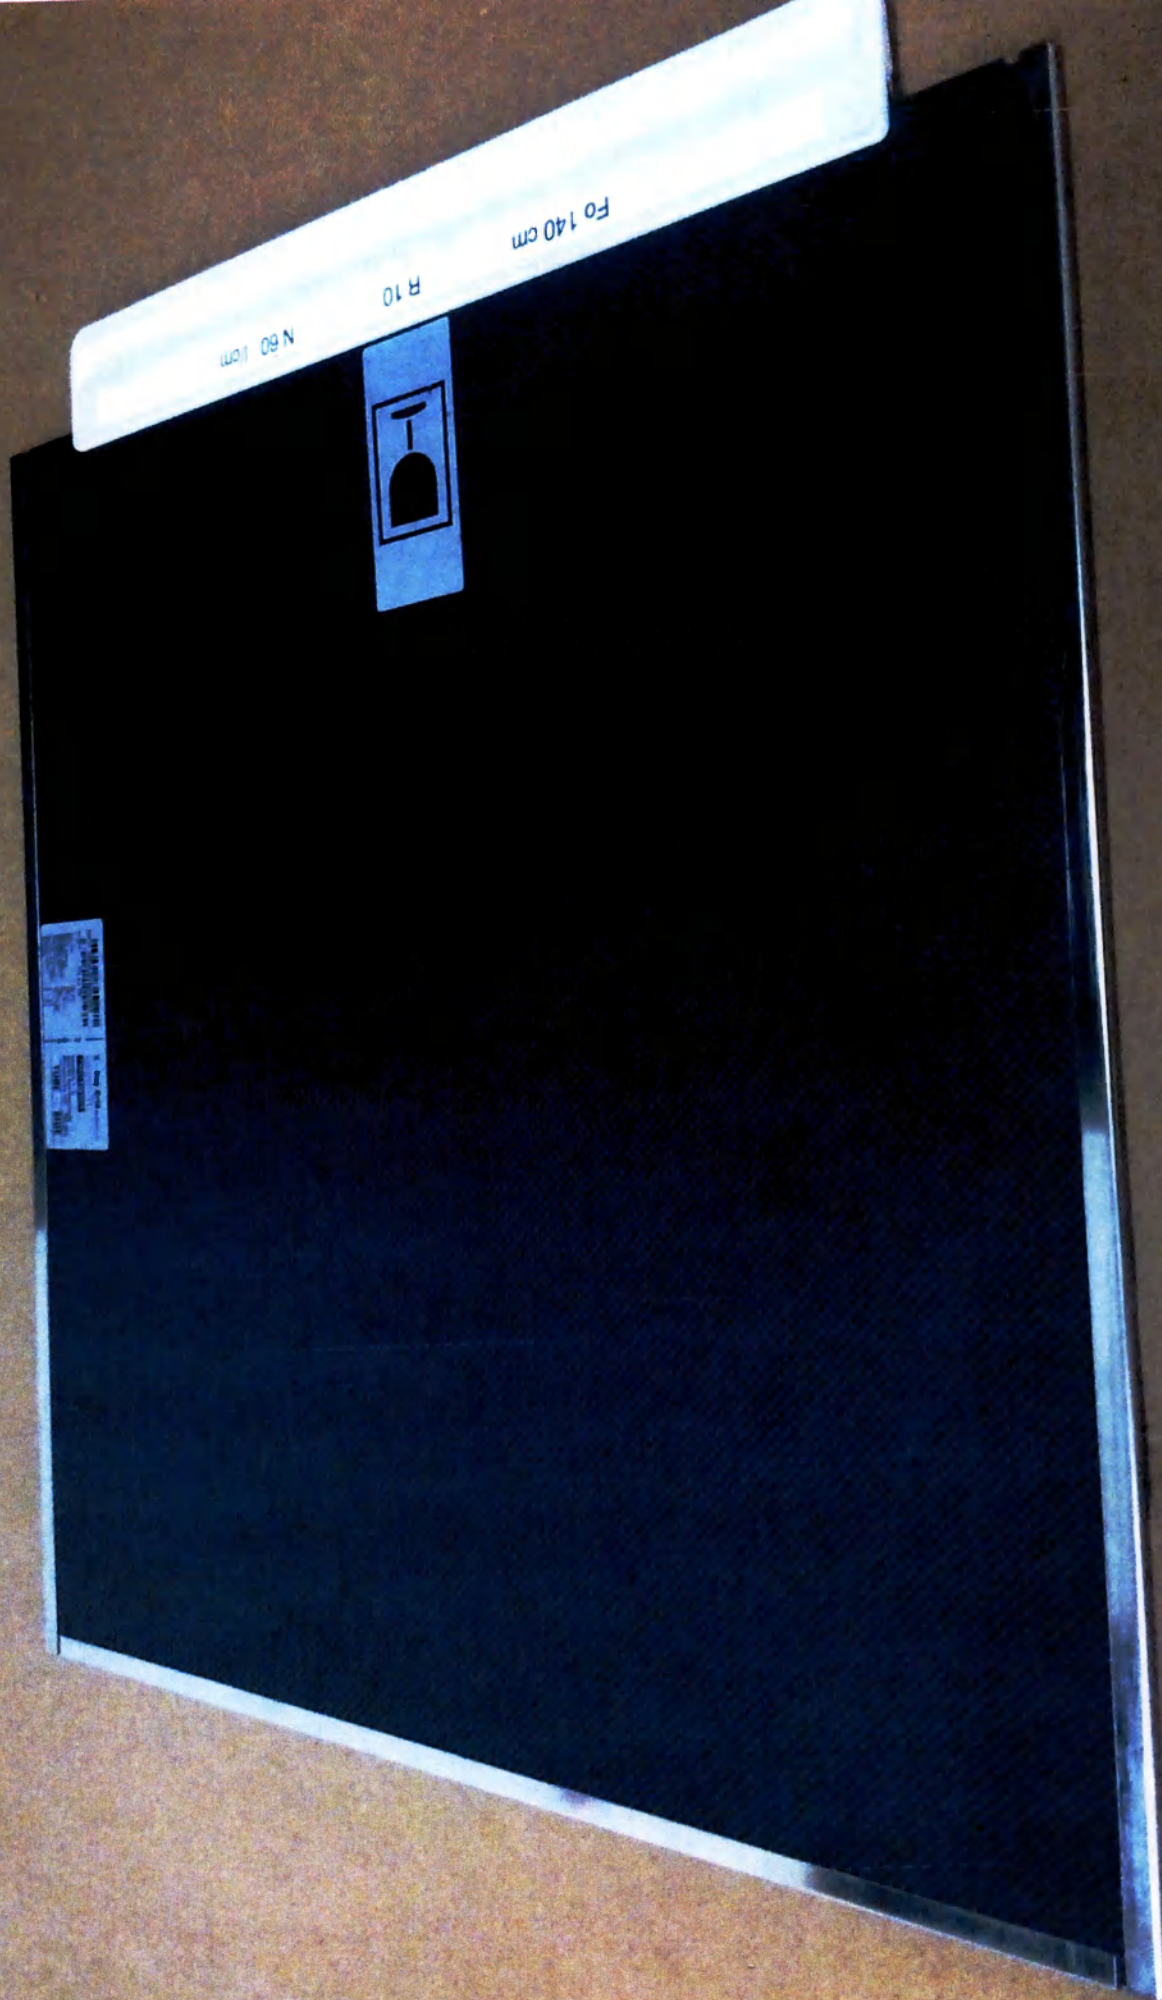


8. Решетки отсеивающие сменные 60/10/180 (не более 2 шт.).

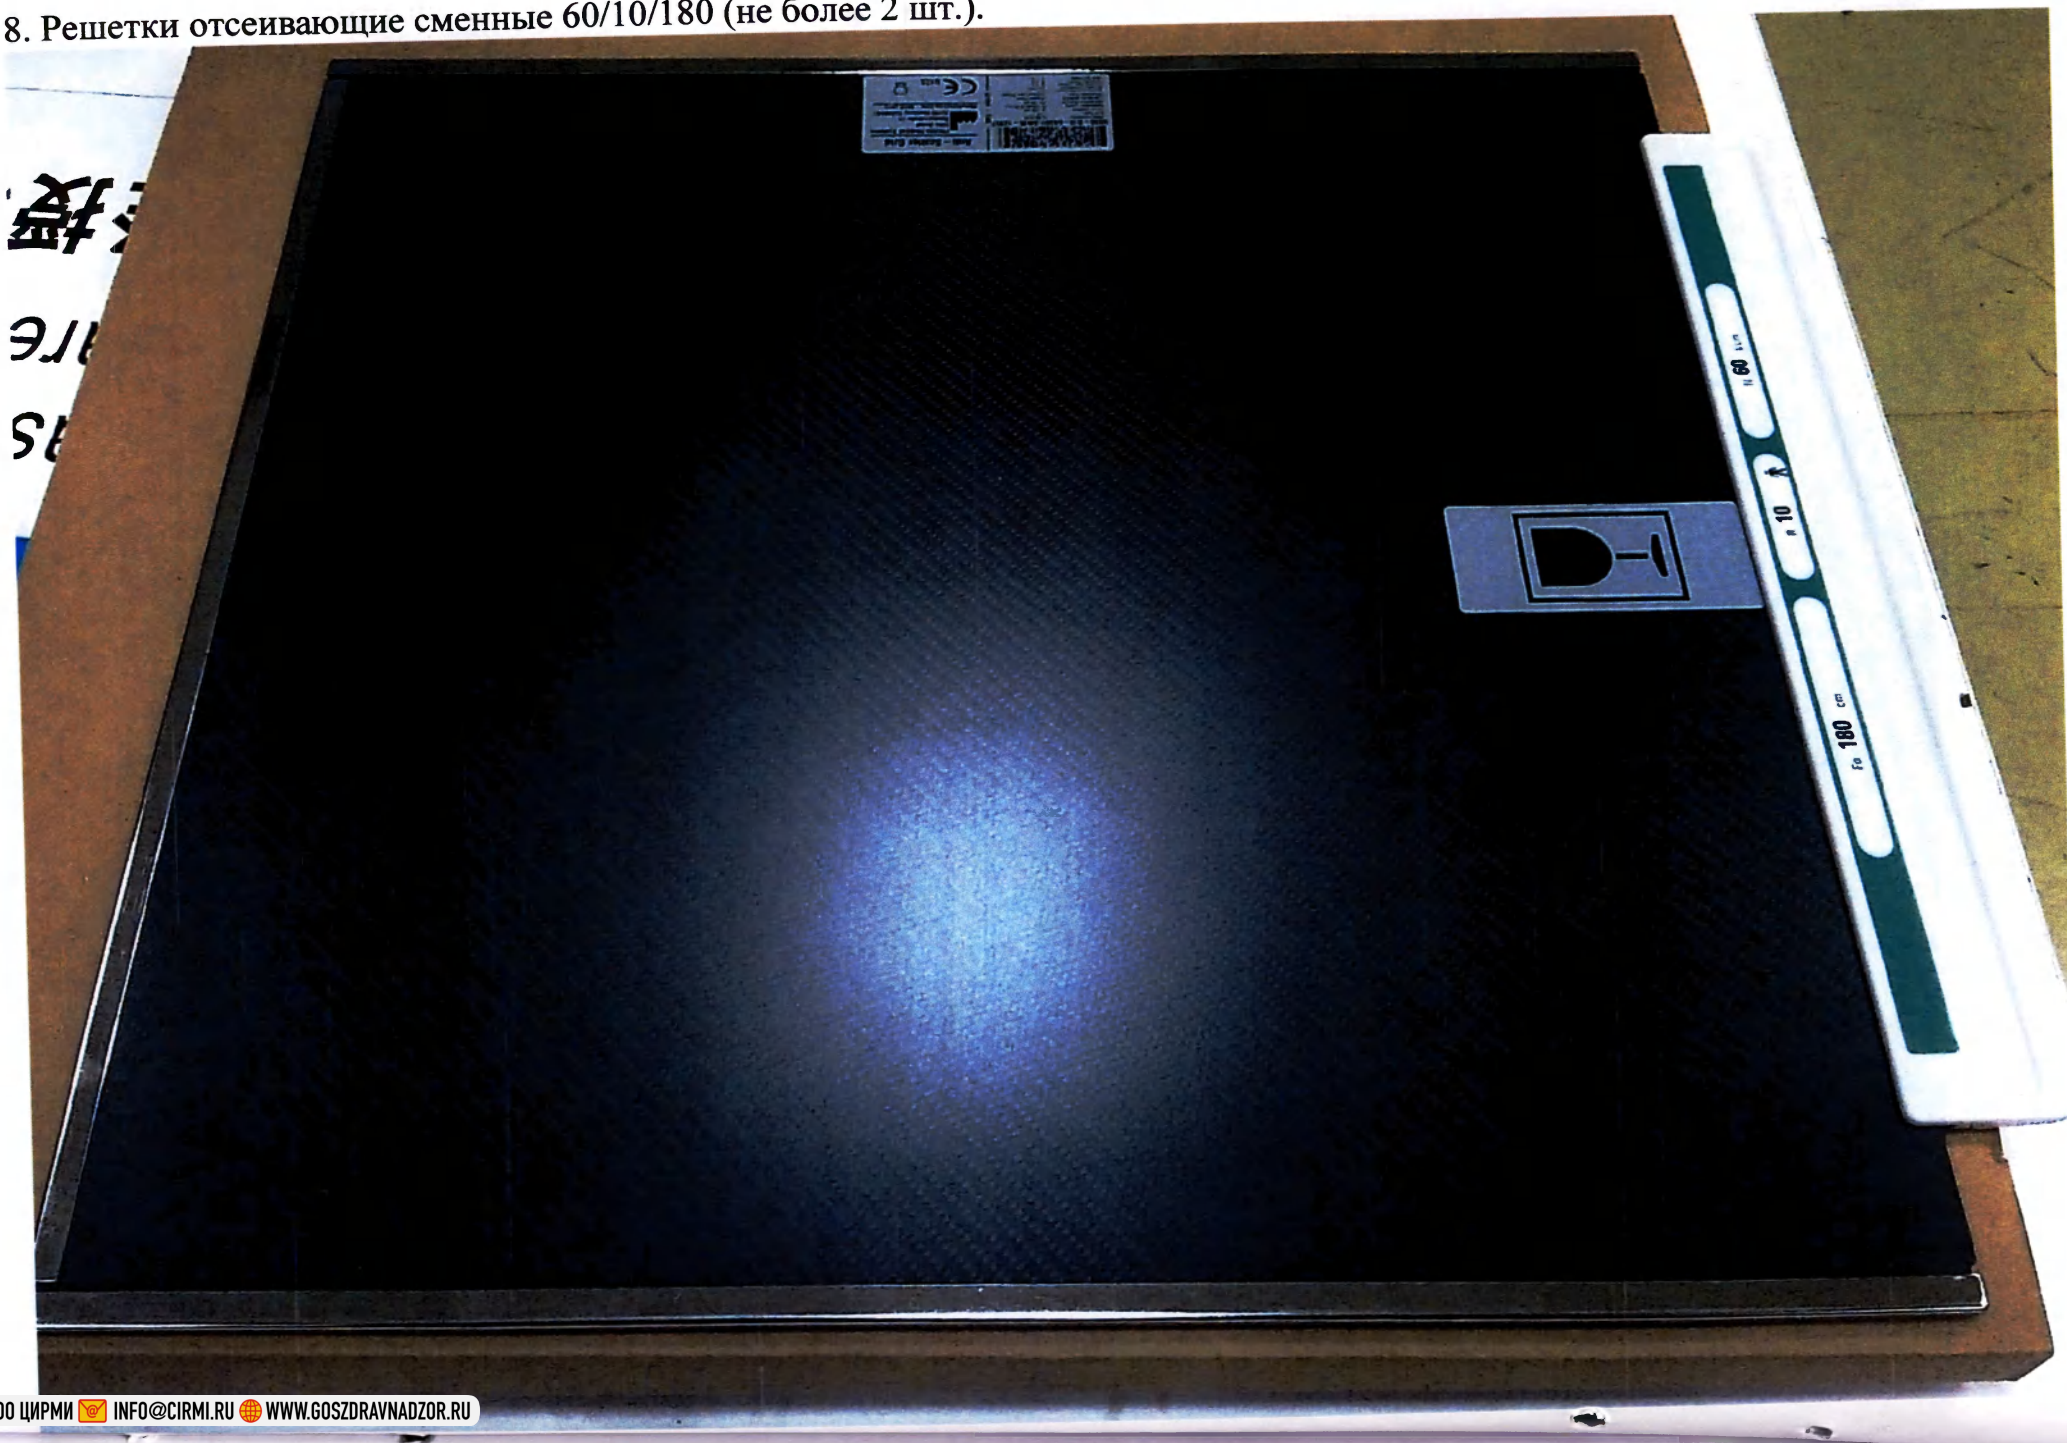

9. Детекторы (не более 2 шт.).

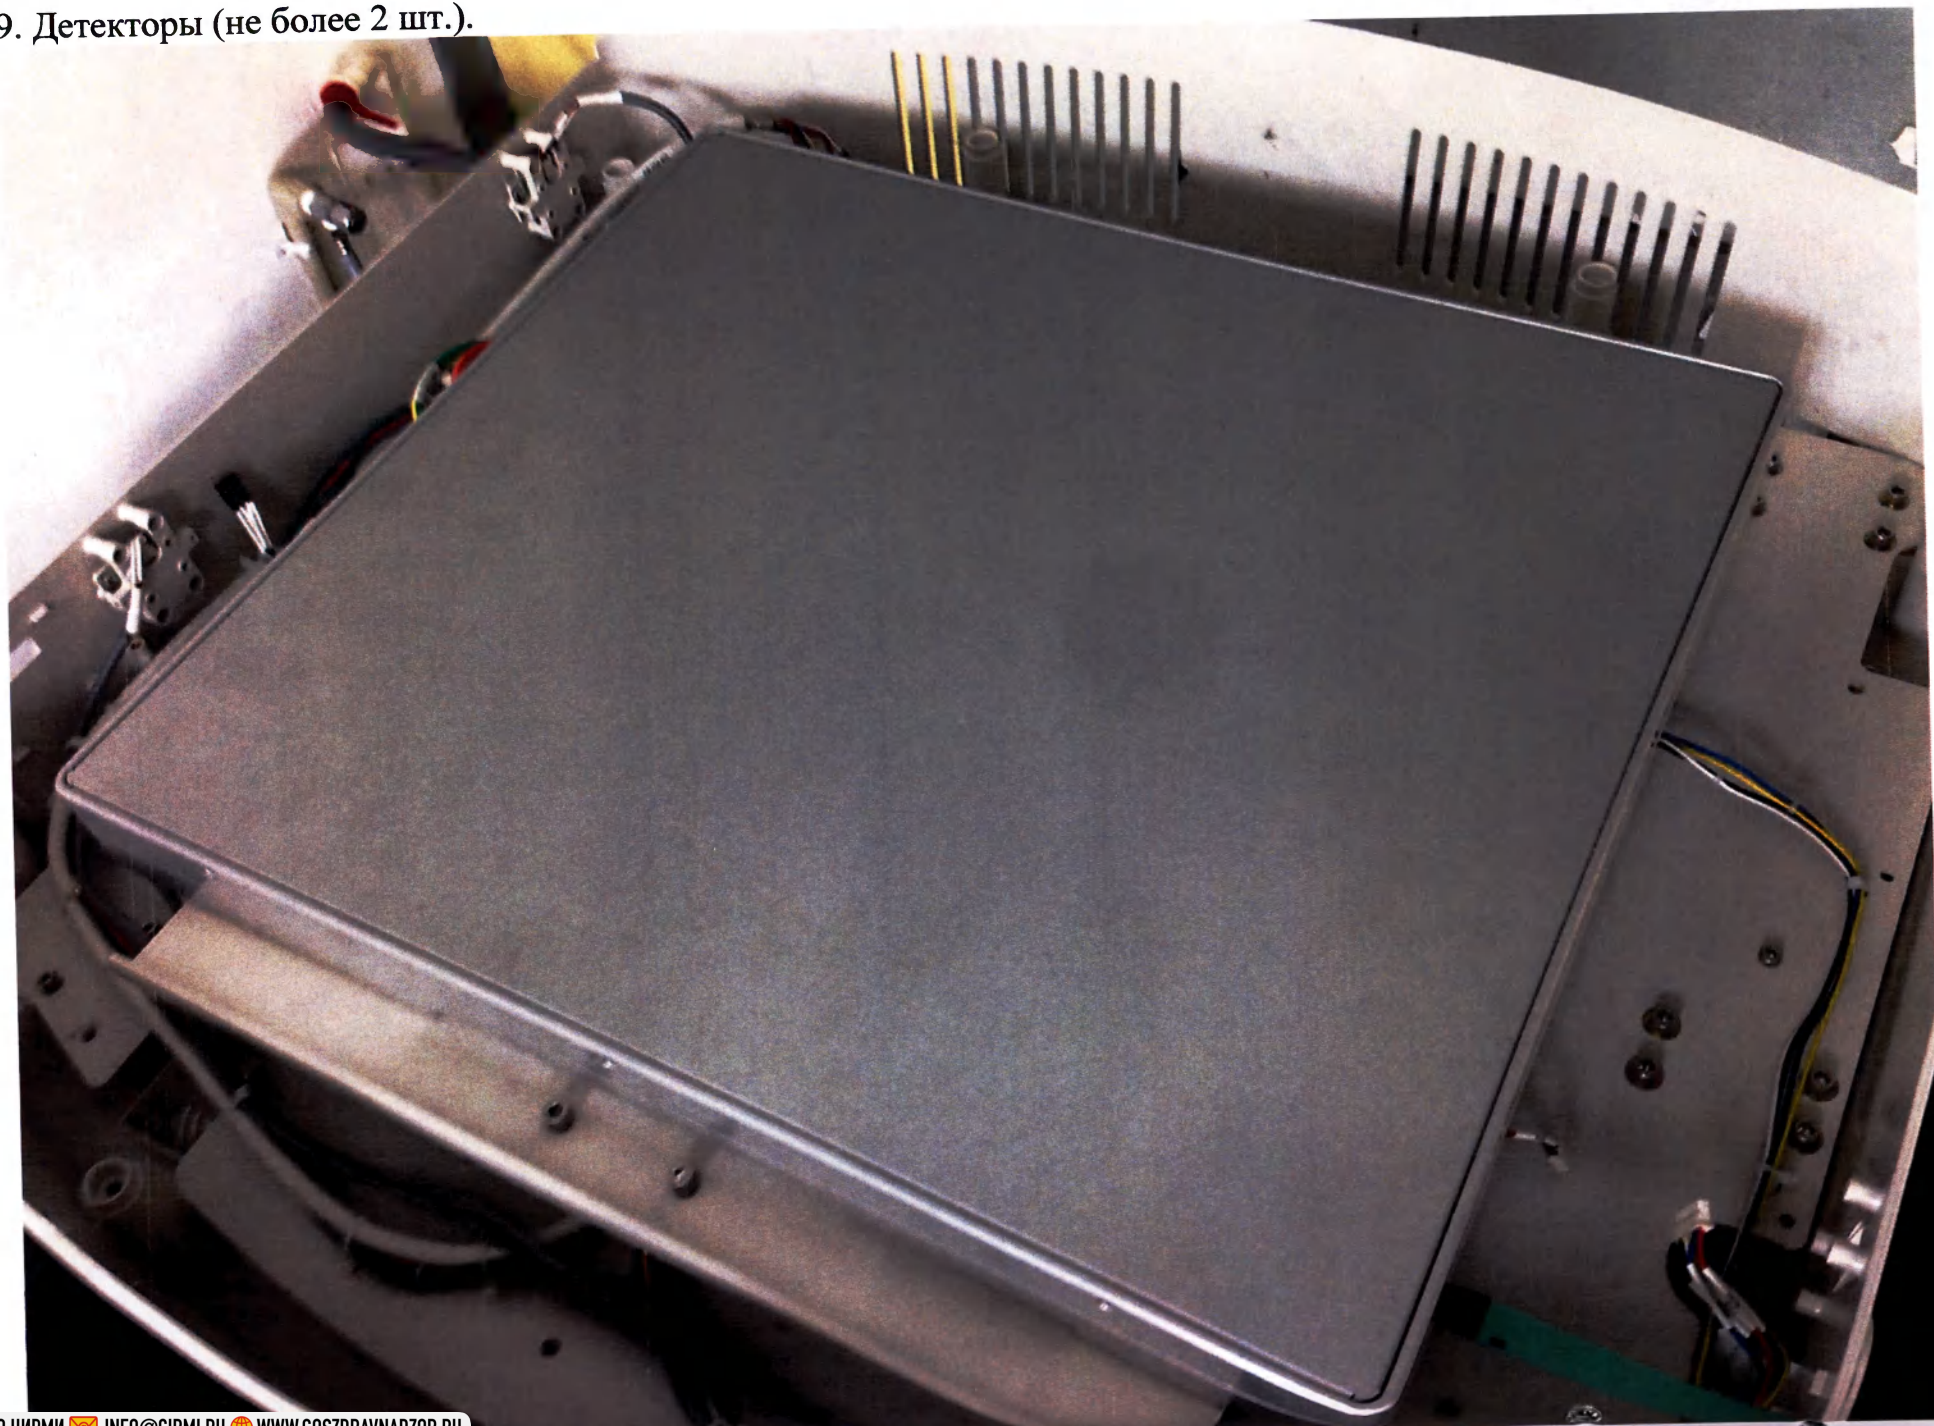


10. Детектор цифровой переносной.

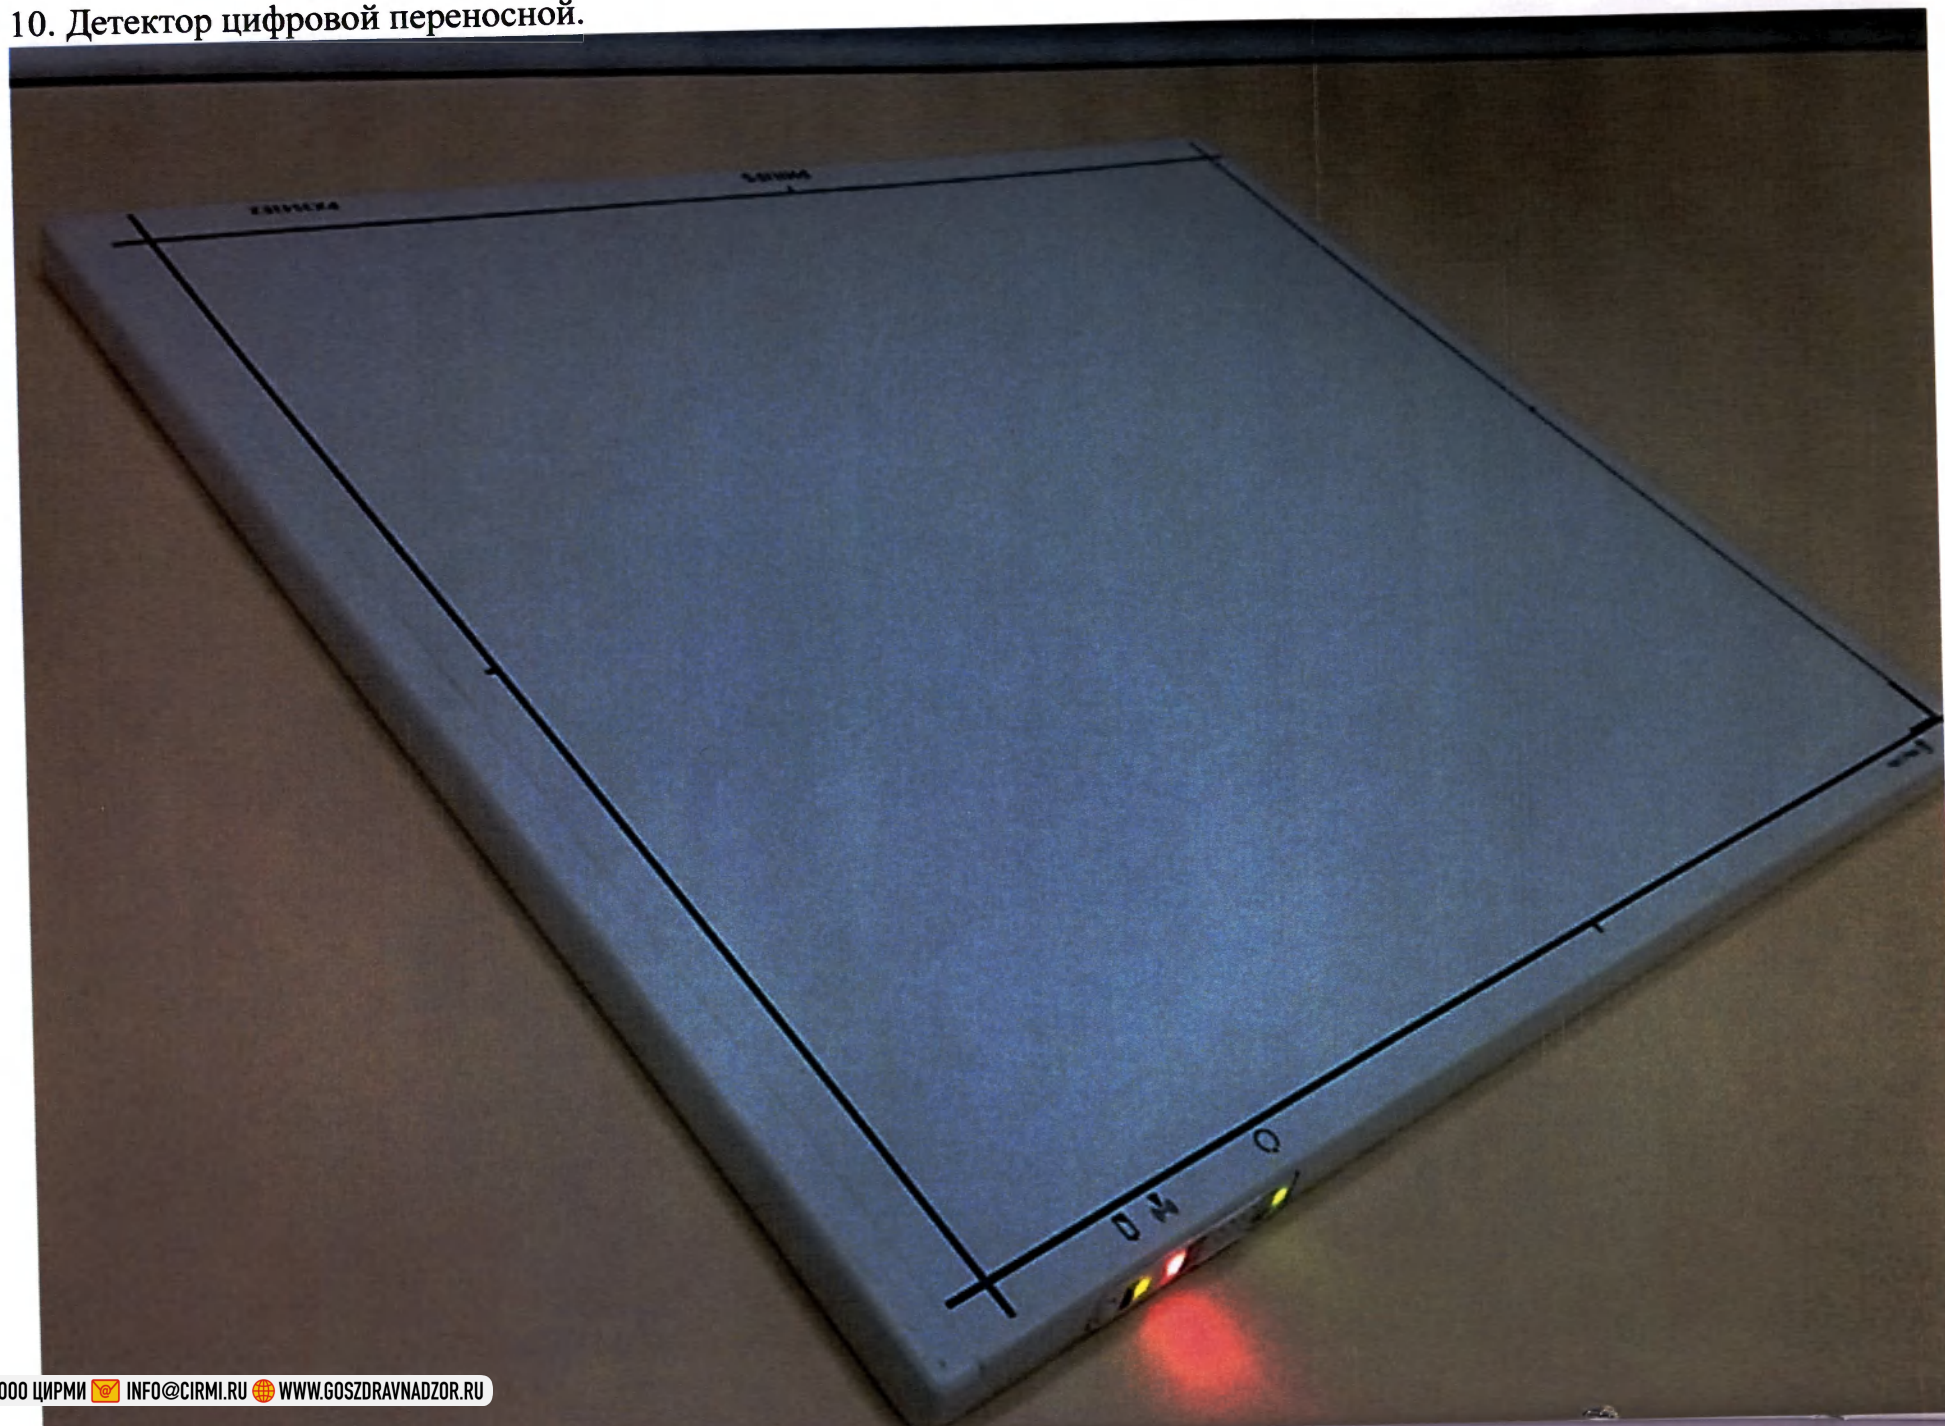


11. Лента компрессионная.



12. Рукоятки (не более 2 шт.).

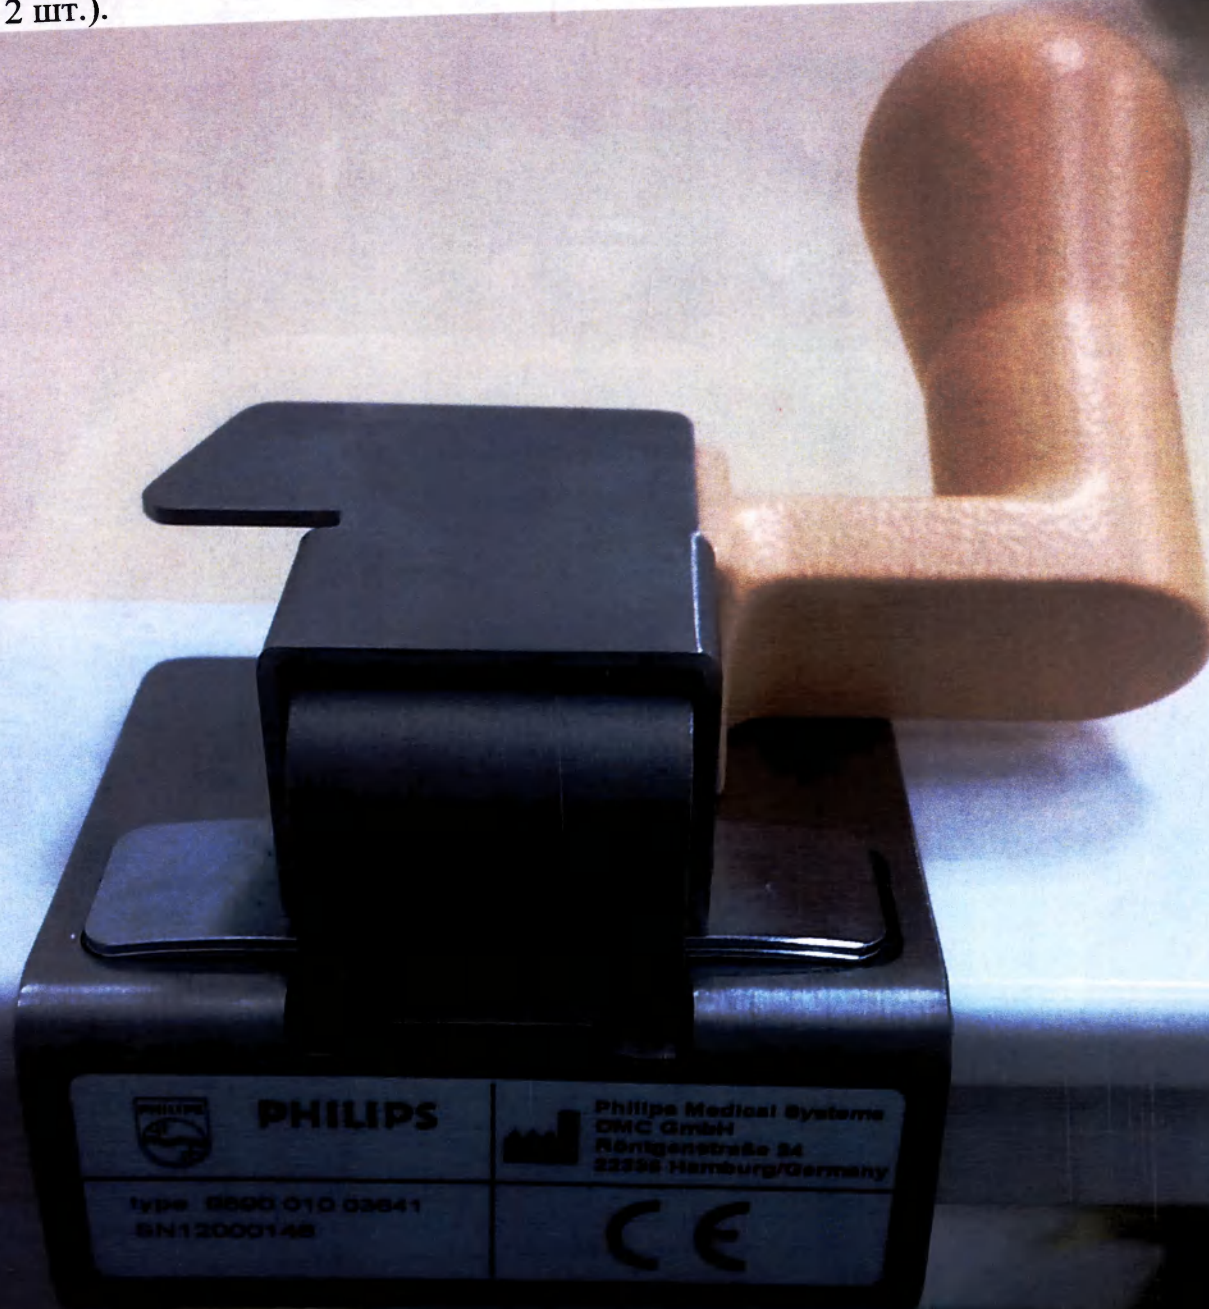


13. Рукоятка верхняя.

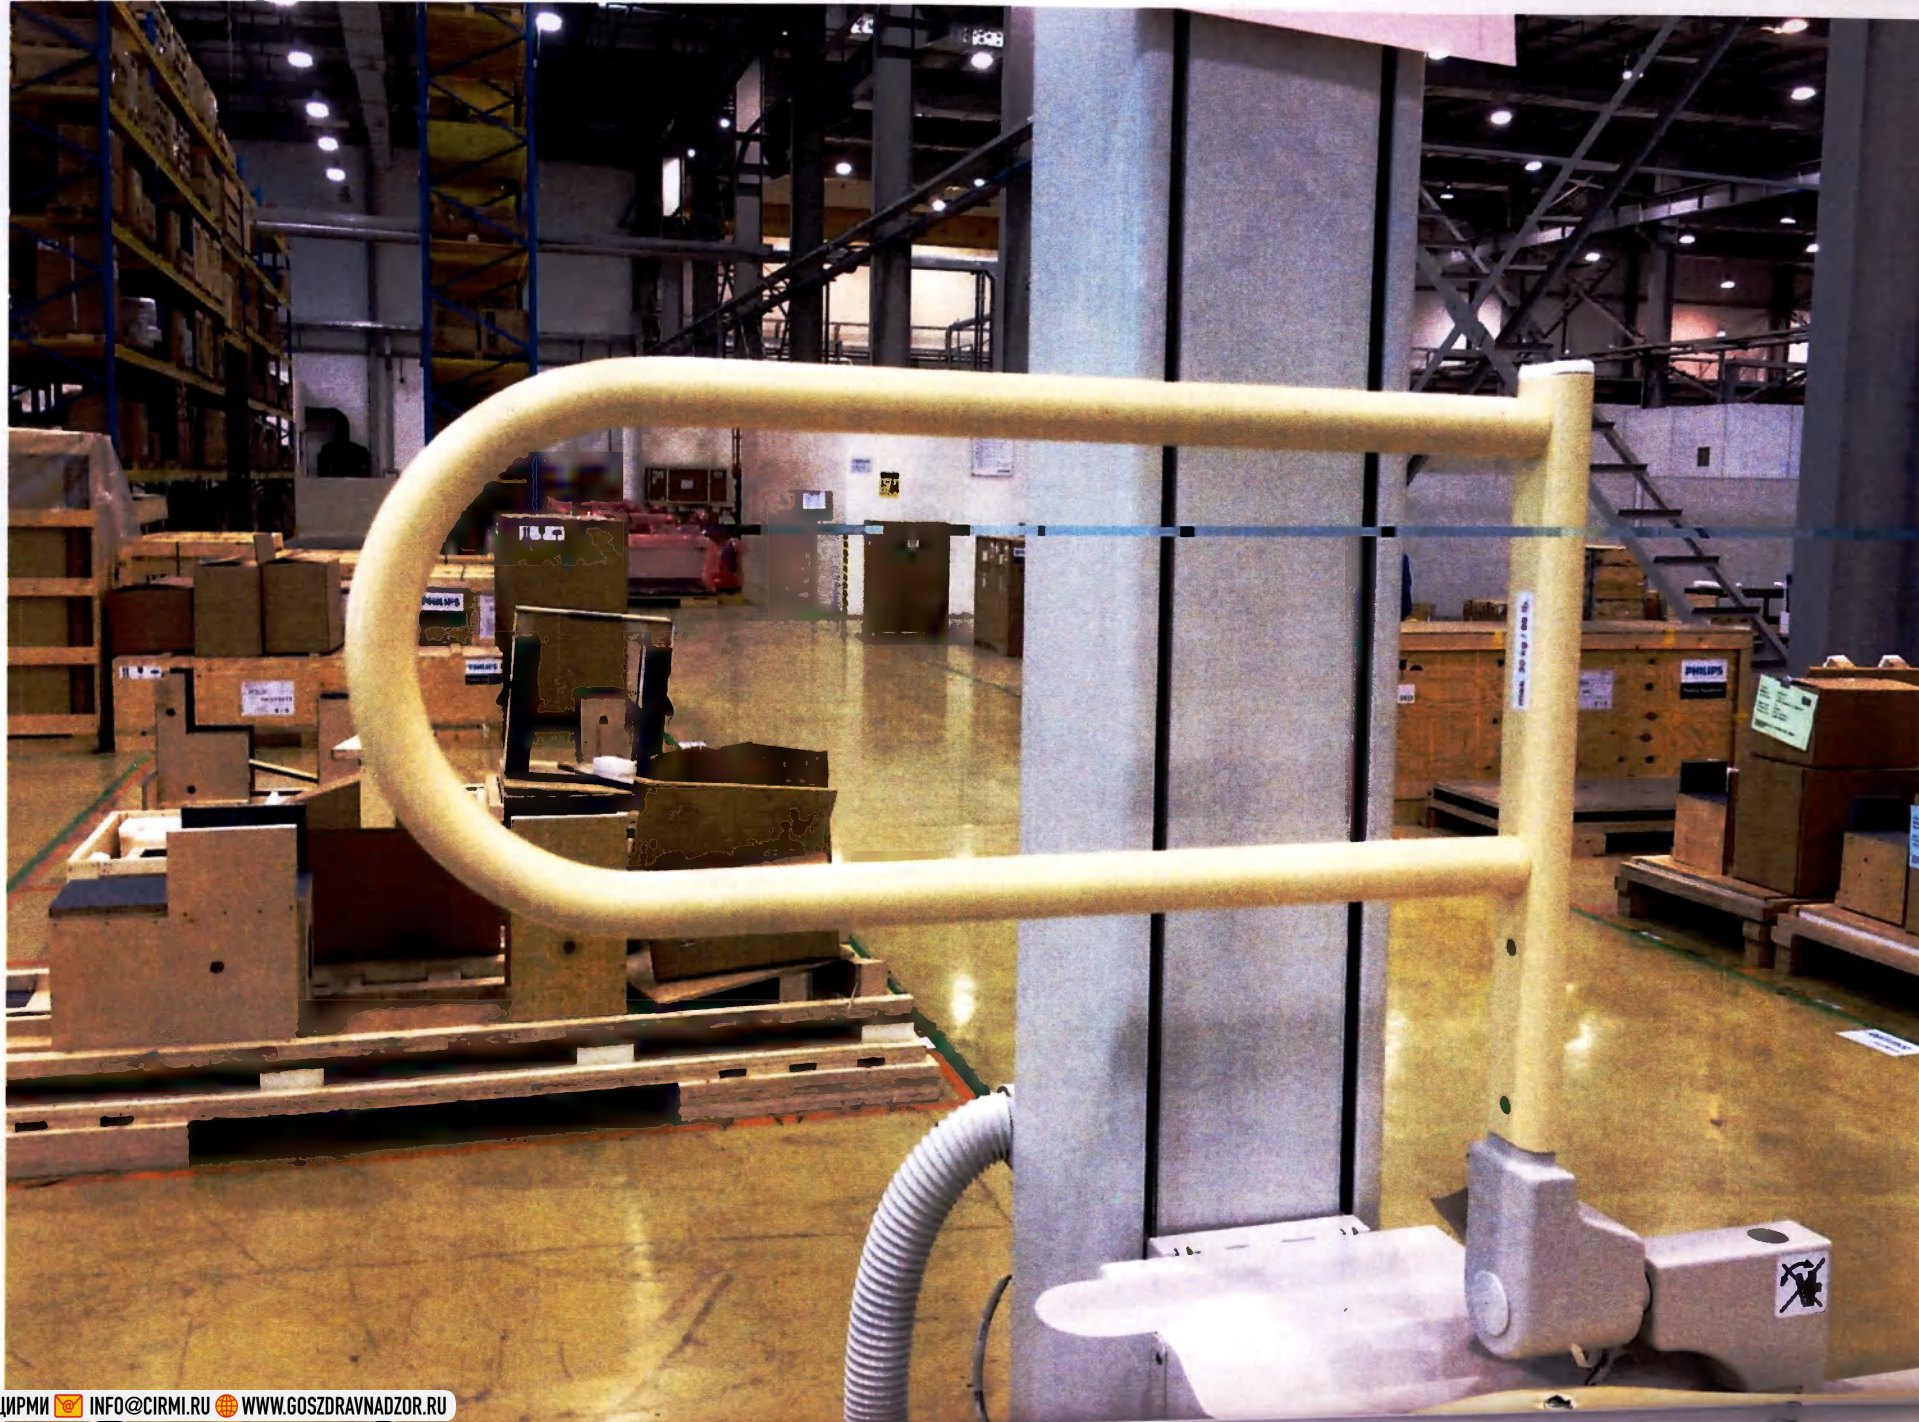


Руководство по
эксплуатации

Русский

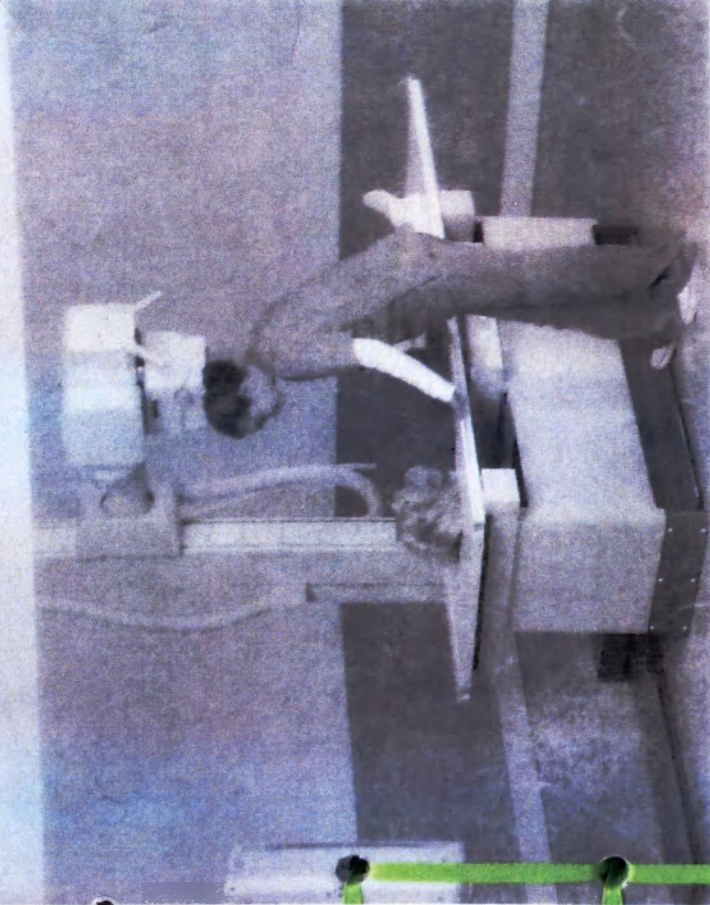

FlexiDiagnost

Версия 2.0



PHILIPS

Leoclen
Regulatory Affairs

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

в 5-й экземпляр

лист(ов)

Руководитель отдела управления
качеством и нормативного
регулирования ООО "Филипс"

О.В. Бахвалова
О.В. Бахвалова