




2015/02/19

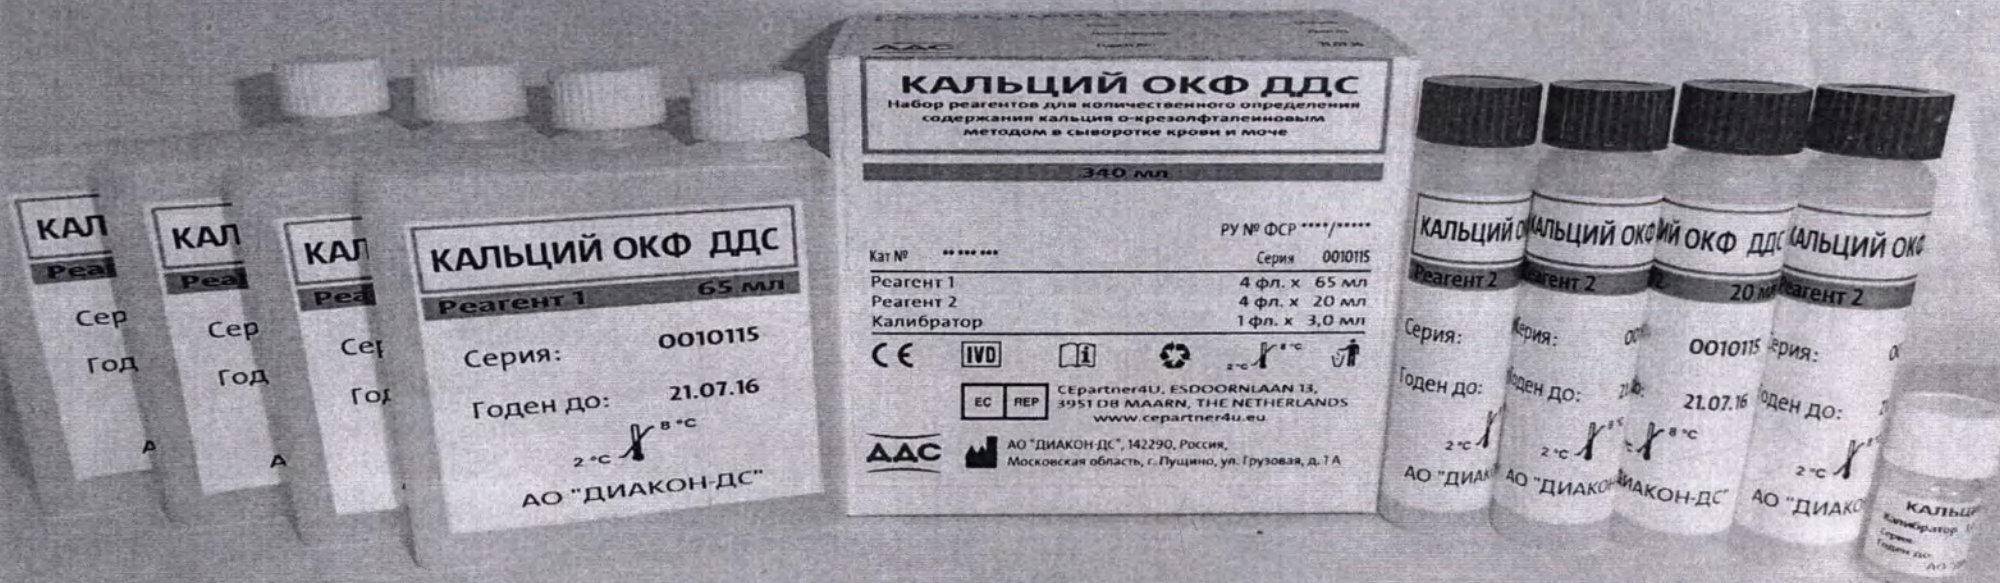

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Реагент 1 10000 мл
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2°C  8°C
АО "ДИАКОН-ДС"

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
АО "ДИАКОН-ДС"
КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Реагент 1 10000 мл
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
АО "ДИАКОН-ДС"

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Реагент 2 2500 мл
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2°C  8°C
АО "ДИАКОН-ДС"

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
2,5 ммоль/л
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2°C  8°C
АО "ДИАКОН-ДС"


2015/02/24



2015/02/11



ООО ЦРПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

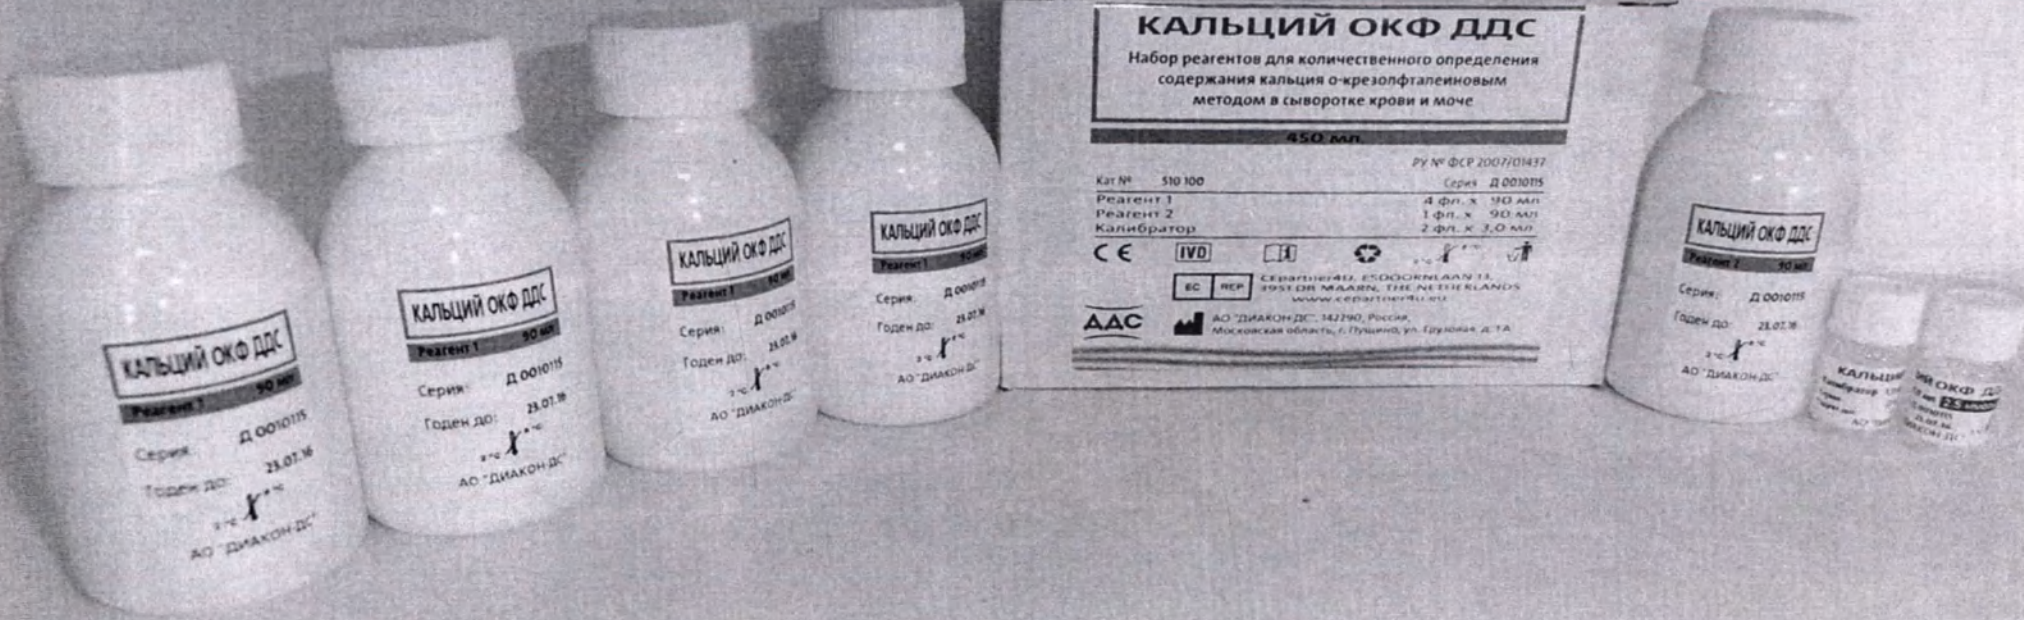

2015/02/17

13






2015/02/17




2015/02/17

15

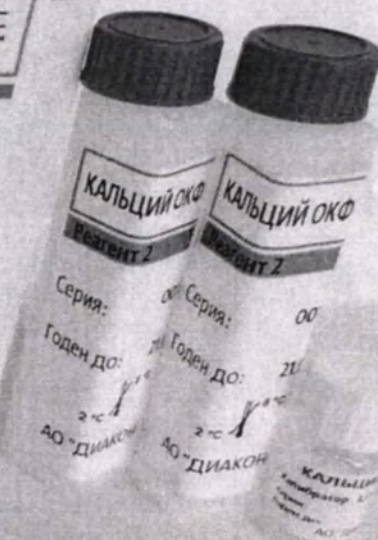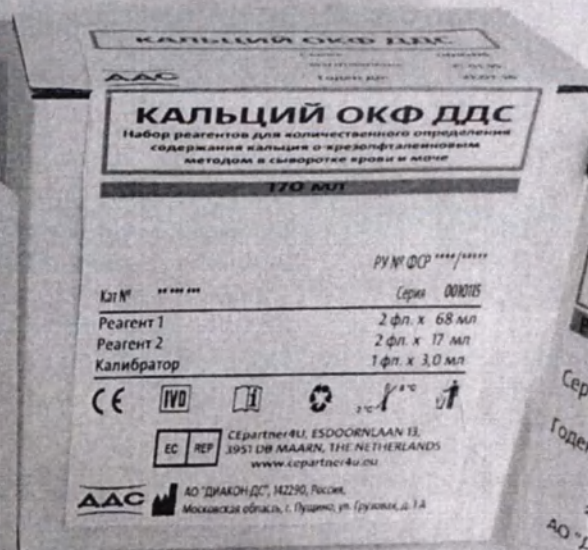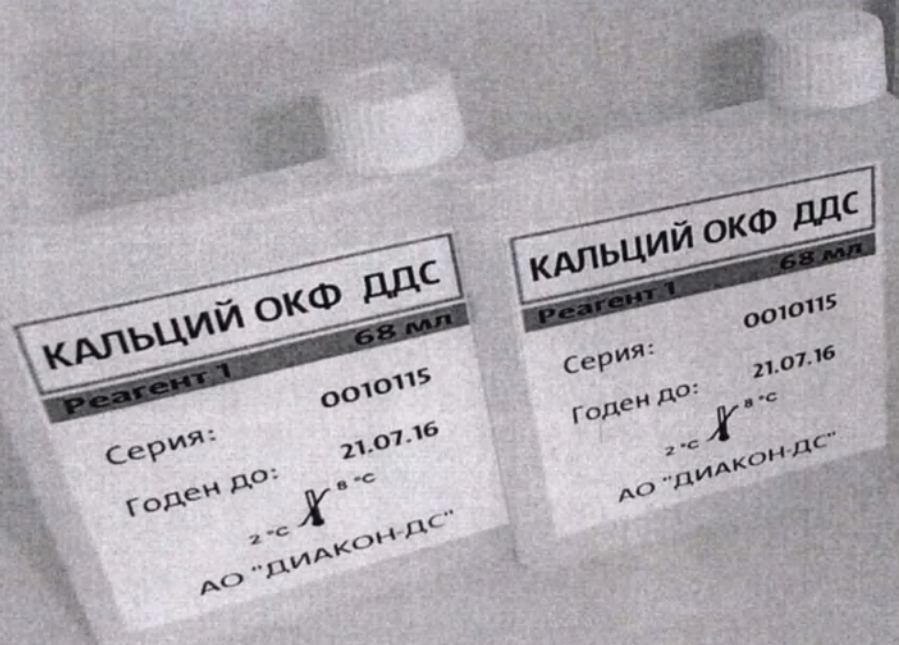

2015/02/17

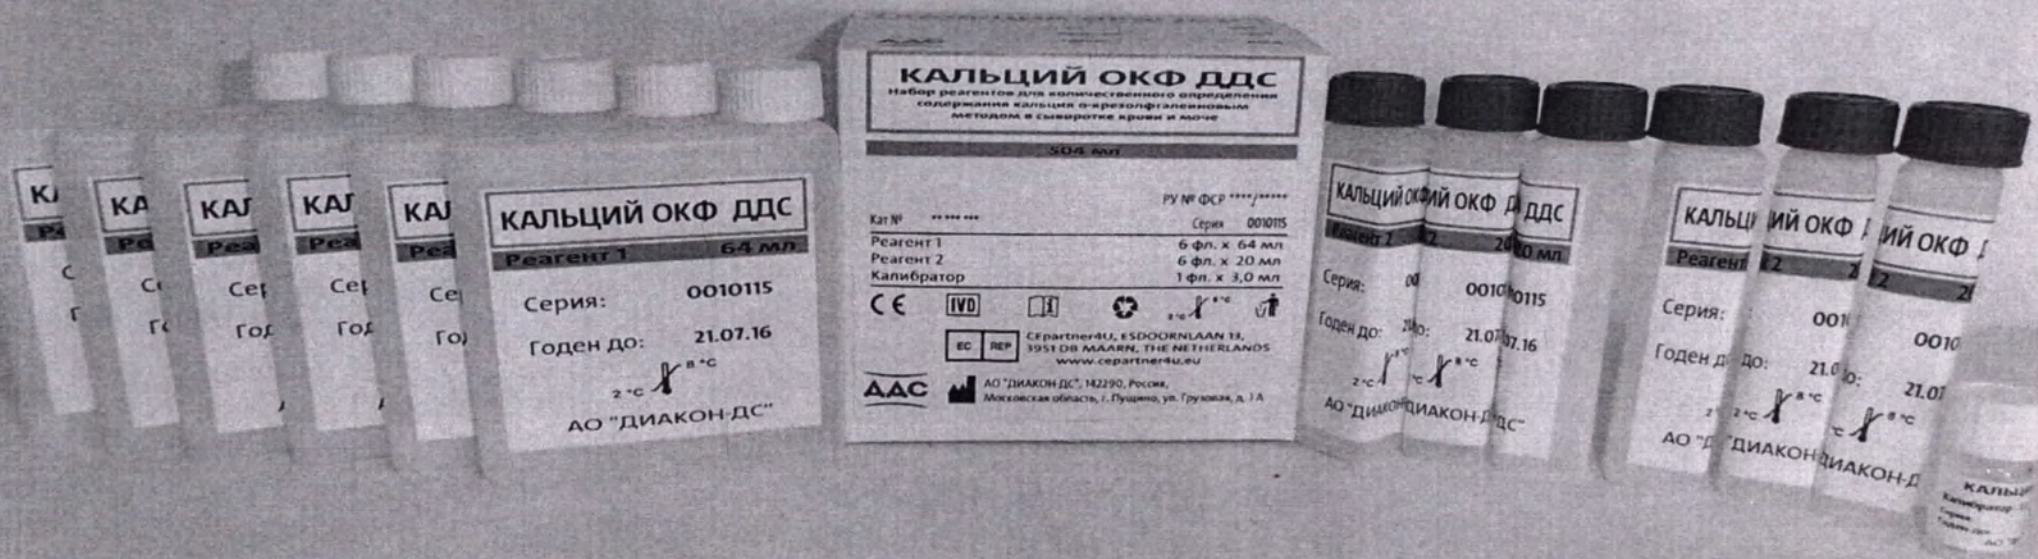

2015/02/19



КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Реагент 1 64 мл
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2 °C 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Реагент 1 64 мл
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2 °C 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Набор реагентов для количественного определения содержания кальция в сыворотке крови и моче методом в сыворотке крови и моче
168 мл
Кат № ***** Серия 0010115
Реагент 1 2 фл. х 64 мл
Реагент 2 2 фл. х 20 мл
Калибратор 1 фл. х 3,0 мл
CE IVD
CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu
ААС АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

КАЛЬЦИЙ ОКФ
Реагент 2
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2 °C 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"


КАЛЬЦИЙ ОКФ
Реагент 2
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2 °C 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

КАЛЬЦИЙ
Калибратор 3,0 мл
Годен до: 21.07.16
2 °C 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

2015/02/19

101

2015/02/19

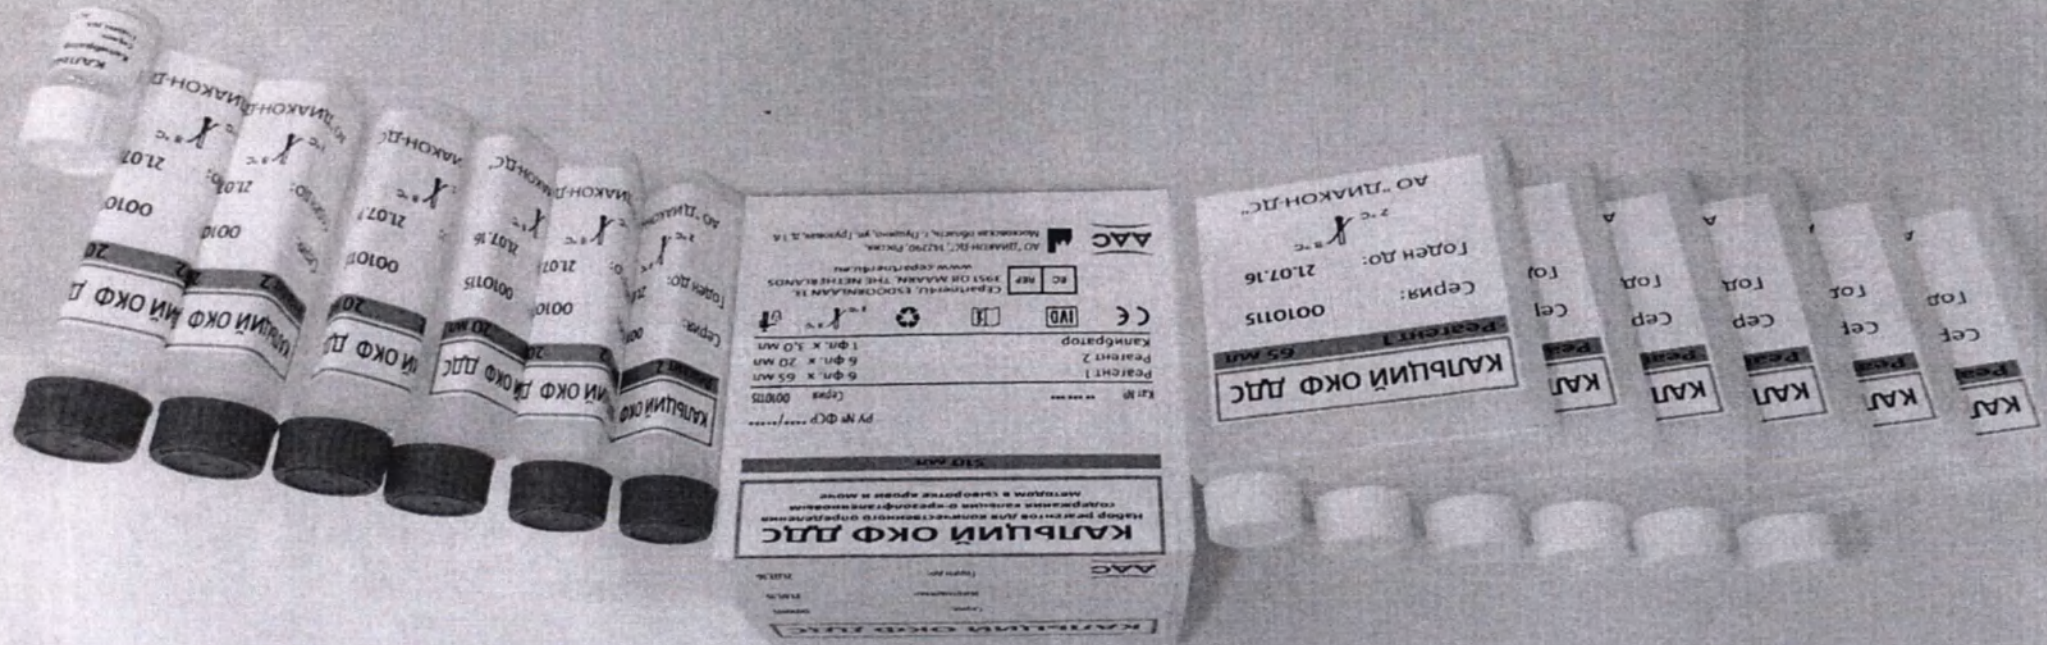



КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Реагент 1 65 мл

Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2°C 18°C
АО "ДИАКОН-ДС"

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Реагент 1 65 мл

Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2°C 18°C
АО "ДИАКОН-ДС"

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Набор реагентов для количественного определения содержания кальция в сыворотке крови и моче методом в-крезолфталениновым

170 мл

Кат №: 0010115
Серия: 0010115

Реагент 1	2 фл. х 65 мл
Реагент 2	2 фл. х 20 мл
Калибратор	1 фл. х 3,0 мл

CE IVD

EC REP CPartner4U, ESDOORNLAAN 13, 3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cpartner4u.eu

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А


КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Реагент 2 20 мл


Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2°C 18°C
АО "ДИАКОН-ДС"

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Калибратор 3,0 мл


Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2°C 18°C
АО "ДИАКОН-ДС"

2015/02/19

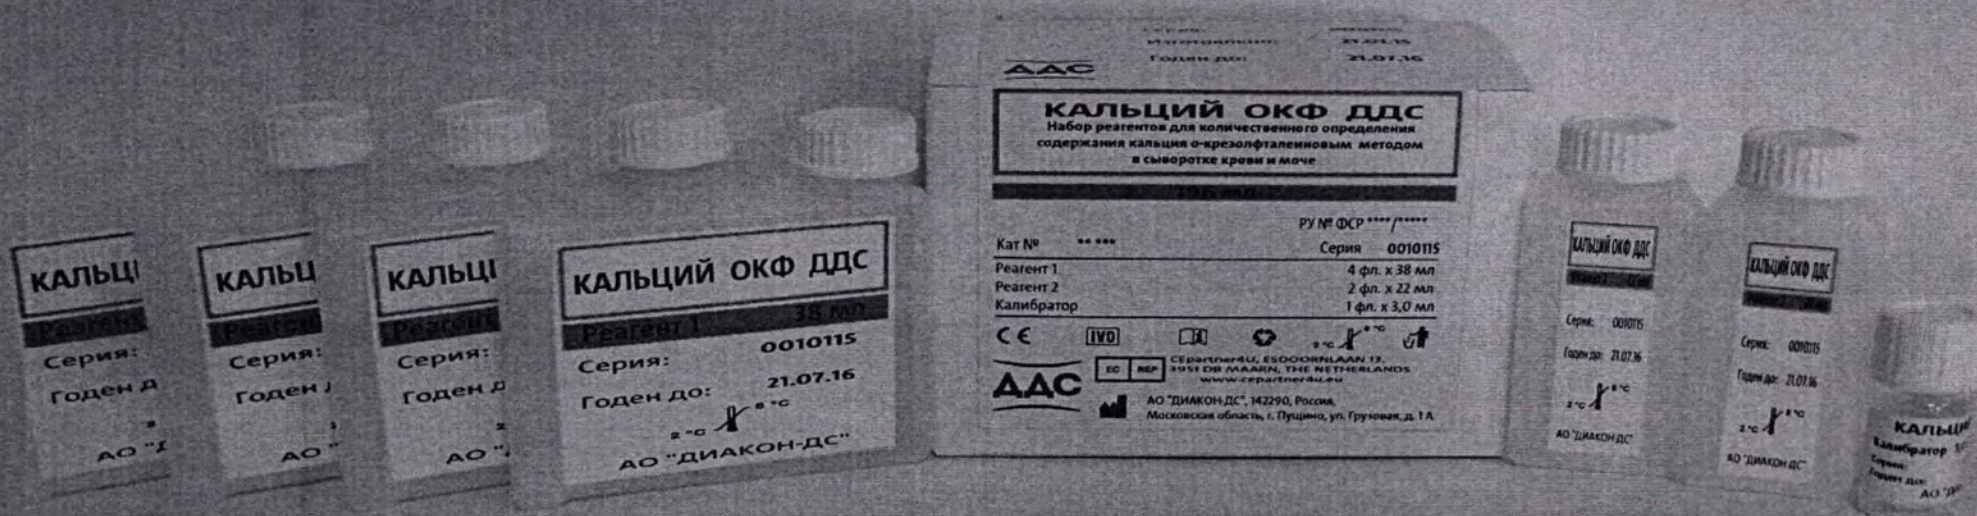

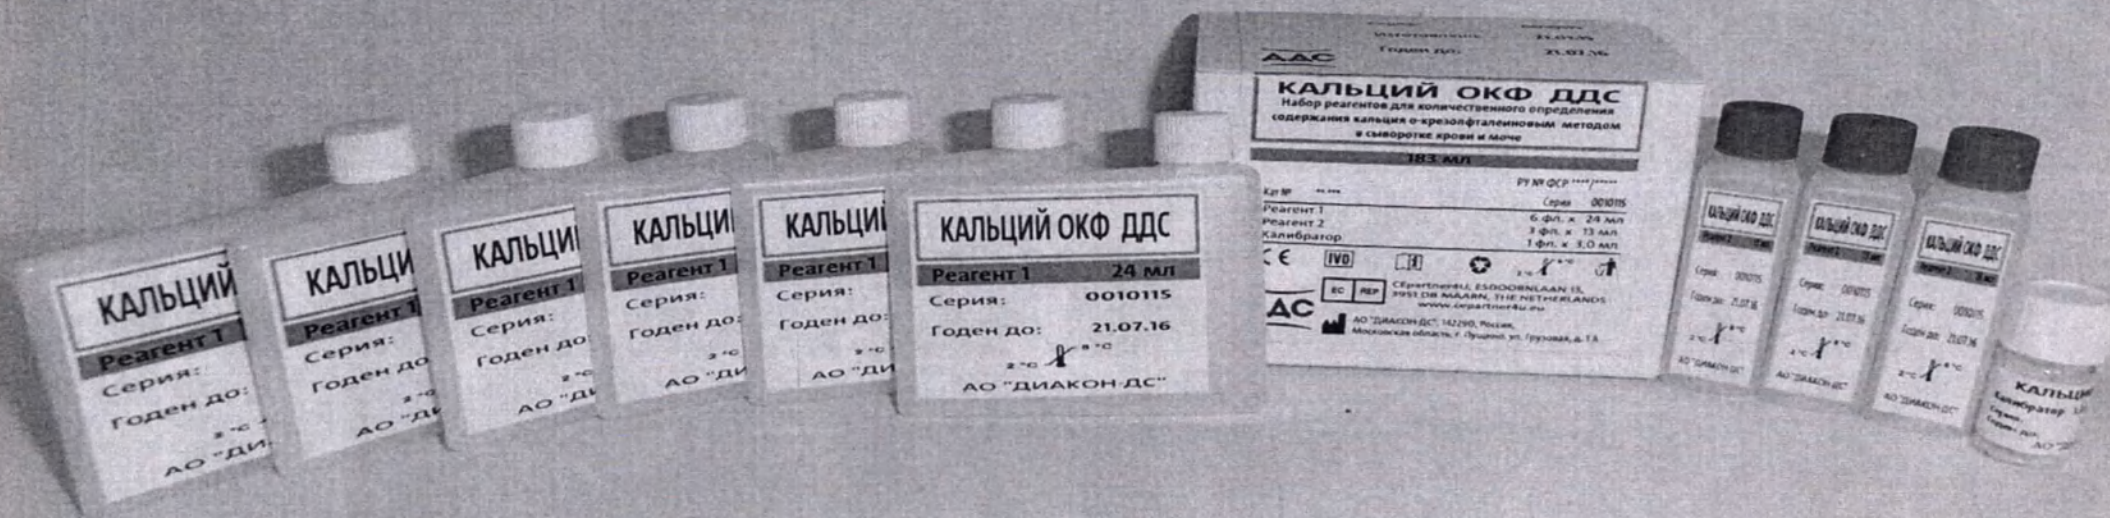

2015/02/19

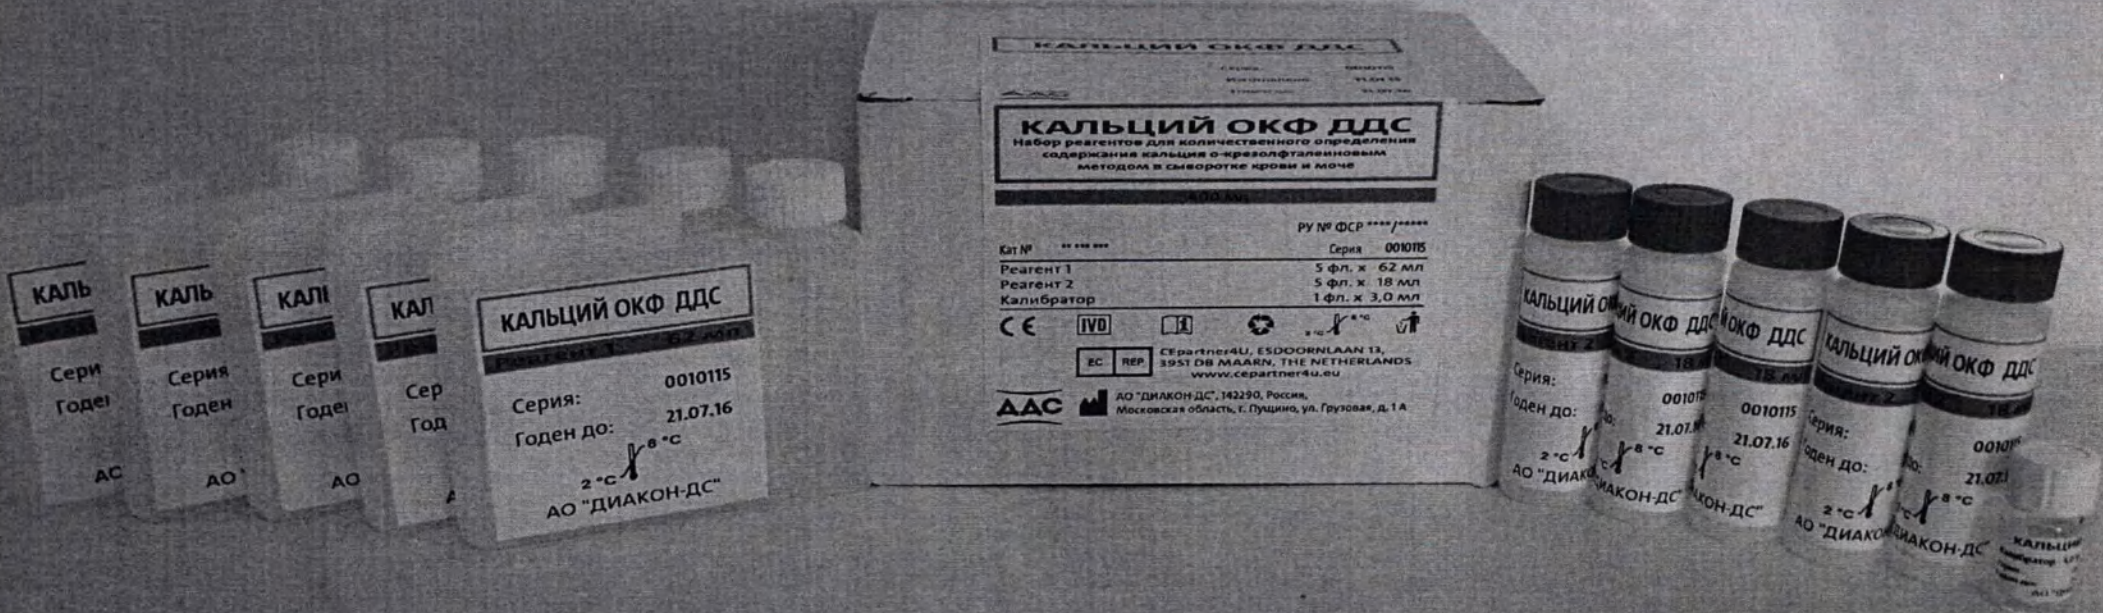



КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Реагент 1 62 мл
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2 °C / 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Реагент 1 62 мл
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2 °C / 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Набор реагентов для количественного определения содержания кальция в сыворотке крови и моче методом в-крезолфталеиновым

Кат №	00 040 000	Серия	0010115
Реагент 1	2 фл. х 62 мл		
Реагент 2	2 фл. х 18 мл		
Калибратор	1 фл. х 3,0 мл		


CE IVD

ЕС REP CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS www.cepartner4u.eu

ДДС АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Реагент 2 18 мл
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2 °C / 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Калибратор 3,0 мл
Серия: 0010115
Годен до: 21.07.16
2 °C / 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

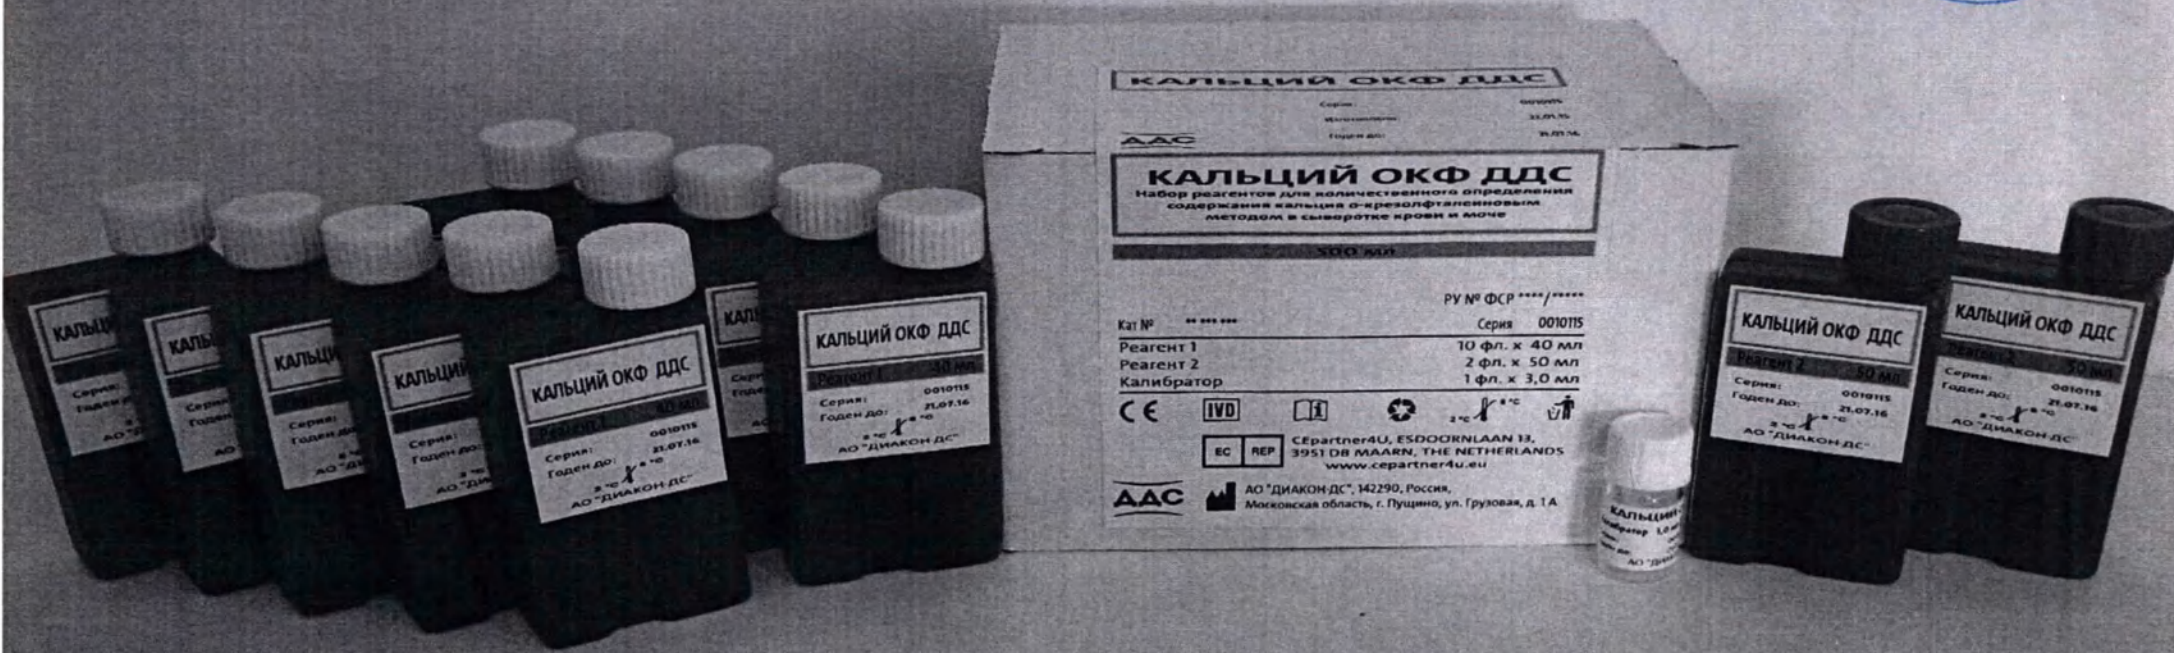

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС

Серия: 0010118
Годен до: 21.07.16

КАЛЬЦИЙ ОКФ ДДС
Набор реагентов для количественного определения содержания кальция оксезофталениновым методом в сыворотке крови и моче


Кат №: 0010118
Серия: 0010118
Реагент 1: 10 фл. x 40 мл
Реагент 2: 2 фл. x 50 мл
Калибратор: 1 фл. x 3,0 мл


CE IVD

EC REP


CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пущино, ул. Грушовая, д. 1 А

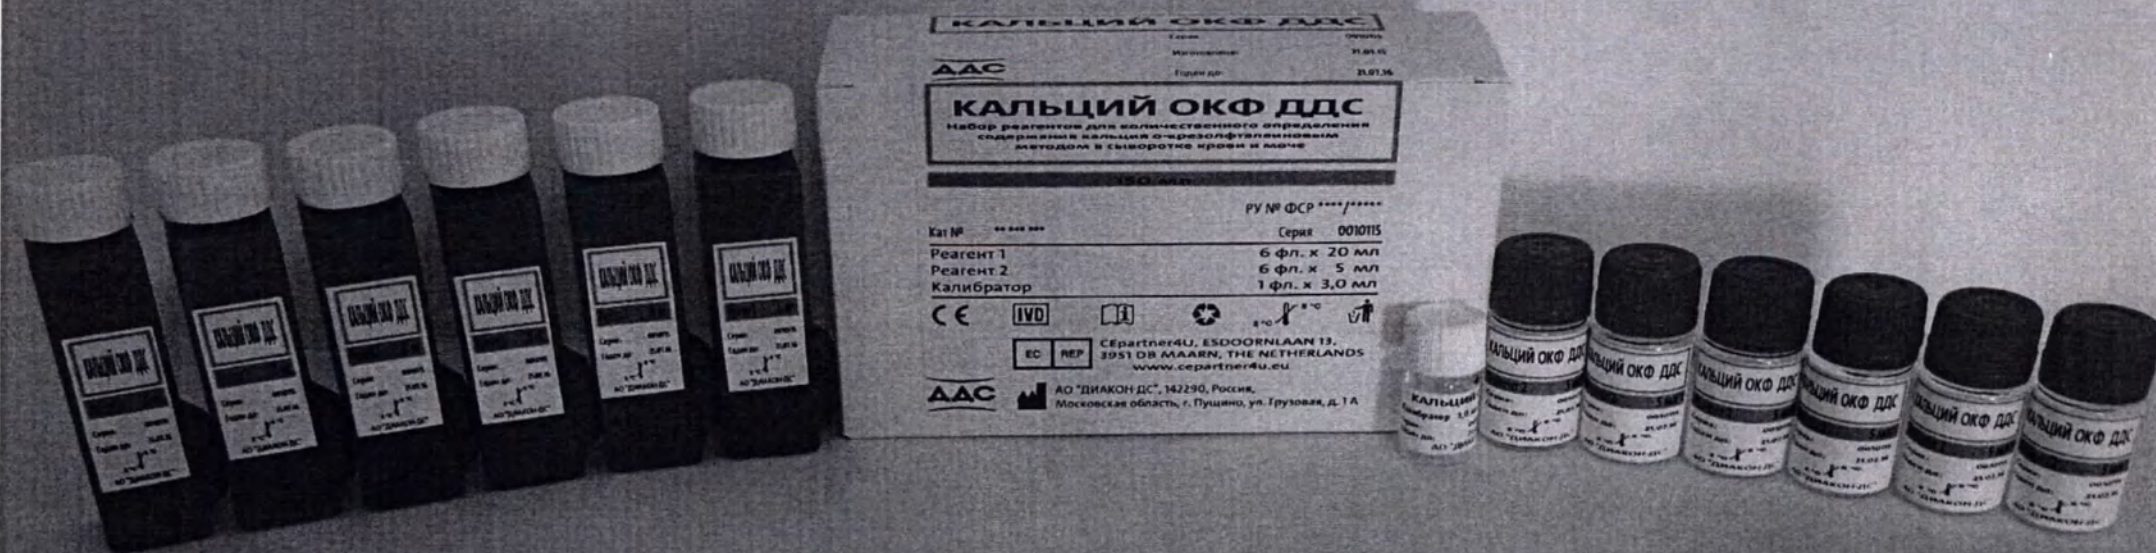

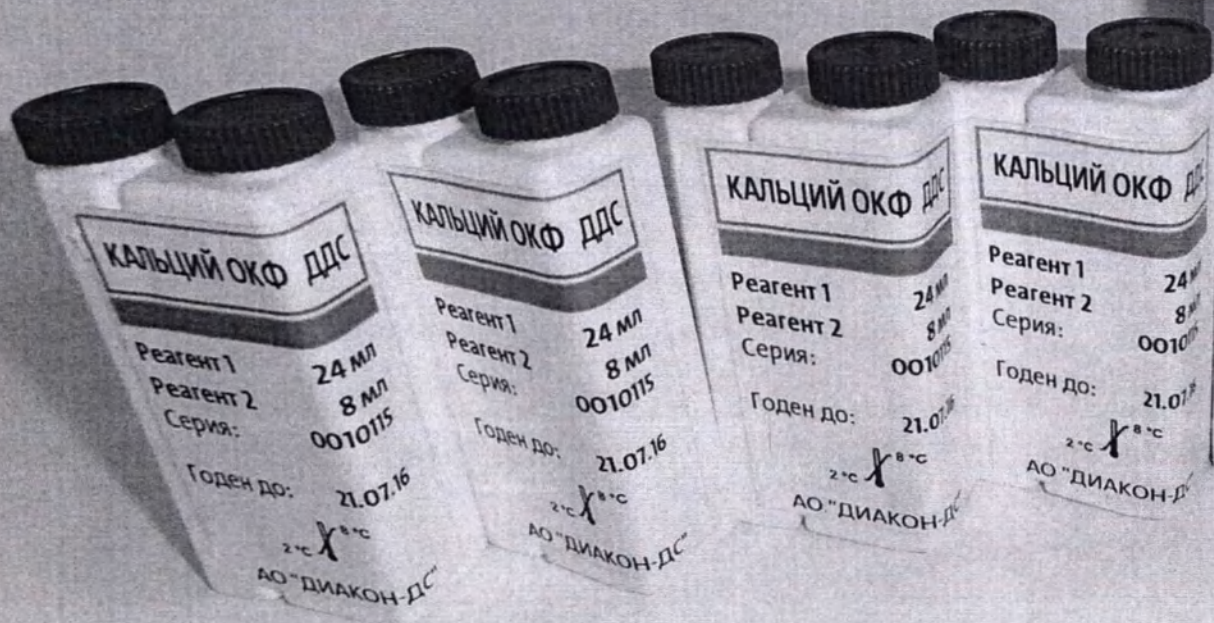

2015/02/20

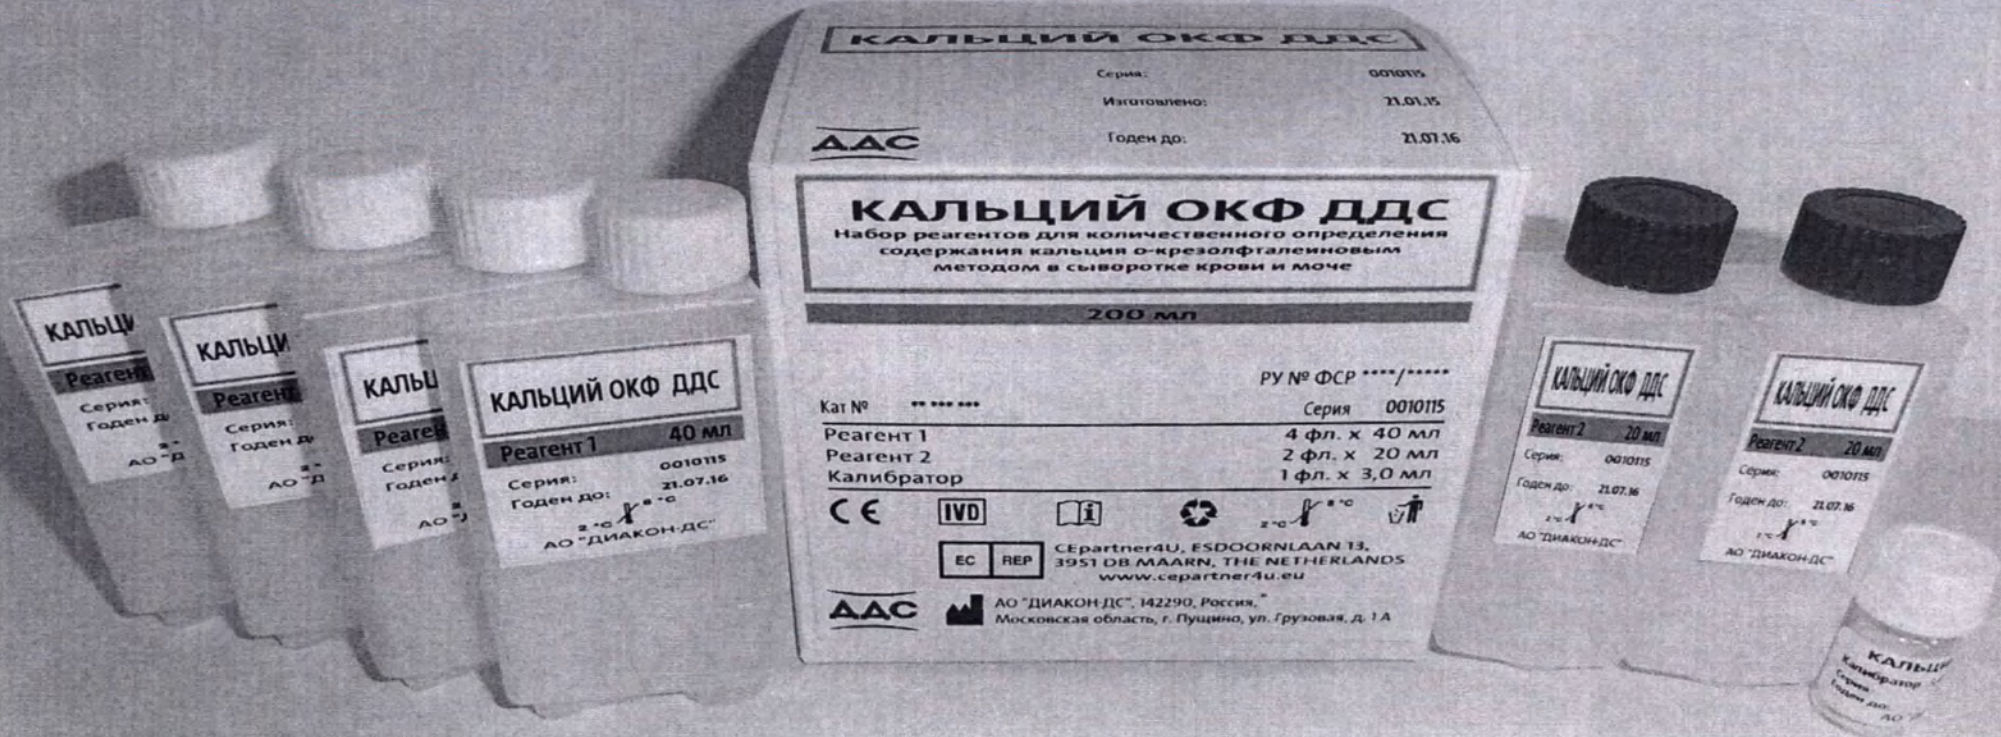

2015/02/20

20



2015/02/20



2015/02/25