


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

" Система компьютерной томографии Ingenuity Flex с принадлежностями "





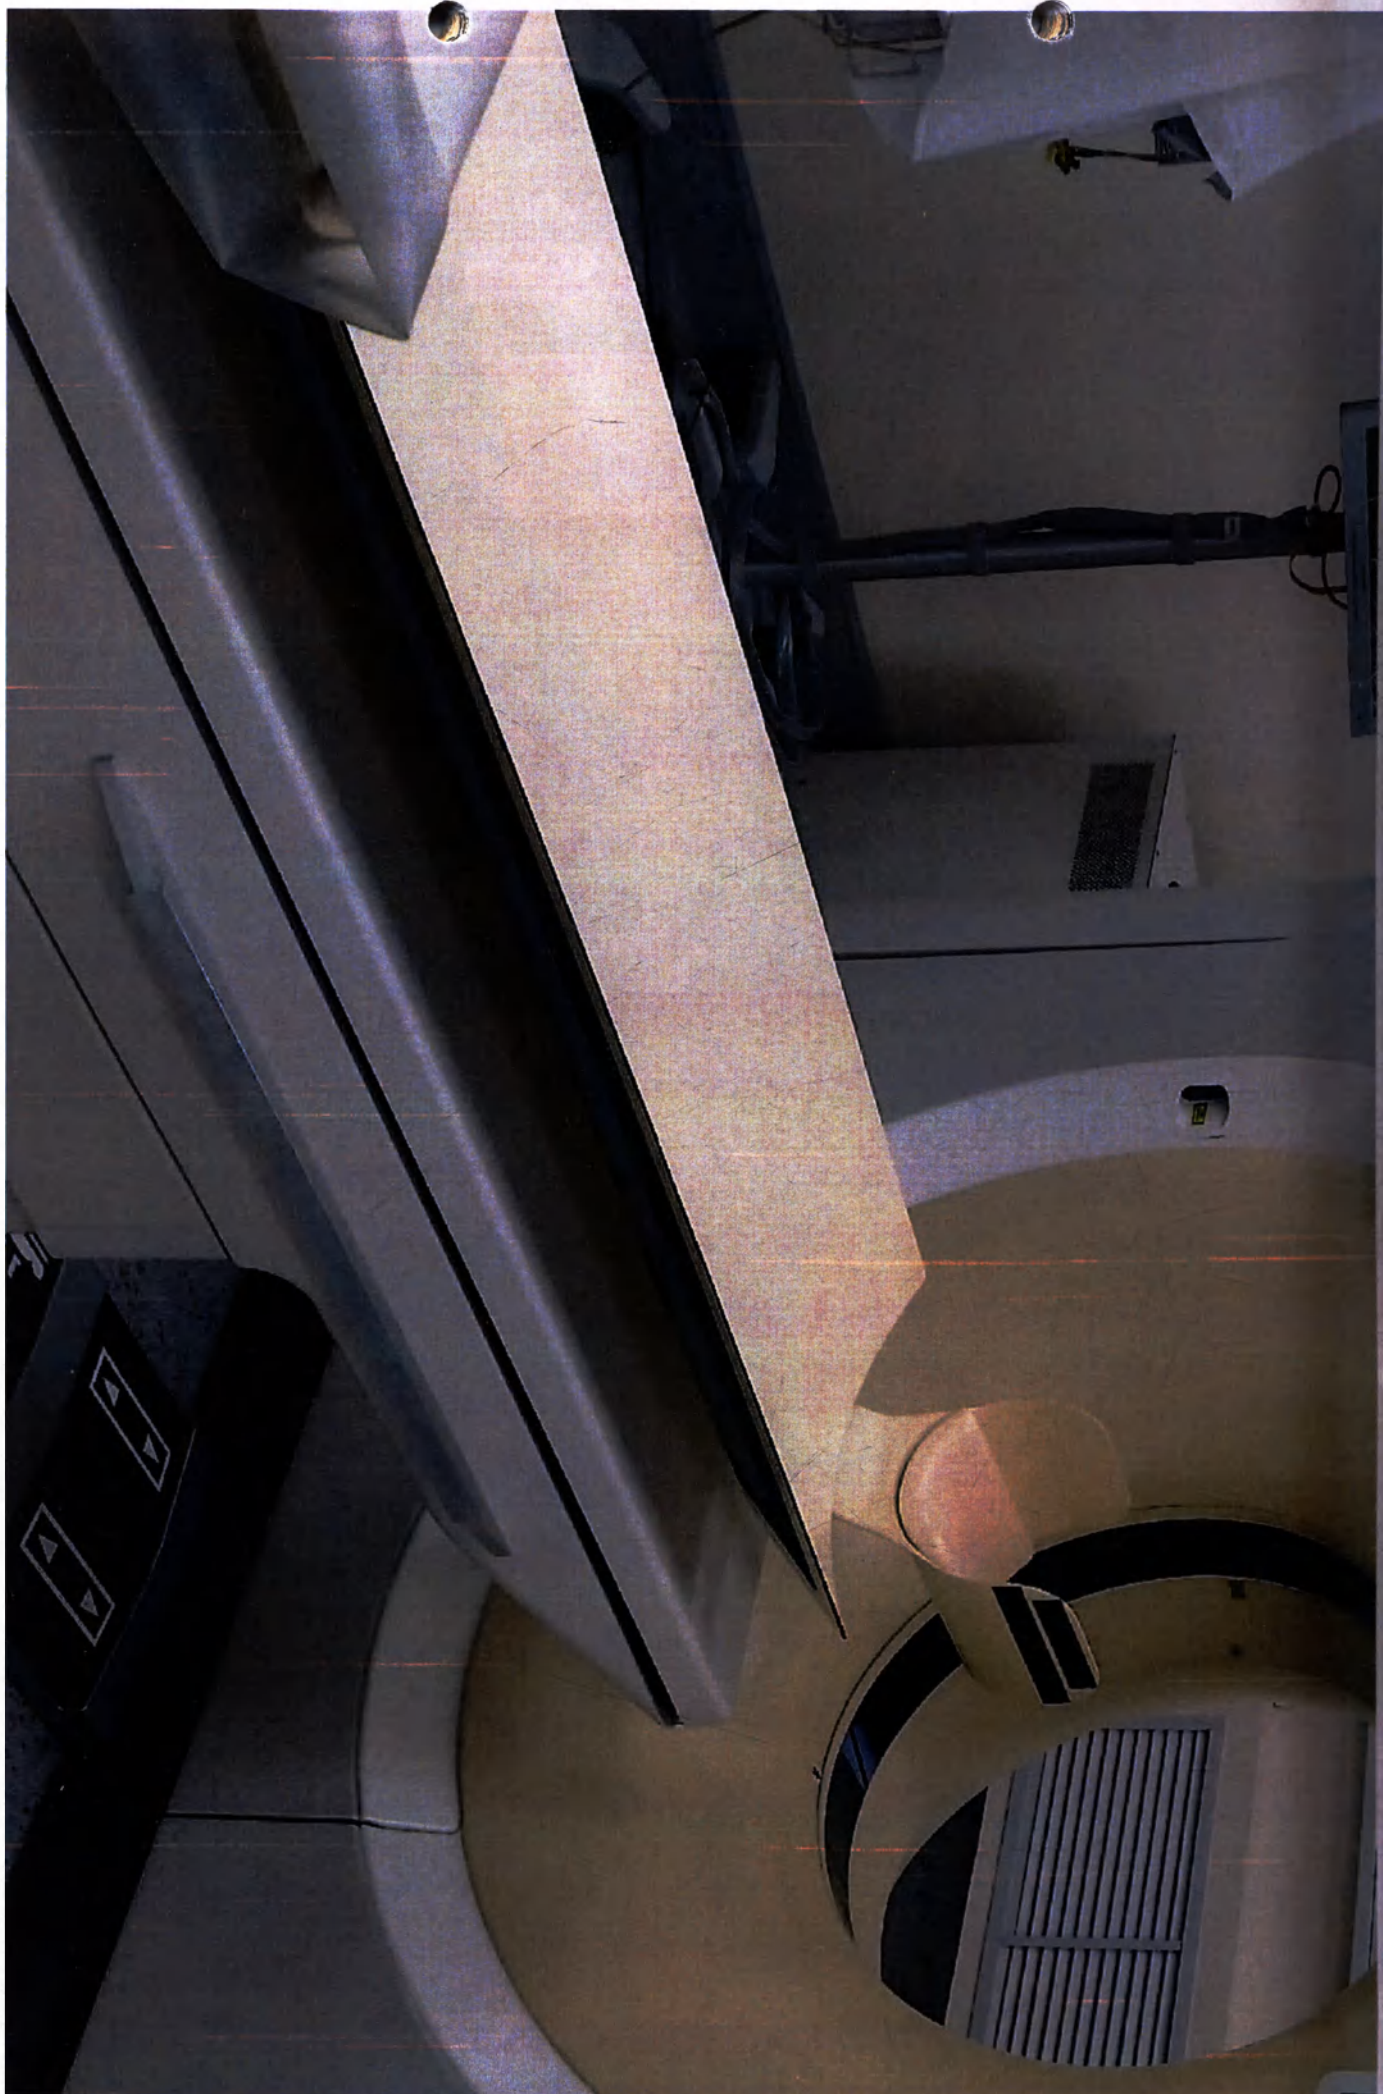


3.1 Блок компьютерный Dell с устройством чтения/записи CD/DVD;






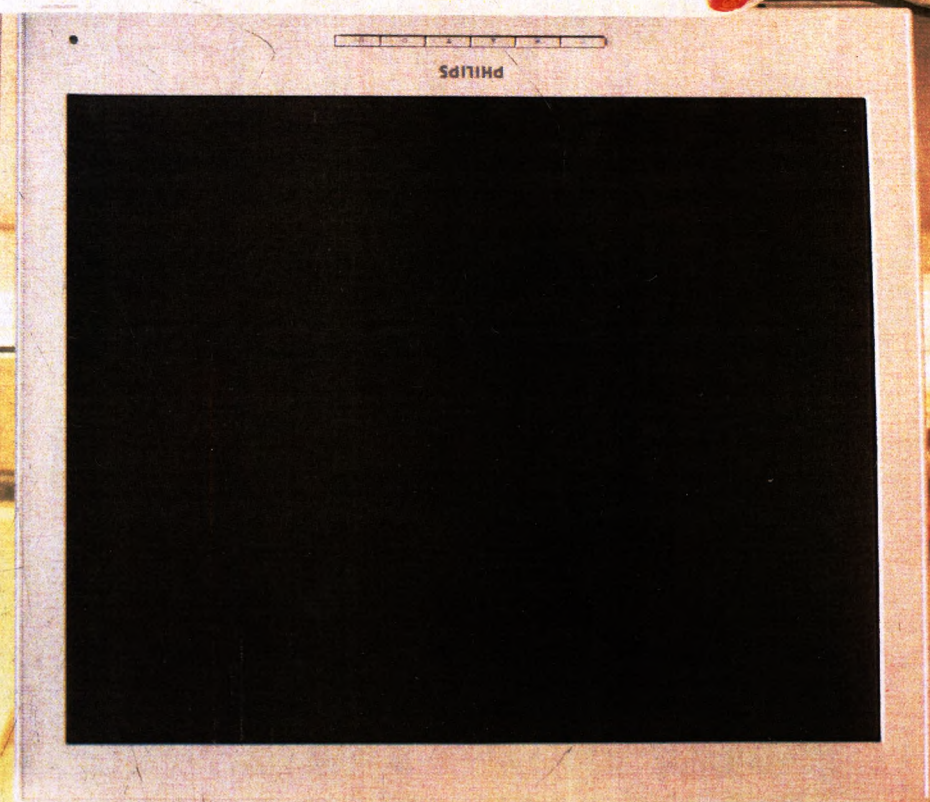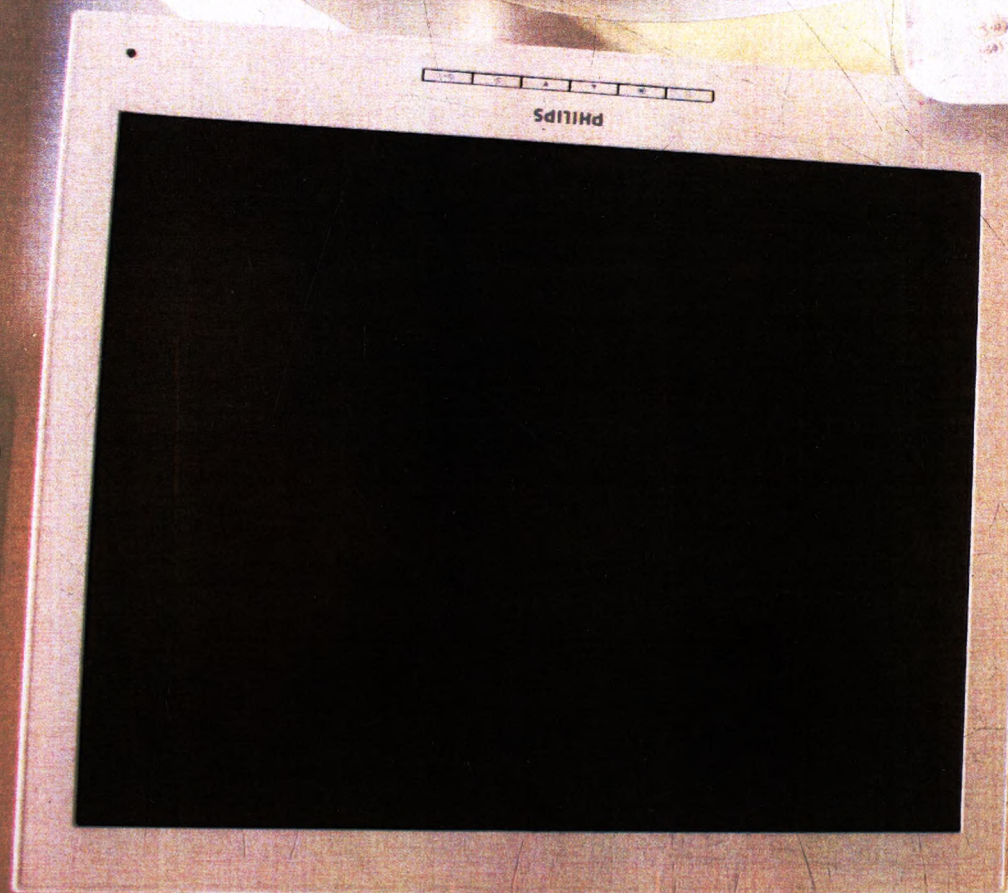


**DO NOT REMOVE PROTECTIVE FOIL
BEFORE FINAL INSTALLATION**

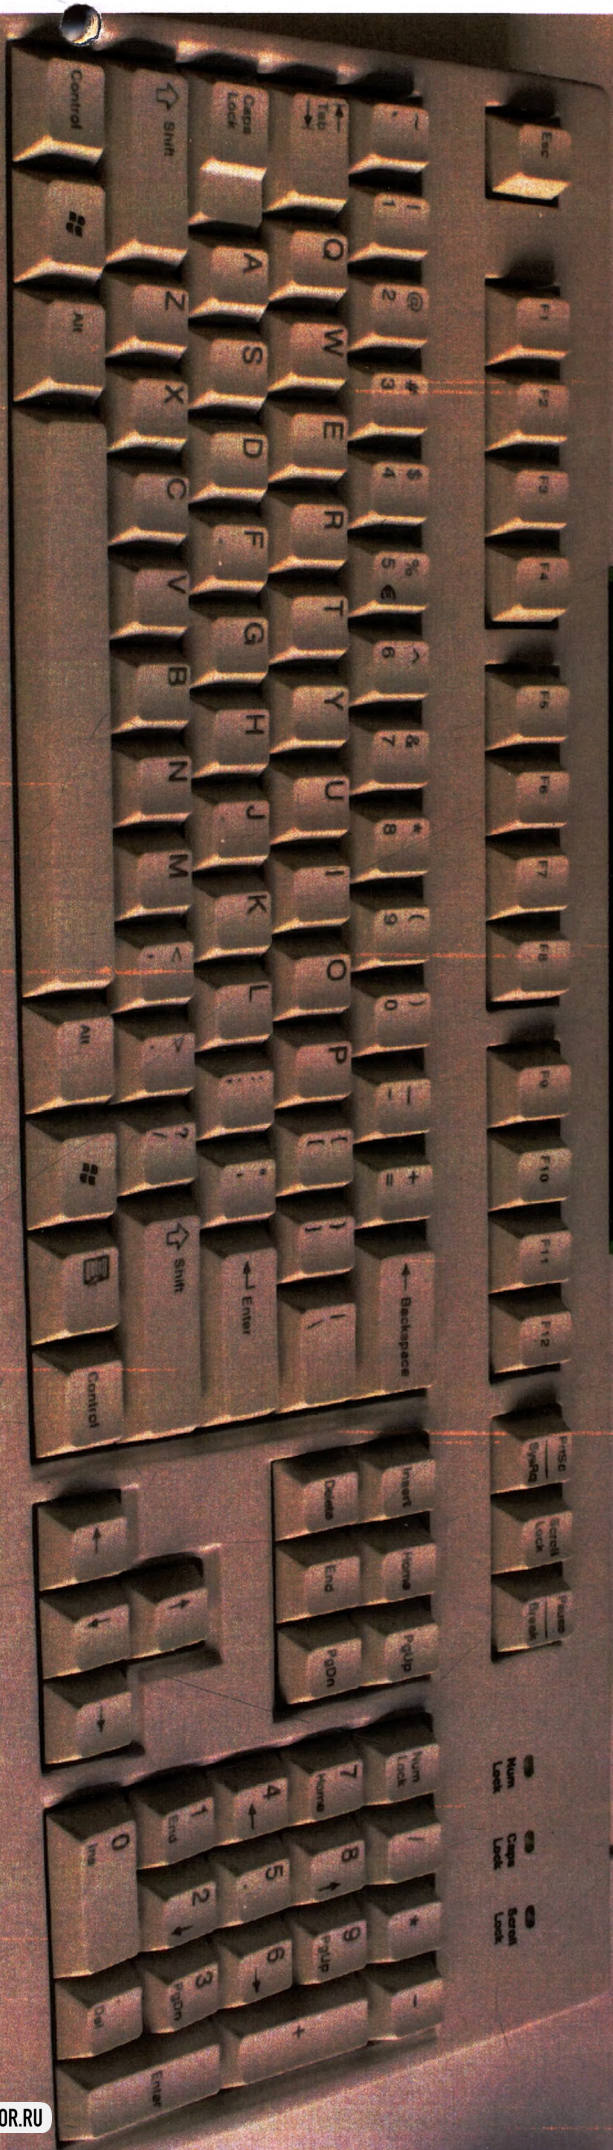

**DO NOT REMOVE PROTECTIVE FOIL
BEFORE FINAL INSTALLATION**

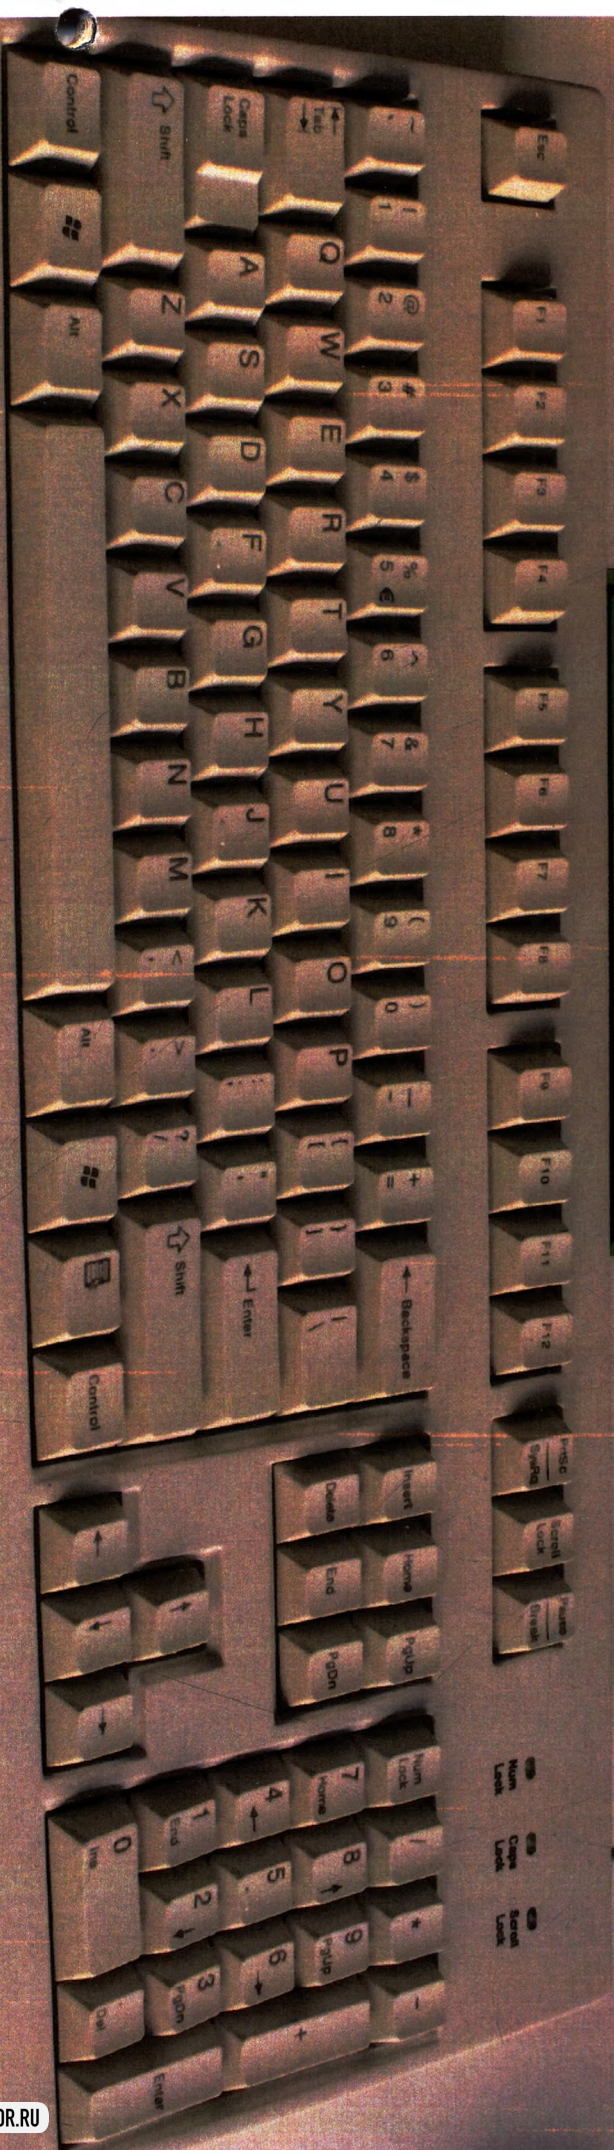



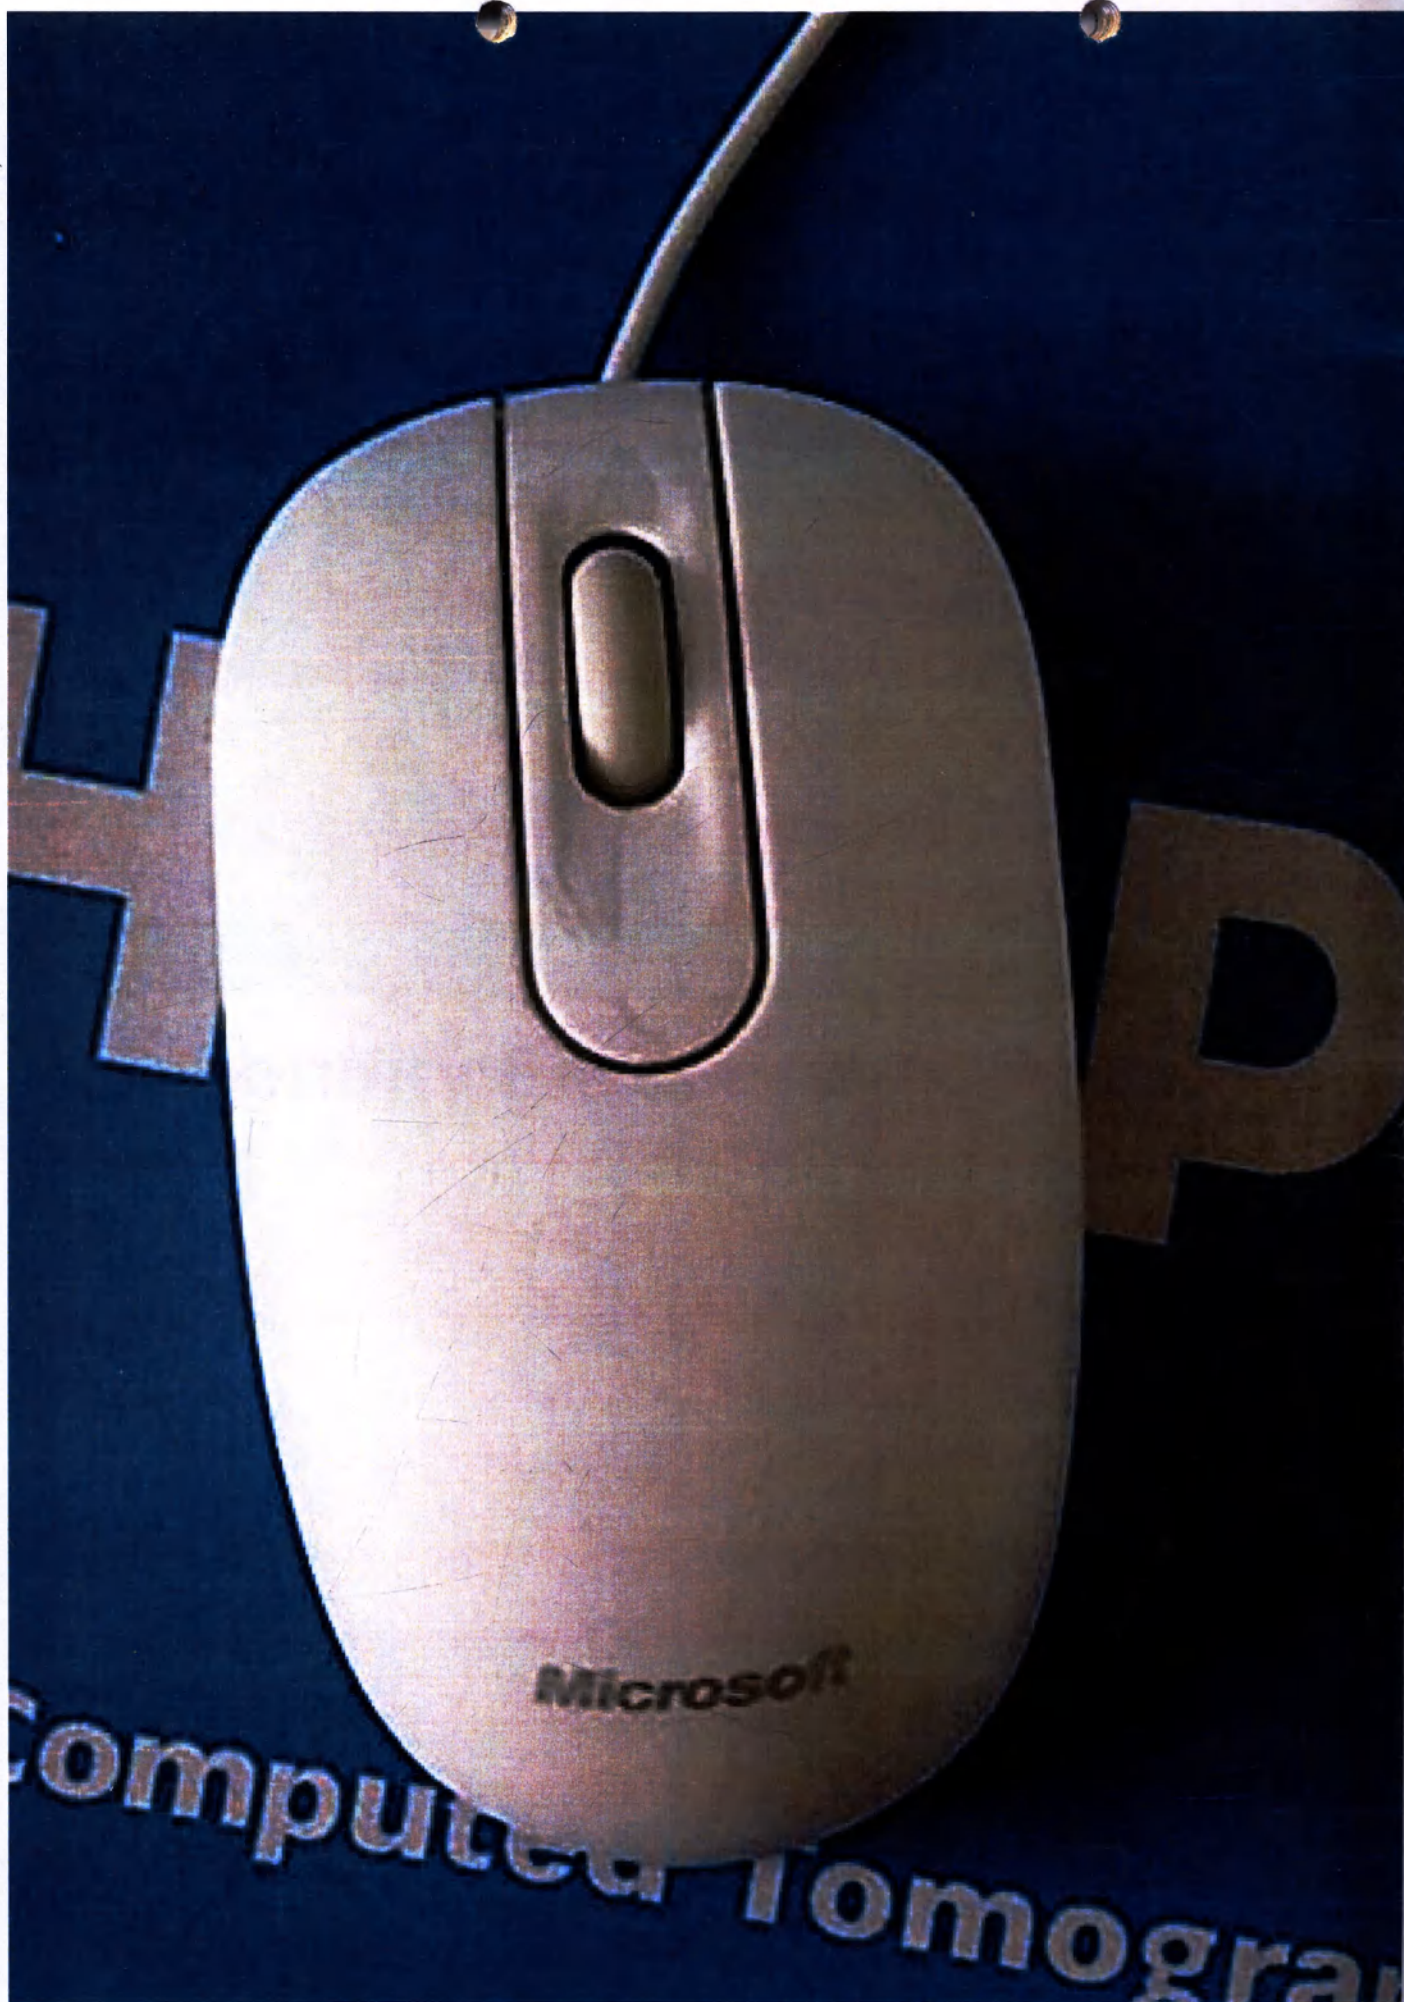

Russian



Руководство по эксплуатации

Ingenuity Flex

459600381931_B



Richard D. Chilton

PHILIPS


1. Ремни для фиксации верхних конечностей (не более 2 шт.).











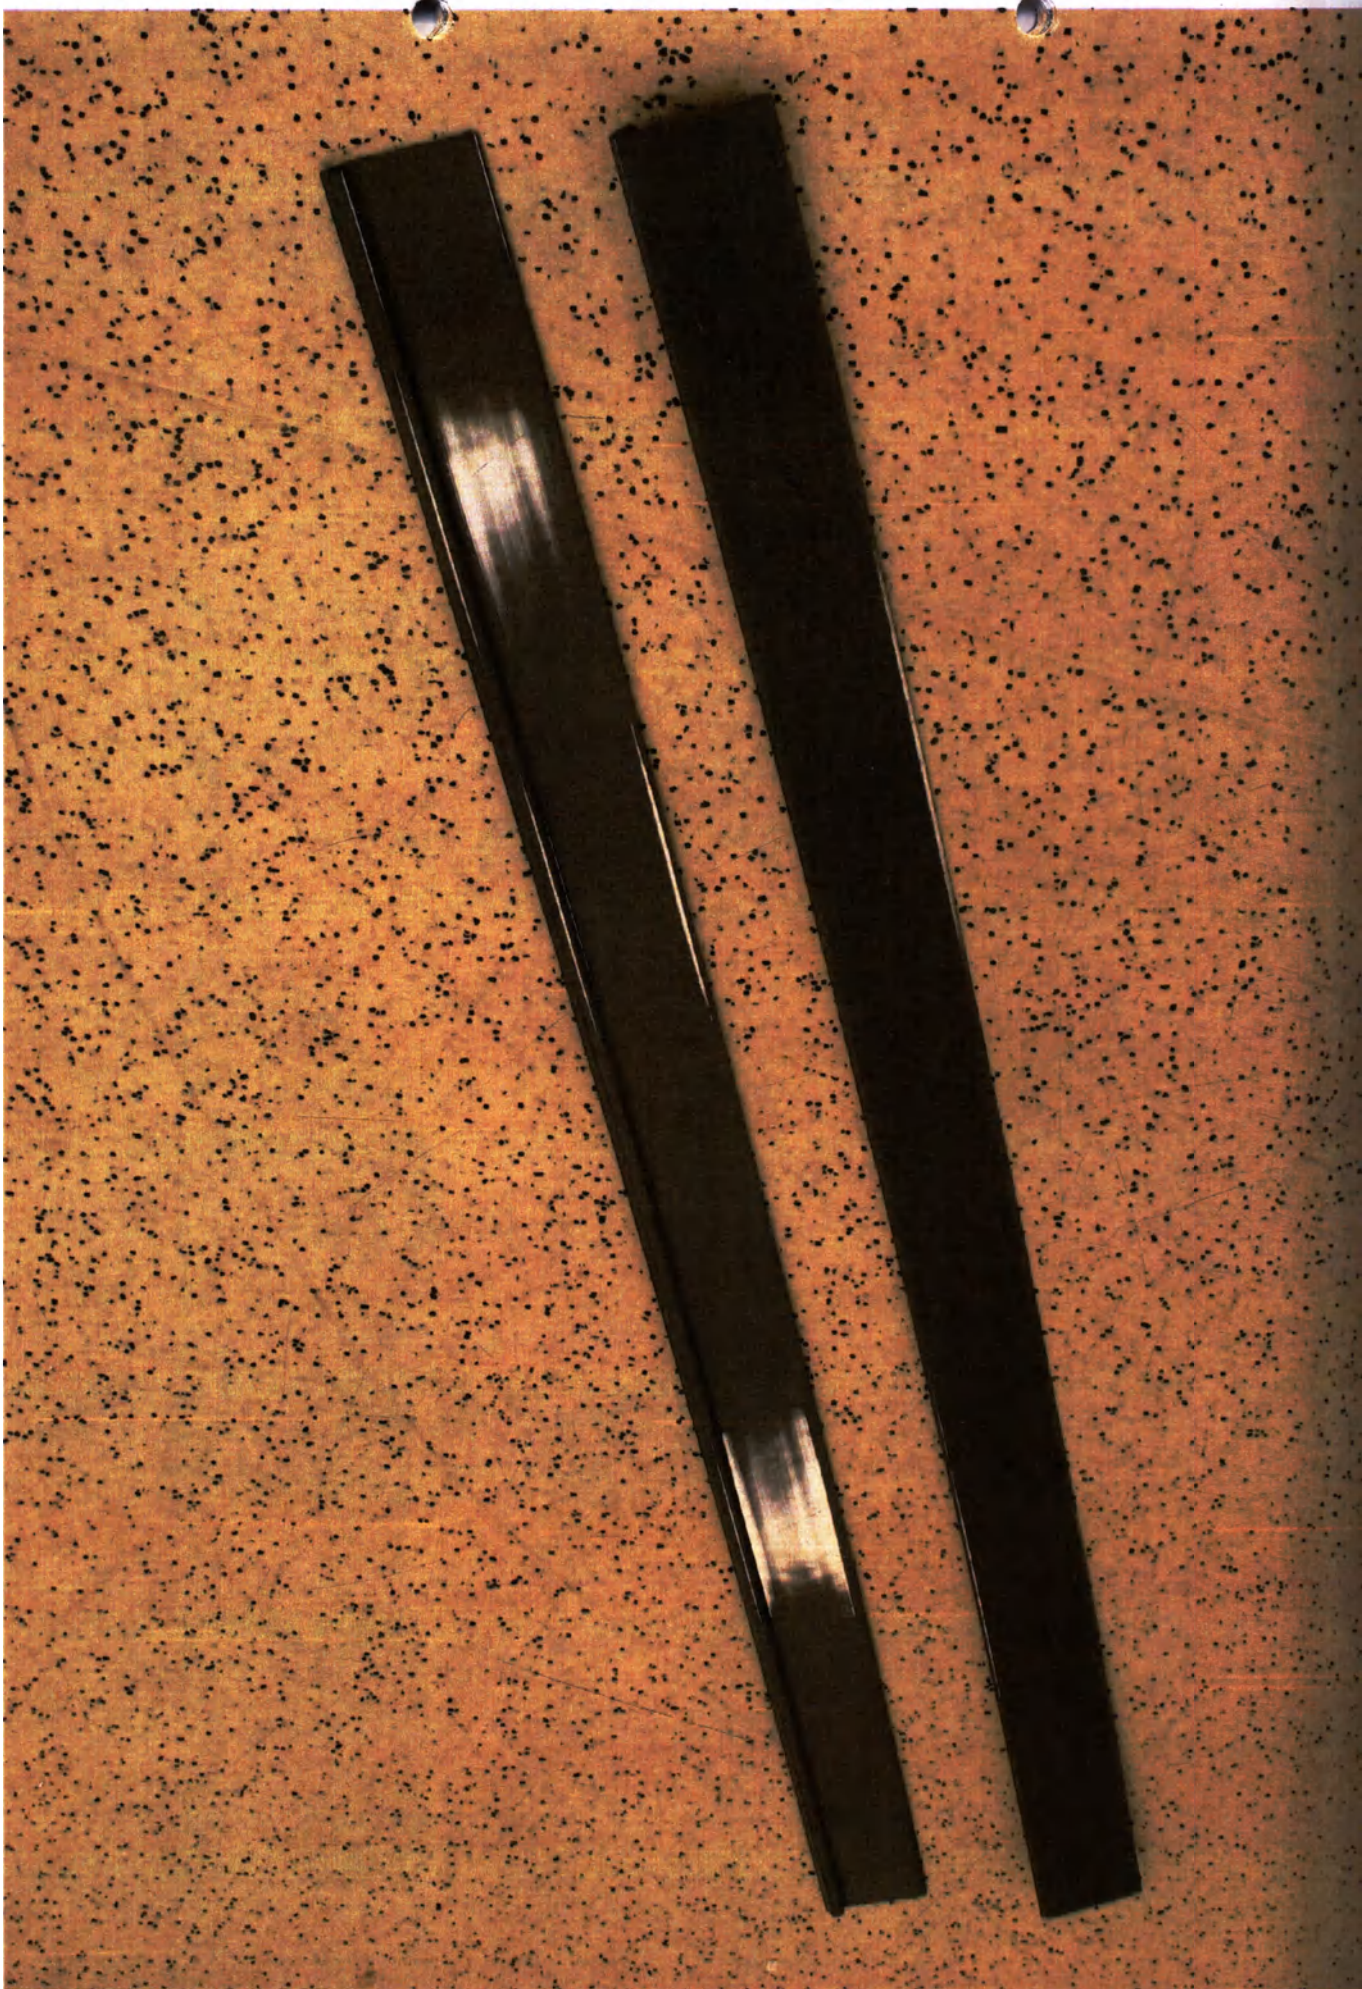






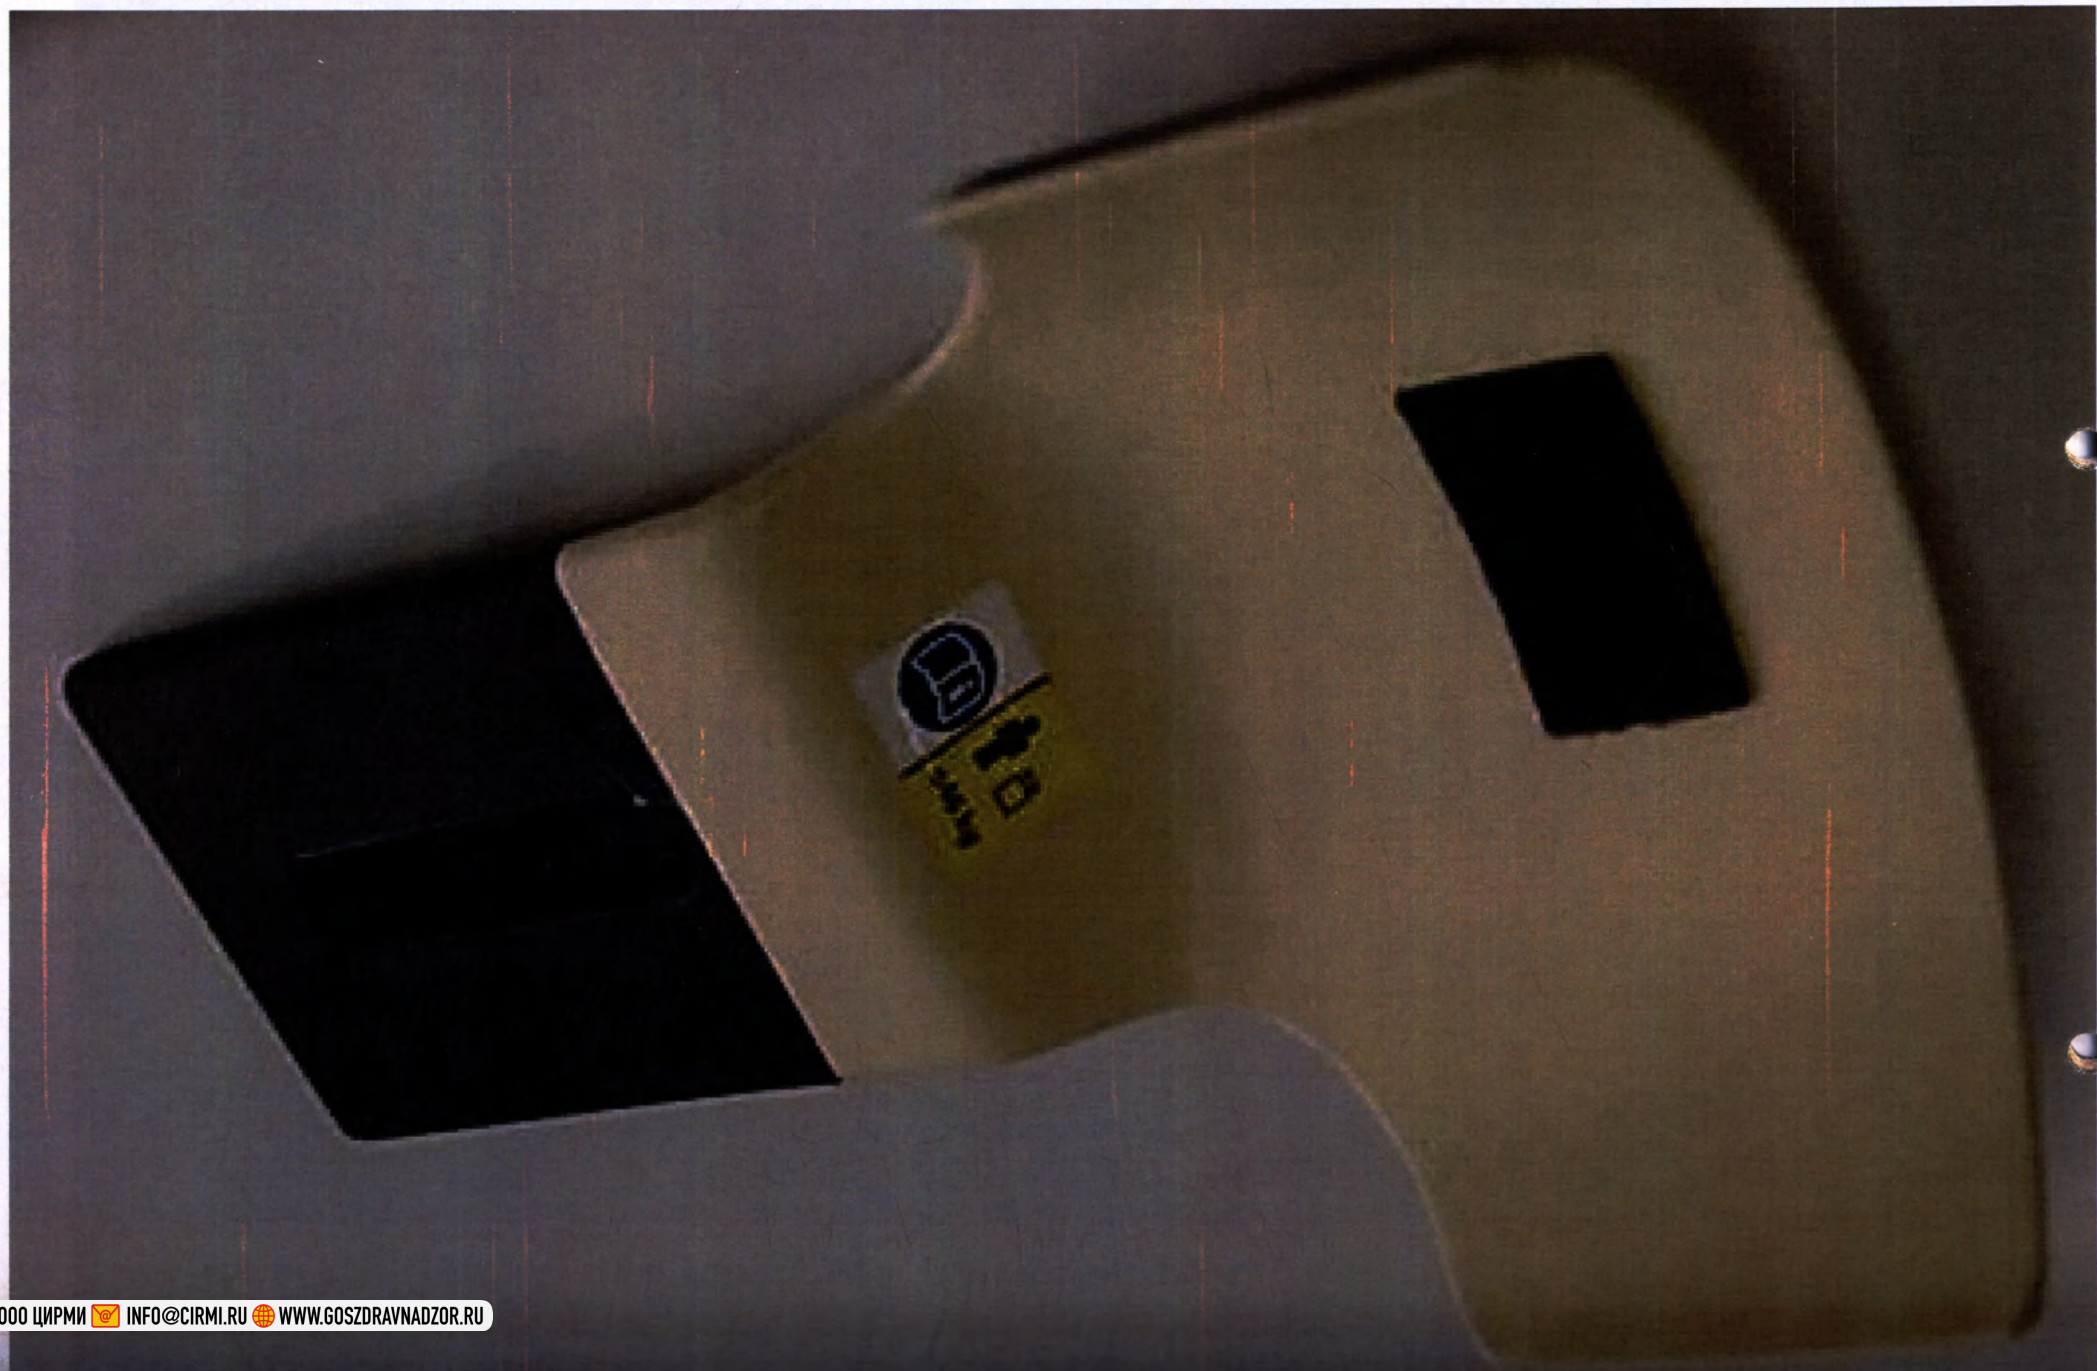

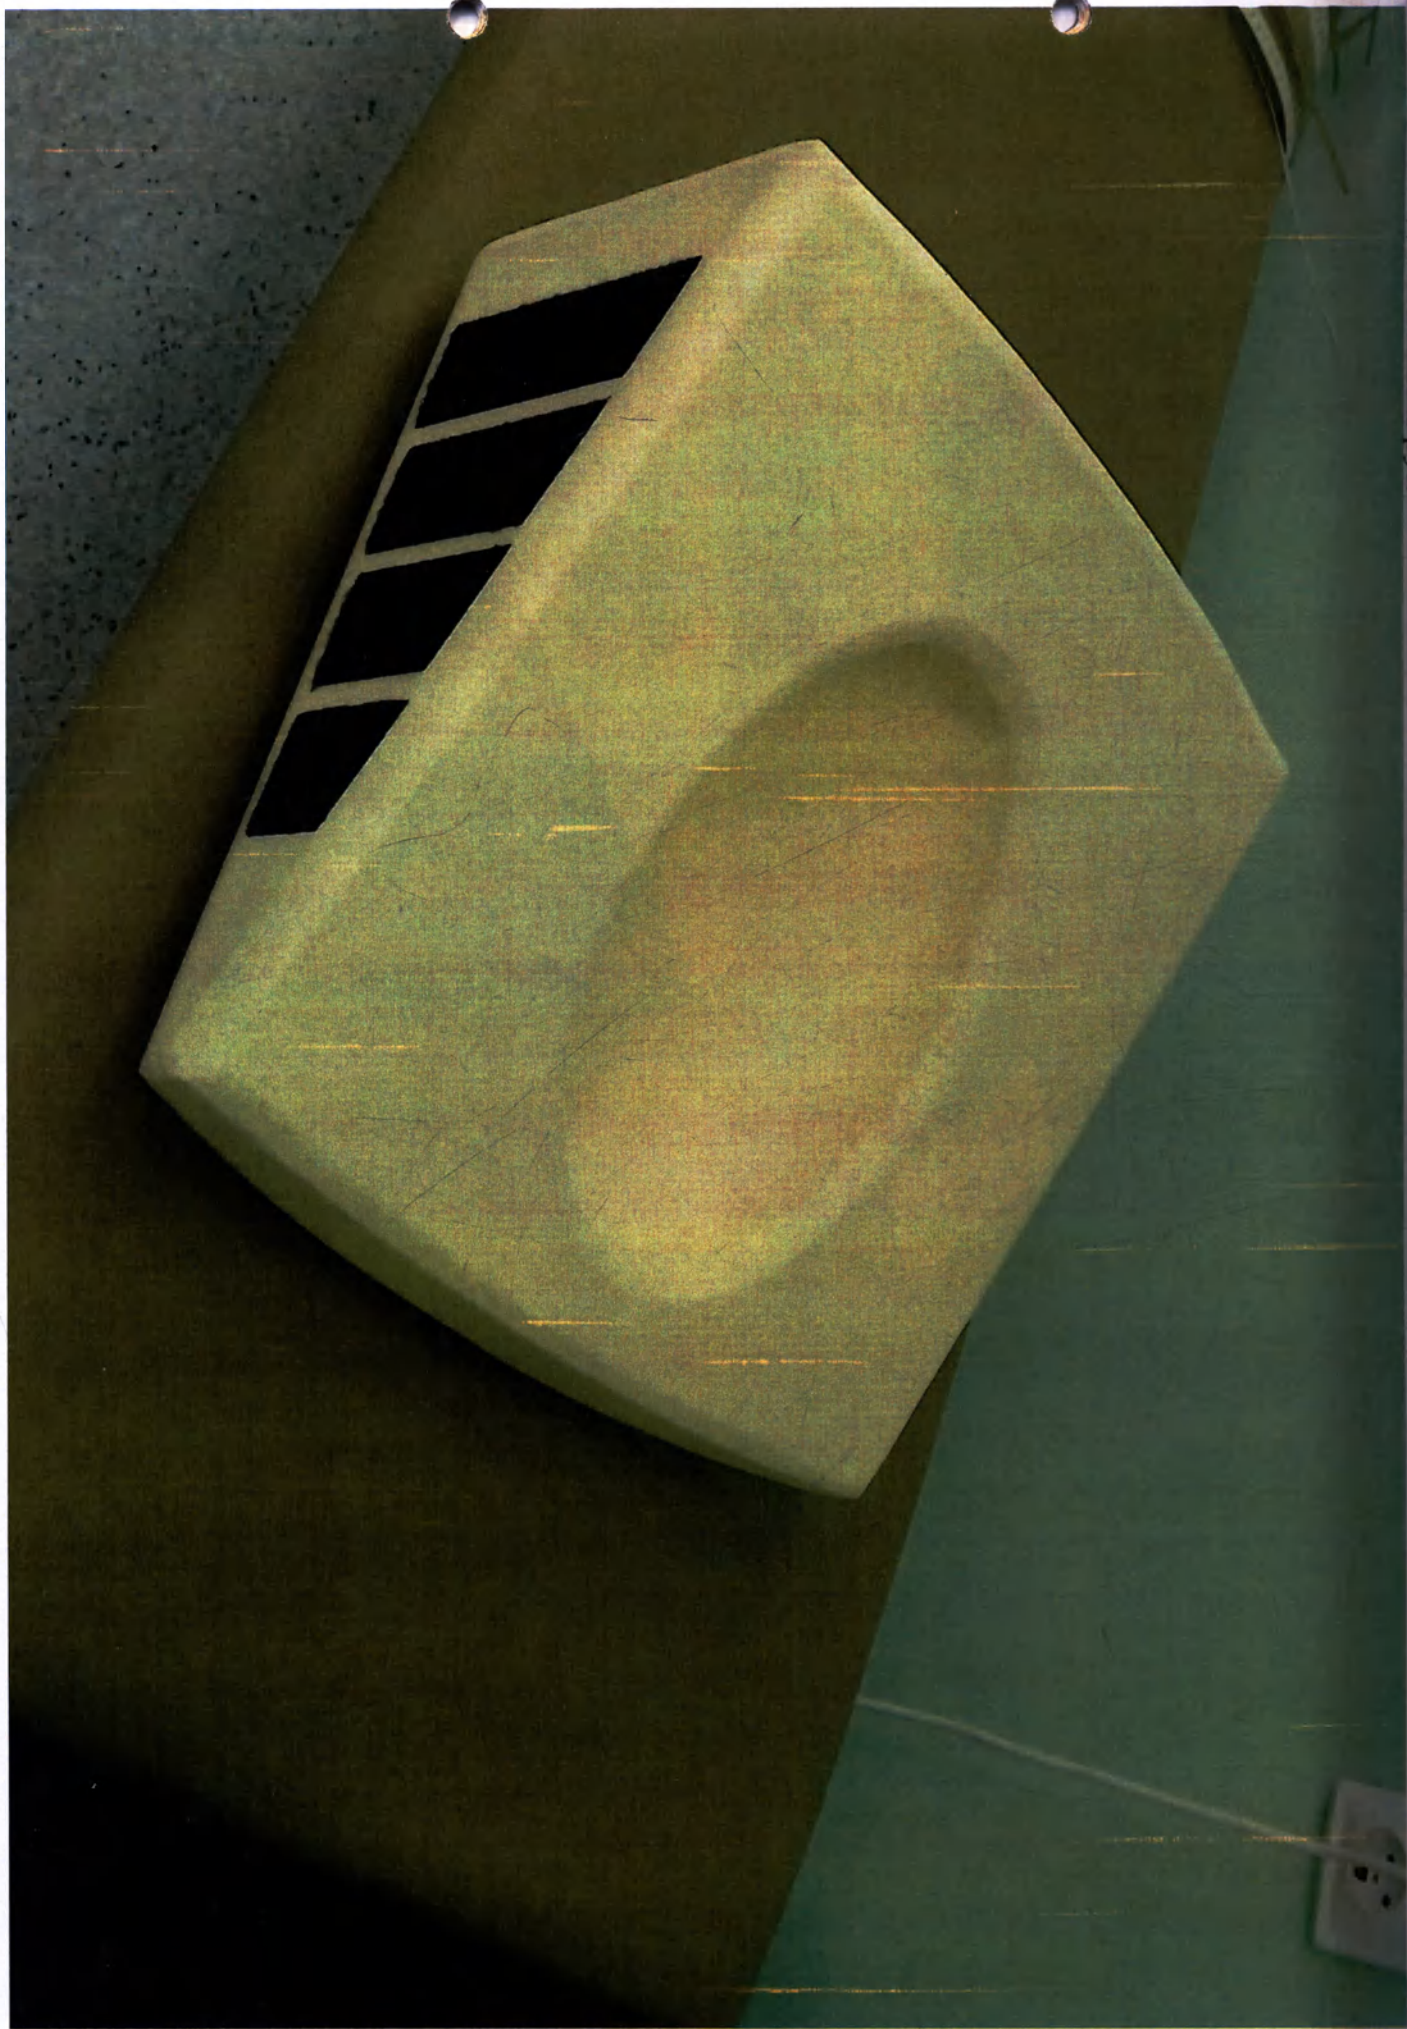





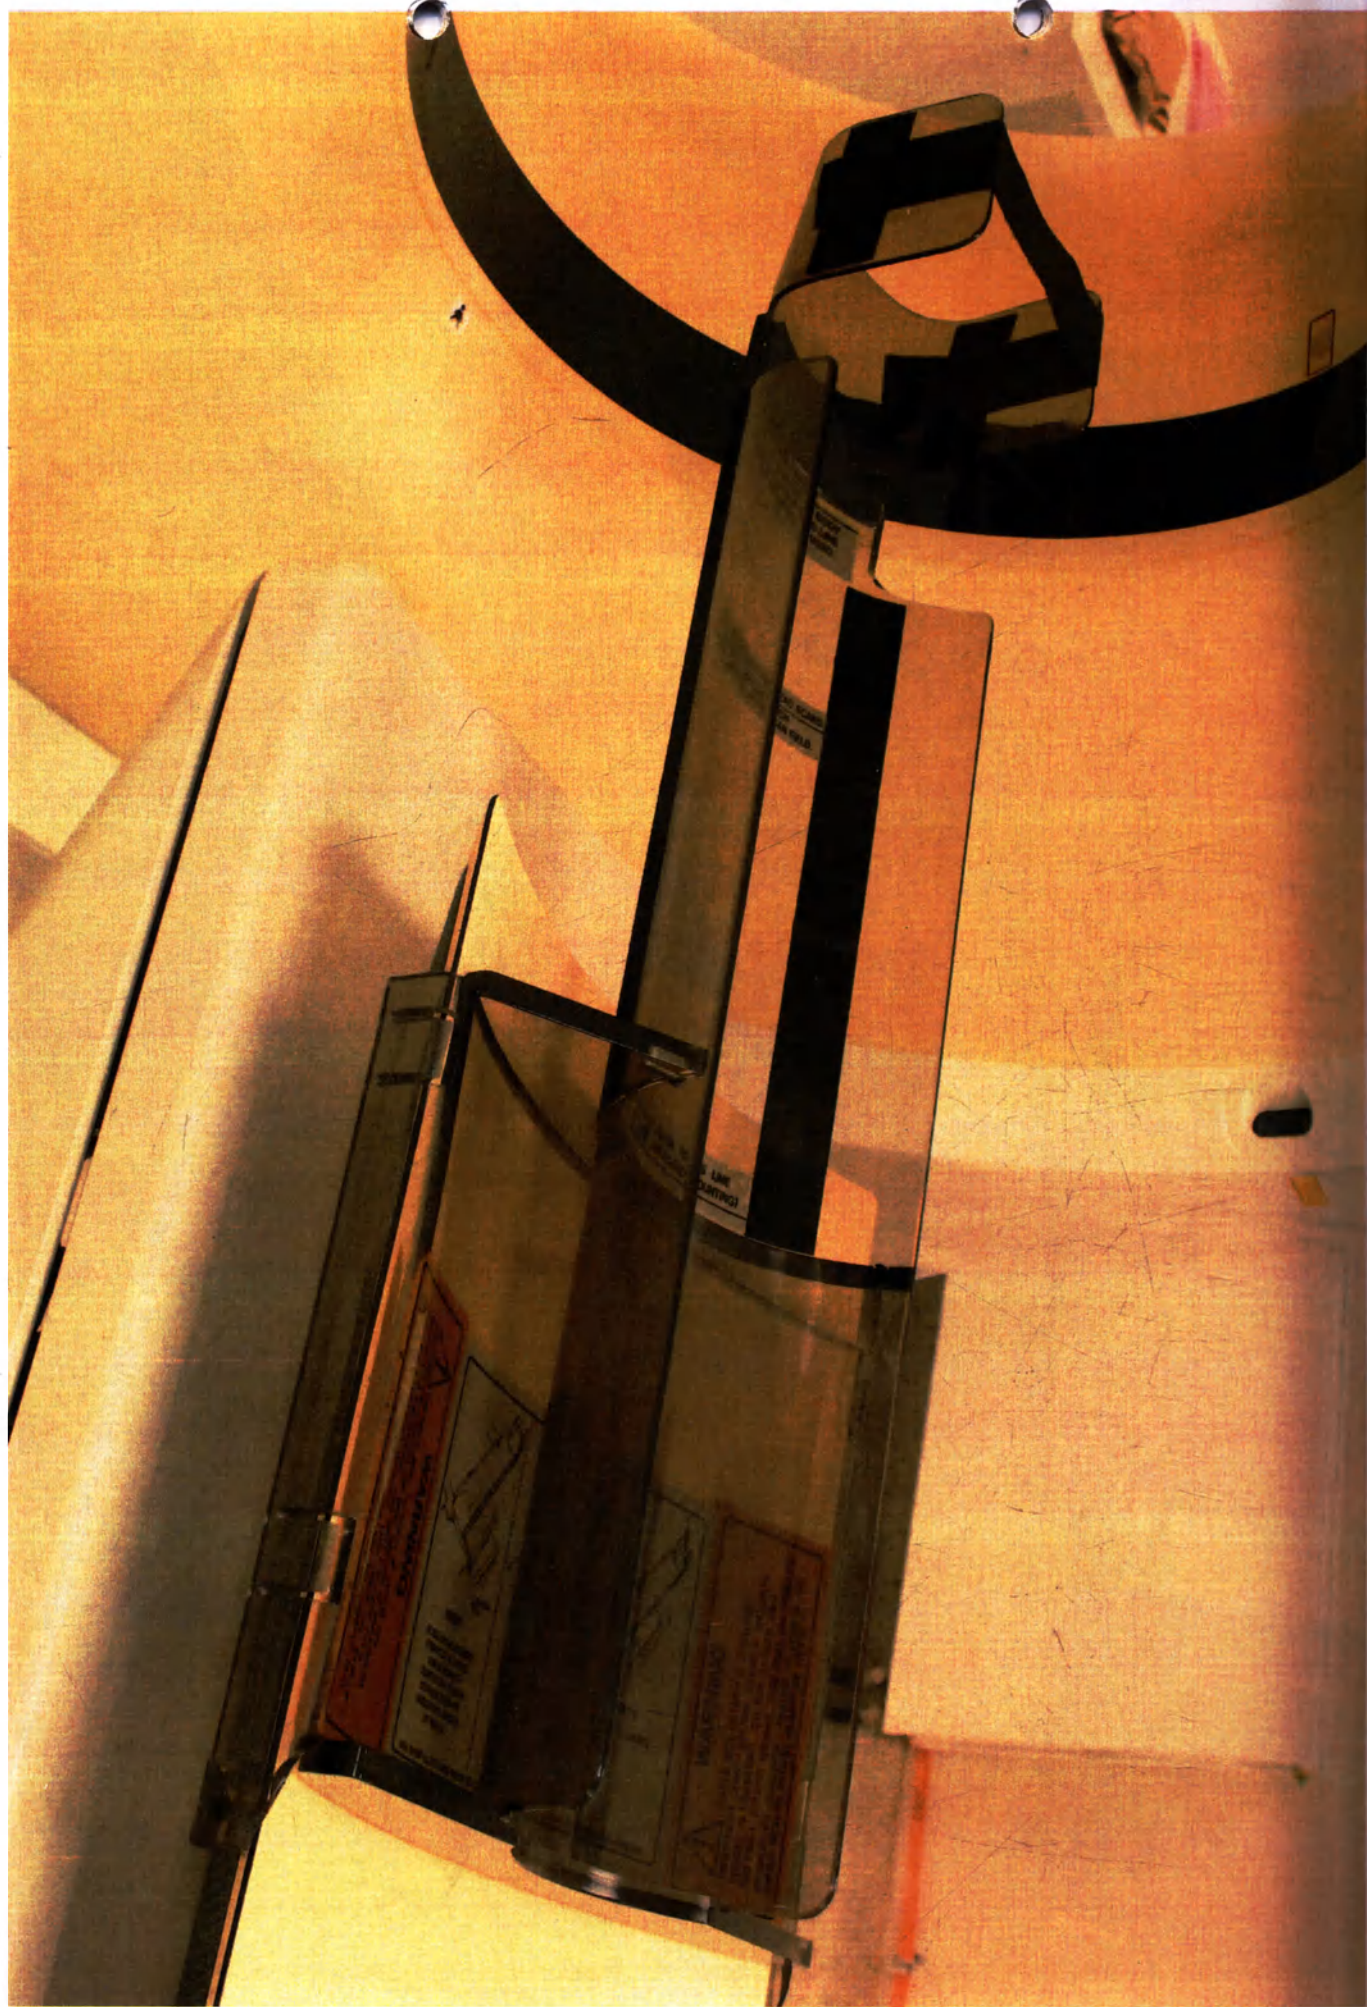





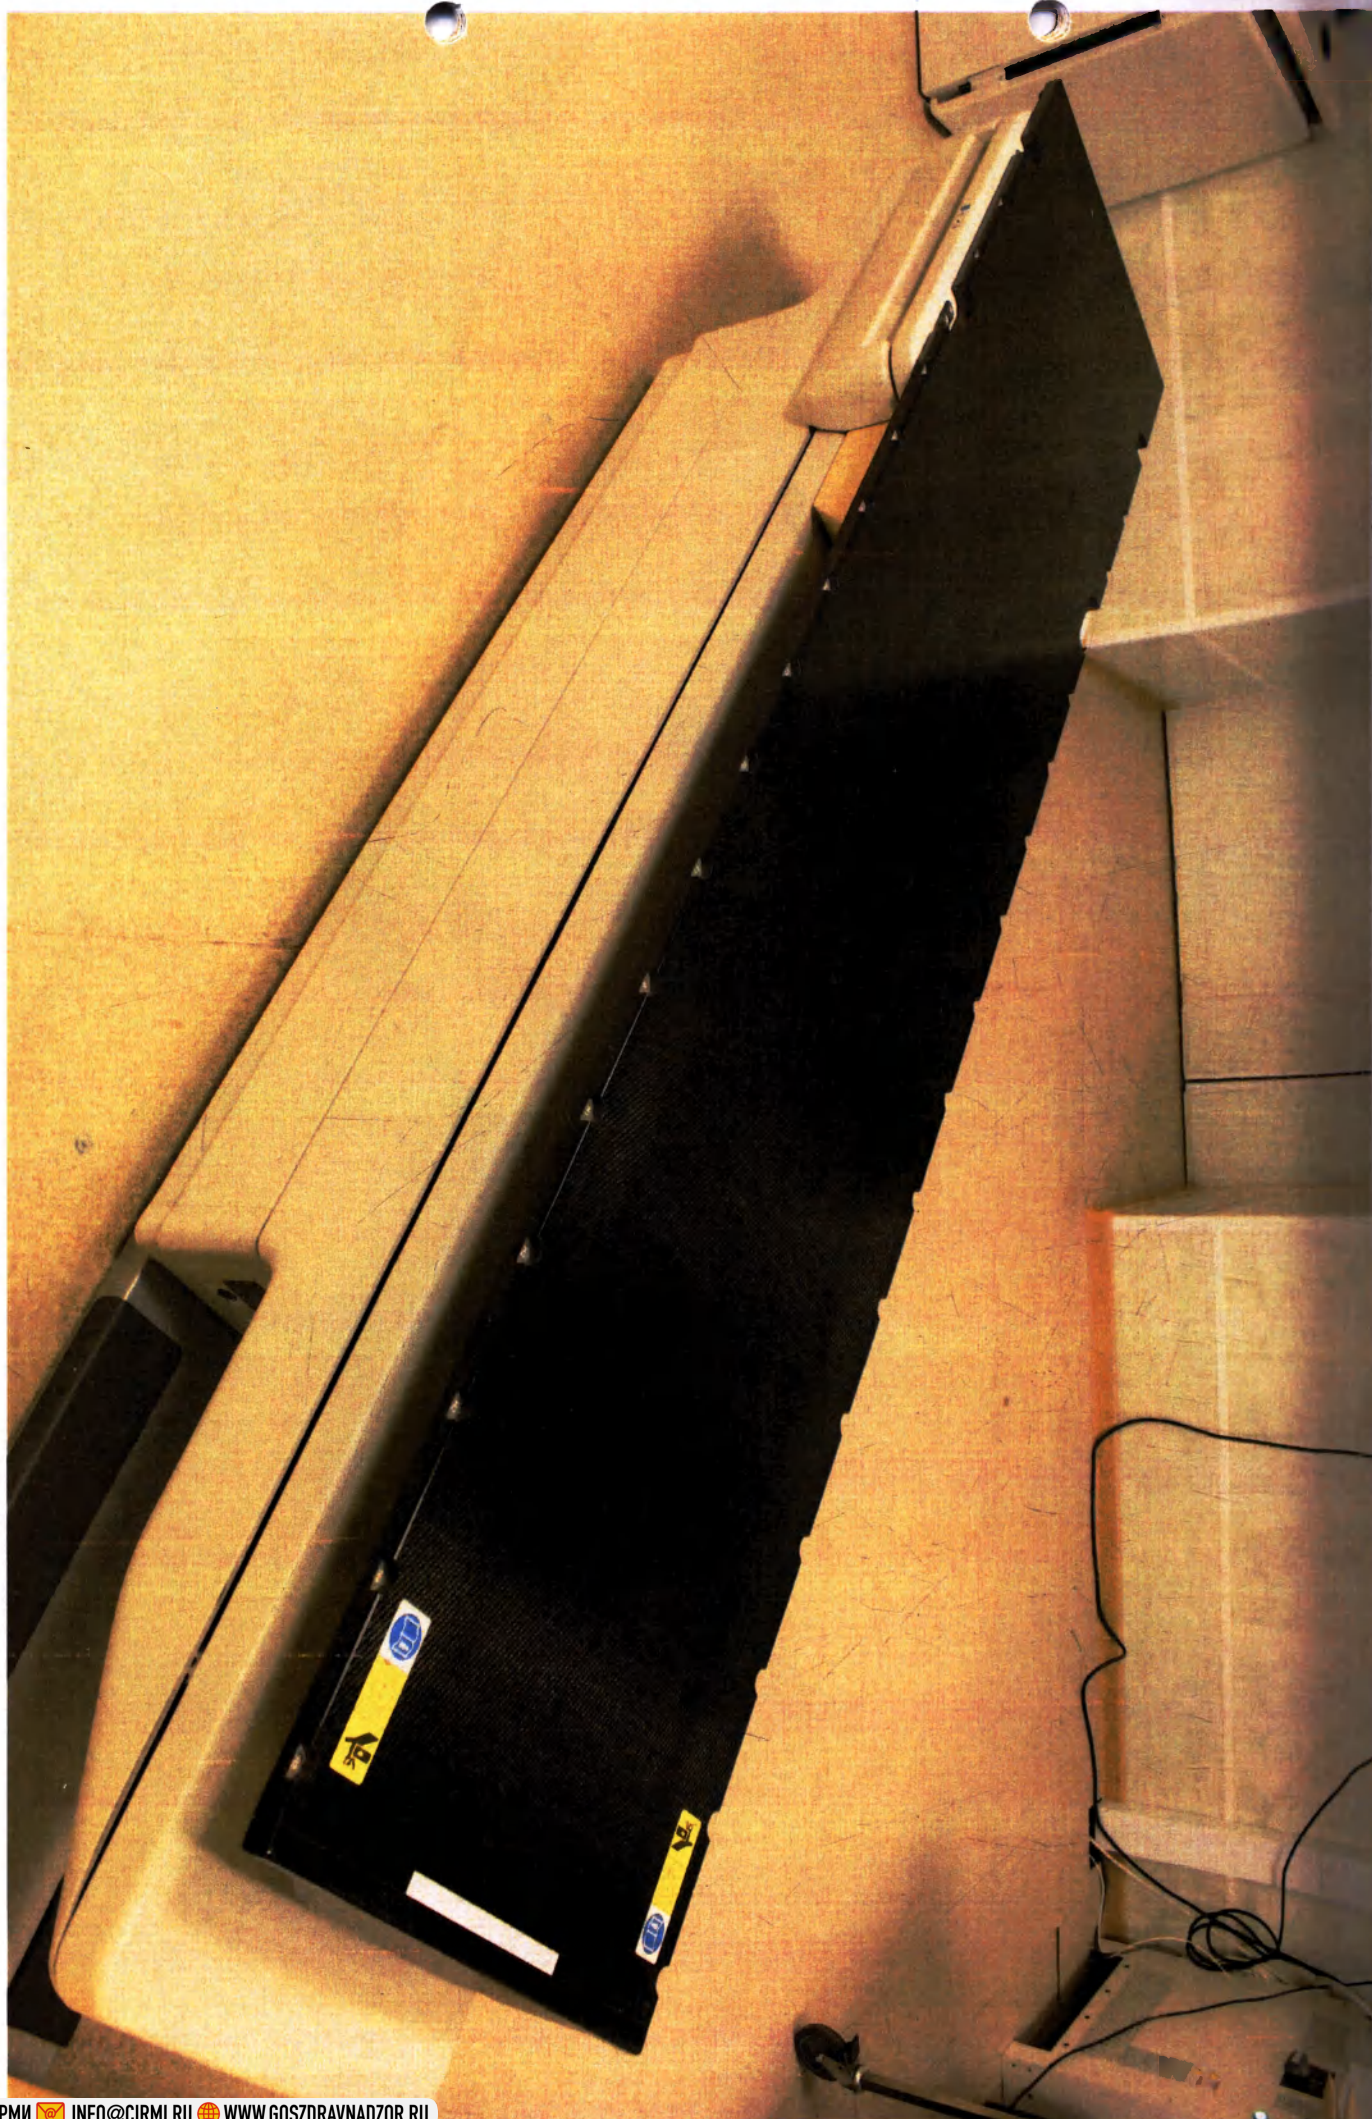


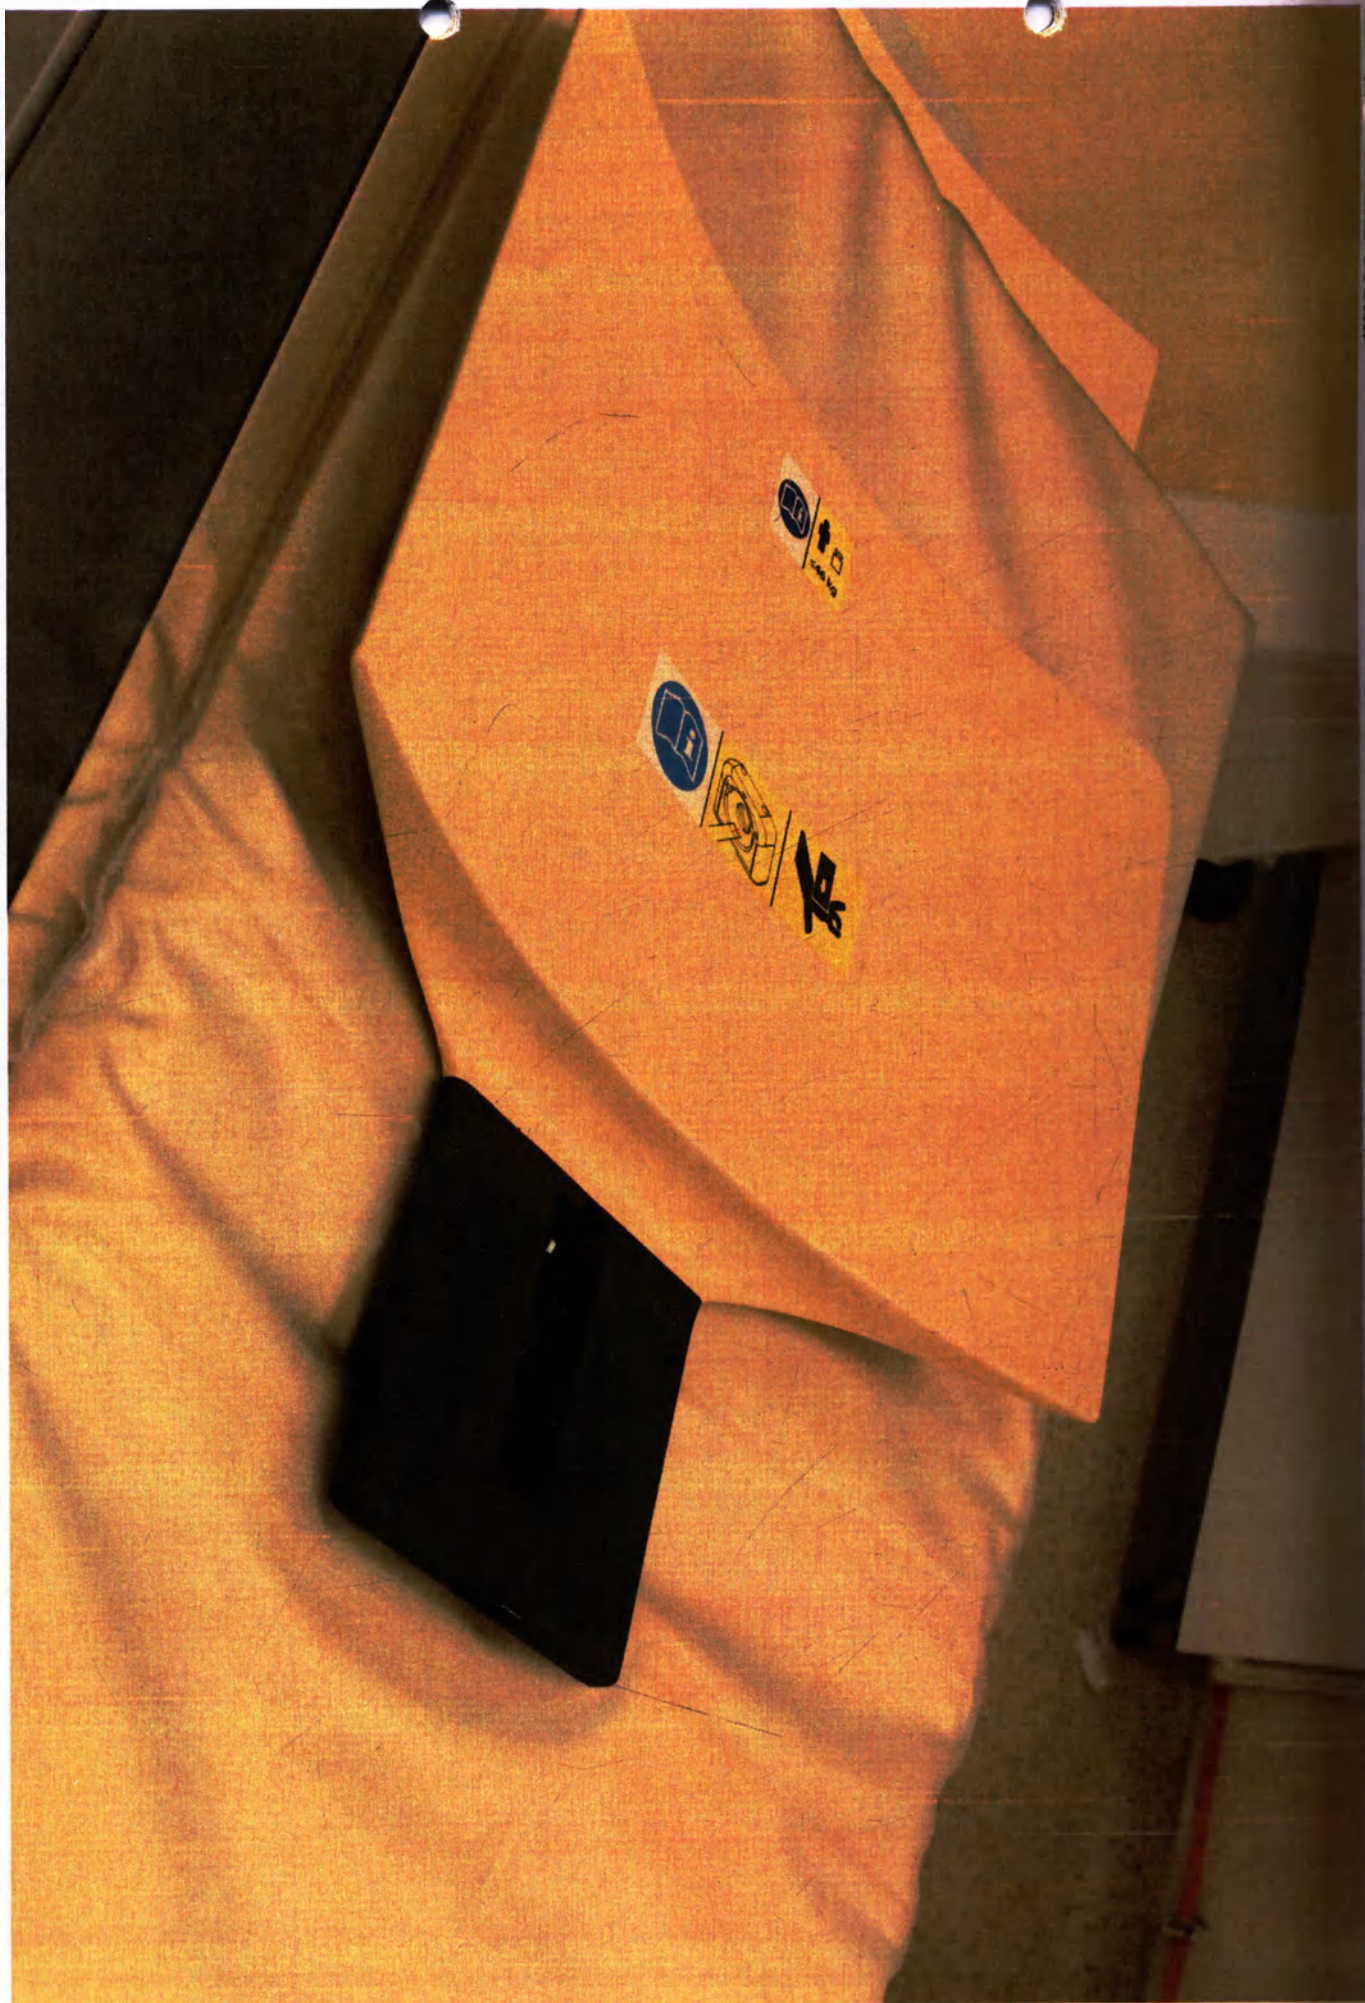





PHILIPS



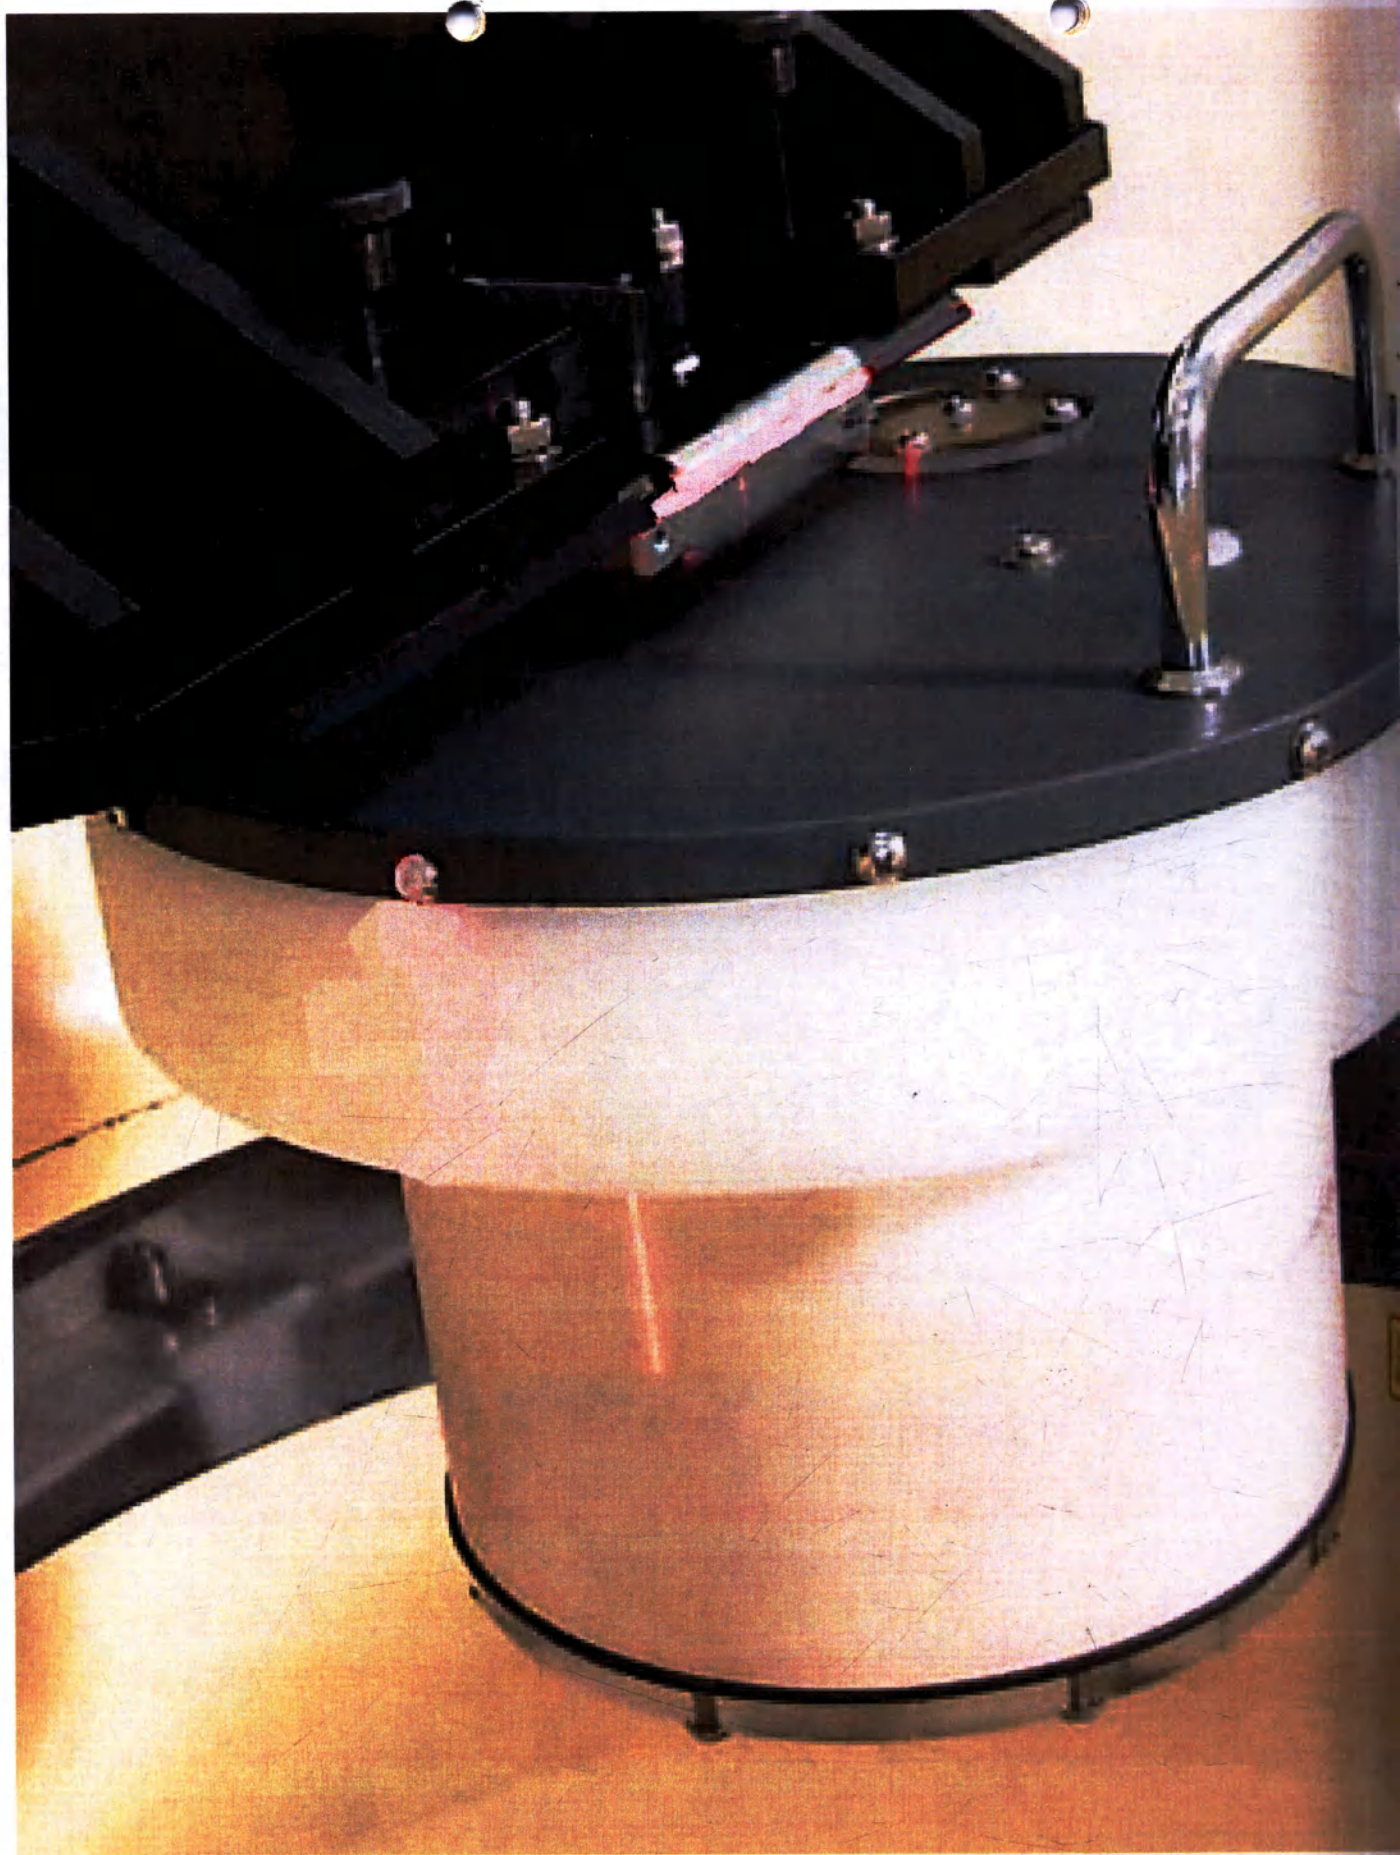



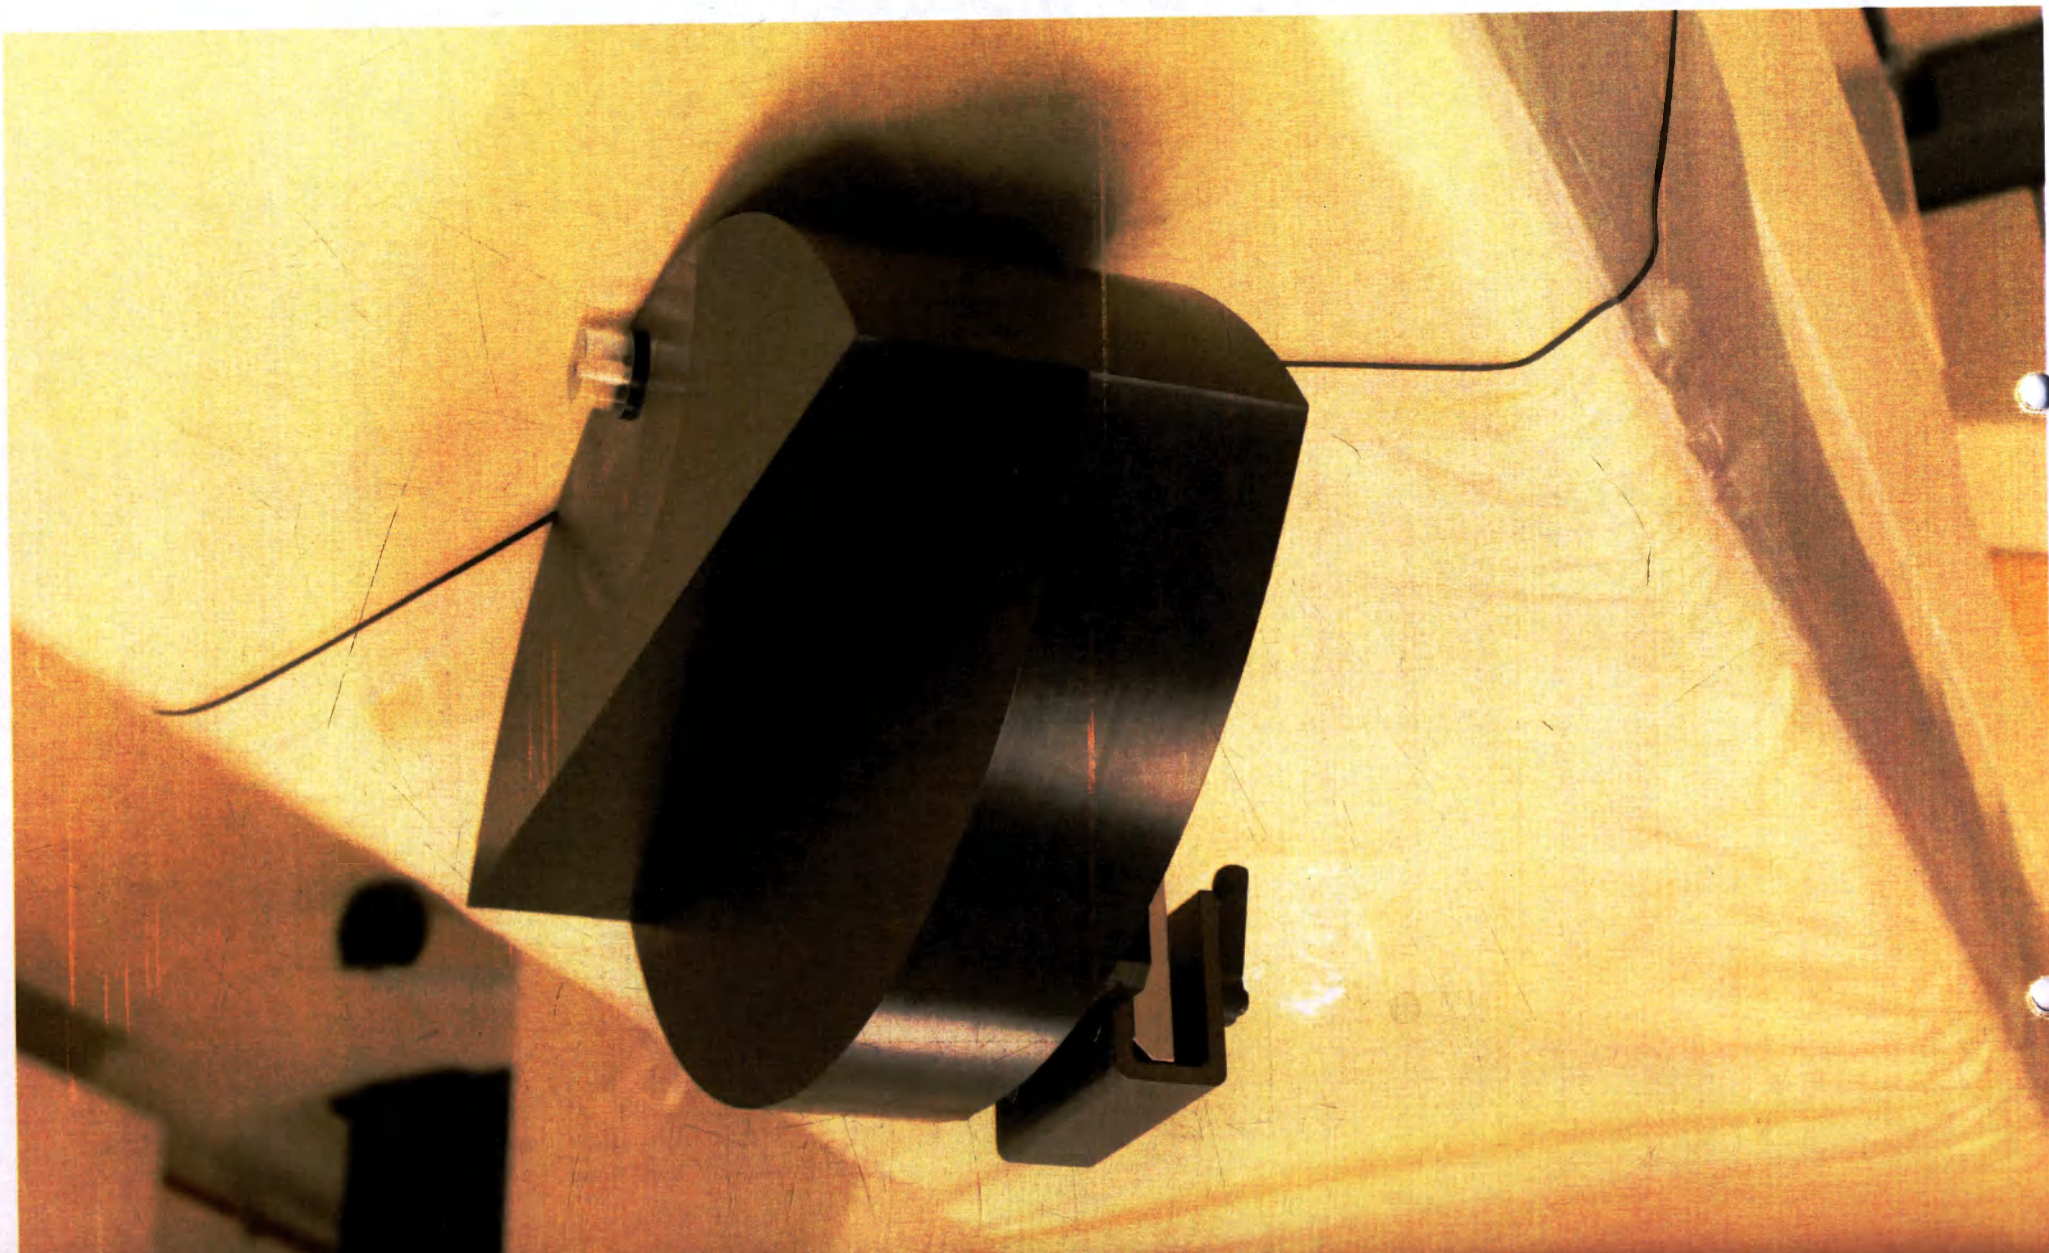

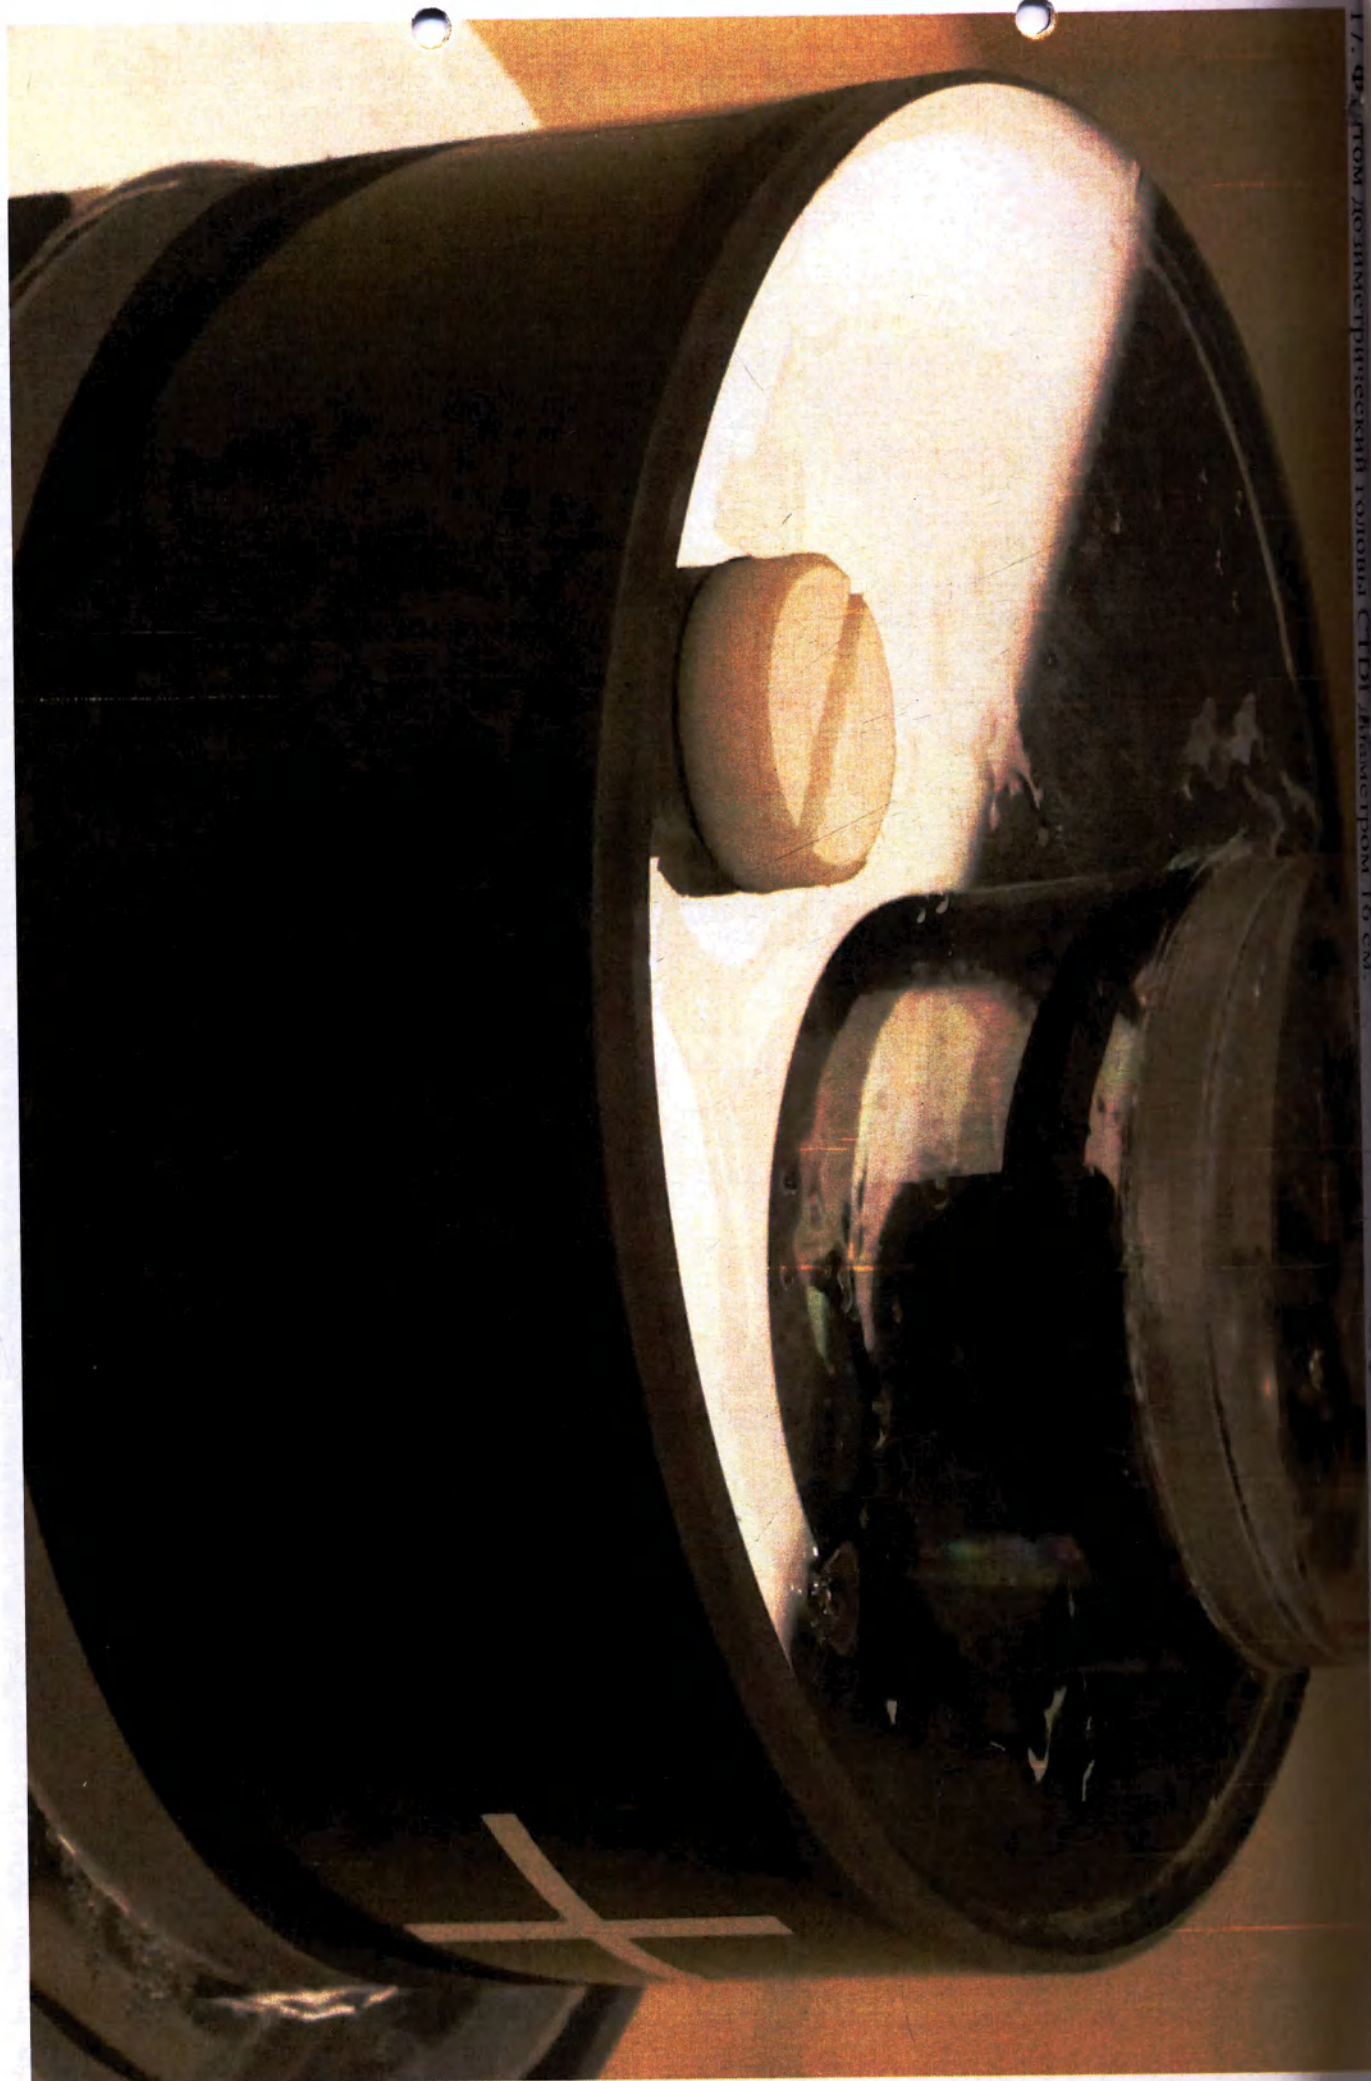



18. Фото дозиметрического тела СДТД диаметром 32 см.










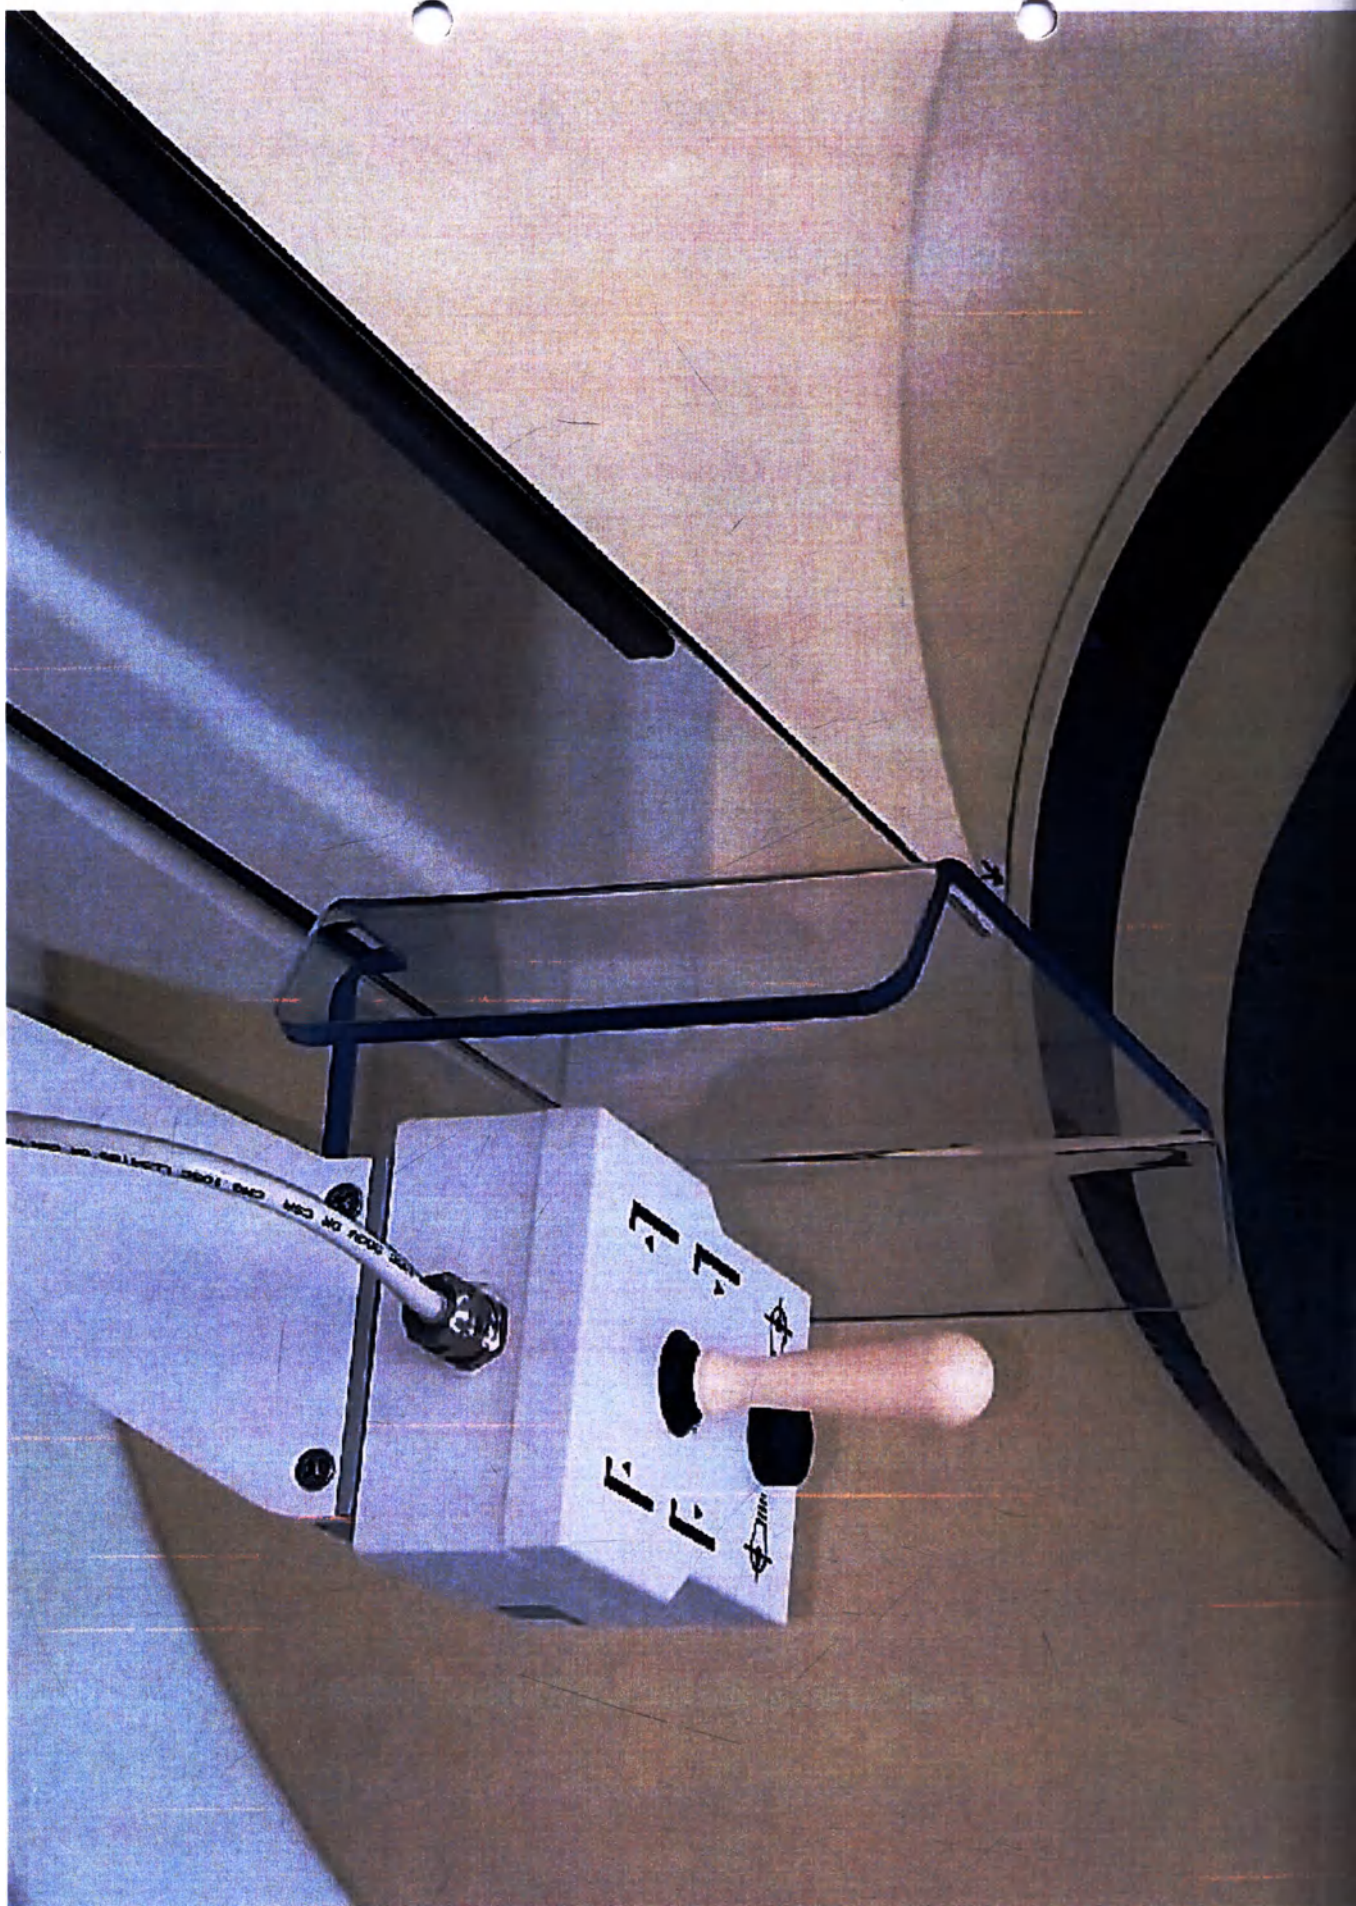

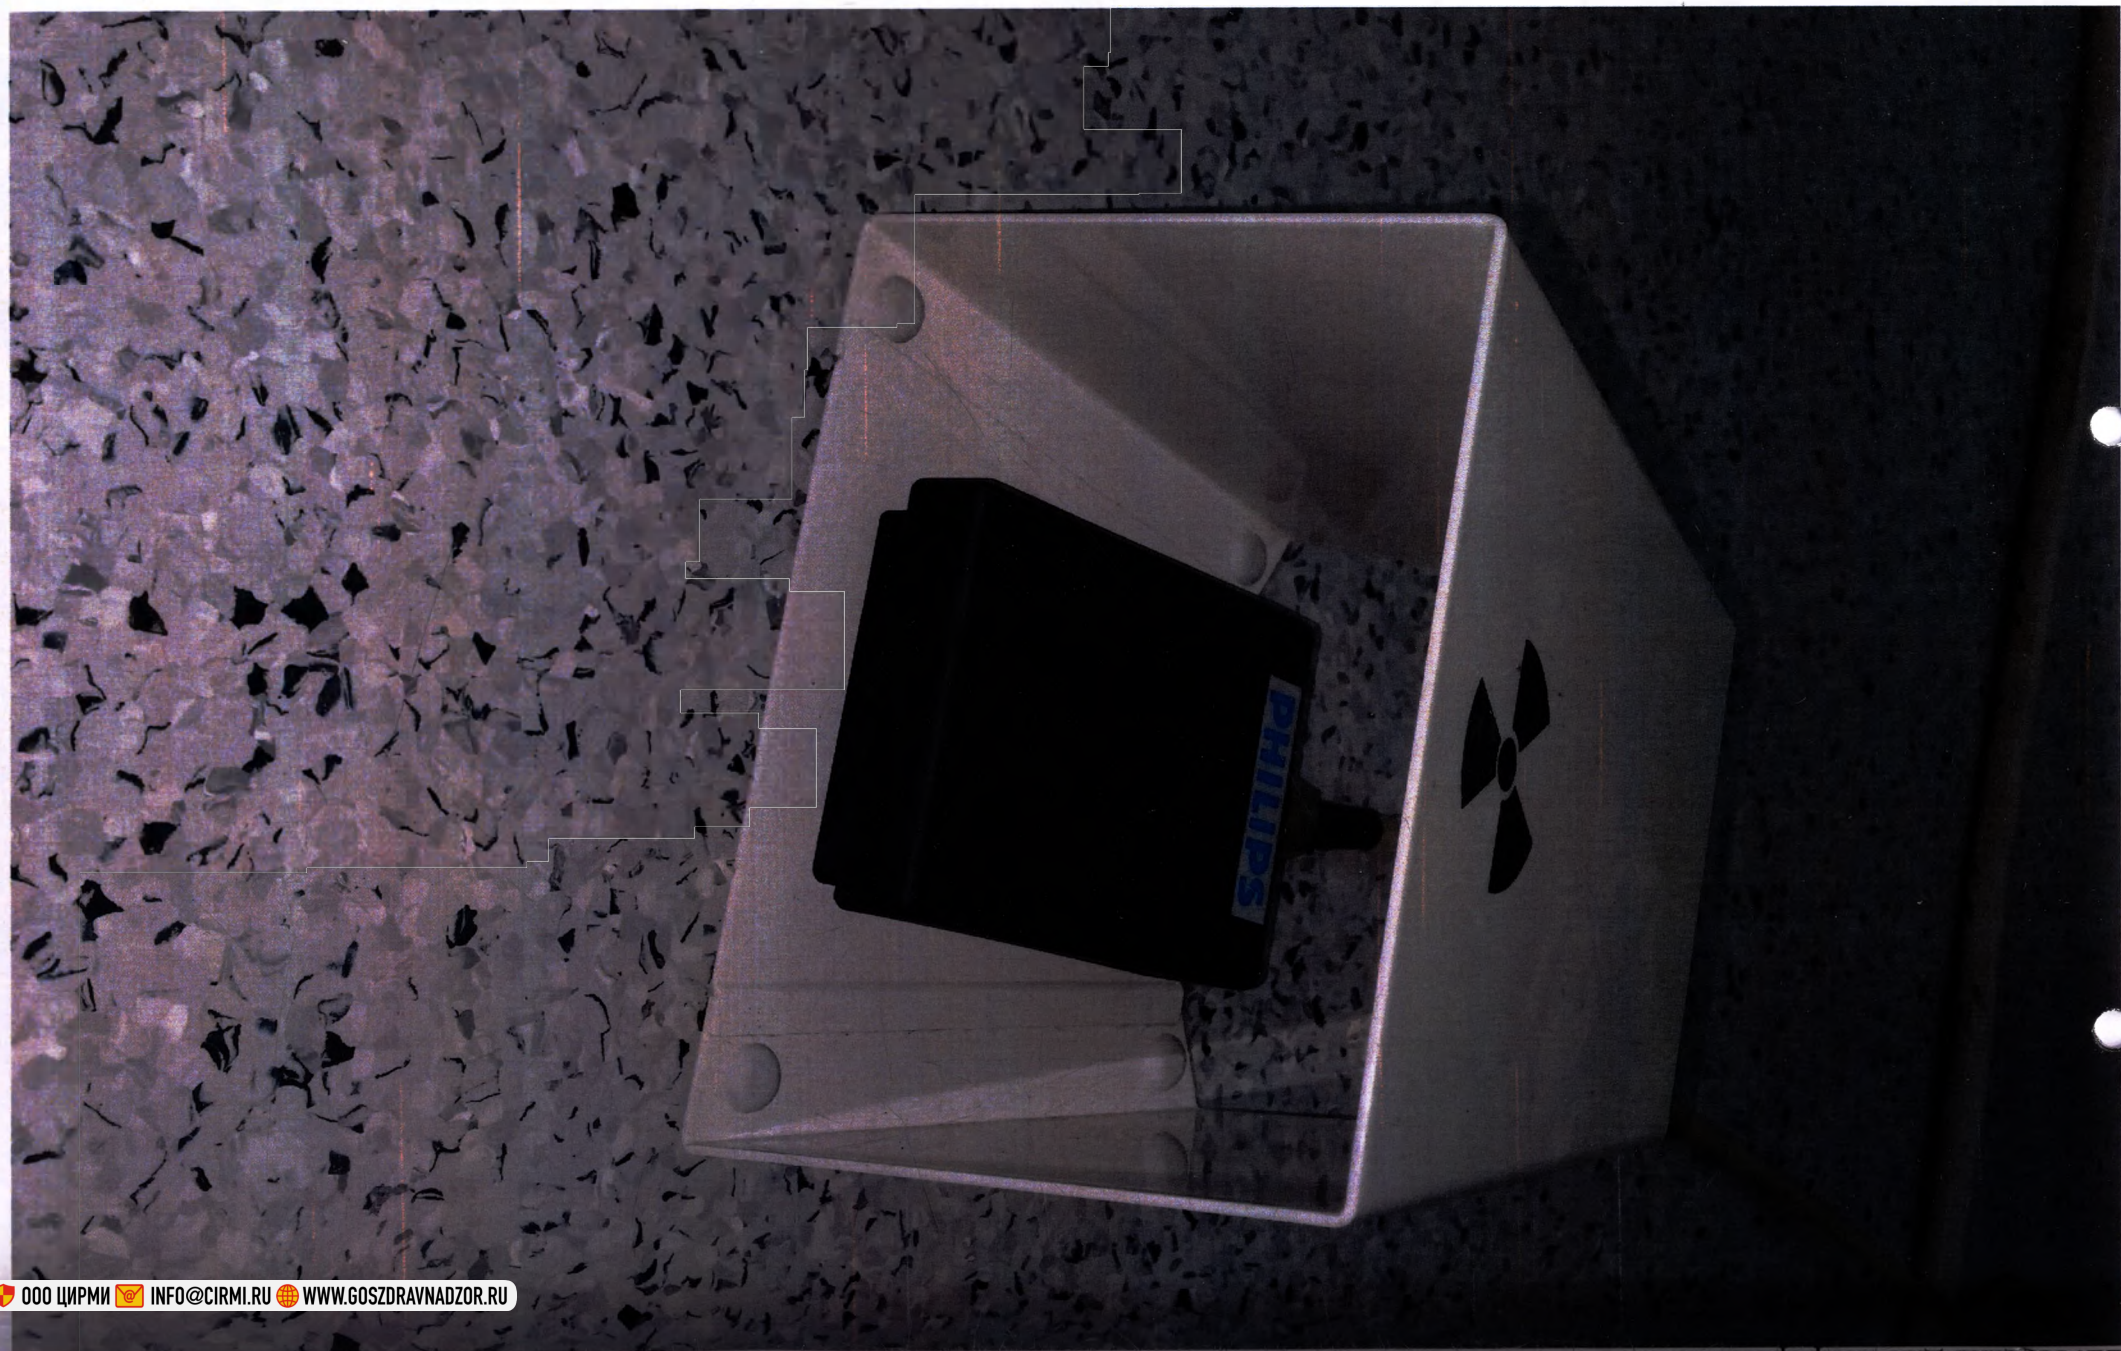

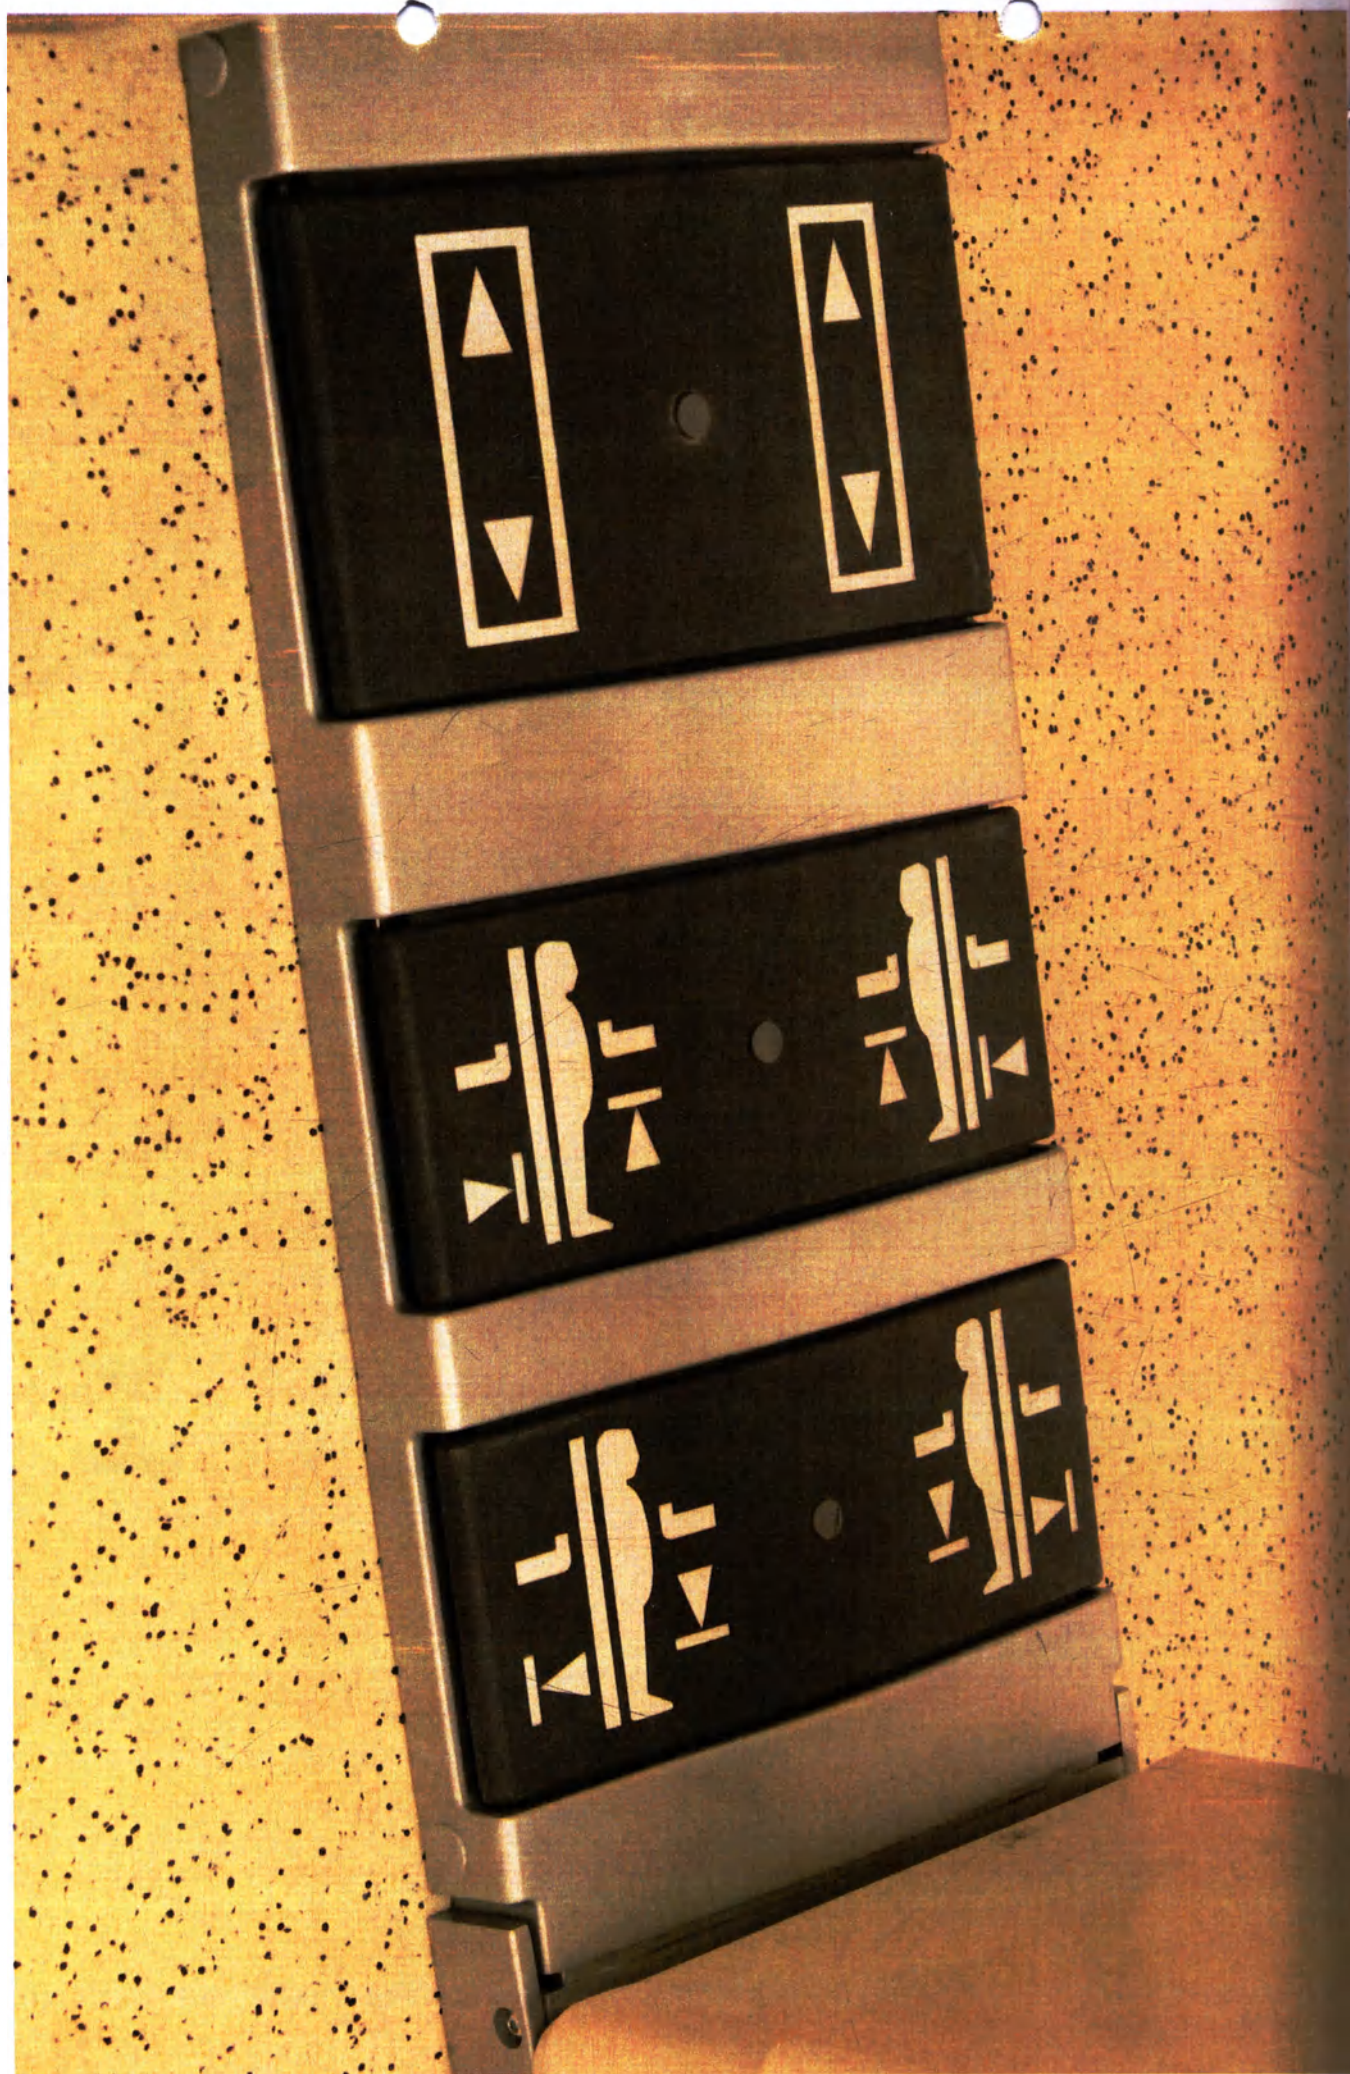

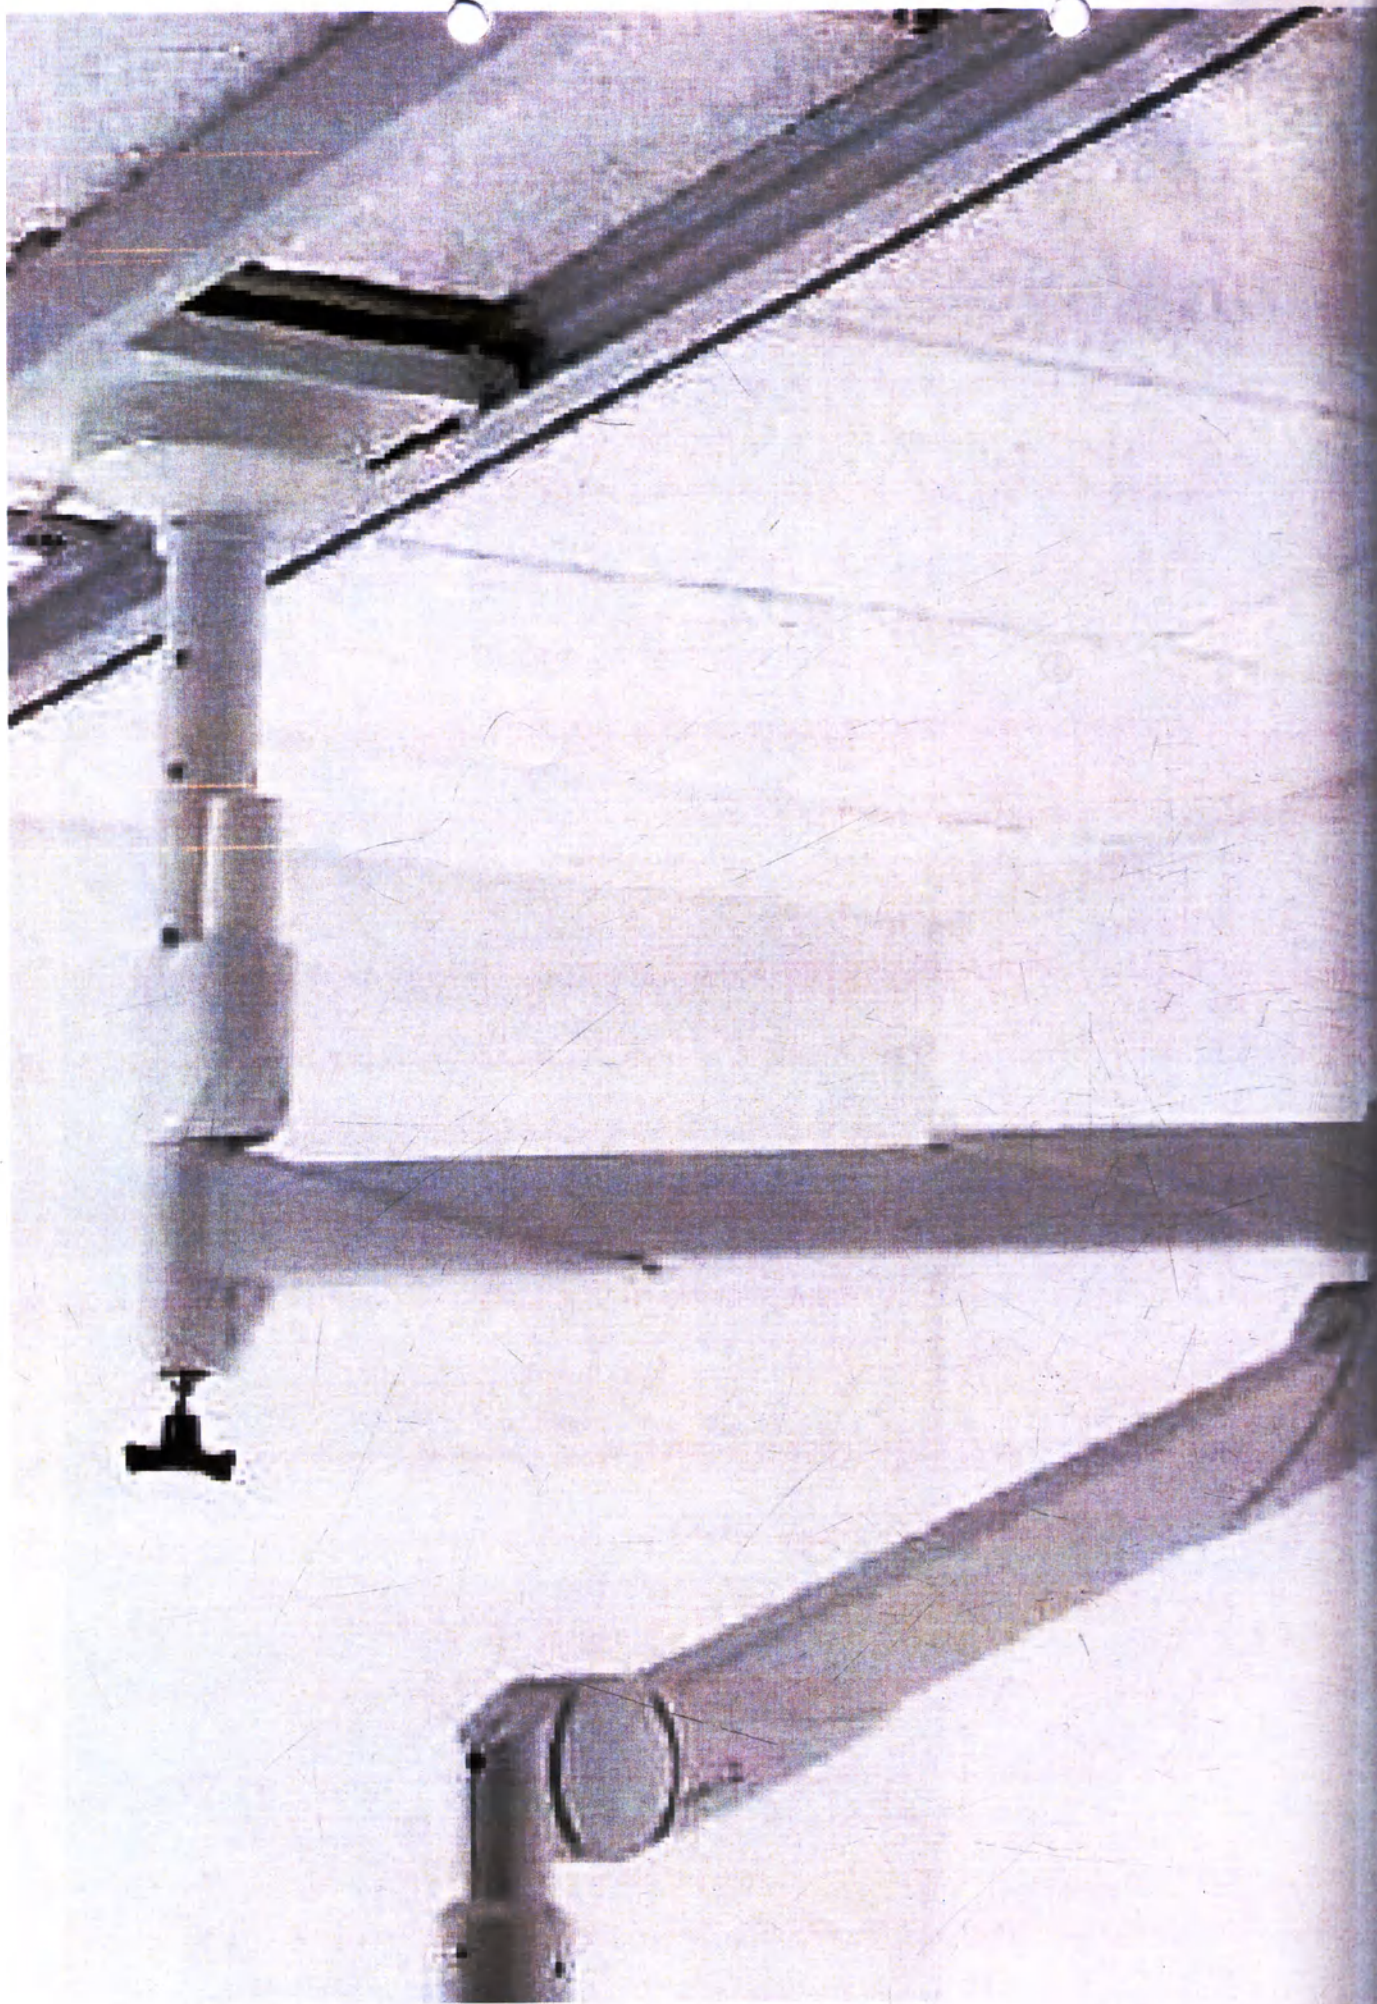

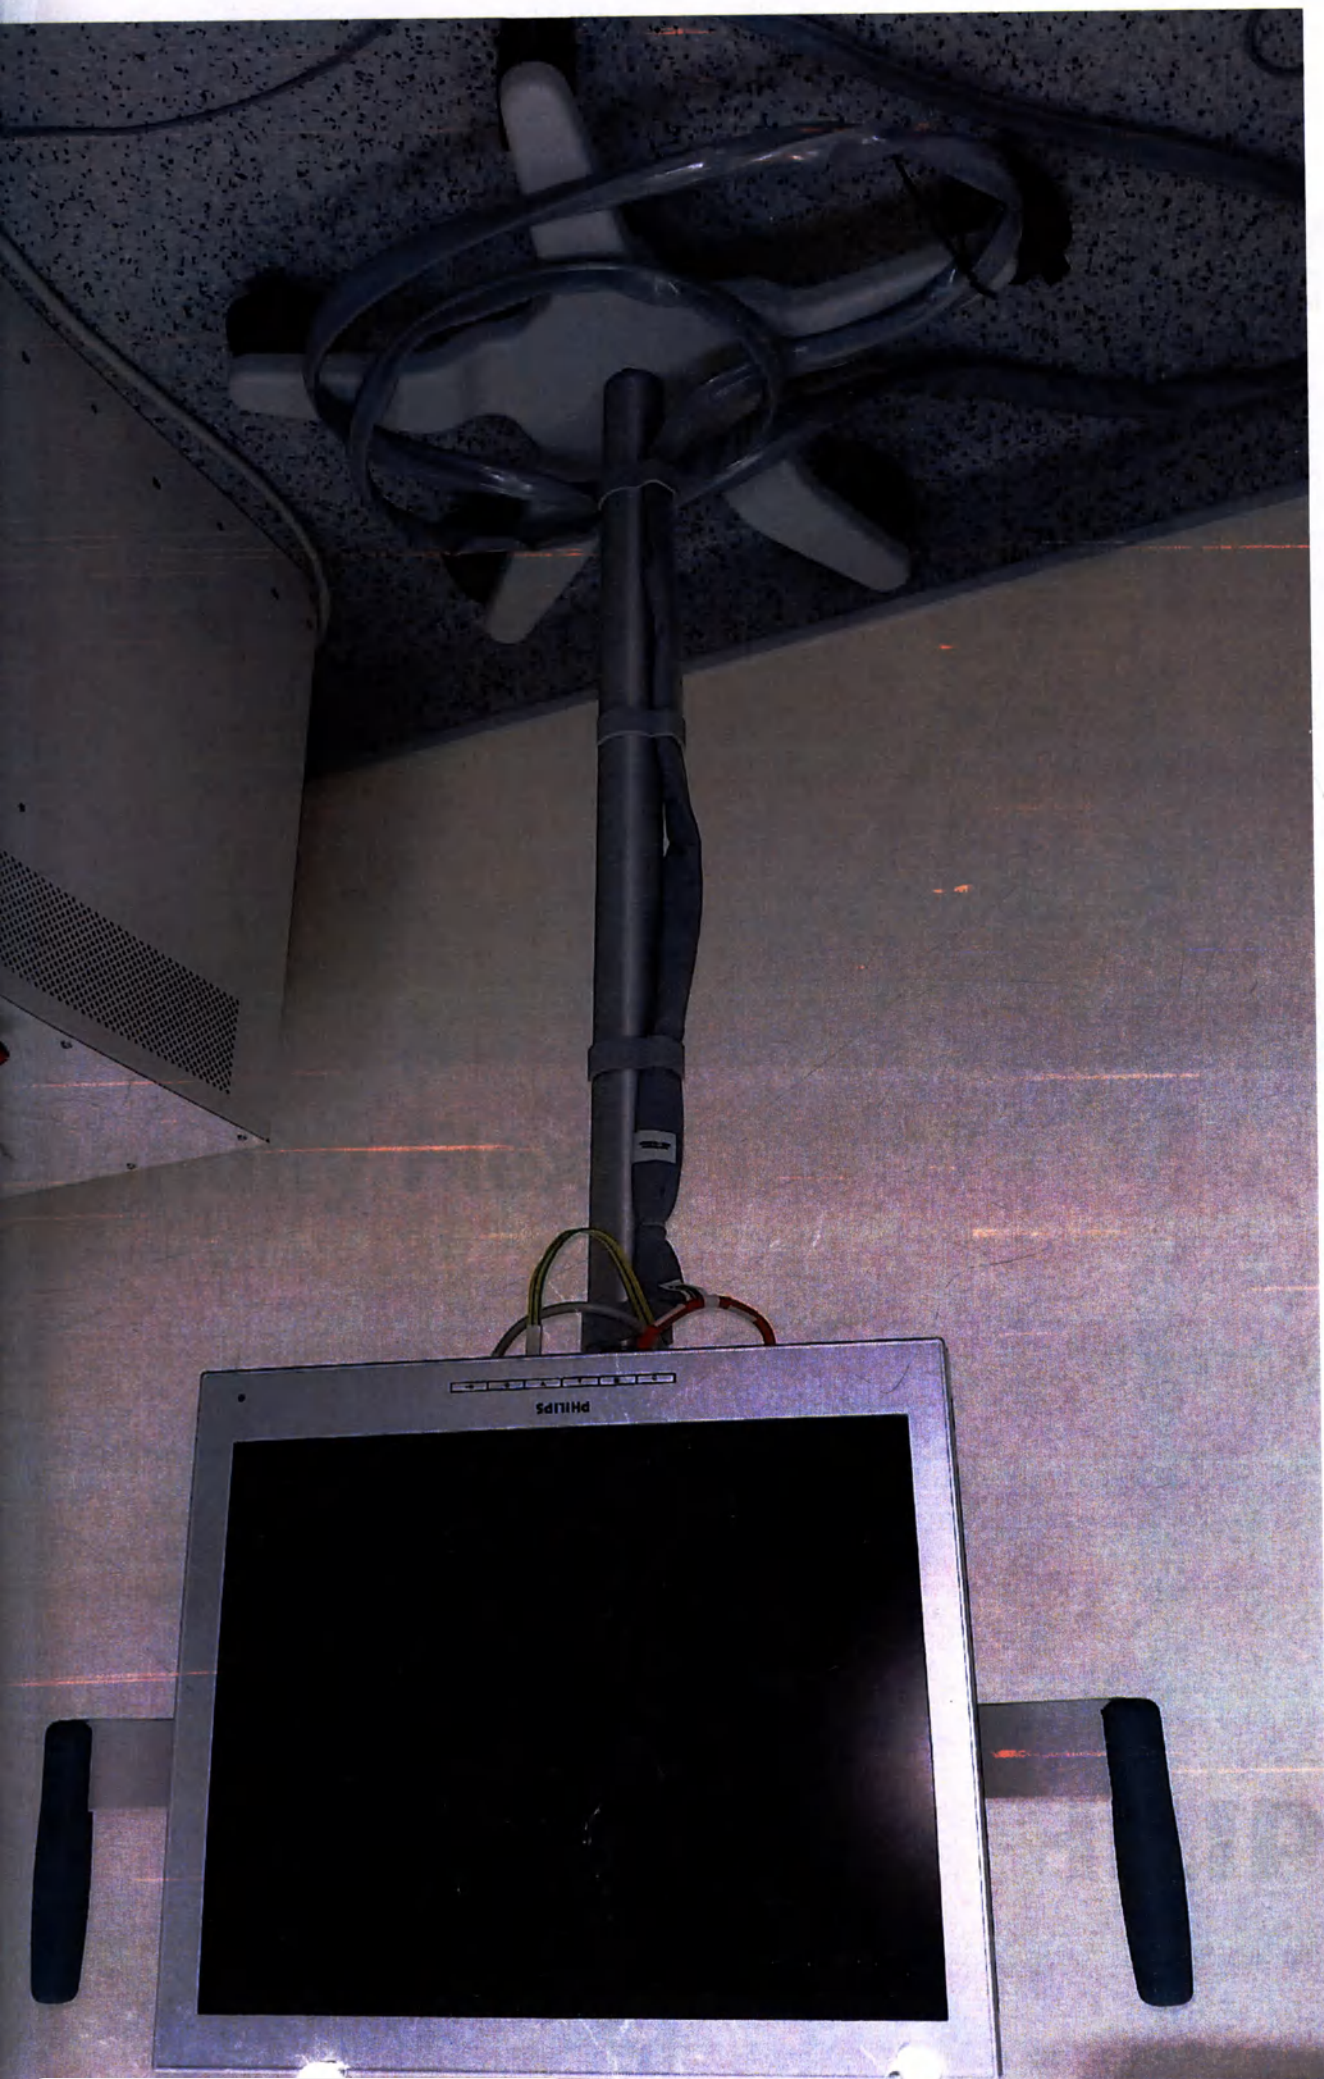

Всего проинформировано
прошнудорано и
скреплено печатью
40 (сорок) листа (ов)

