

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Сирона Дентал Системс»**



М.В. Кротенко

"02" февраля 2015 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система цифровая для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG, в исполнении: XIOS XG Select USB, XIOS XG Supreme USB, XIOS XG Select WiFi, XIOS XG Supreme WiFi,

**производства SIRONA Dental Systems GmbH (СИРОНА Дентал Системс ГмбХ),
Германия; Sirona Dental, Inc (Сирона Дентал, Инк.), США**

Система цифровая для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG, в исполнении: XIOS XG Select USB, XIOS XG Supreme USB, XIOS XG Select WiFi, XIOS XG Supreme WiFi.		
1.	Система цифровая для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG Select USB	6
1.	Модуль USB обработки рентгеновских снимков.	8
2.	Настенное крепление для модуля USB.	9
3.	Кабель XIOS XG USB A/B.	10
4.	Датчик XIOS XG Select Sensor USB, размер 0 или размер 1 или размер 2.	11
5.	Настенный держатель датчика XIOS XG.	13
6.	Стартовый комплект позиционеров для датчиков XIOS XG Starter Kit, в составе:	14
6.1.	позиционеры в сборе;	15
6.2.	чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков	16
Принадлежности к системе цифровой для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG Select USB		
1.	Сенсоры XIOS XG Select: размер 0; размер 1; размер 2.	17
2.	Настенный держатель датчика XIOS XG	19
3.	Настенное крепление для модуля USB	20
4.	Адаптер для настенного модуля	21
5.	Настенный модуль для подключения датчиков.	22
6.	Кабель XIOS XG USB A/B	23
7.	Кабели XIOS XG USB: длиной 90 см.; длиной 180 см.; длиной 270 см.	24
8.	Стартовый комплект позиционеров для датчиков XIOS XG Starter Kit, в составе:	27
8.1.	позиционеры в сборе	28
8.2.	чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков	29
9.	Чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков	30
10.	Держатели датчиков XIOS XG: для передних зубов, синие; для боковых зубов, желтые; для прикусной съемки, красные; универсальные, зеленые; Endo для эндодонтической съемки, серые.	31
11.	Комплект для замены кабеля XIOS XG USB Cable Kit, в составе:	36
11.1.	кабель XIOS XG USB: длиной 90 см.; длиной 180 см.; длиной 270 см.;	37
11.2.	отвертка специальная;	38
11.3.	колпачки защитные резьбовые	39
11.4.	полосы из эластомера	40
11.5.	винты с плоской головкой	41
12.	Тест фантом для настройки датчика.	42
13.	Ограничители поля излучения Heliodent Plus для датчика, размер 0 (белый); размер 1 (черный); размер 2 (синий)	43
14.	Программное обеспечения SIDEXIS XG (SIDEXIS XG Standard) / SIDEXIS 4 на электронном носителе.	46
15.	Программное обеспечение для модернизации SIDEXIS XG (SIDEXIS XG Standard) / SIDEXIS 4 - на электронном носителе.	48
16.	Программное обеспечение XIOS XG Plugin-CD на электронном носителе.	50
17.	Программный модуль SIDEXIS XG TSE - на электронном носителе.	51
18.	Полные версии ПО на электронном носителе: SIDICOM WLS; SIDICOM QR –; SIDICOM PS; SIDICOM RM.	52
19.	Руководство по эксплуатации на электронном и / или бумажном носителе.	55
20.	Руководство по программному обеспечению на электронном и / или бумажном носителе.	56


II.	Система цифровая для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG Supreme USB	57
1.	Модуль USB обработки рентгеновских снимков.	59
2.	Настенное крепление для модуля USB.	60
3.	Кабель XIOS XG USB A/B.	61
4.	Датчик XIOS XG Supreme Sensor USB, размер 0 или размер 1 или размер 2.	62
5.	Настенный держатель датчика XIOS XG.	64
6.	Стартовый комплект позиционеров для датчиков XIOS XG Starter Kit, в составе:	65
6.1.	позиционеры в сборе;	66
6.2.	чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков	67
	Принадлежности к системе цифровой для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG Supreme USB	
1.	Сенсоры XIOS XG Supreme: размер 0; размер 1; размер 2.	68
2.	Настенный держатель датчика XIOS XG	70
3.	Настенное крепление для модуля USB	71
4.	Адаптер для настенного модуля	72
5.	Настенный модуль для подключения датчиков.	73
6.	Кабель XIOS XG USB A/B	74
7.	Кабели XIOS XG USB: длиной 90 см.; длиной 180 см.; длиной 270 см.	75
8.	Стартовый комплект позиционеров для датчиков XIOS XG Starter Kit, в составе:	78
8.1.	позиционеры в сборе	79
8.2.	чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков	80
9.	Чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков	81
10.	Держатели датчиков XIOS XG: для передних зубов, синие; для боковых зубов, желтые; для прикусной съемки, красные; универсальные, зеленые; Endo для эндодонтической съемки, серые.	82
11.	Комплект для замены кабеля XIOS XG USB Cable Kit, в составе:	87
11.1.	кабель XIOS XG USB: длиной 90 см.; длиной 180 см.; длиной 270 см.	88
11.2.	отвертка специальная;	89
11.3.	колпачки защитные резьбовые	90
11.4.	полосы из эластомера	91
12.5.	винты с плоской головкой	92
12.	Тест фантом для настройки датчика.	93
13.	Ограничители поля излучения Heliodent Plus для датчика, размер 0 (белый); размер 1 (черный); размер 2 (синий)	94
14.	Программное обеспечение SIDEXIS XG (SIDEXIS XG Standard) / SIDEXIS 4 на электронном носителе.	97
15.	Программное обеспечение для модернизации SIDEXIS XG (SIDEXIS XG Standard) / SIDEXIS 4 - на электронном носителе.	99
16.	Программное обеспечение XIOS XG Plugin-CD на электронном носителе.	101
17.	Программный модуль SIDEXIS XG TSE - на электронном носителе.	102
18.	Полные версии ПО на электронном носителе: SIDICOM WLS; SIDICOM QR; SIDICOM PS; SIDICOM RM.	103
19.	Руководство по эксплуатации на электронном и / или бумажном носителе.	106
20.	Руководство по программному обеспечению на электронном и / или бумажном носителе	107
III.	Система цифровая для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG Select WiFi	108
1.	Модуль WiFi обработки рентгеновских снимков.	110
2.	Зажим для модуля WiFi.	111
3.	Устройство зарядное для модуля WiFi.	112
4.	Крепление настенное устройства зарядного модуля WiFi.	113
5.	Кабель XIOS XG USB A/B.	114
6.	Датчик XIOS XG Select Sensor WiFi, размер 0 или размер 1 или размер 2.	115

7.	Настенный держатель датчика XIOS XG.	117
8.	Блок питания с соединительным кабелем.	118
9.	Стартовый комплект позиционеров для датчиков XIOS XG Starter Kit, в составе:	119
9.1.	позиционеры в сборе	120
9.2.	чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков	121
	Принадлежности к системе цифровой для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG Select WiFi	
1.	Сенсоры XIOS XG Select: размер 0; размер 1; размер 2.	122
2.	Настенный держатель датчика XIOS XG	124
3.	Аккумулятор специальный для модуля WiFi.	125
4.	Ридер XIOS XG Wi-Fi USB RFID	126
5.	Кабель USB удлинительный для ридера XIOS XG WiFi RFID	127
6.	Кабели XIOS XG Wi-Fi: длиной 45 см.; длиной 90 см.; длиной 180 см.; длиной 270 см..	128
7.	Стартовый комплект позиционеров для датчиков XIOS XG Starter Kit, в составе:	132
7.1.	позиционеры в сборе	133
7.2.	чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков	134
8.	Чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков	135
9.	Держатели датчиков XIOS XG: для передних зубов, синие; для боковых зубов, желтые; для прикусной съемки, красные; универсальные, зеленые; Endo для эндодонтической съемки, серые	136
10.	Комплект для замены кабеля XIOS XG WiFi Cable Kit, в составе:	141
10.1.	кабель XIOS XG Wi-Fi: длиной 45 см.; длиной 90 см.; длиной 180 см.; длиной 270 см.	142
10.2..	отвертка специальная;	143
10.3.	колпачки резьбовые защитные	144
10.4.	полосы из эластомера	145
10.5.	винты с плоской головкой	146
11.	Тест фантом для настройки датчика.	147
12.	Ограничители поля излучения Heliodent Plus для датчика, размер 0 (белый); размер 1 (черный); размер 2 (синий).	148
13.	Программное обеспечение SIDEXIS XG (SIDEXIS XG Standard) / SIDEXIS 4 на электронном носителе.	151
14.	Программное обеспечение для модернизации SIDEXIS XG (SIDEXIS XG Standard) / SIDEXIS 4 - на электронном носителе.	153
15.	Программное обеспечение XIOS XG Plugin-CD на электронном носителе.	155
16.	Программный модуль SIDEXIS XG TSE - на электронном носителе.	156
17.	Полные версии ПО на электронном носителе: SIDICOM WLS; SIDICOM QR; SIDICOM PS; SIDICOM RM.	157
18.	Руководство по эксплуатации на электронном и / или бумажном носителе.	160
19.	Руководство по программному обеспечению на электронном и / или бумажном носителе	161
IV.	Система цифровая для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG Supreme WiFi	162
1.	Модуль WiFi обработки рентгеновских снимков.	164
2.	Зажим для модуля WiFi.	165
3.	Устройство зарядное для модуля WiFi.	166
4.	Крепление настенное устройства зарядного модуля WiFi.	167
5.	Кабель XIOS XG USB A/B.	168
6.	Датчик XIOS XG Supreme Sensor WiFi, размер 0 или размер 1 или размер 2.	169
7.	Настенный держатель датчика XIOS XG.	171
8.	Блок питания с соединительным кабелем.	172
9.	Стартовый комплект позиционеров для датчиков XIOS XG Starter Kit, в составе:	173
9.1.	позиционеры в сборе	174


9.2.	чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков	175
	Принадлежности к системе цифровой для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG Supreme WiFi	
1.	Сенсоры XIOS XG Supreme: размер 0; размер 1; размер 2	176
2.	Настенный держатель датчика XIOS XG	178
3.	Аккумулятор специальный для модуля WiFi.	179
4.	Ридер XIOS XG Wi-Fi USB RFID	180
5.	Кабель USB удлинительный для ридера XIOS XG WiFi RFID	181
6.	Кабели XIOS XG Wi-Fi: длиной 45 см.; длиной 90 см.; длиной 180 см.; длиной 270 см.	182
7.	Стартовый комплект позиционеров для датчиков XIOS XG Starter Kit, в составе:	186
7.1.	позиционеры в сборе	187
7.2.	чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков	188
8.	Чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков	189
9.	Держатели датчиков XIOS XG: для передних зубов, синие; для боковых зубов, желтые; для прикусной съемки, красные; универсальные, зеленые; Endo для эндодонтической съемки, серые	190
10.	Комплект для замены кабеля XIOS XG WiFi Cable Kit – в составе:	195
10.1.	кабель XIOS XG Wi-Fi: длиной 45 см.; длиной 90 см.; длиной 180 см.; длиной 270 см	196
10.2.	отвертка специальная;	197
10.3.	колпачки резьбовые защитные	198
10.4.	полосы из эластомера	199
10.5.	винты с плоской головкой	200
11.	Тест фантом для настройки датчика.	201
12.	Ограничители поля излучения Heliodont Plus для датчика, размер 0 (белый); размер 1 (черный); размер 2 (синий)	202
13.	Программное обеспечение SIDEXIS XG (SIDEXIS XG Standard) / SIDEXIS 4 на электронном носителе.	205
14.	Программное обеспечение для модернизации SIDEXIS XG (SIDEXIS XG Standard) / SIDEXIS 4 - на электронном носителе.	207
15.	Программное обеспечение XIOS XG Plugin-CD на электронном носителе.	209
16.	Программный модуль SIDEXIS XG TSE - на электронном носителе.	210
17.	Полные версии ПО на электронном носителе: SIDICOM WLS; SIDICOM QR; SIDICOM PS; SIDICOM RM	211
18.	Руководство по эксплуатации на электронном и / или бумажном носителе.	214
19.	Руководство по программному обеспечению на электронном и / или бумажном носителе.	215
	Приложение № 1	216

I. Система цифровая для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG Select USB.



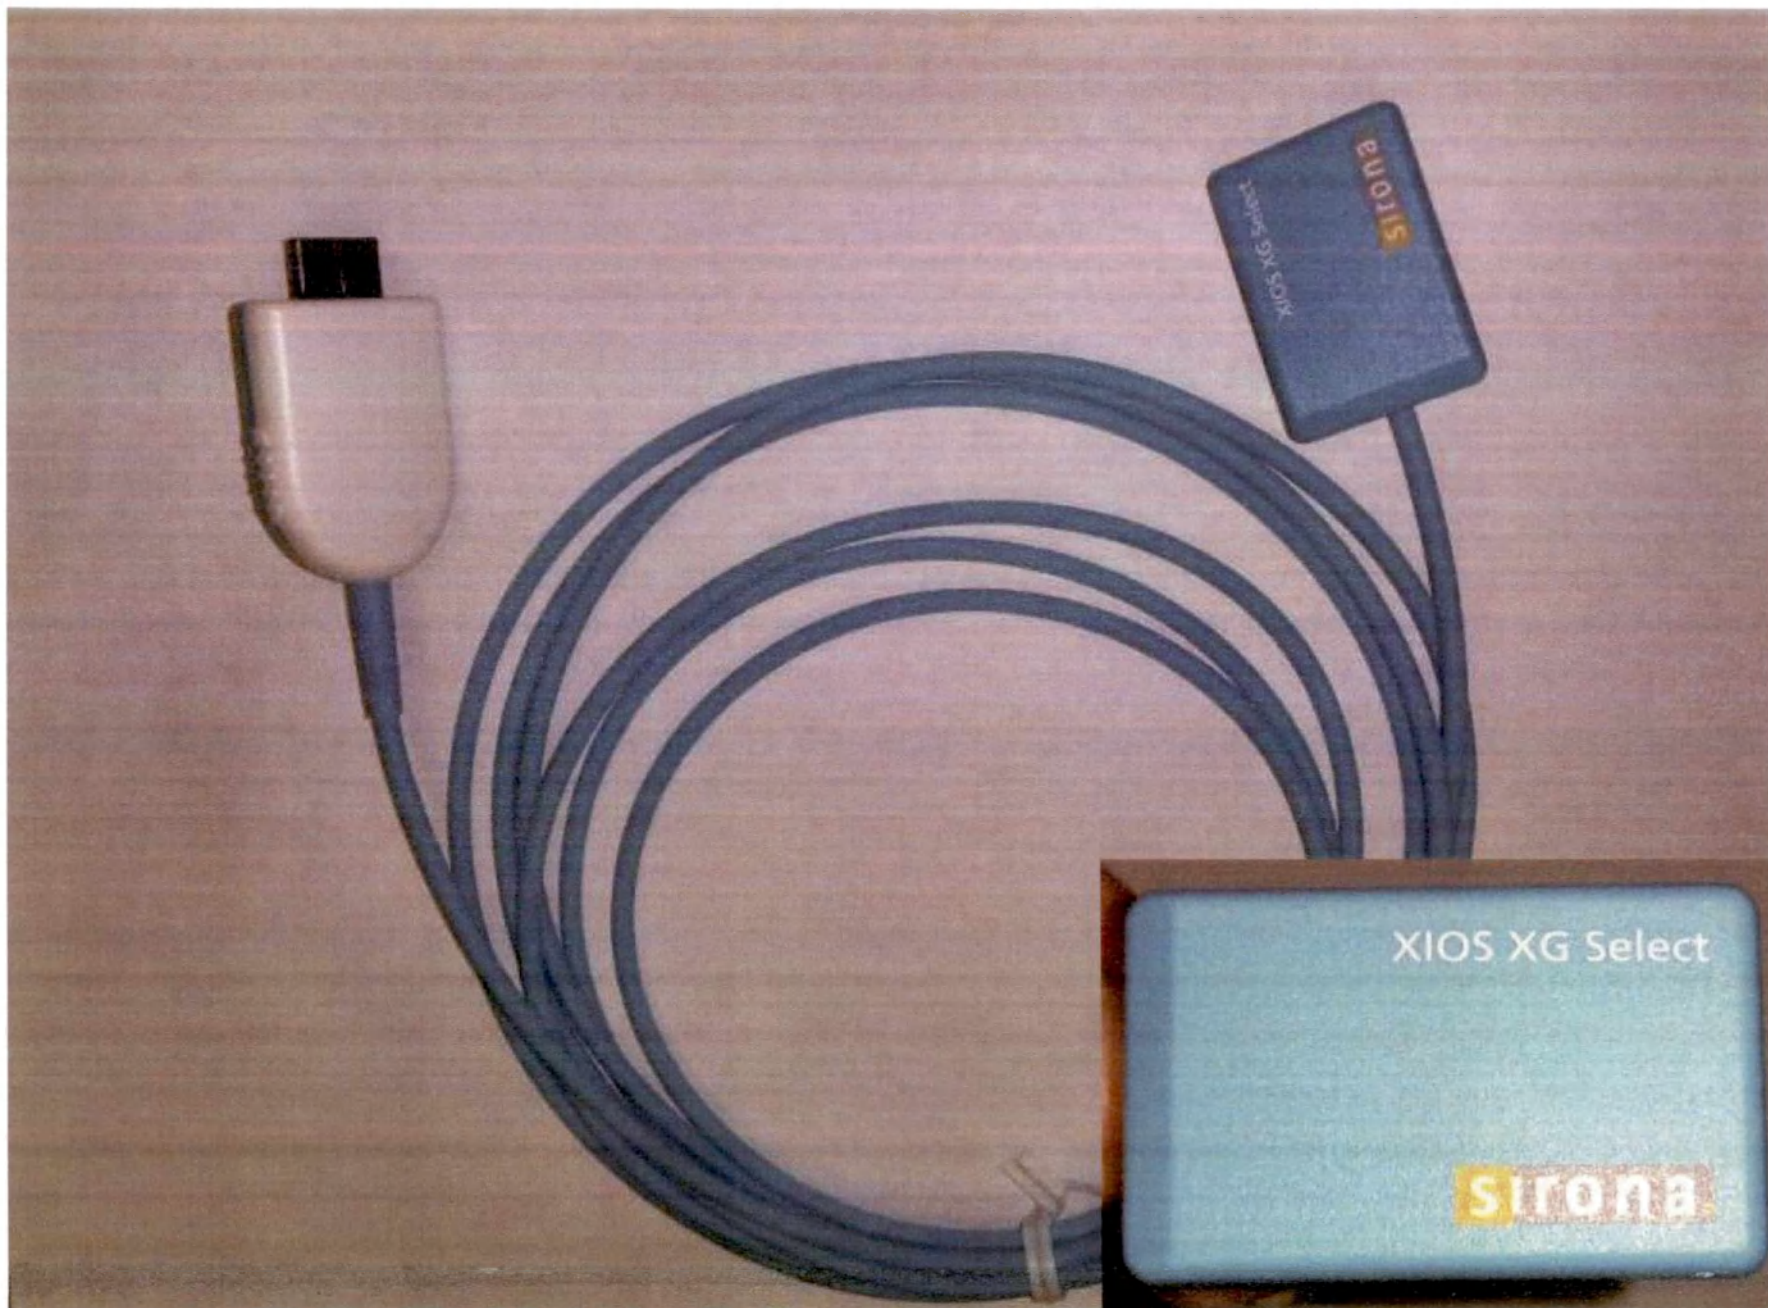

1. Модуль USB обработки рентгеновских снимков.

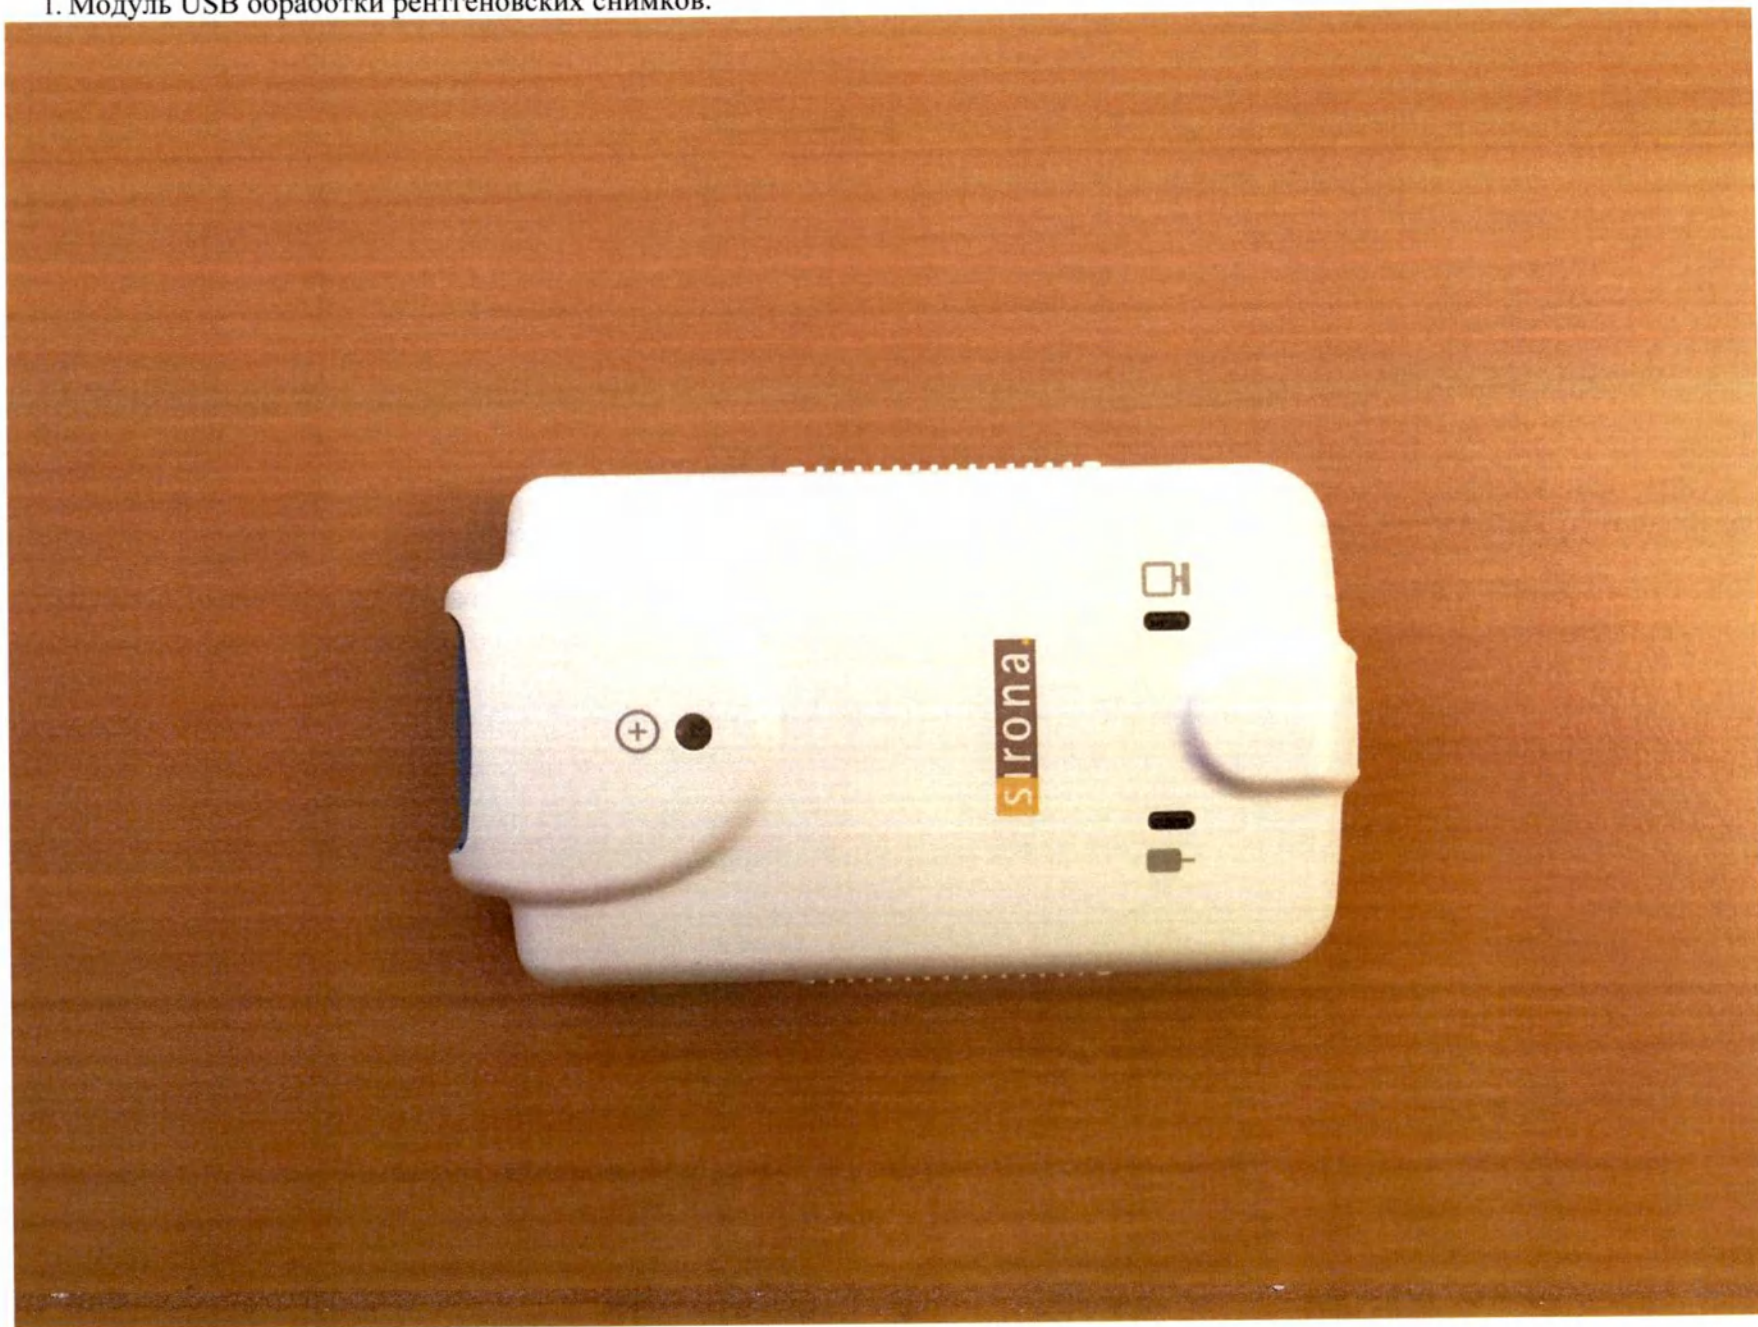

2. Настенное крепление для модуля USB.



3. Кабель XIOS XG USB A/B.



4. Датчик XIOS XG Select Sensor USB, размер 0 или размер 1 или размер 2.



Размер 2




Размер 1

Размер 0

5. Настенный держатель датчика XIOS XG.





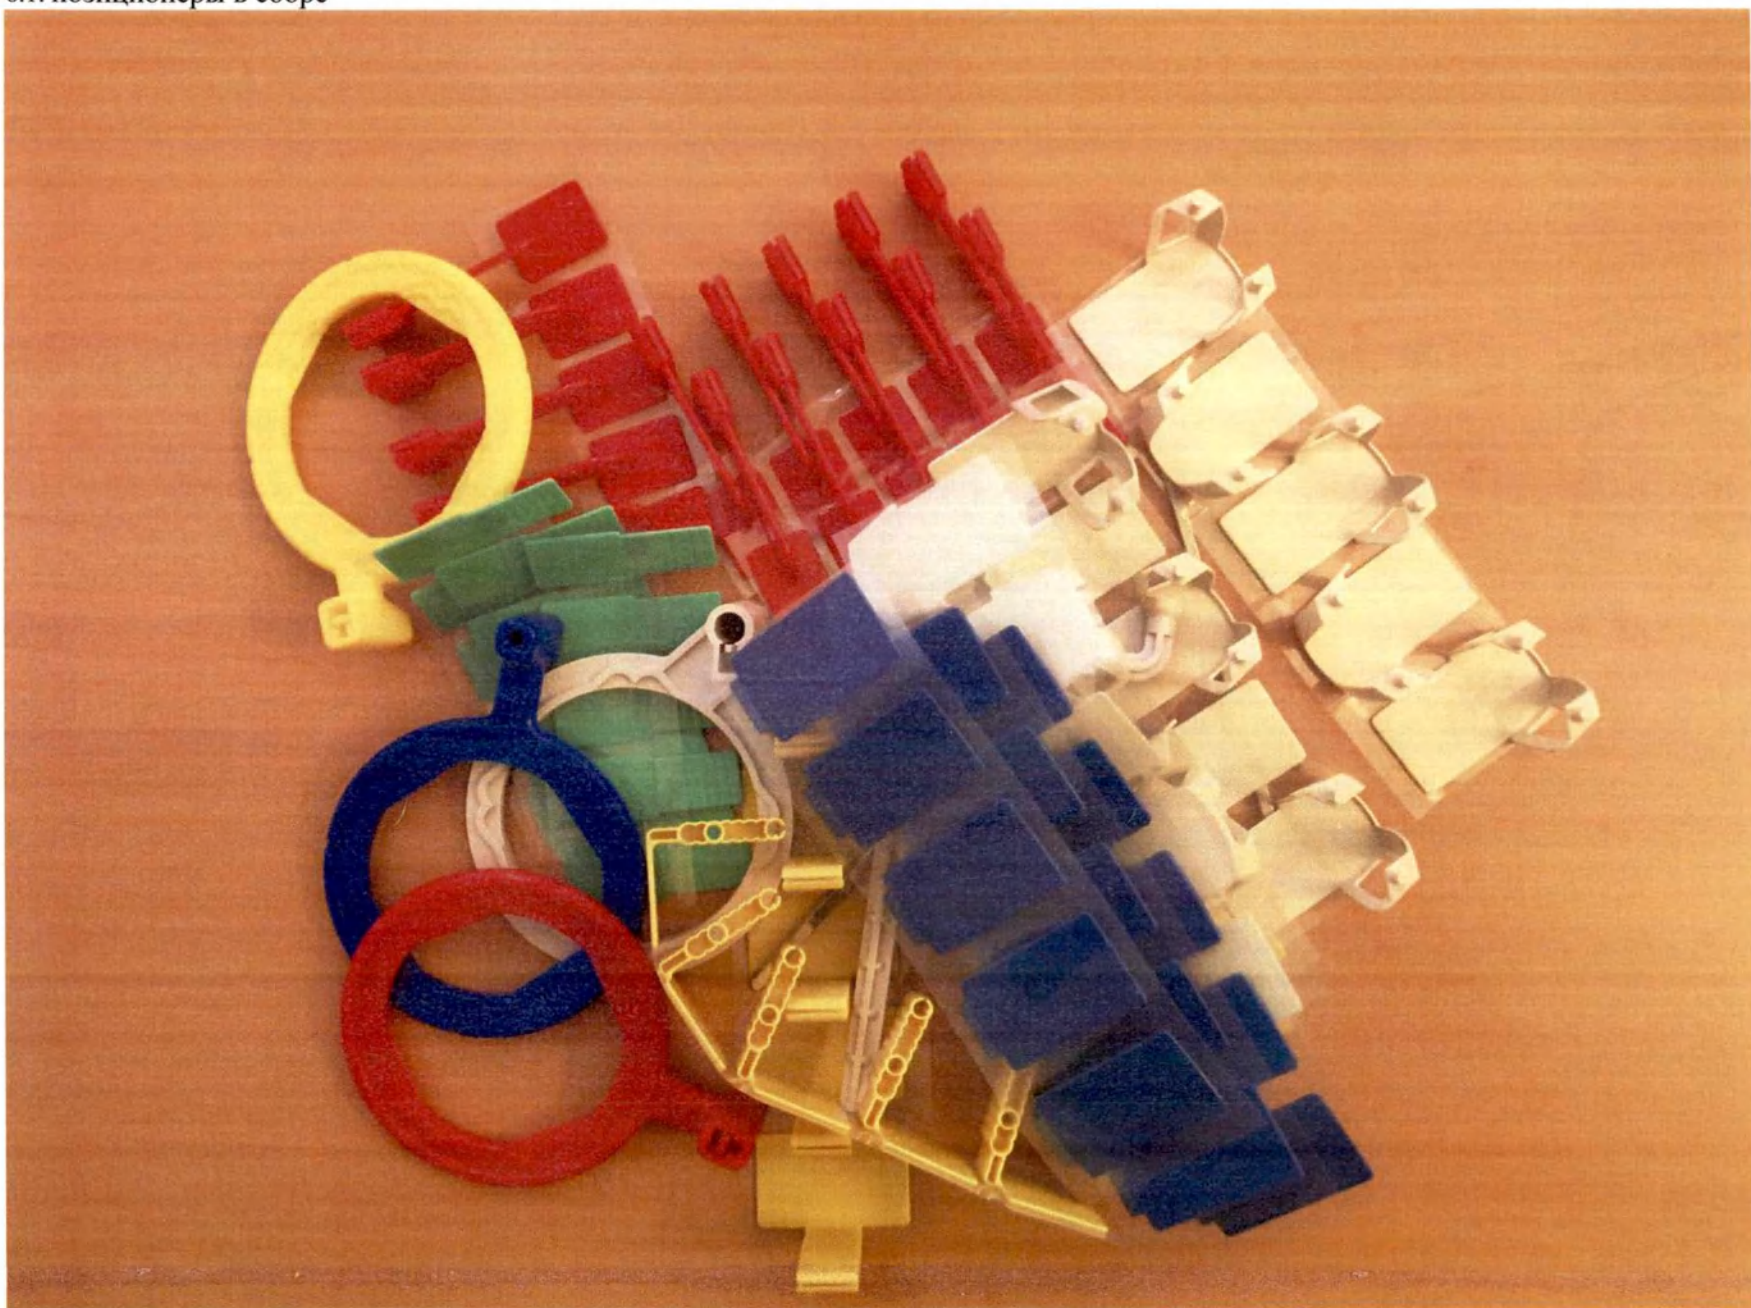


6.2. чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков



Принадлежности к системе XIOS XG Select USB. 1.Сенсоры XIOS XG Select: размер 0; размер 1; размер 2.




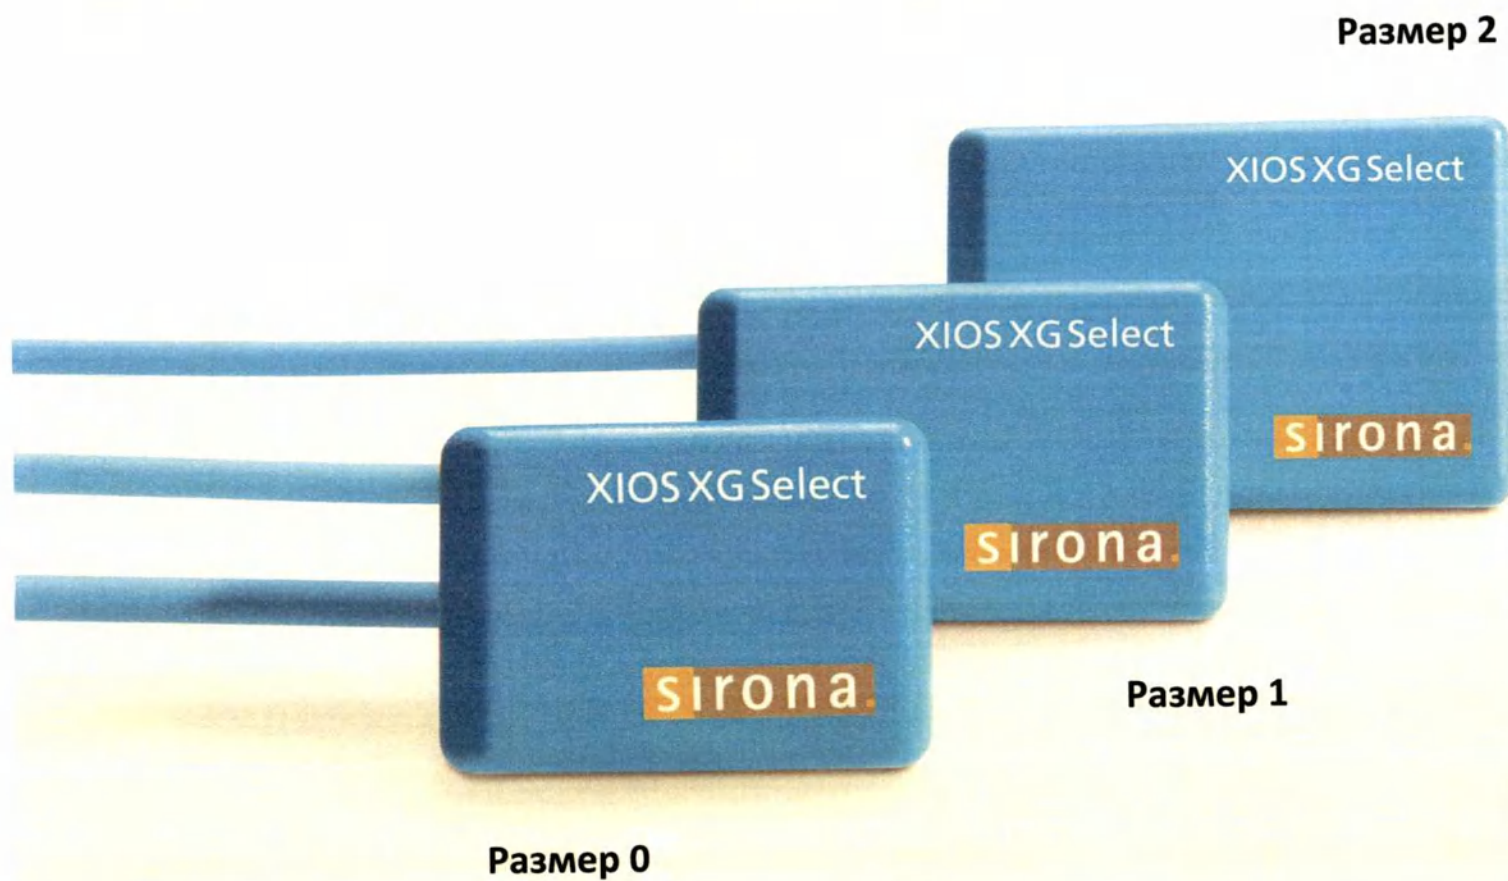

2. Настенный держатель датчика XIOS XG




3. Настенное крепление для модуля USB

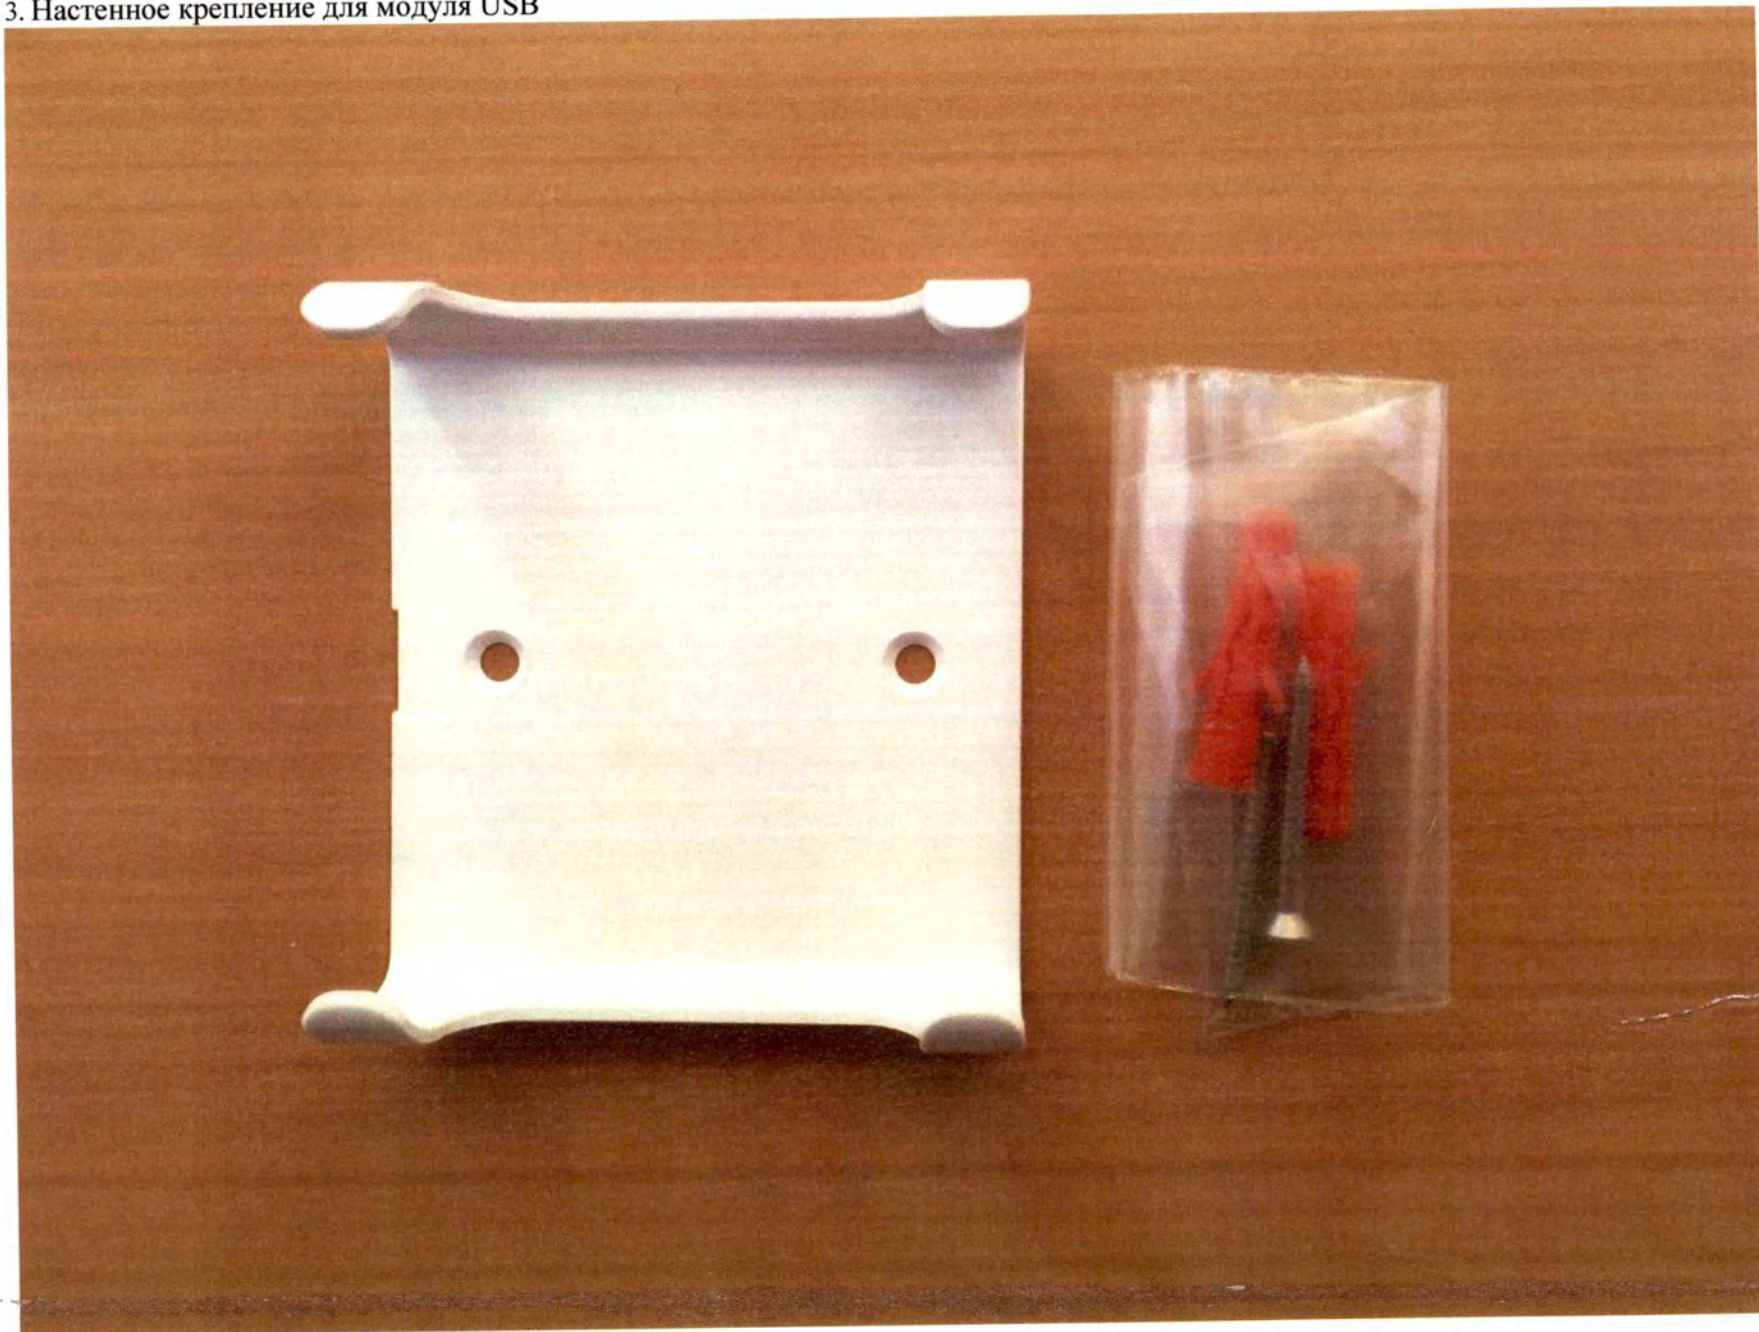


4. Адаптер для настенного модуля.




5. Настенный модуль для подключения датчиков.

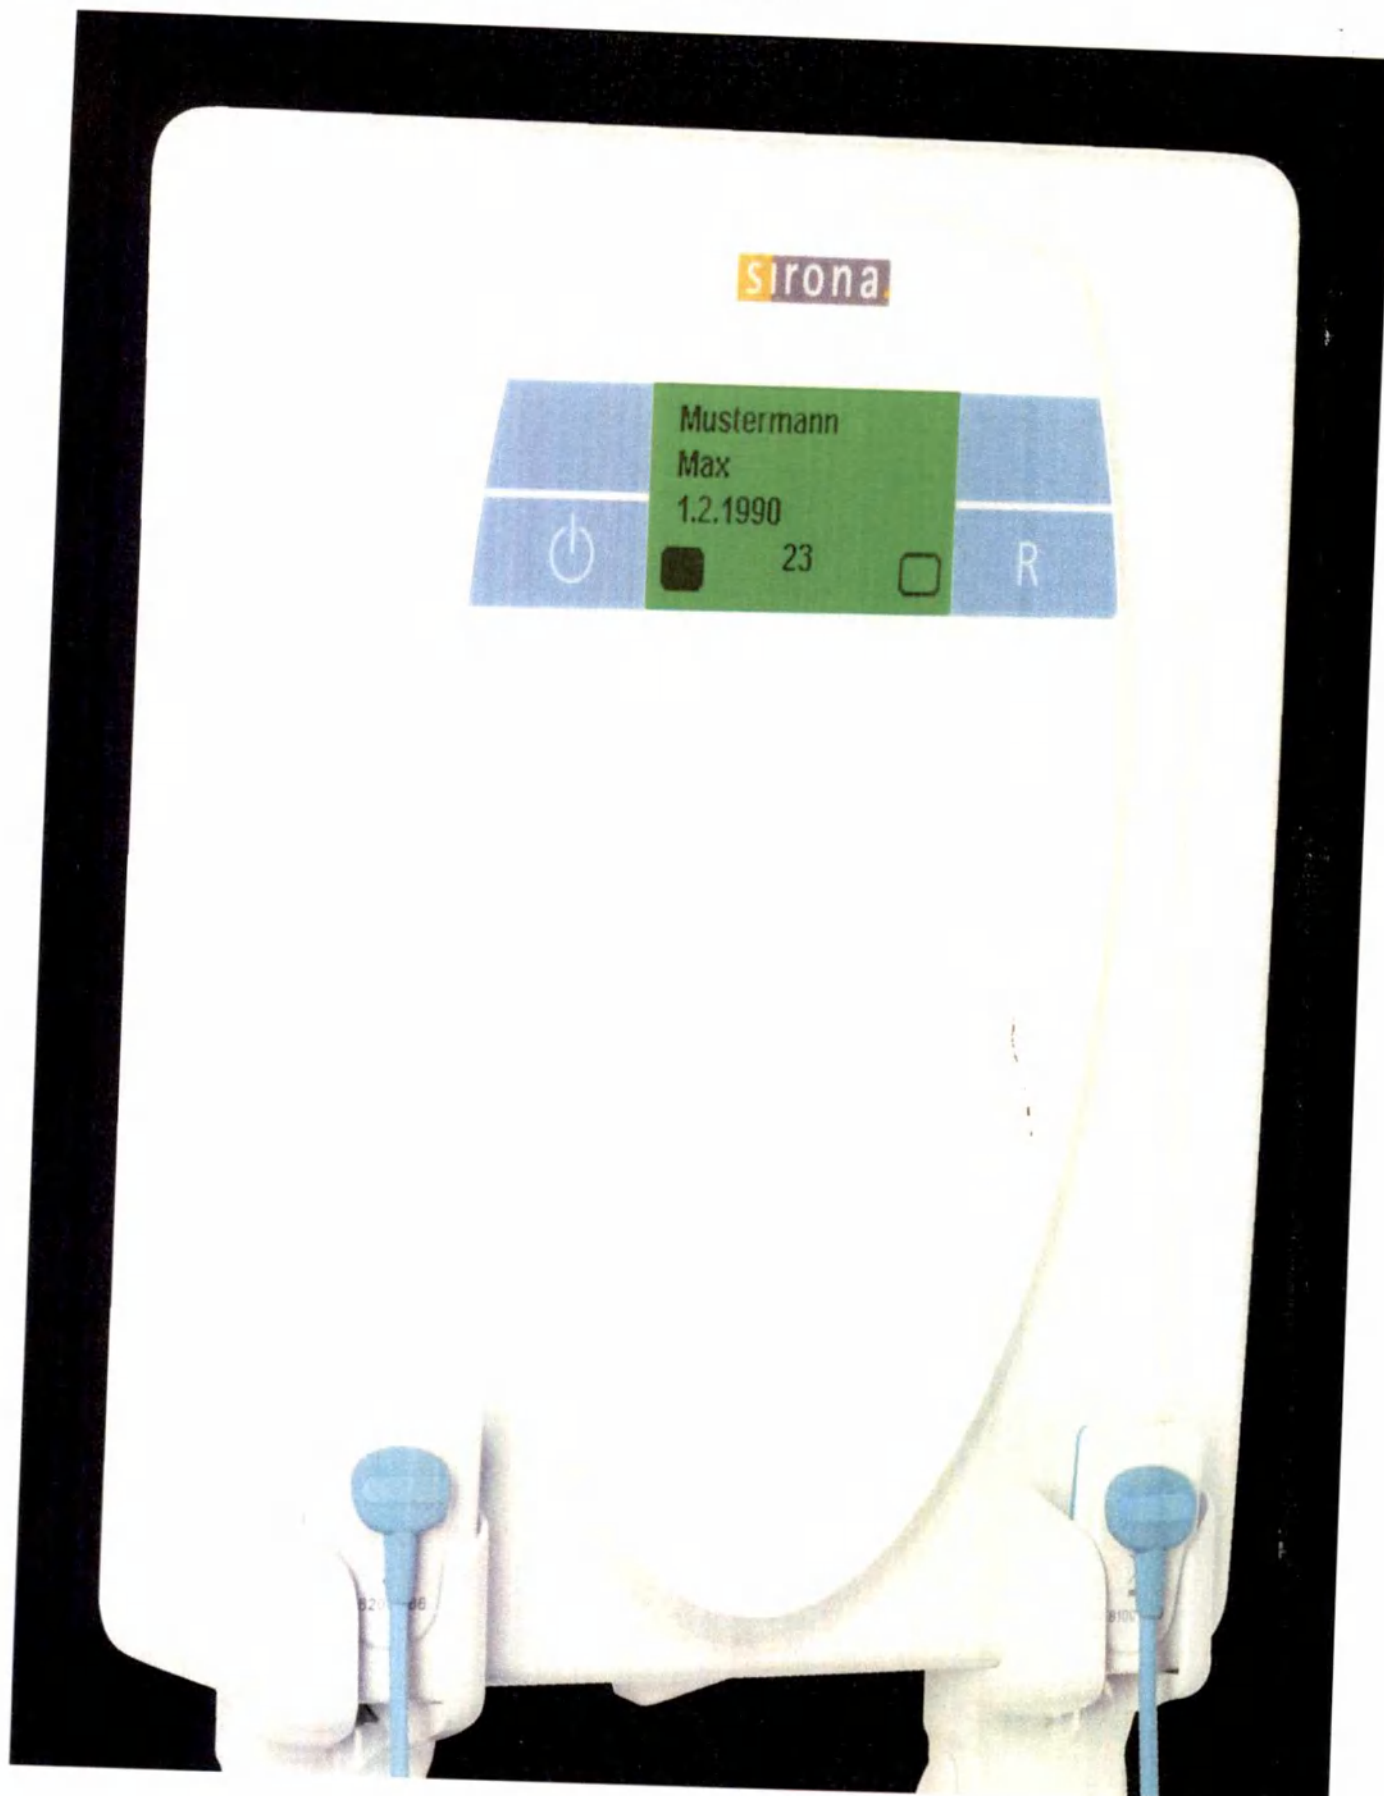


6. Кабель XIOS XG USB A/B.

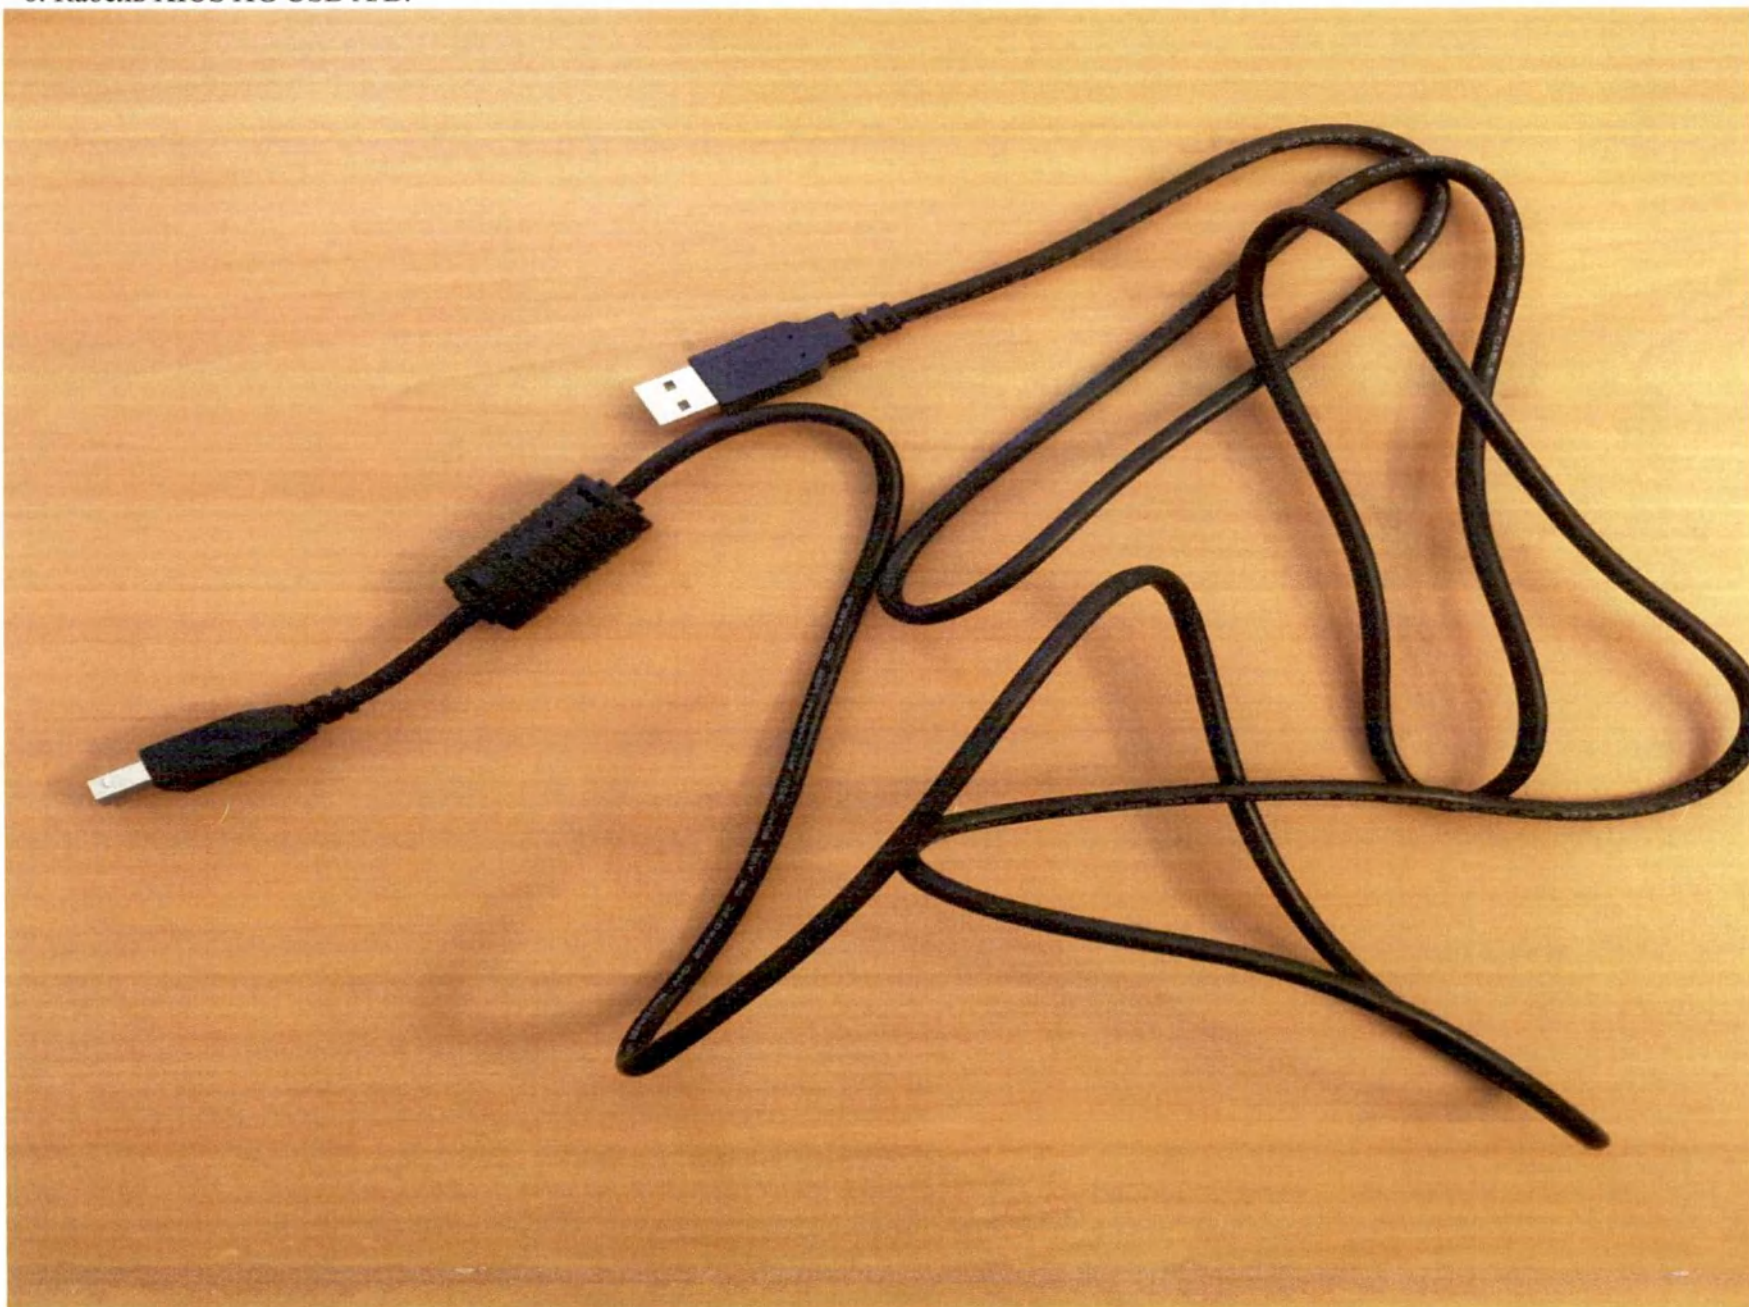


7. Кабели XIOS XG USB: длиной 90 см.

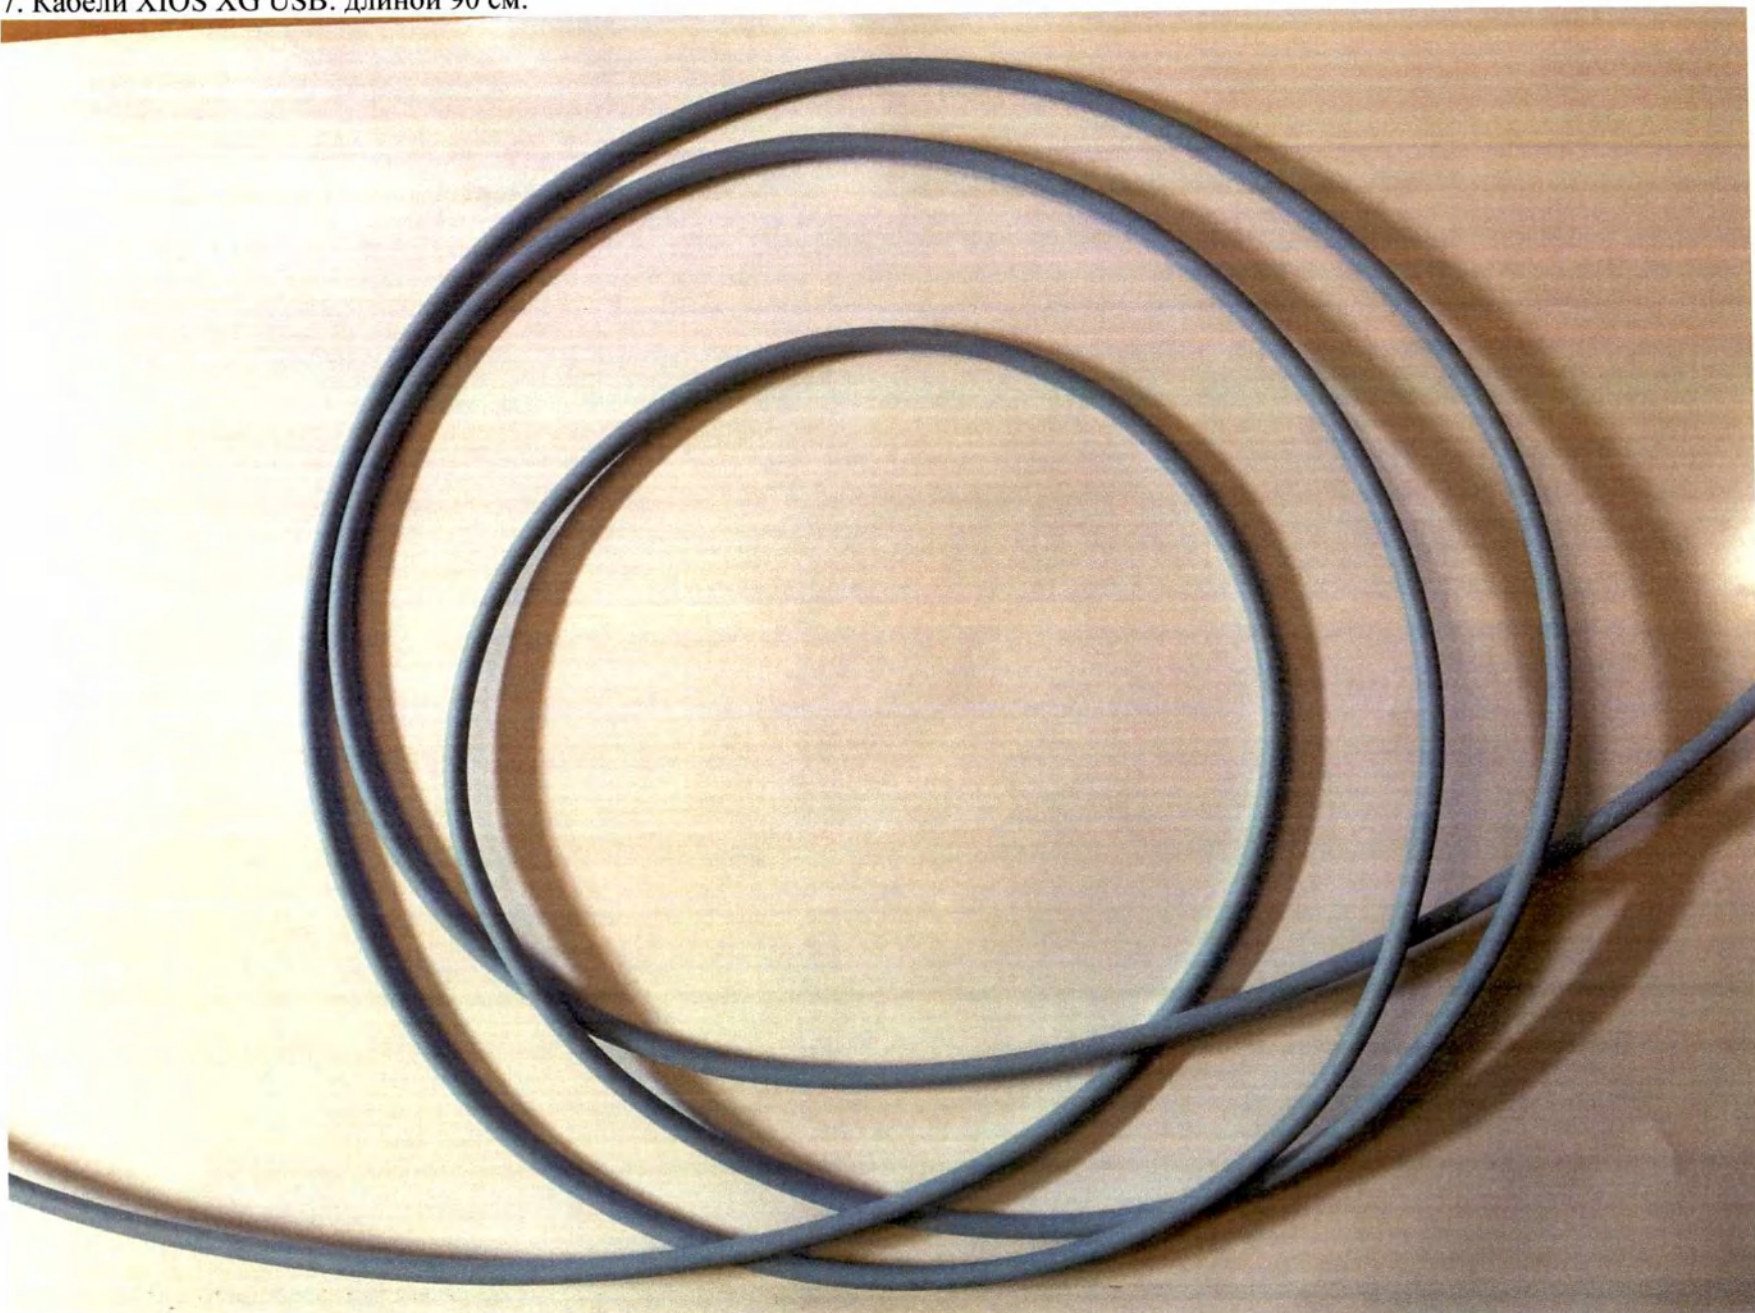

длиной 180 см.

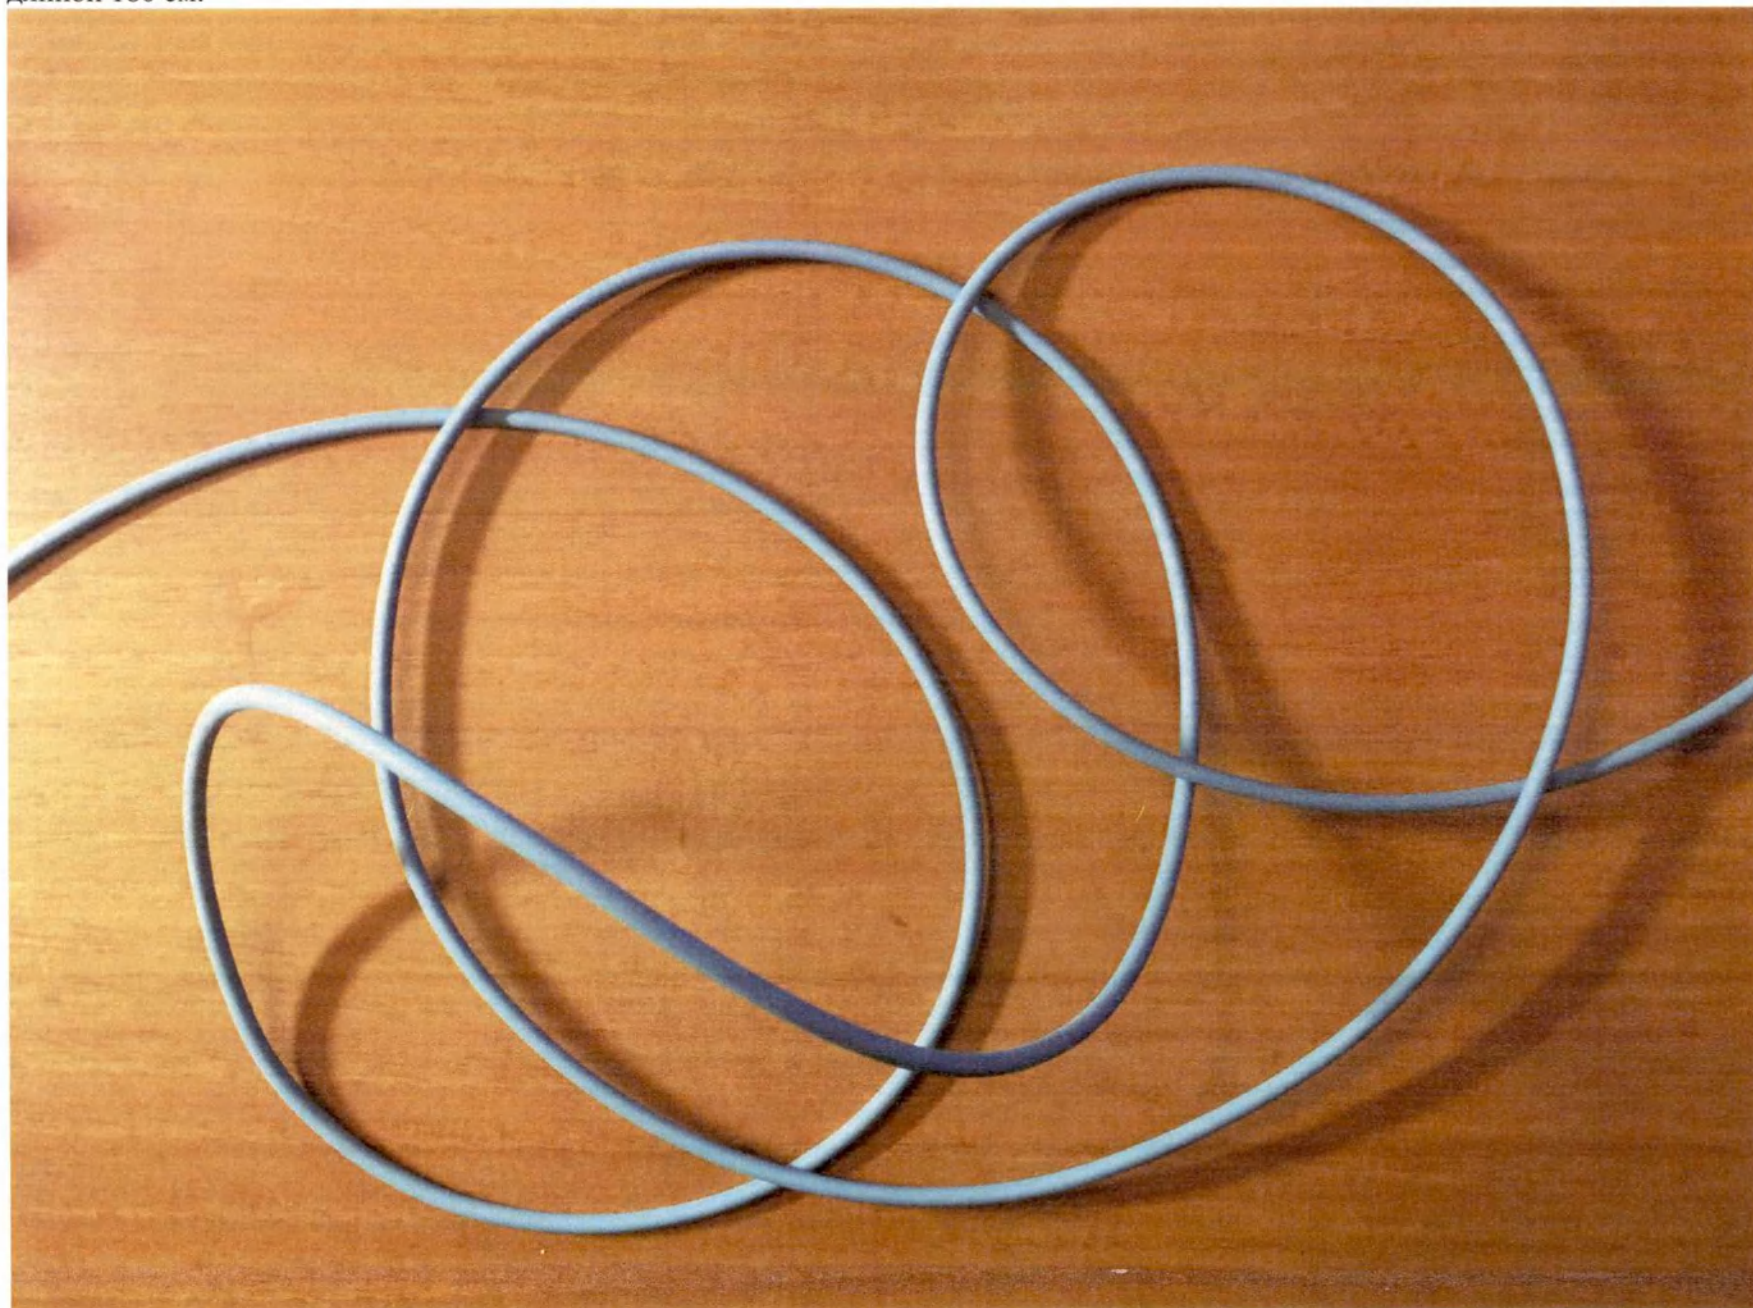


длиной 270 см

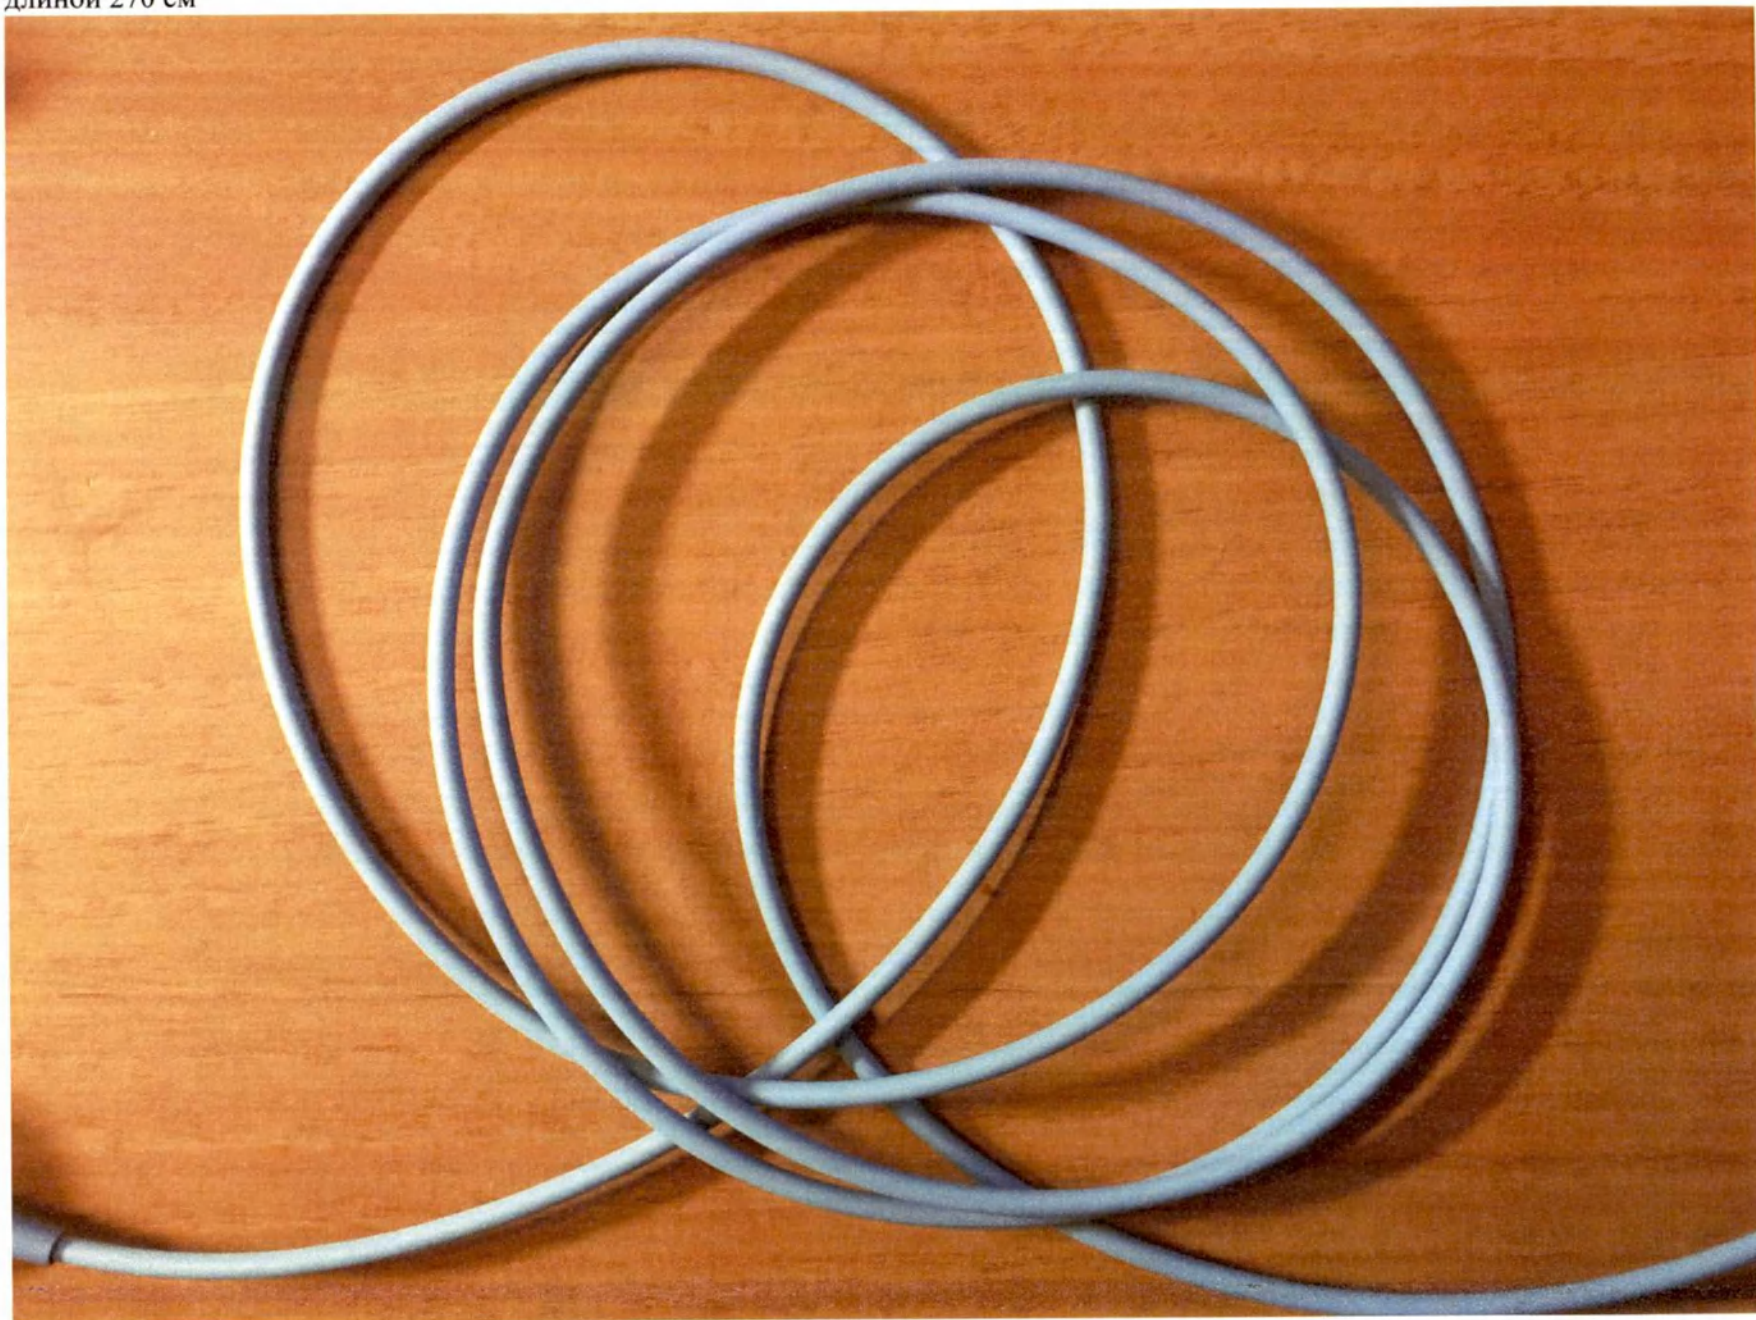

8. Стартовый комплект позиционеров для датчиков XIOS XG Starter Kit, в составе:




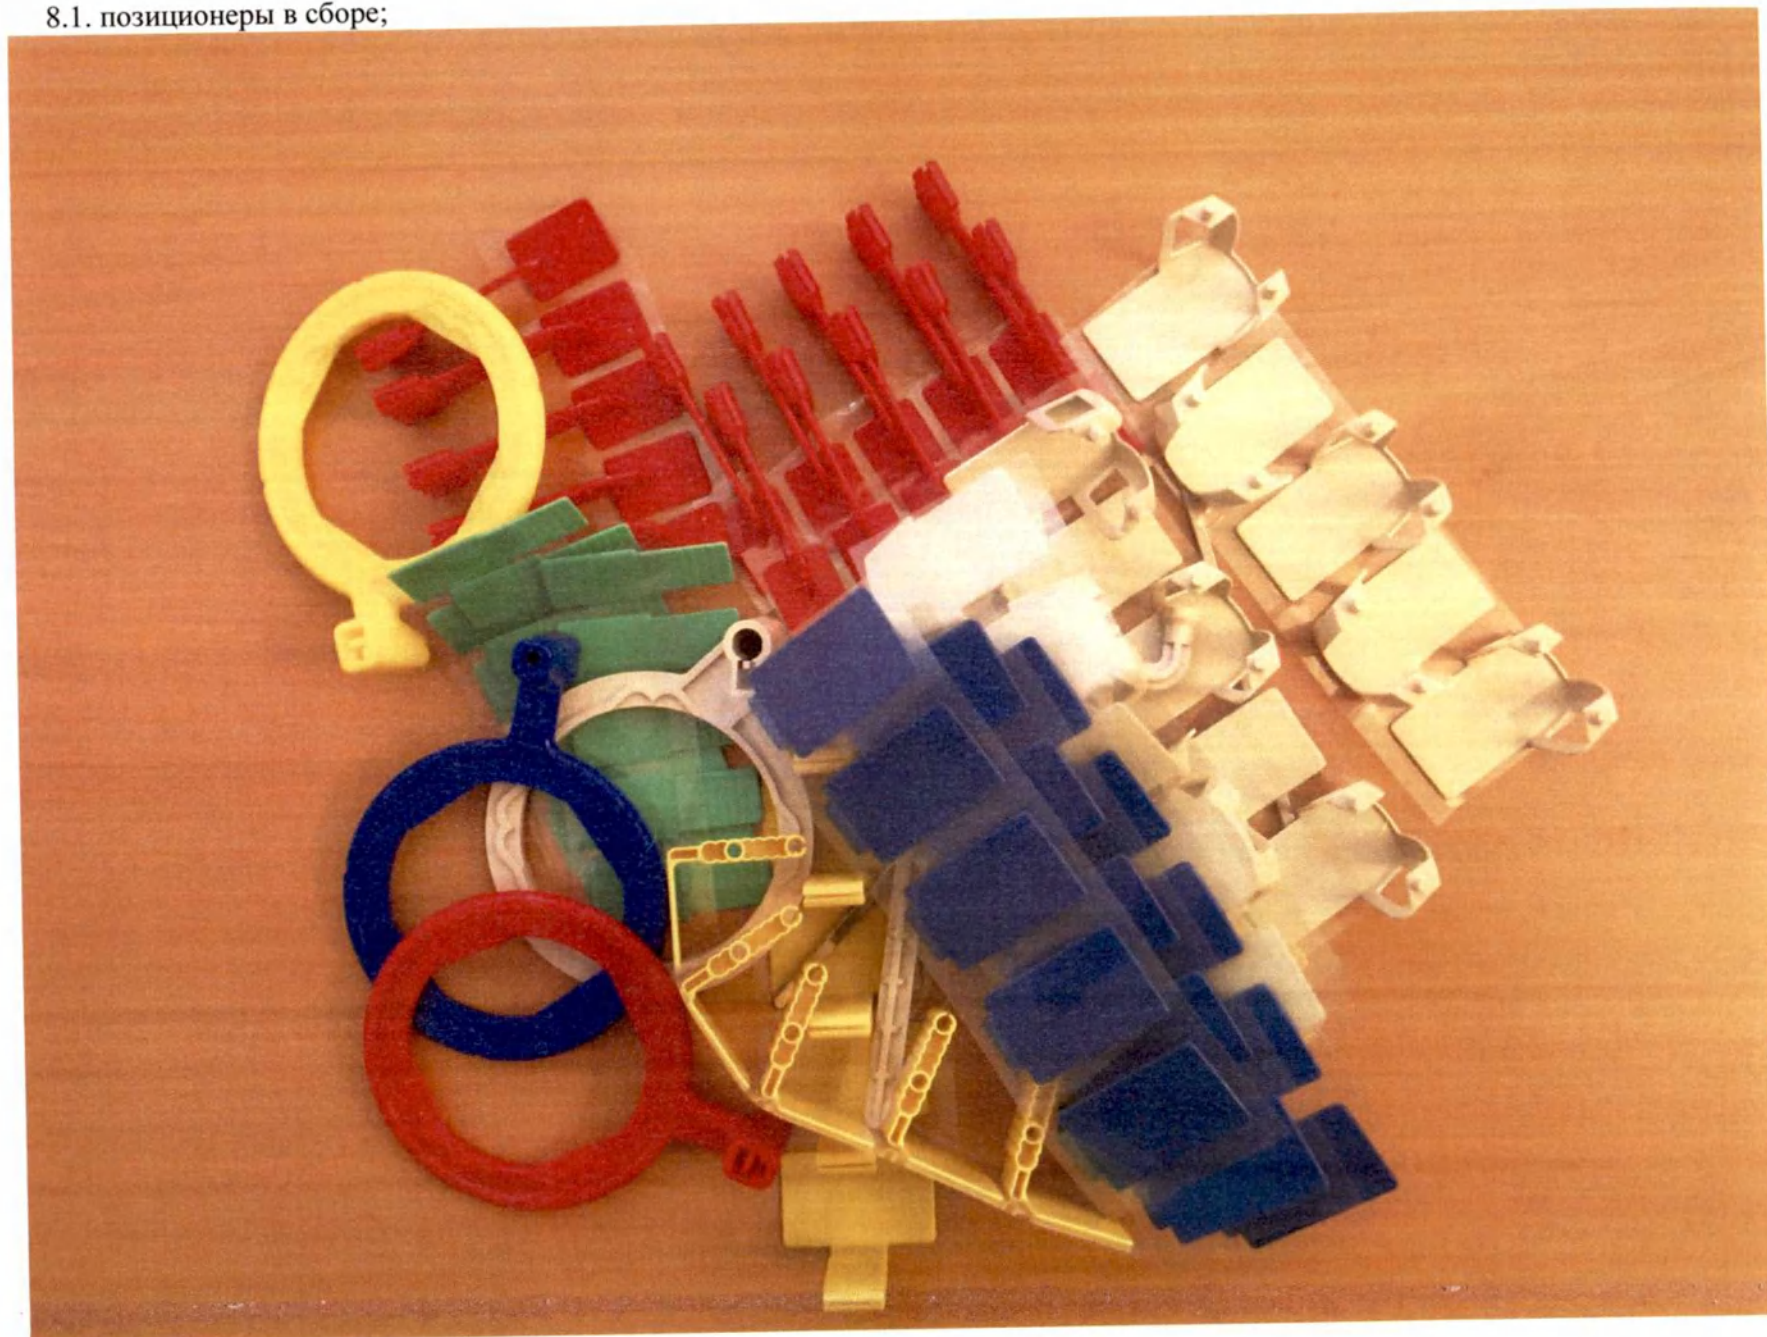


8.2. чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков.




9. Чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков.

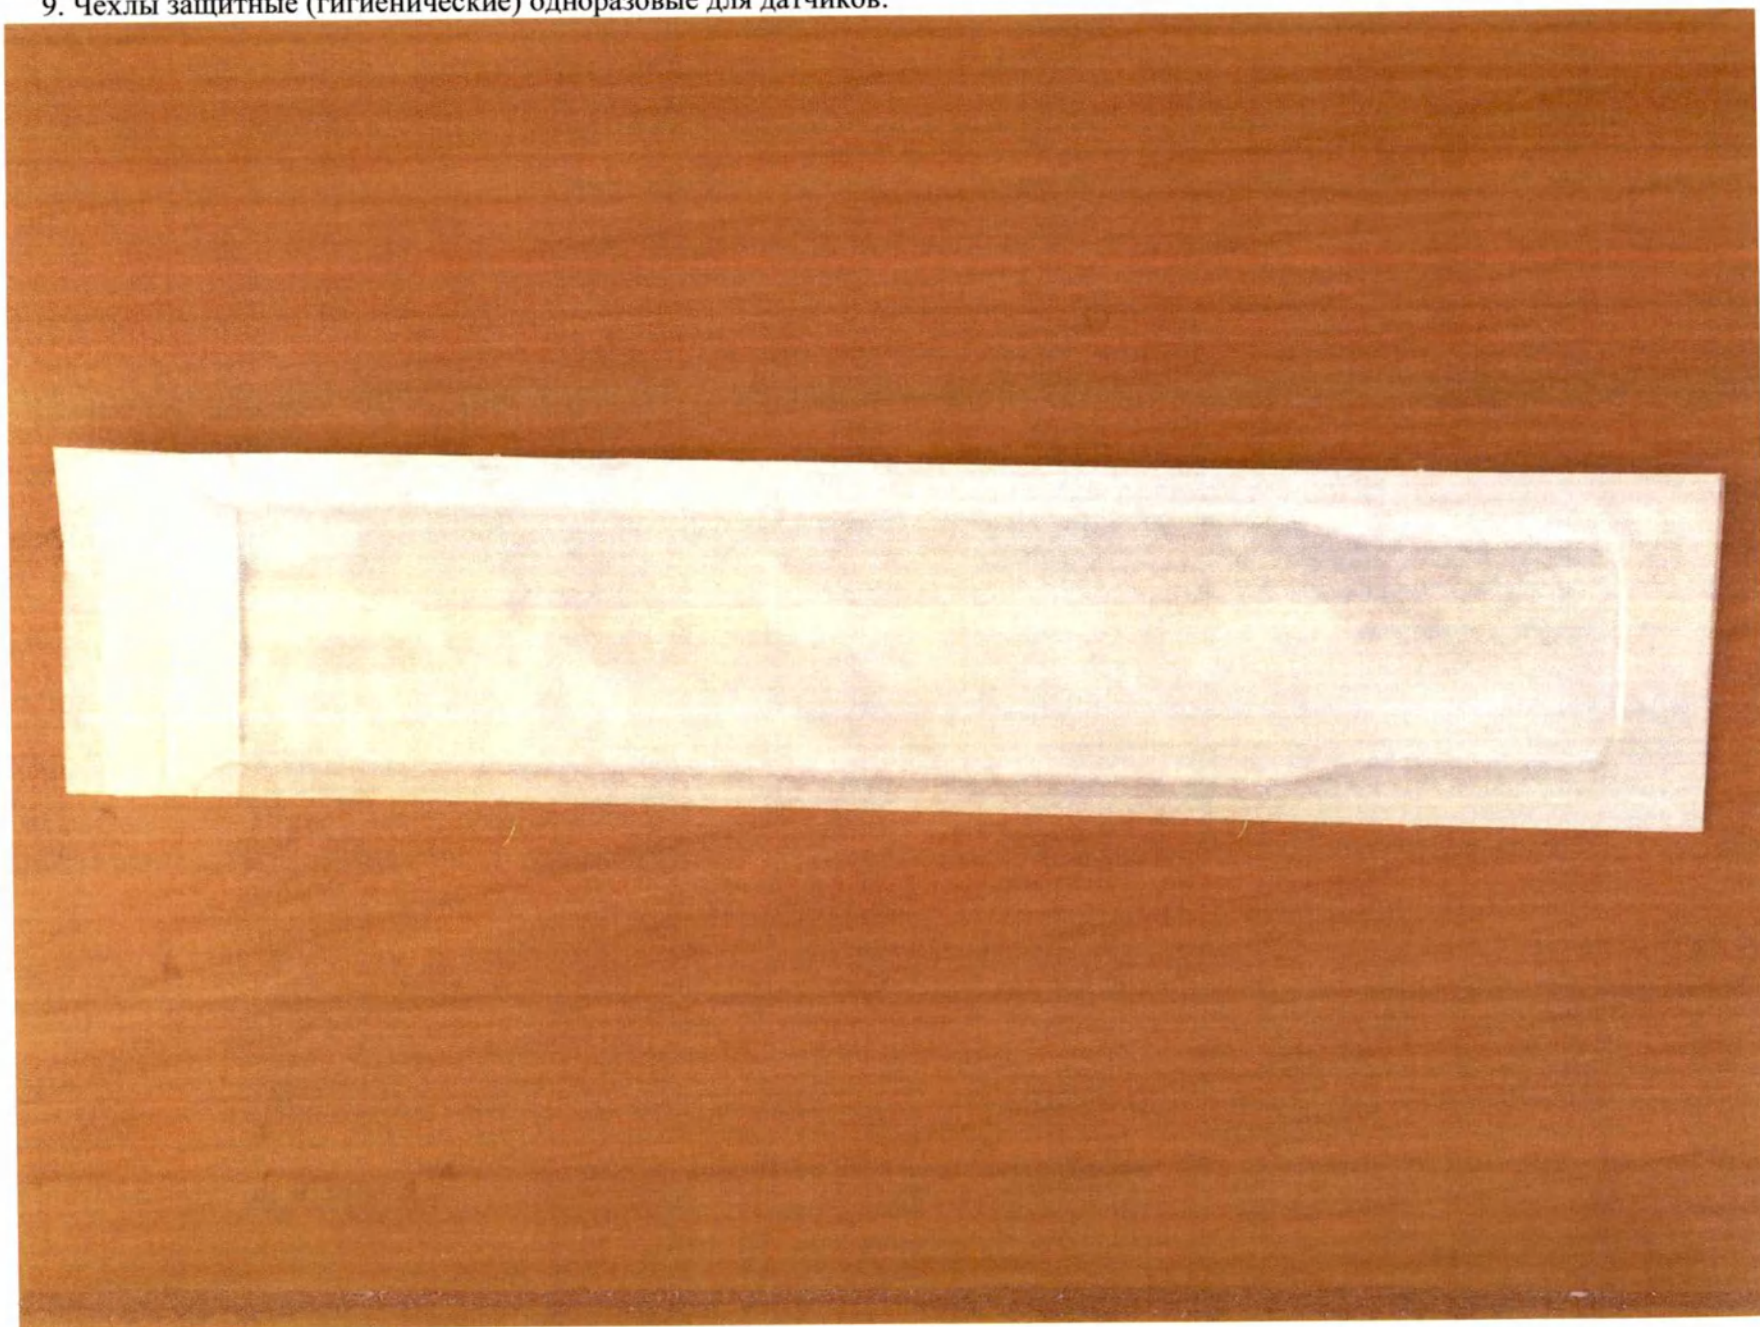


Синие

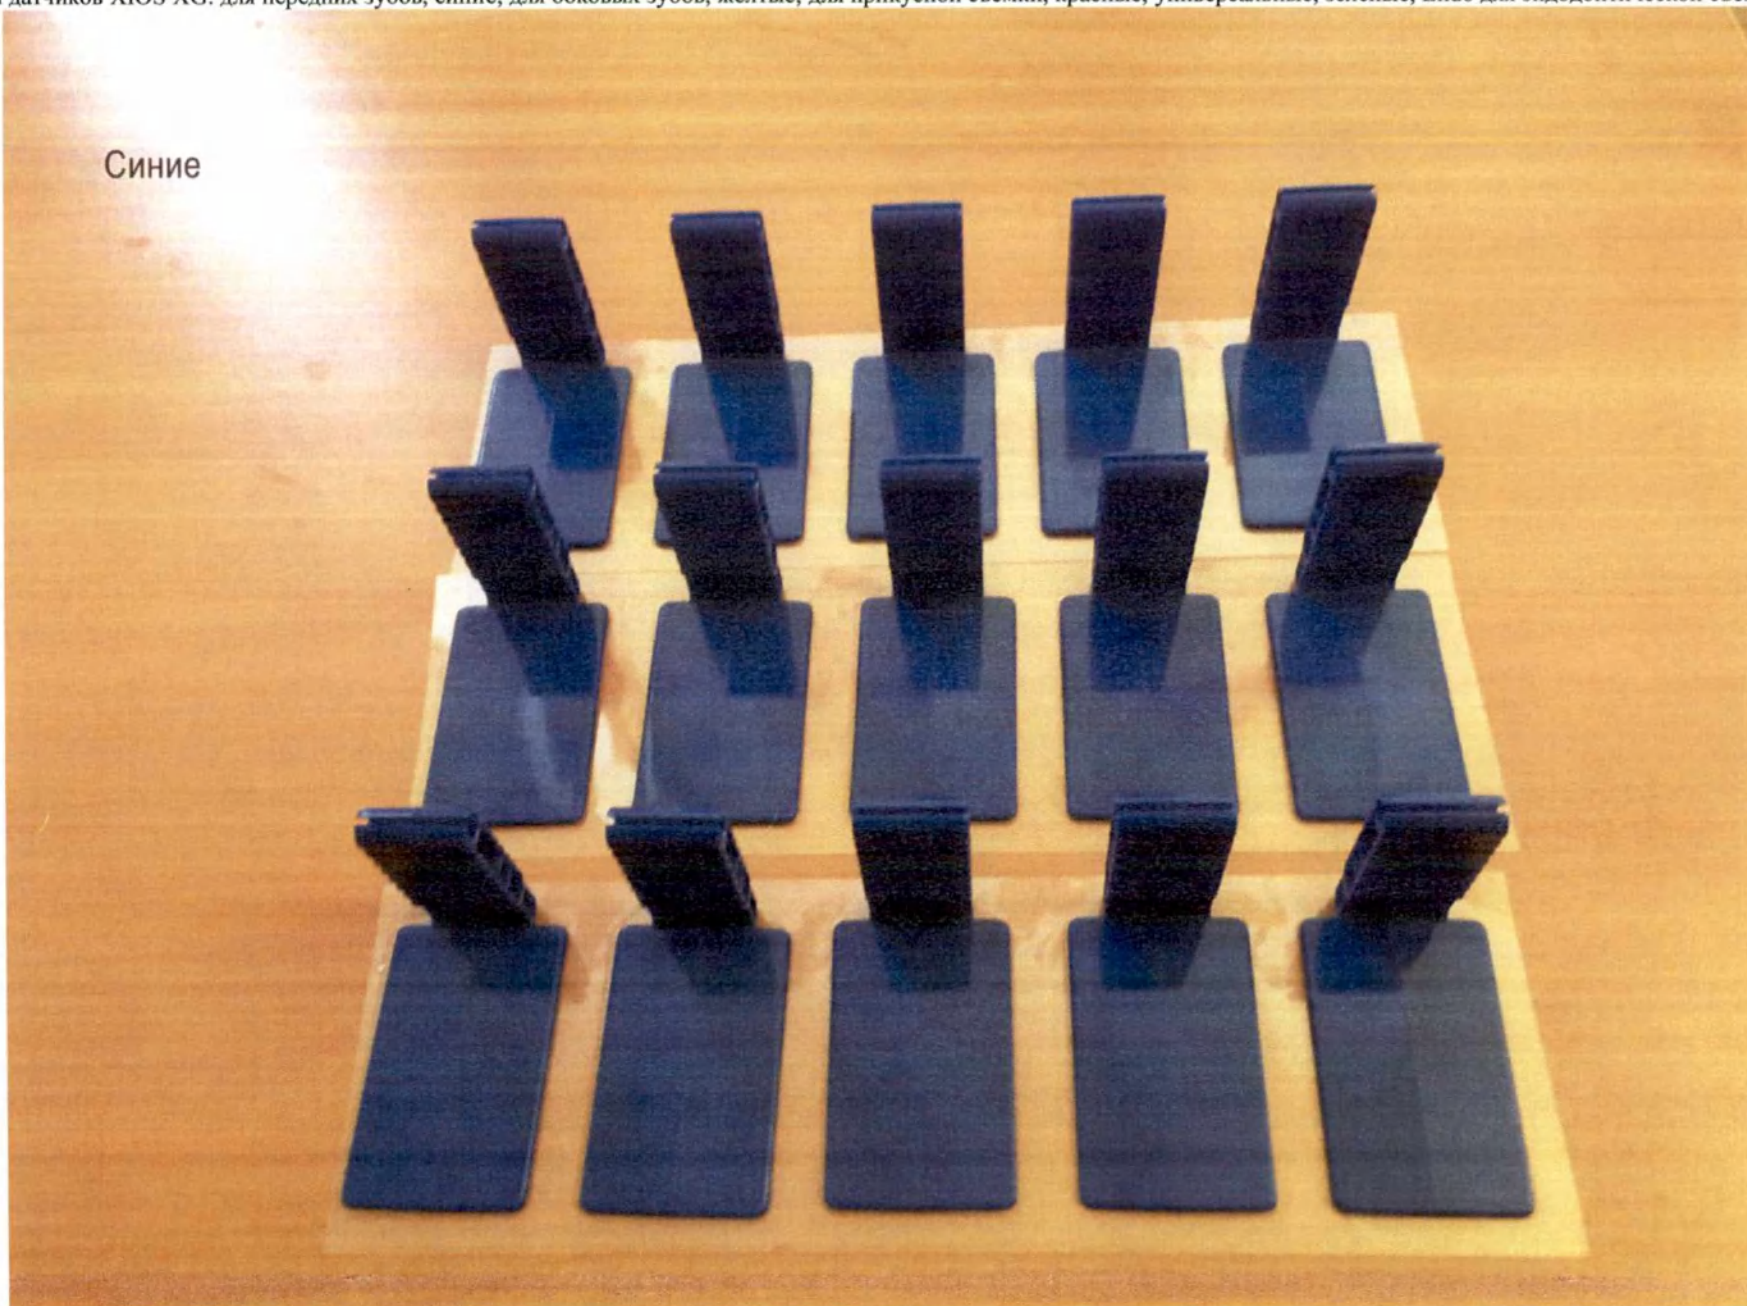

Желтые

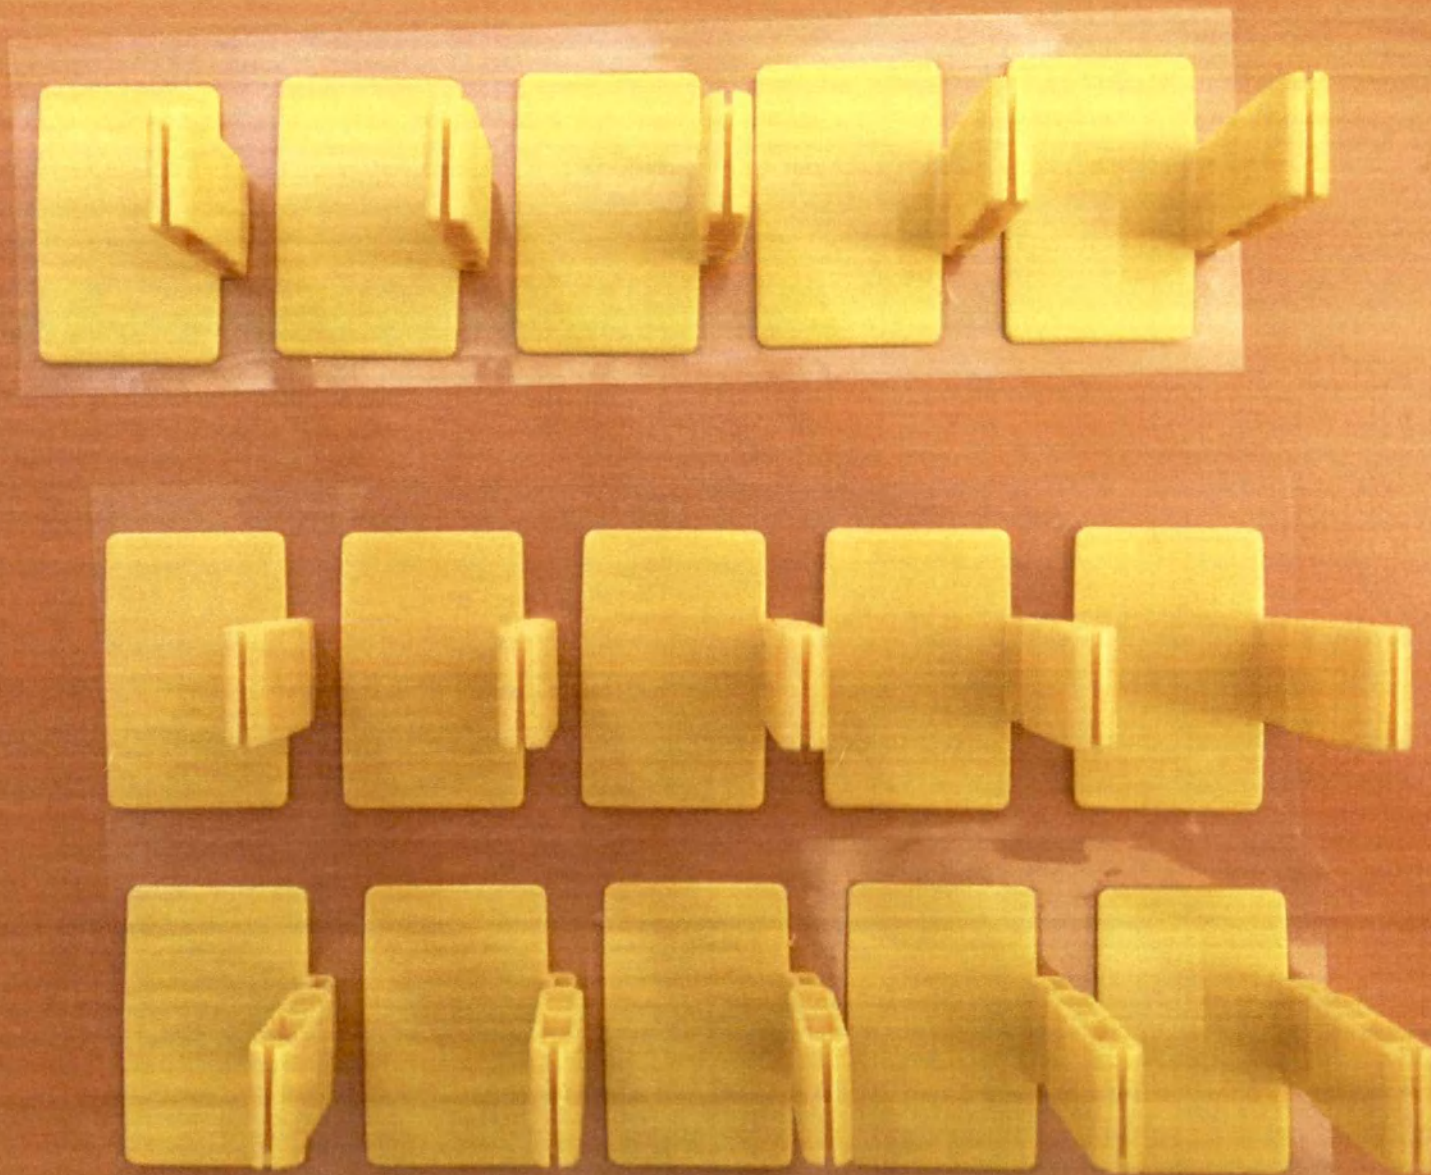

Красные

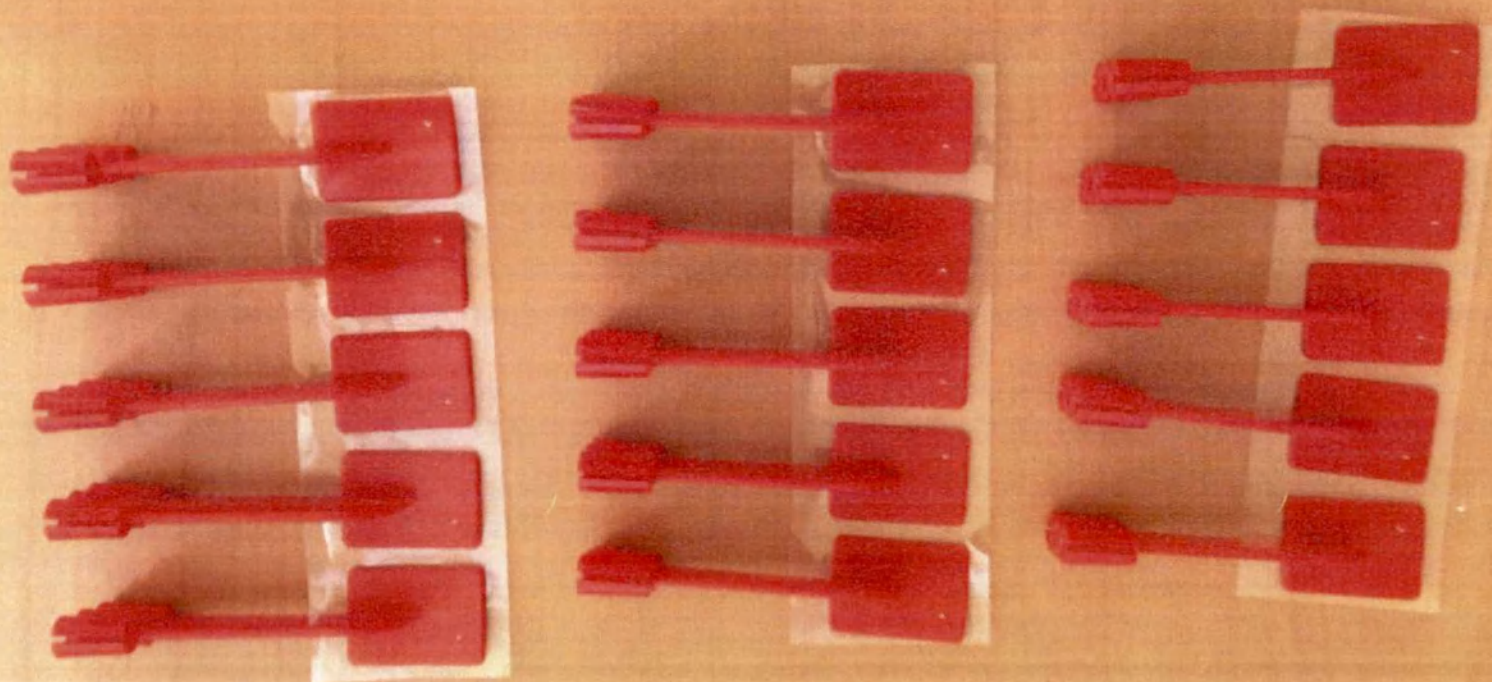


Зеленые




Серые




11. Комплекты для замены кабеля XIOS XG USB Cable Kit, в составе:

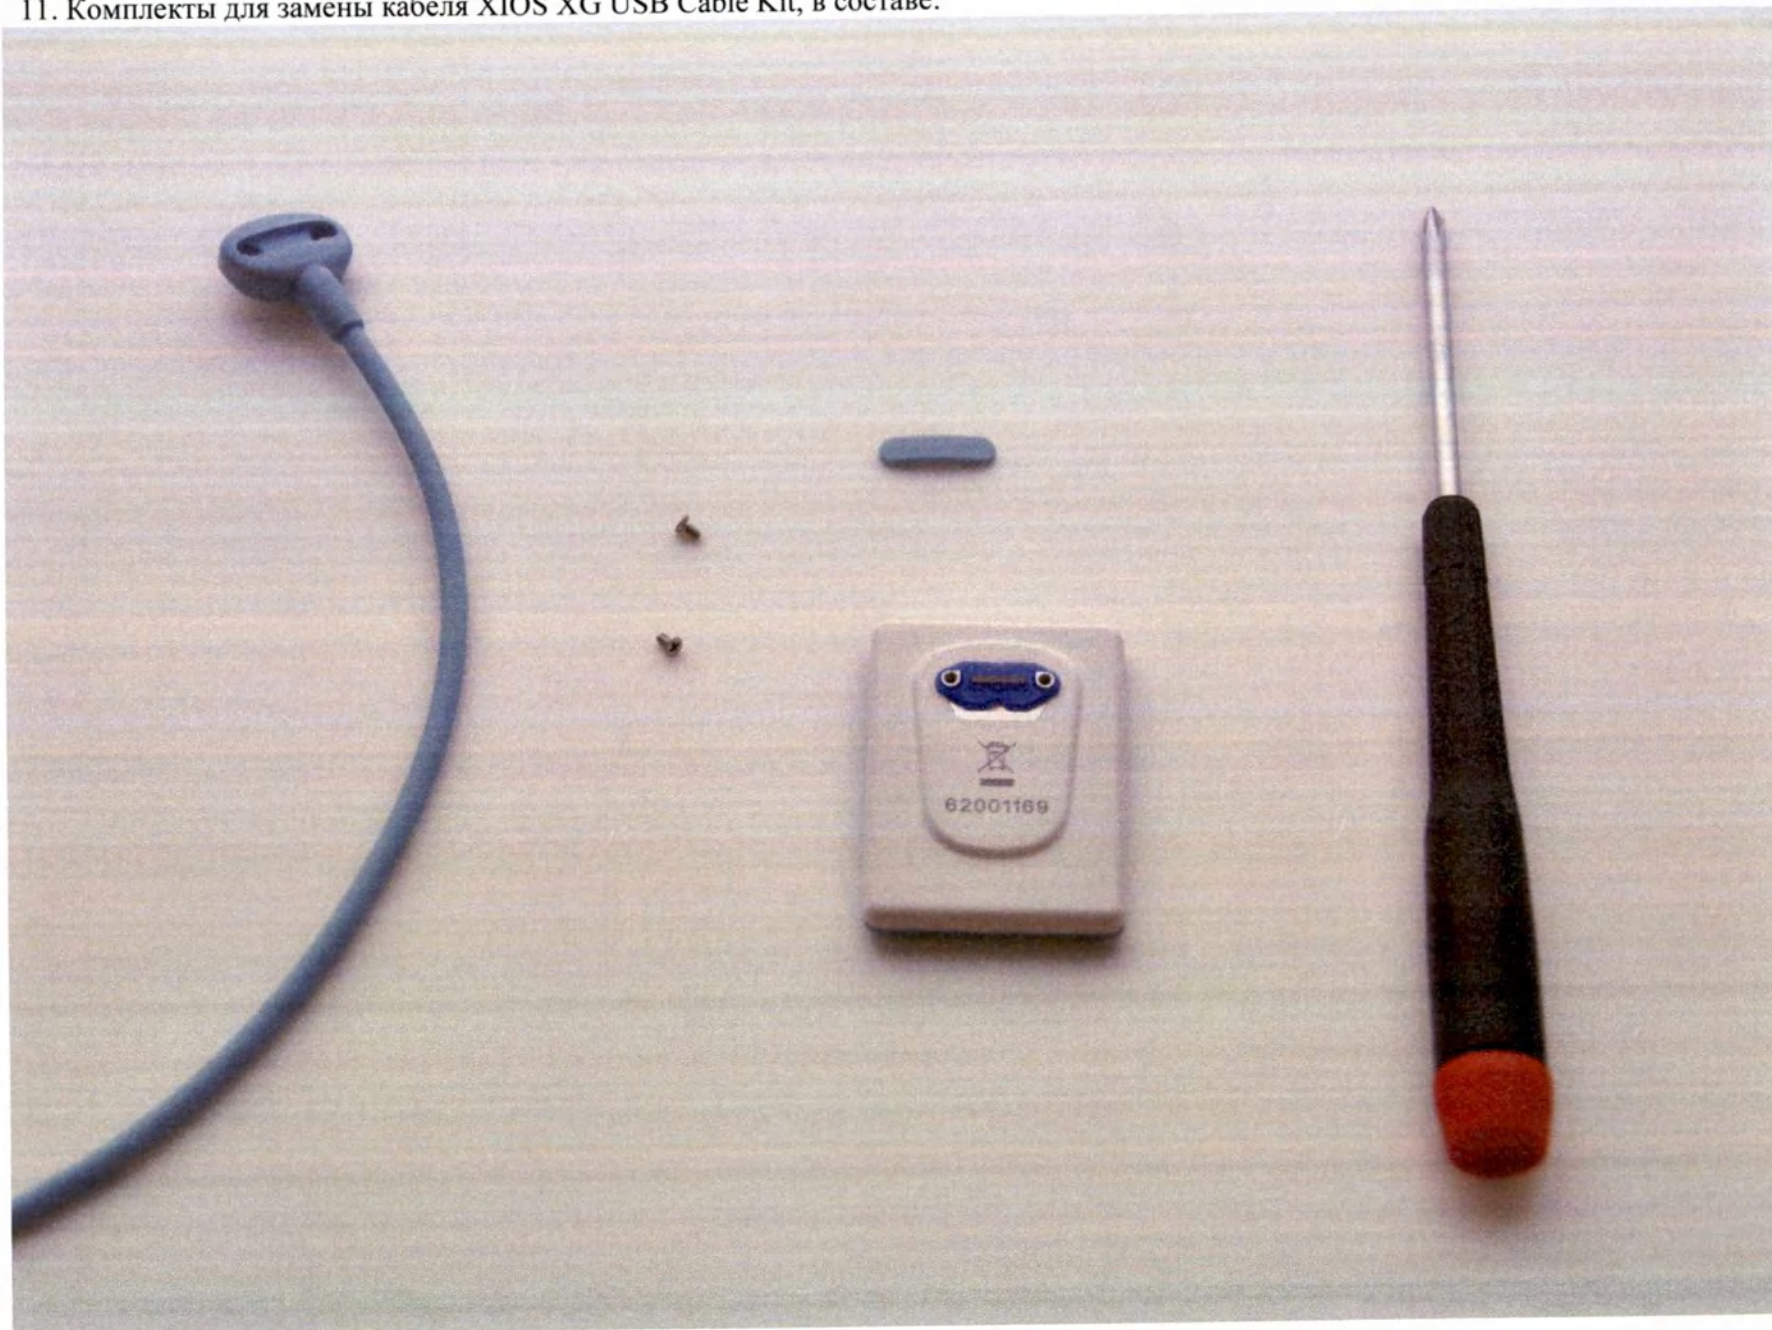


11.1. кабель датчика: длиной 90 см; длиной 180 см; длиной 270 см;

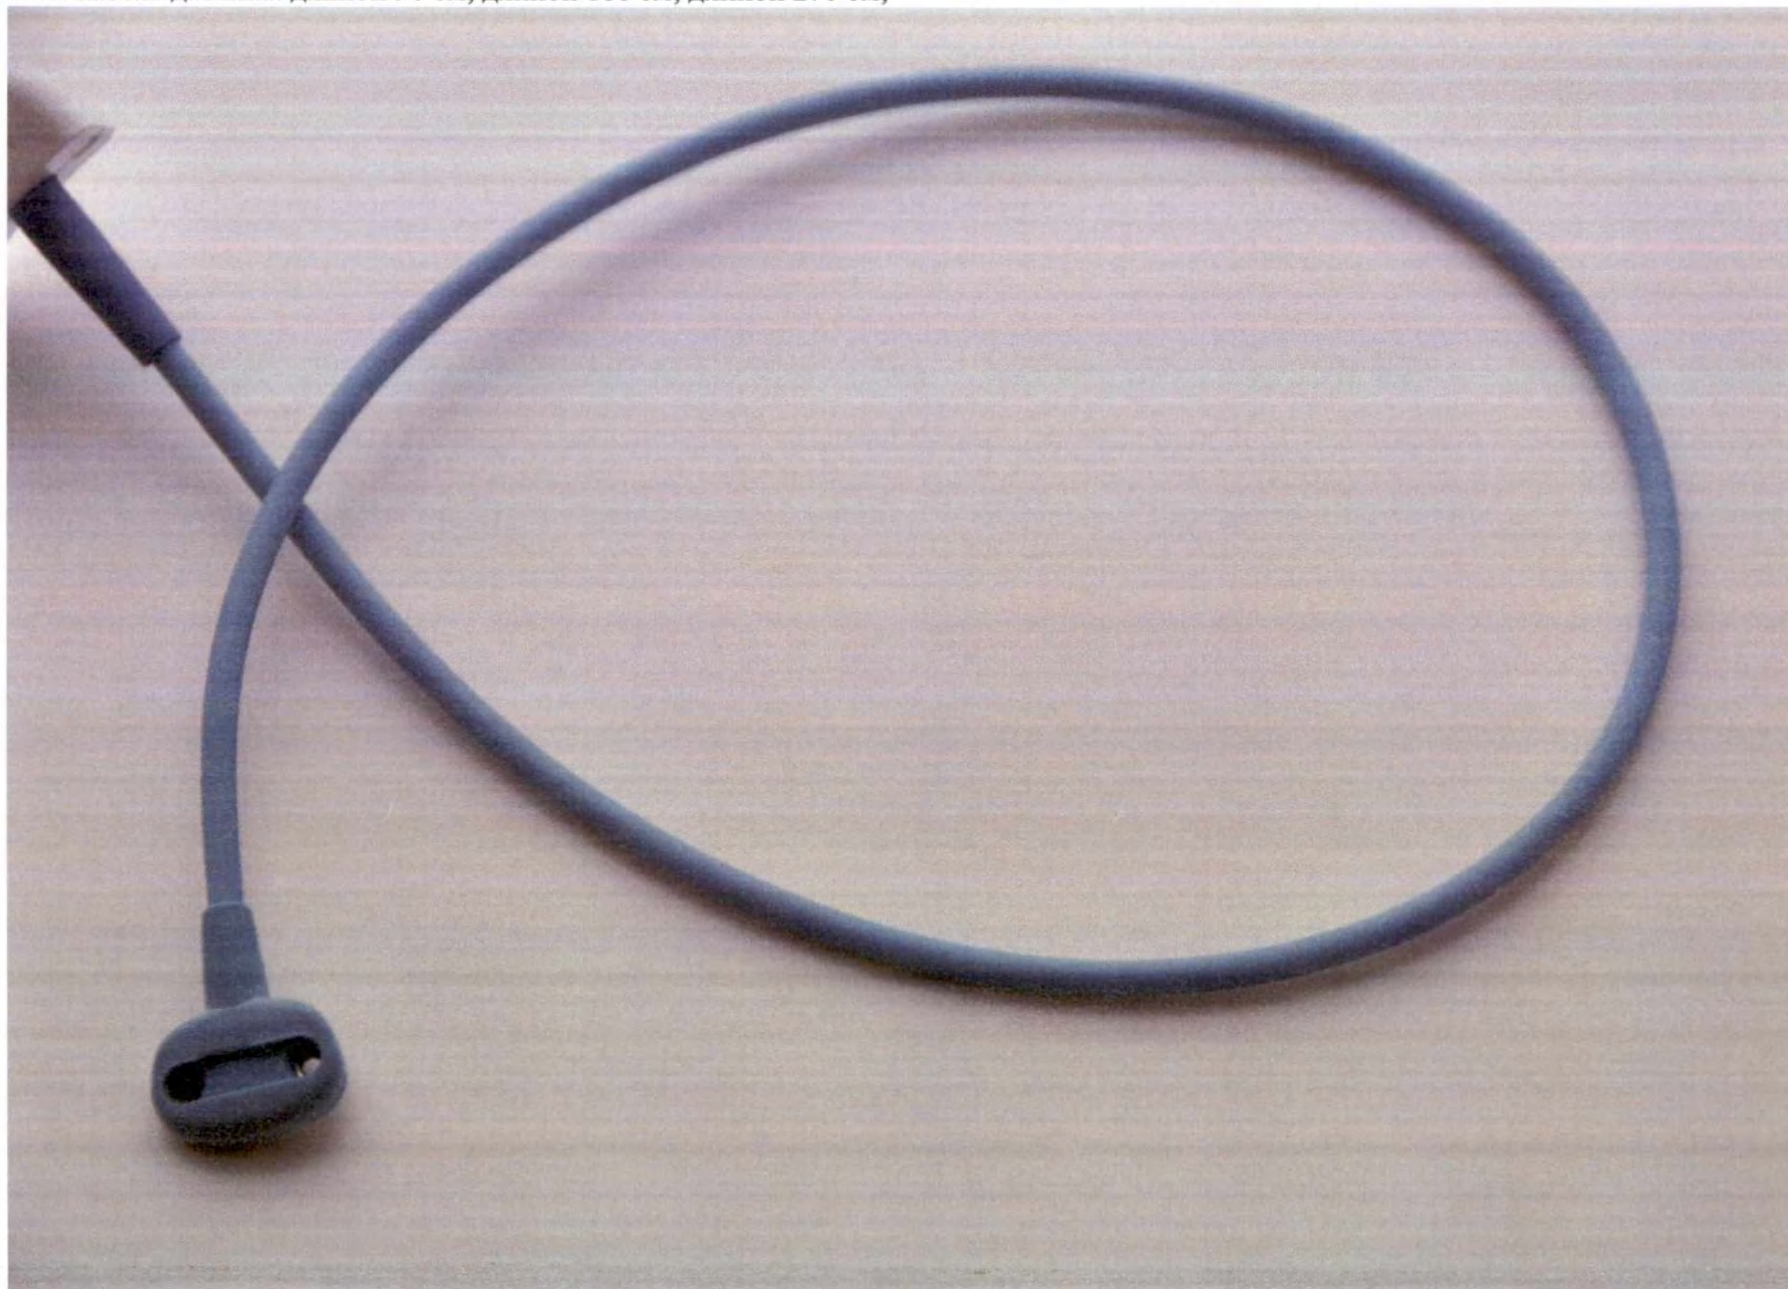


11.2. отвертка специальная;

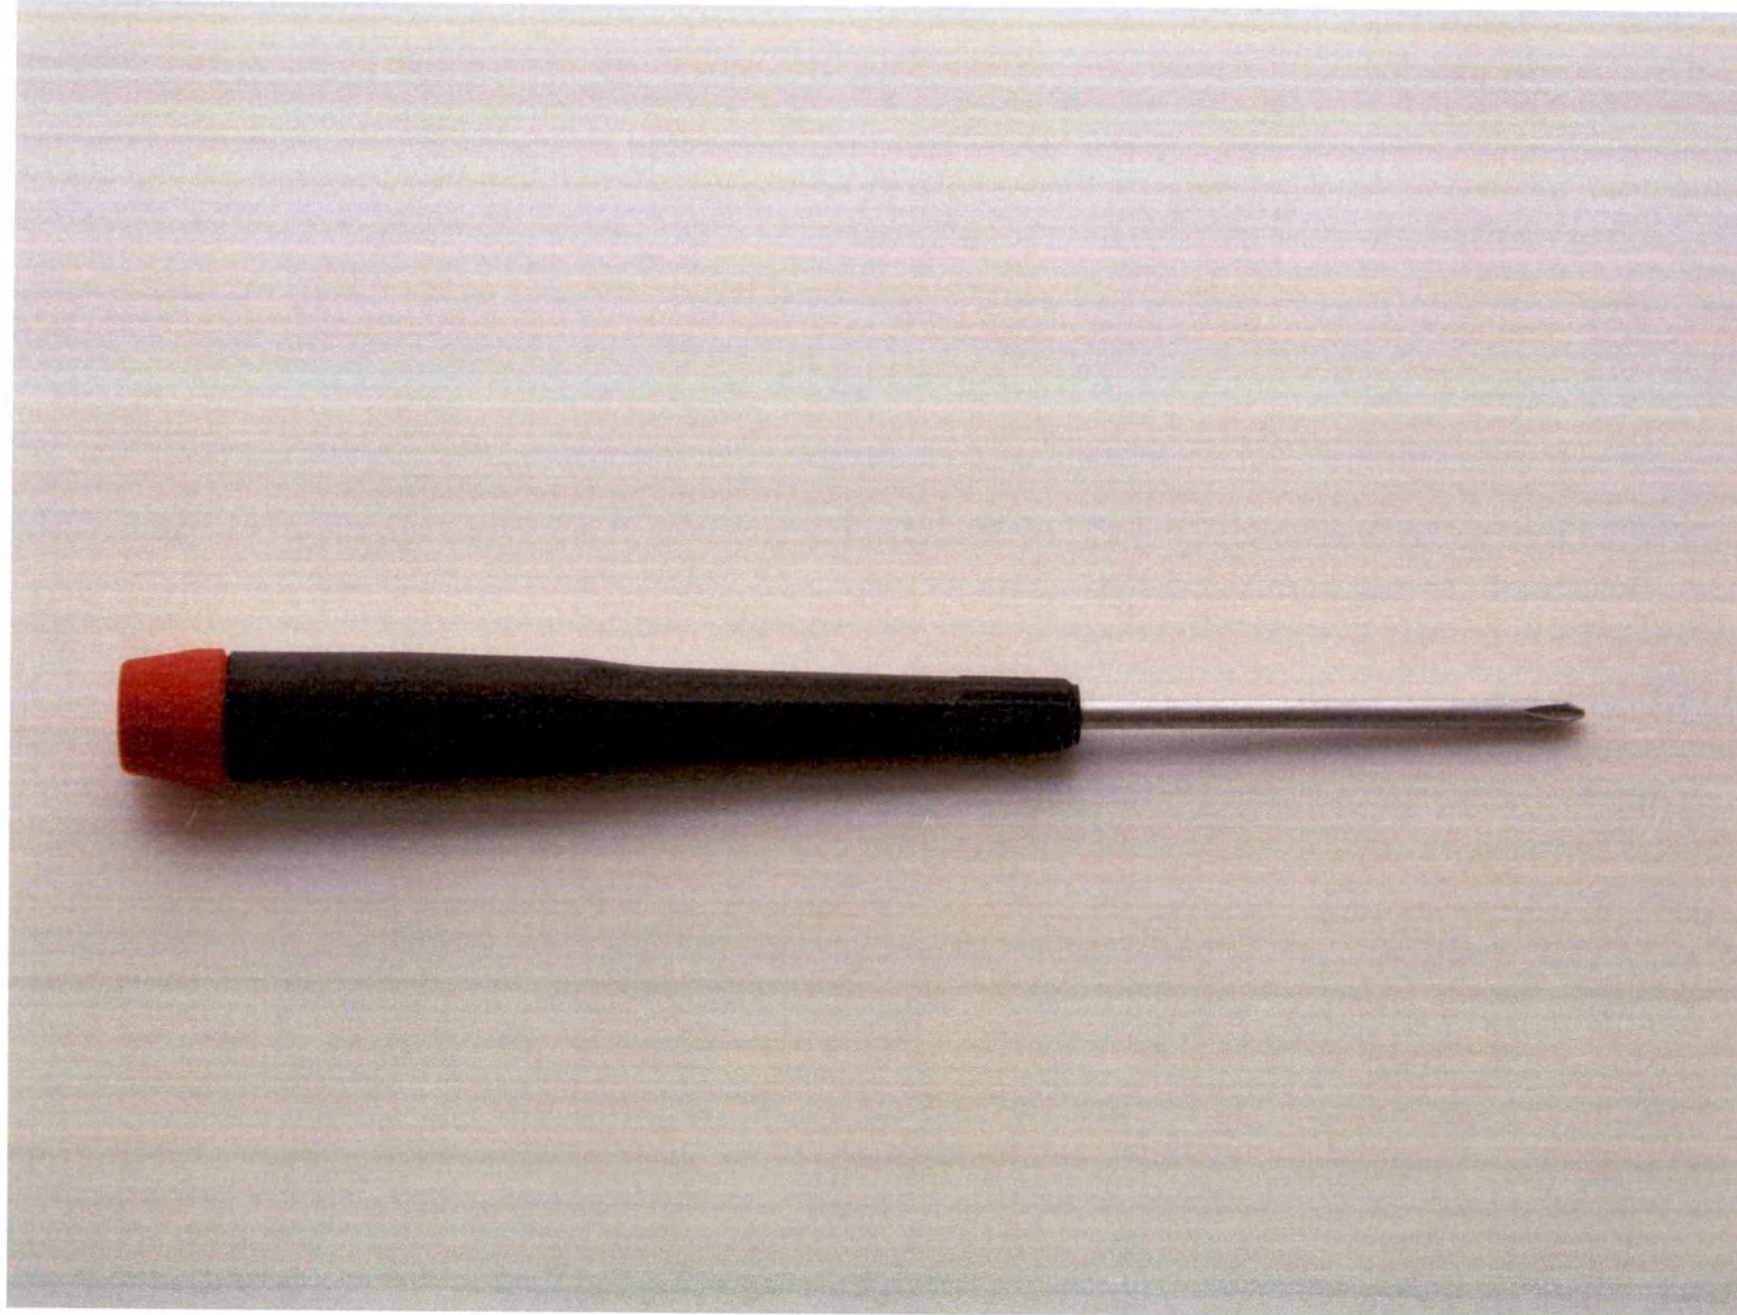

11.3. колпачки защитные резьбовые;

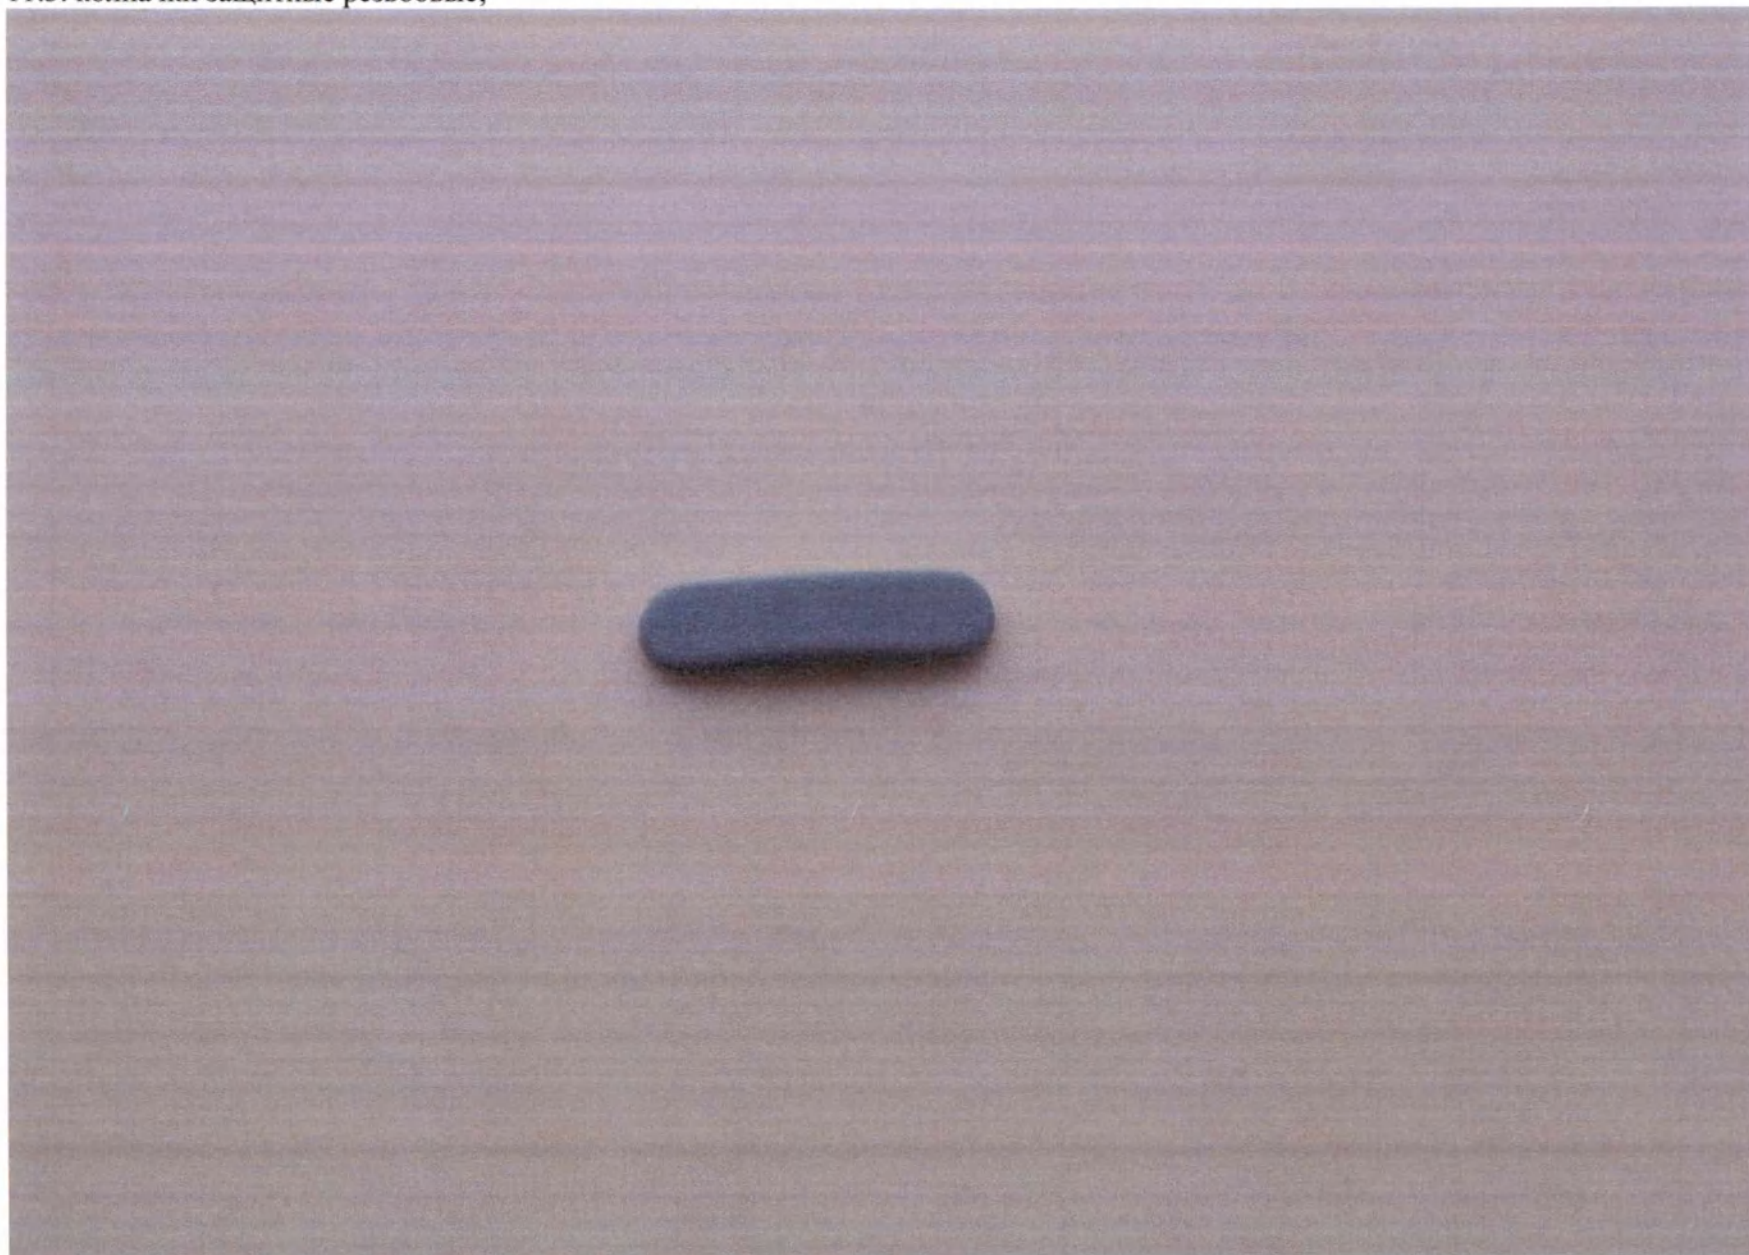


11.4. полосы из эластомера;

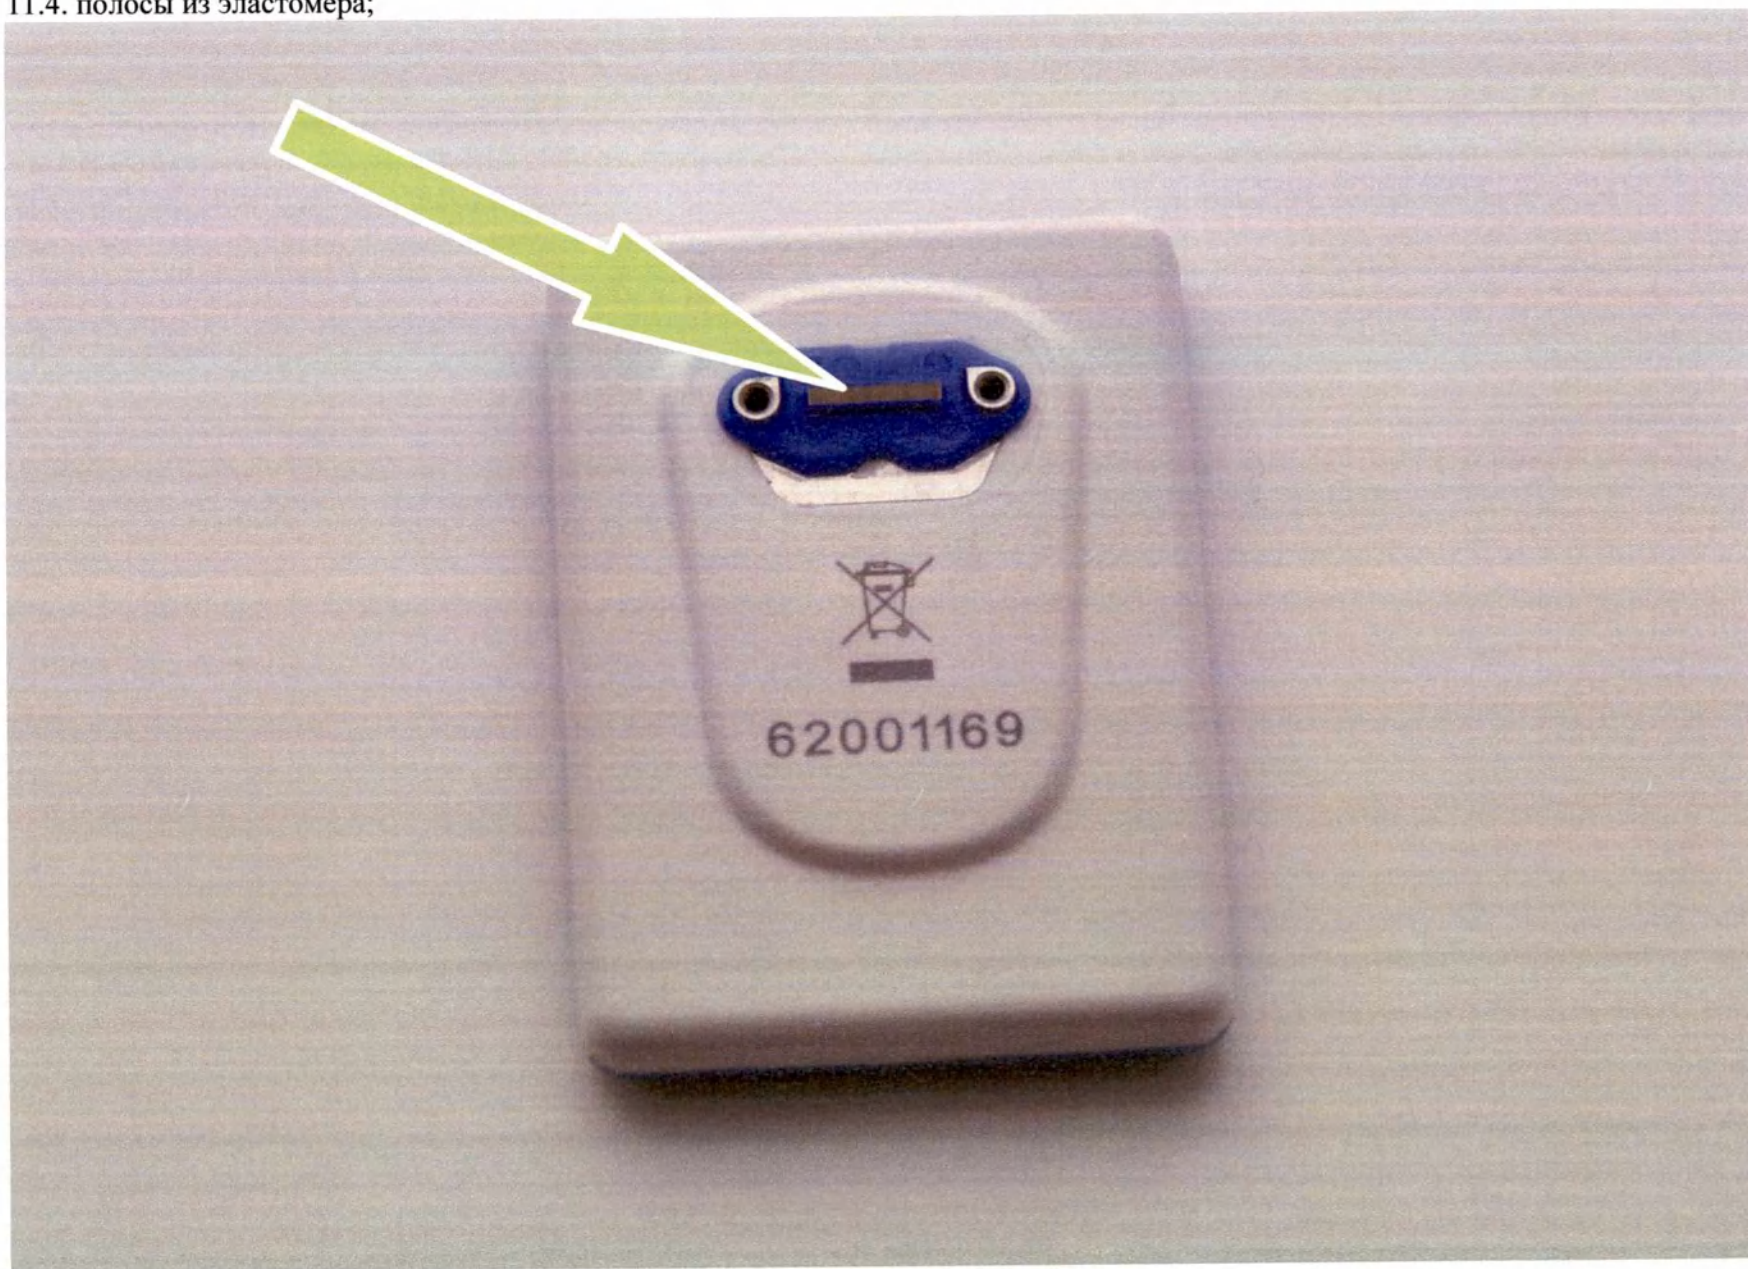

11.5. винты с плоской головкой.




12. Тест фантом для настройки датчика.

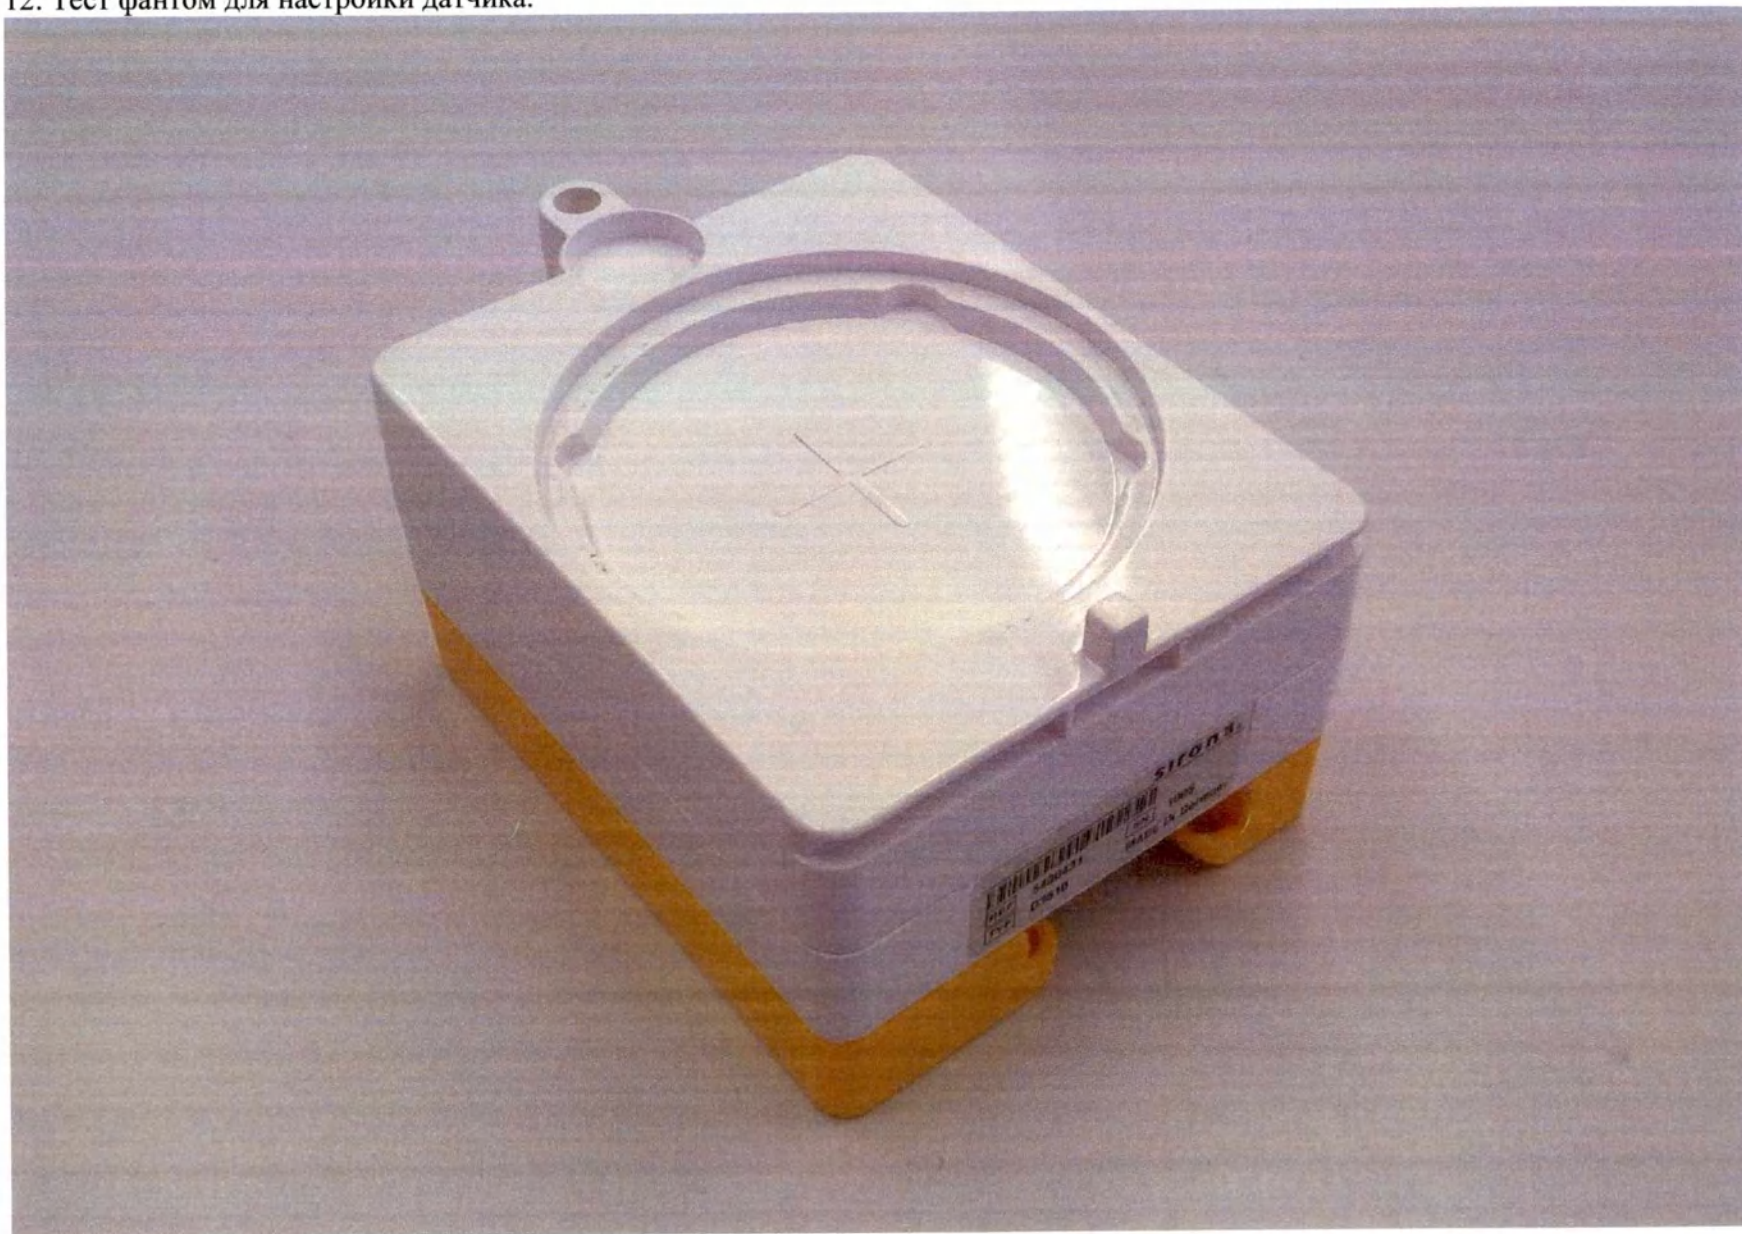

13. Ограничители поля излучения Heliodont Plus для датчика, размер 0 (белый); размер 1 (черный); размер 2 (синий).
размер 0 (белый)



размер 1 (черный)

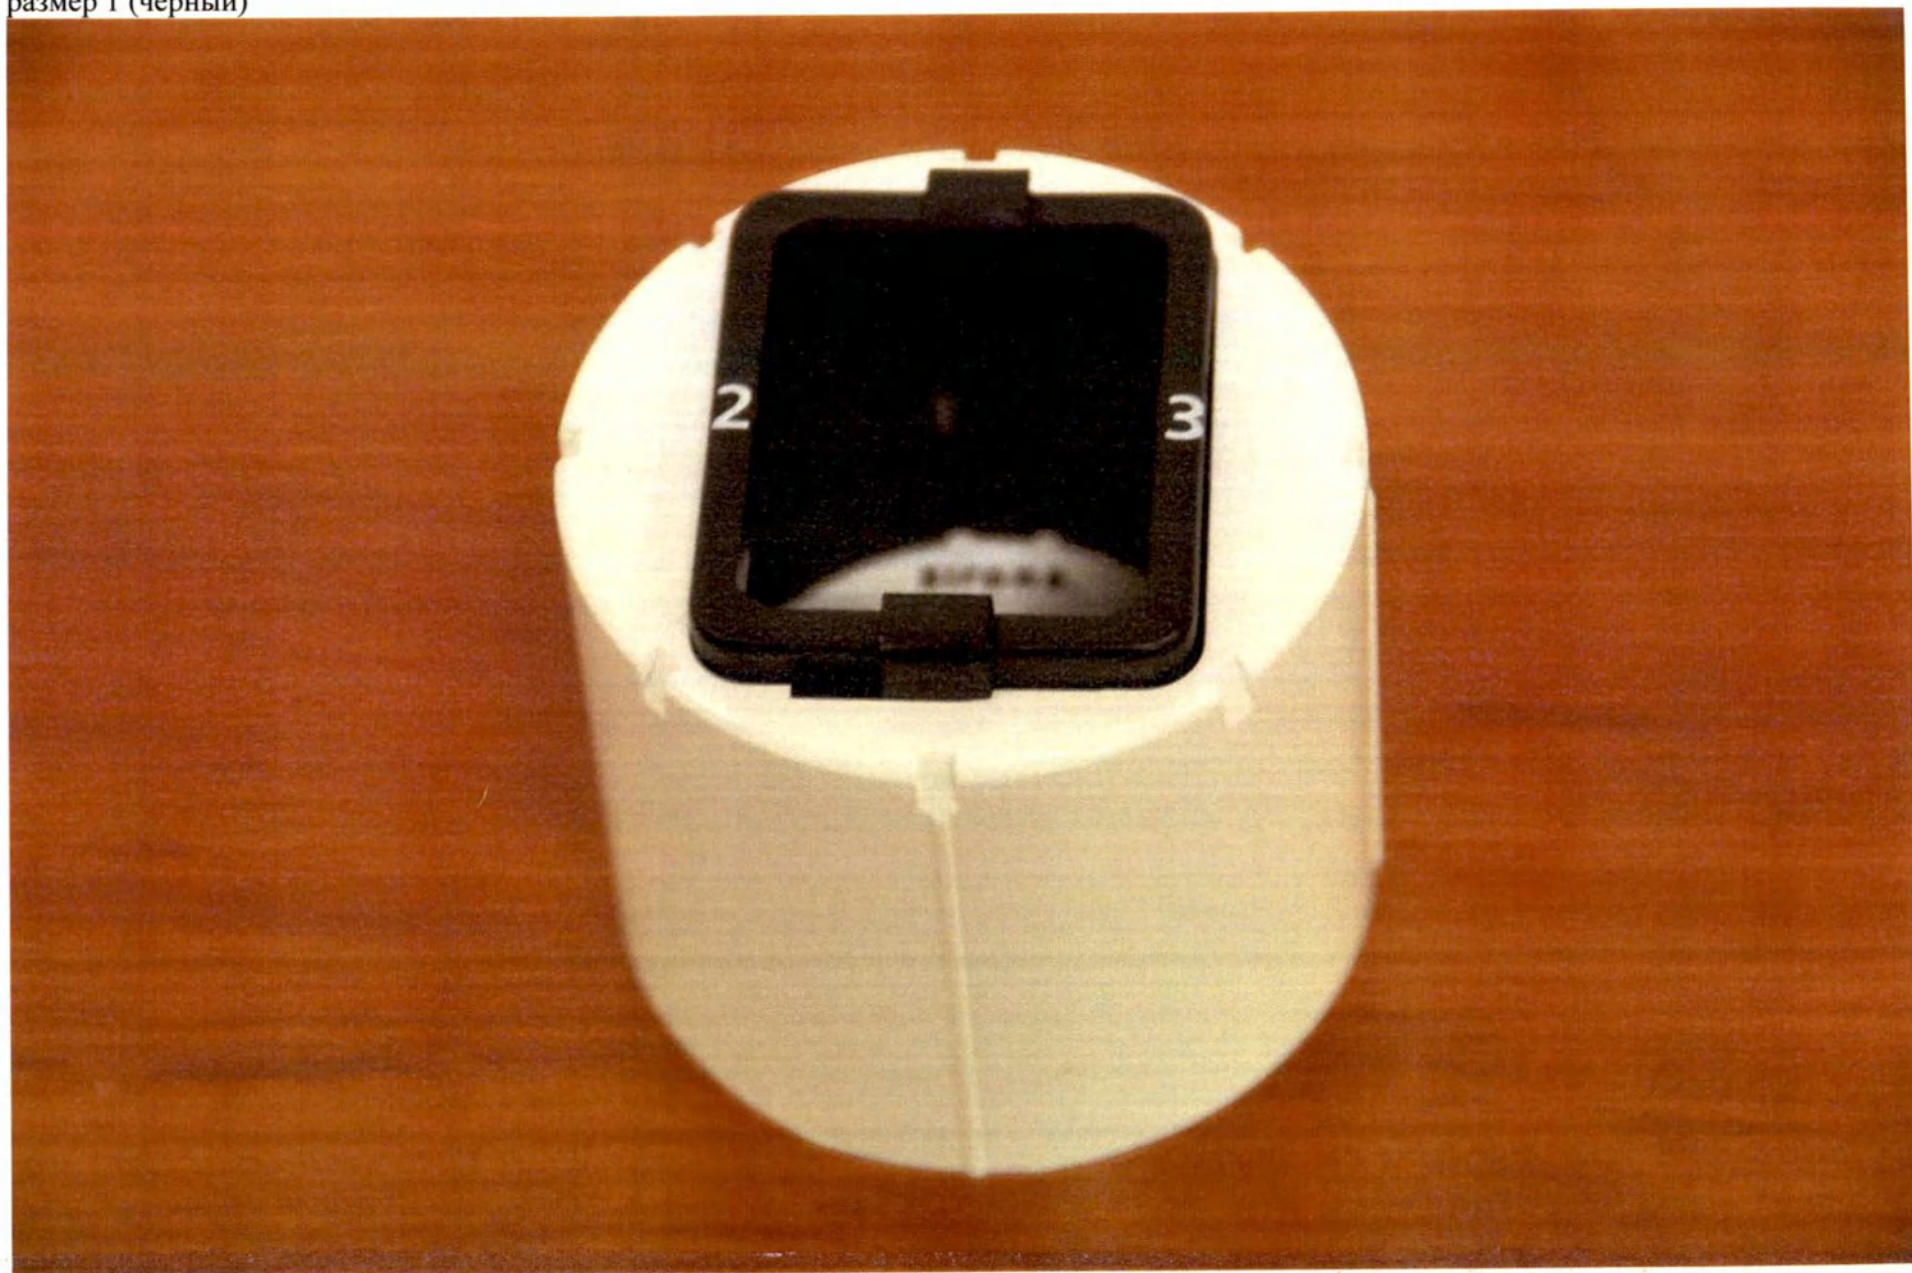

размер 2 (синий)



14. Программное обеспечения SIDEXIS XG (SIDEXIS XG Standard) / SIDEXIS 4 на электронном носителе.



SIDEXIS 4

001-2013/08/07
(4.0 DE, EN, FR, ES, IT)



©Sirona Dental Systems GmbH 2013

The Dental Company

sirona.

6456532 D 3592 000 000

Sirona Dental Systems GmbH

Fabrikstraße 31
D 64625 Bensheim

Alle Urheber- und Leistungsschutz-
rechte vorbehalten. Kein Verleih.
Keine unerlaubte Vervielfältigung.

All copyrights in the recorded works
and in the recorded performances
reserved. no lending. No unauthorized
duplication. No lease.

CE
0123 Rx only

Diese Produkt trägt das CE-Kennzeichen
mit den Bestimmungen der Richtlinie
93/42/EWG vom 14. Juni 1993 über
Medizinprodukte.

This produkt bears the CE label in
accordance with the provisions of the
Council Directive 93/42/EWG Of June 14,
1993 concerning medical devices.

15. Программное обеспечение для модернизации SIDEXIS XG (SIDEXIS XG Standard) / SIDEXIS 4 - на электронном носителе.



SIDEXIS 4

001-2013/08/07
(4.0 DE, EN, FR, ES, IT)



Alle Urheber- und Leistungsschutz-
rechte vorbehalten. Kein Verleih.
Keine unerlaubte Vervielfältigung.

All copyrights in the recorded works
and in the recorded performances
reserved. no lending. No unauthorized
duplication. No lease.

CE
0123 Rx only

Diese Produkt trägt das CE-Kennzeichen
mit den Bestimmungen der Richtlinie
93/42/EWG vom 14. Juni 1993 über
Medizinprodukte.

This produkt bears the CE label in
accordance with the provisions of the
Council Directive 93/42/EWG Of June 14,
1993 concerning medical devices.

©Sirona Dental Systems GmbH 2013

The Dental Company

sirona

6456532 D 3592 000 000

Sirona Dental Systems GmbH

Fabrikstraße 31
D 64625 Bensheim


REF 64 11 578 D3610

002-15/04/13

(1.1 DE, EN, FR, ES, IT)

© Sirona Dental Systems GmbH 2013 • Fabrikstraße 31 • D-64625 Bensheim

XIOS XG Select/Supreme SIDEXIS XG Plugin

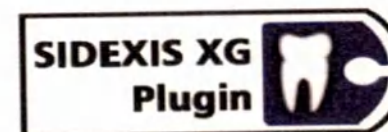


Alle Urheber- und Leistungs-
schutzrechte vorbehalten. Kein
Verleih. Keine unerlaubte Nutzung.
Keine unerlaubte Vervielfältigung.

All copyrights in the recorded works
and in the recorded performances
reserved. No lending. No
unauthorized duplication. No lease.

sirona.

The Dental Company

SIDEXIS XG Terminal Server Edition

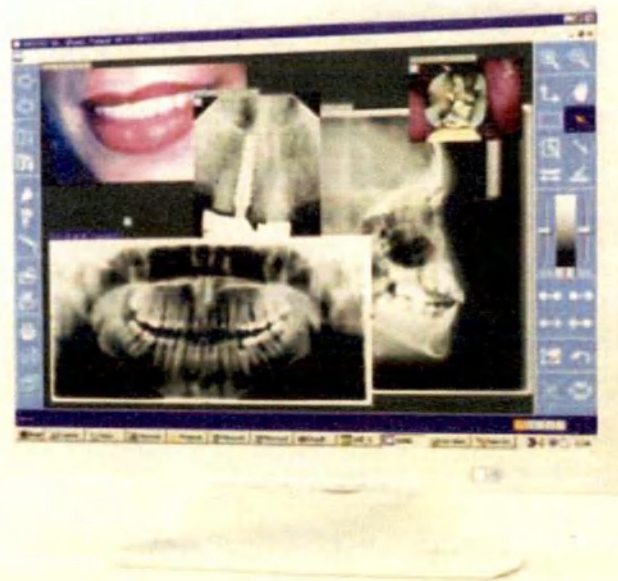

The Dental Company **sirona.**

SIDICOM[®] WLS



The Dental Company **sirona.**

SIDEXIS DICOM Query & Retrieve



The Dental Company

sirona


SIDICOM PS




Sirona

The Dental Company

Approved by
Head of Regulatory Affairs
SIRONA Dental Systems GmbH



February 10, 20



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система цифровая для получения и обработки интраоральных
рентгеновских снимков XIOS XG, в исполнении XIOS XG Select USB,
XIOS XG Supreme USB, XIOS XG Select WiFi, XIOS XG Supreme WiFi, с
принадлежностями,

производства SIRONA Dental Systems GmbH (СИРОНА Дентал Системс
ГмбХ), Германия; Sirona Dental, Inc (Сирона Дентал, Инк.), США


2014

sirona.
The Dental Company


SIDEXIS XG

Руководство пользователя / версии 2.6

Русский

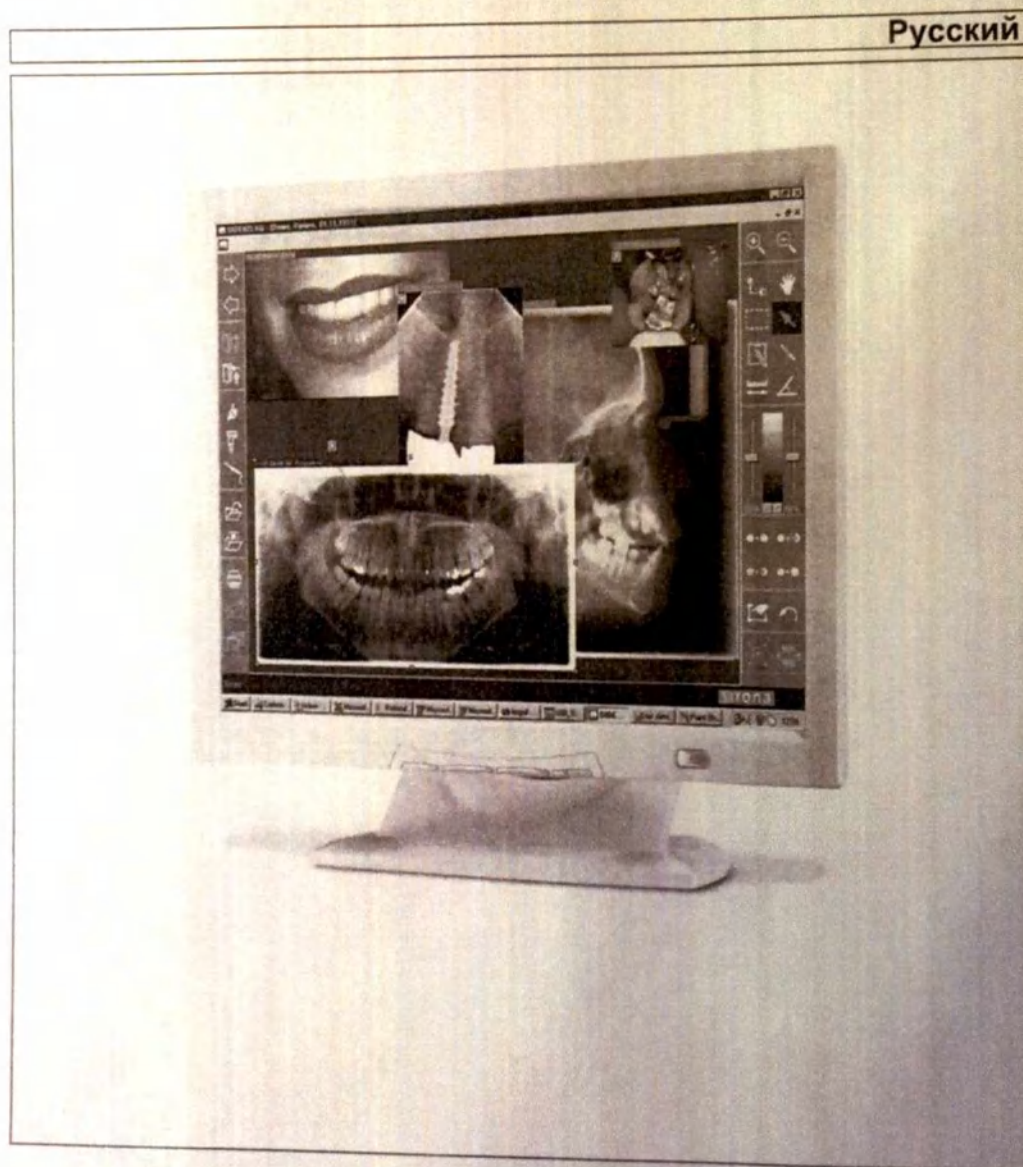


II. Система цифровая для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG Supreme USB.

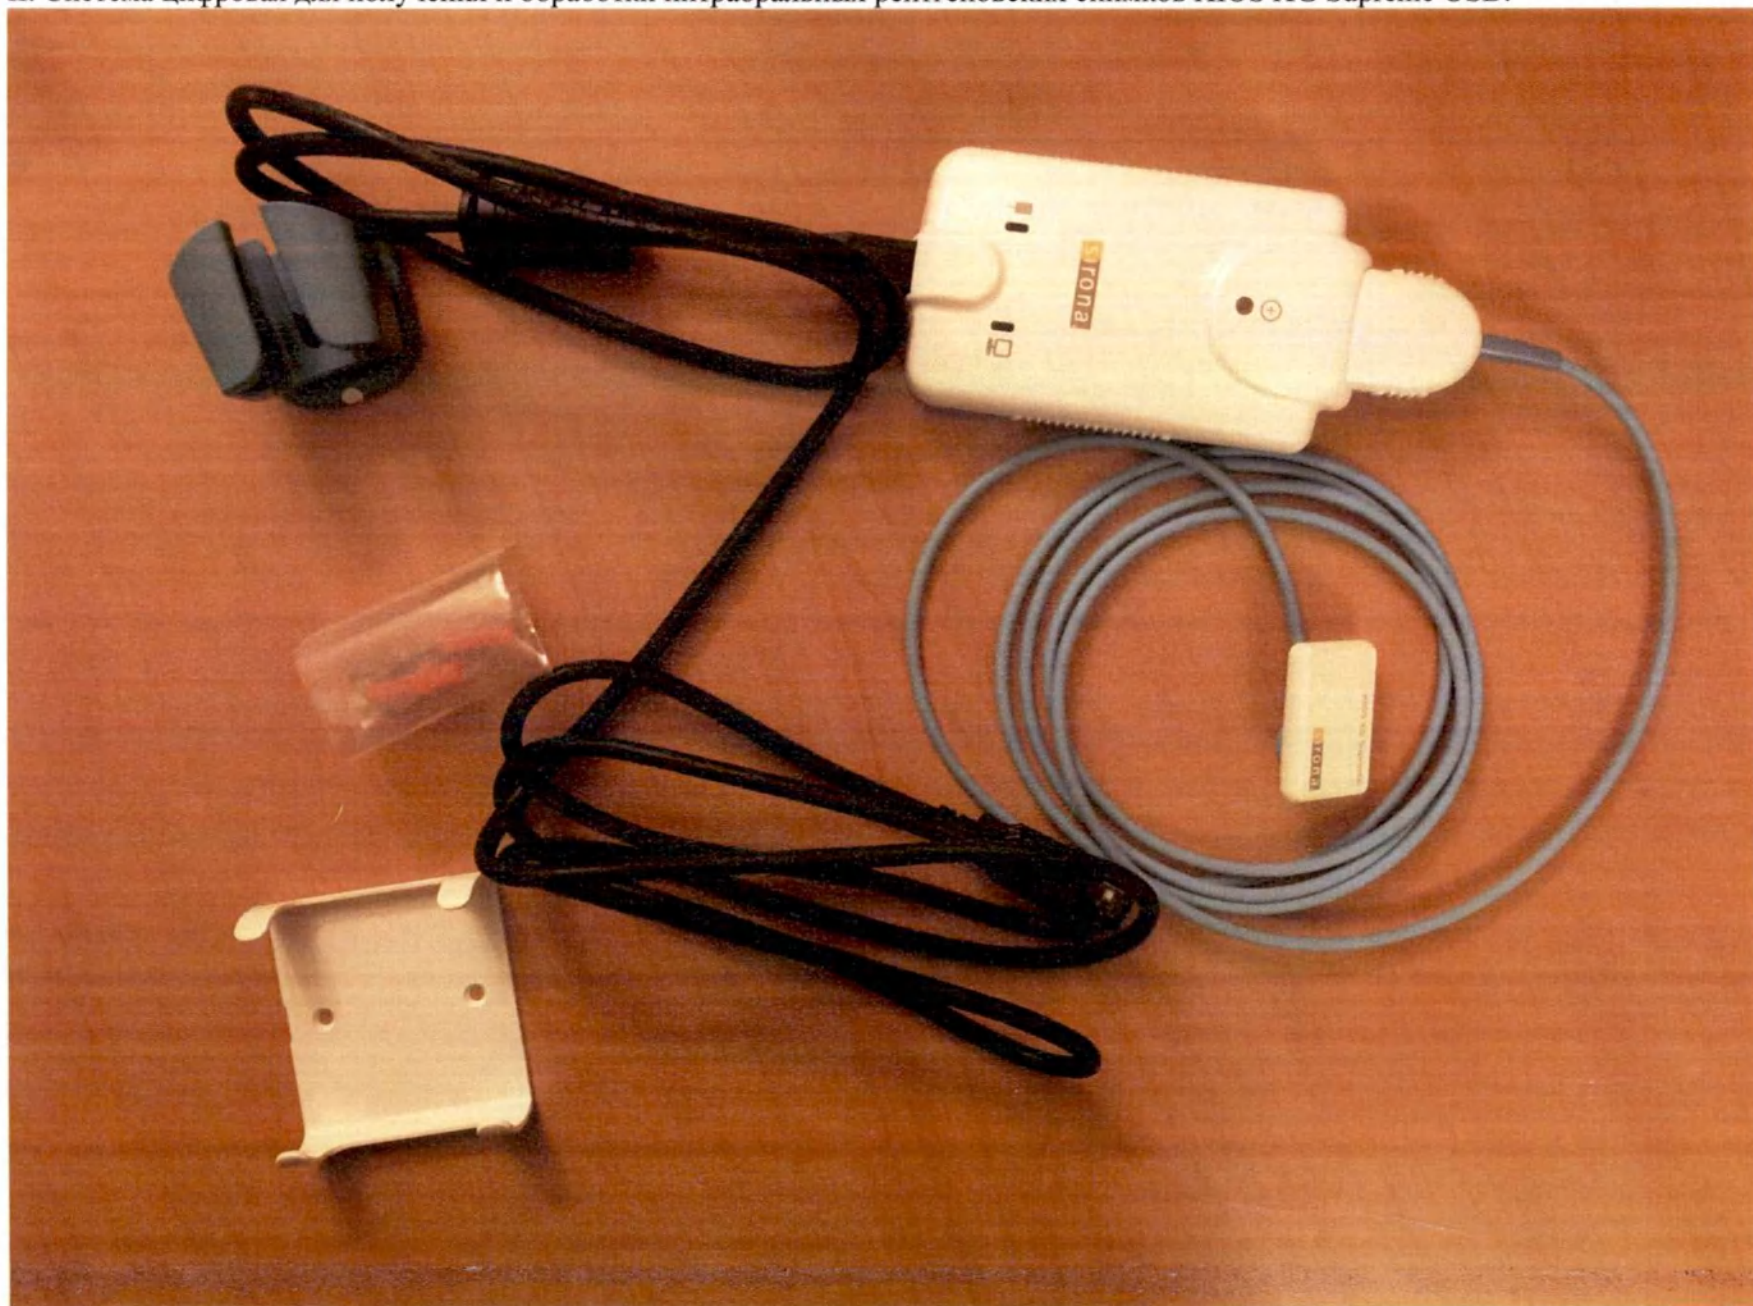





1. Модуль USB обработки рентгеновских снимков.

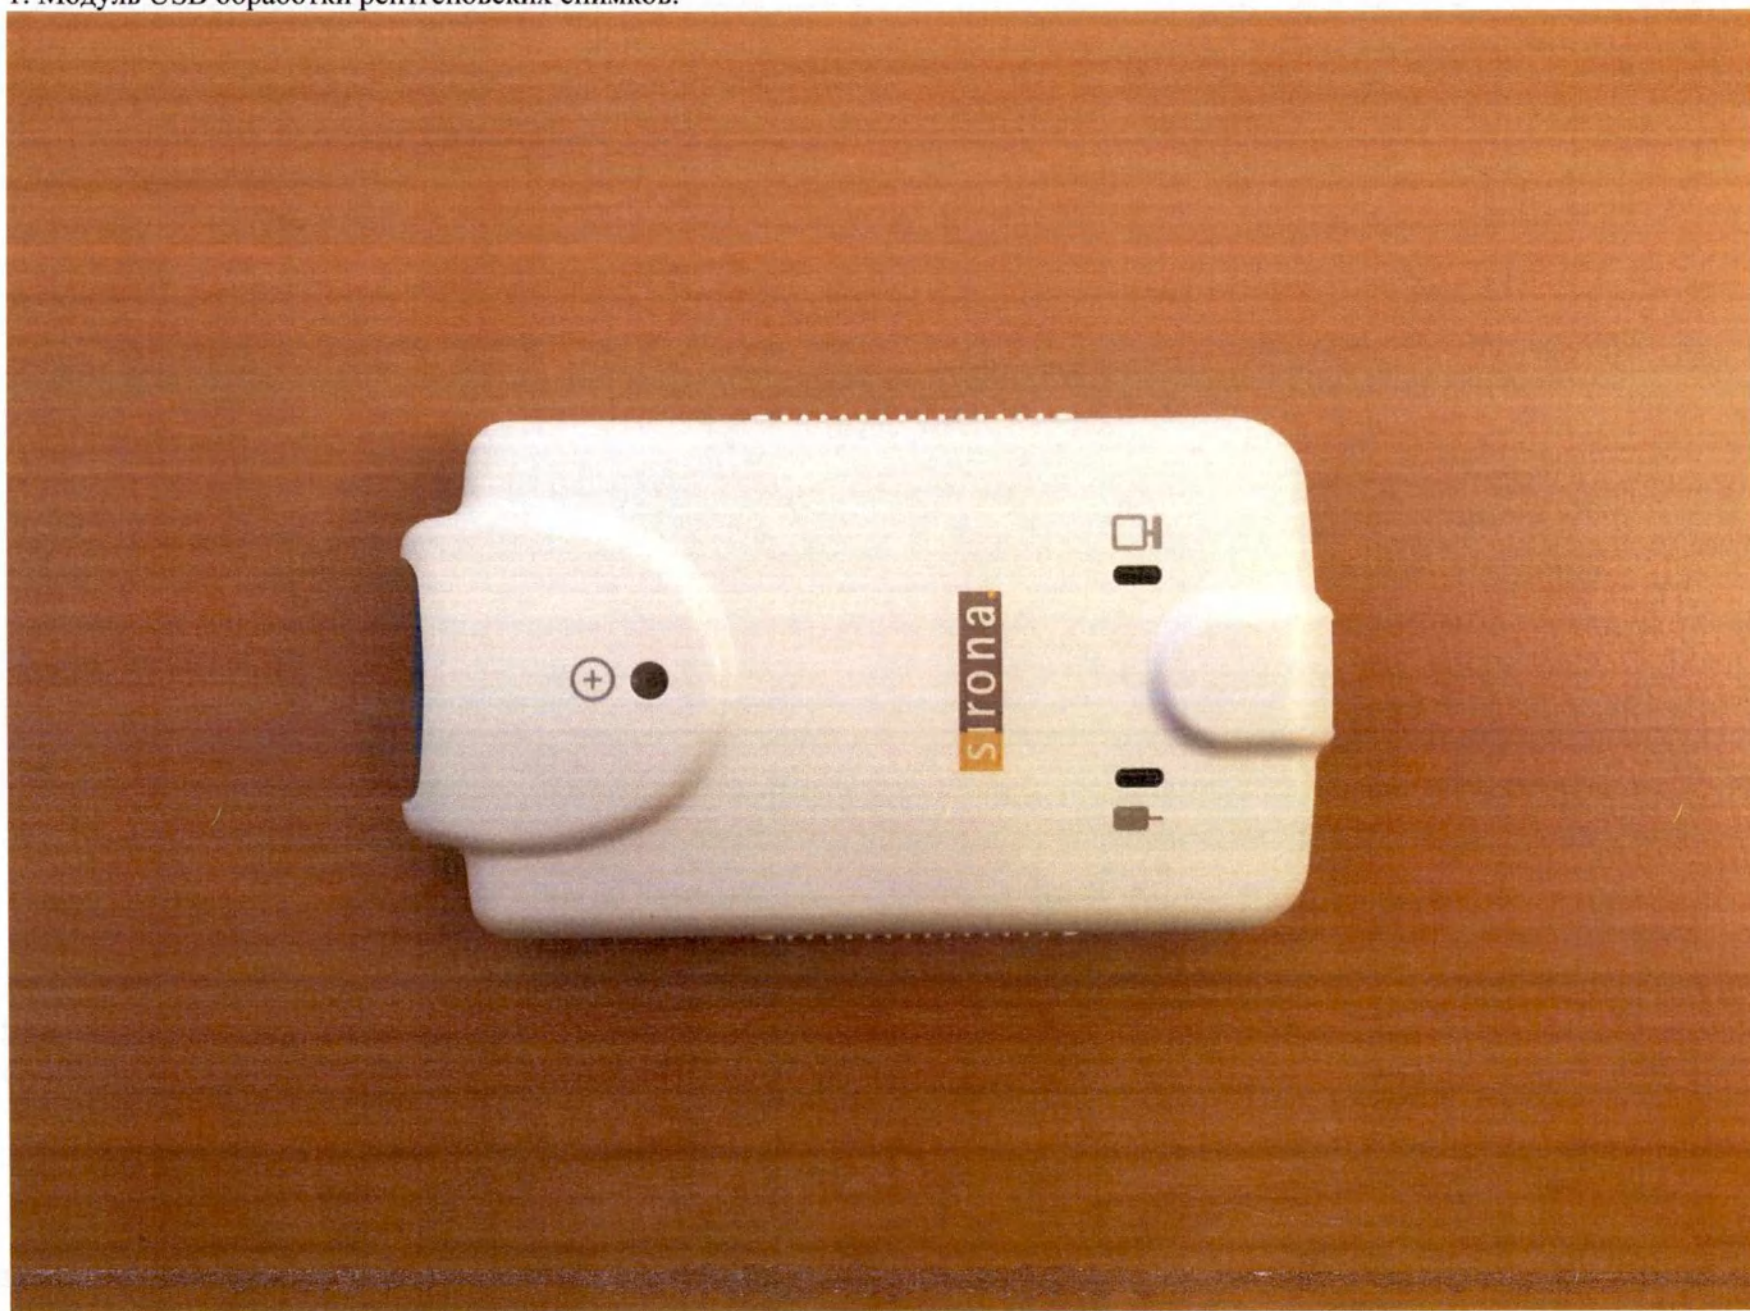

2. Настенное крепление для модуля USB

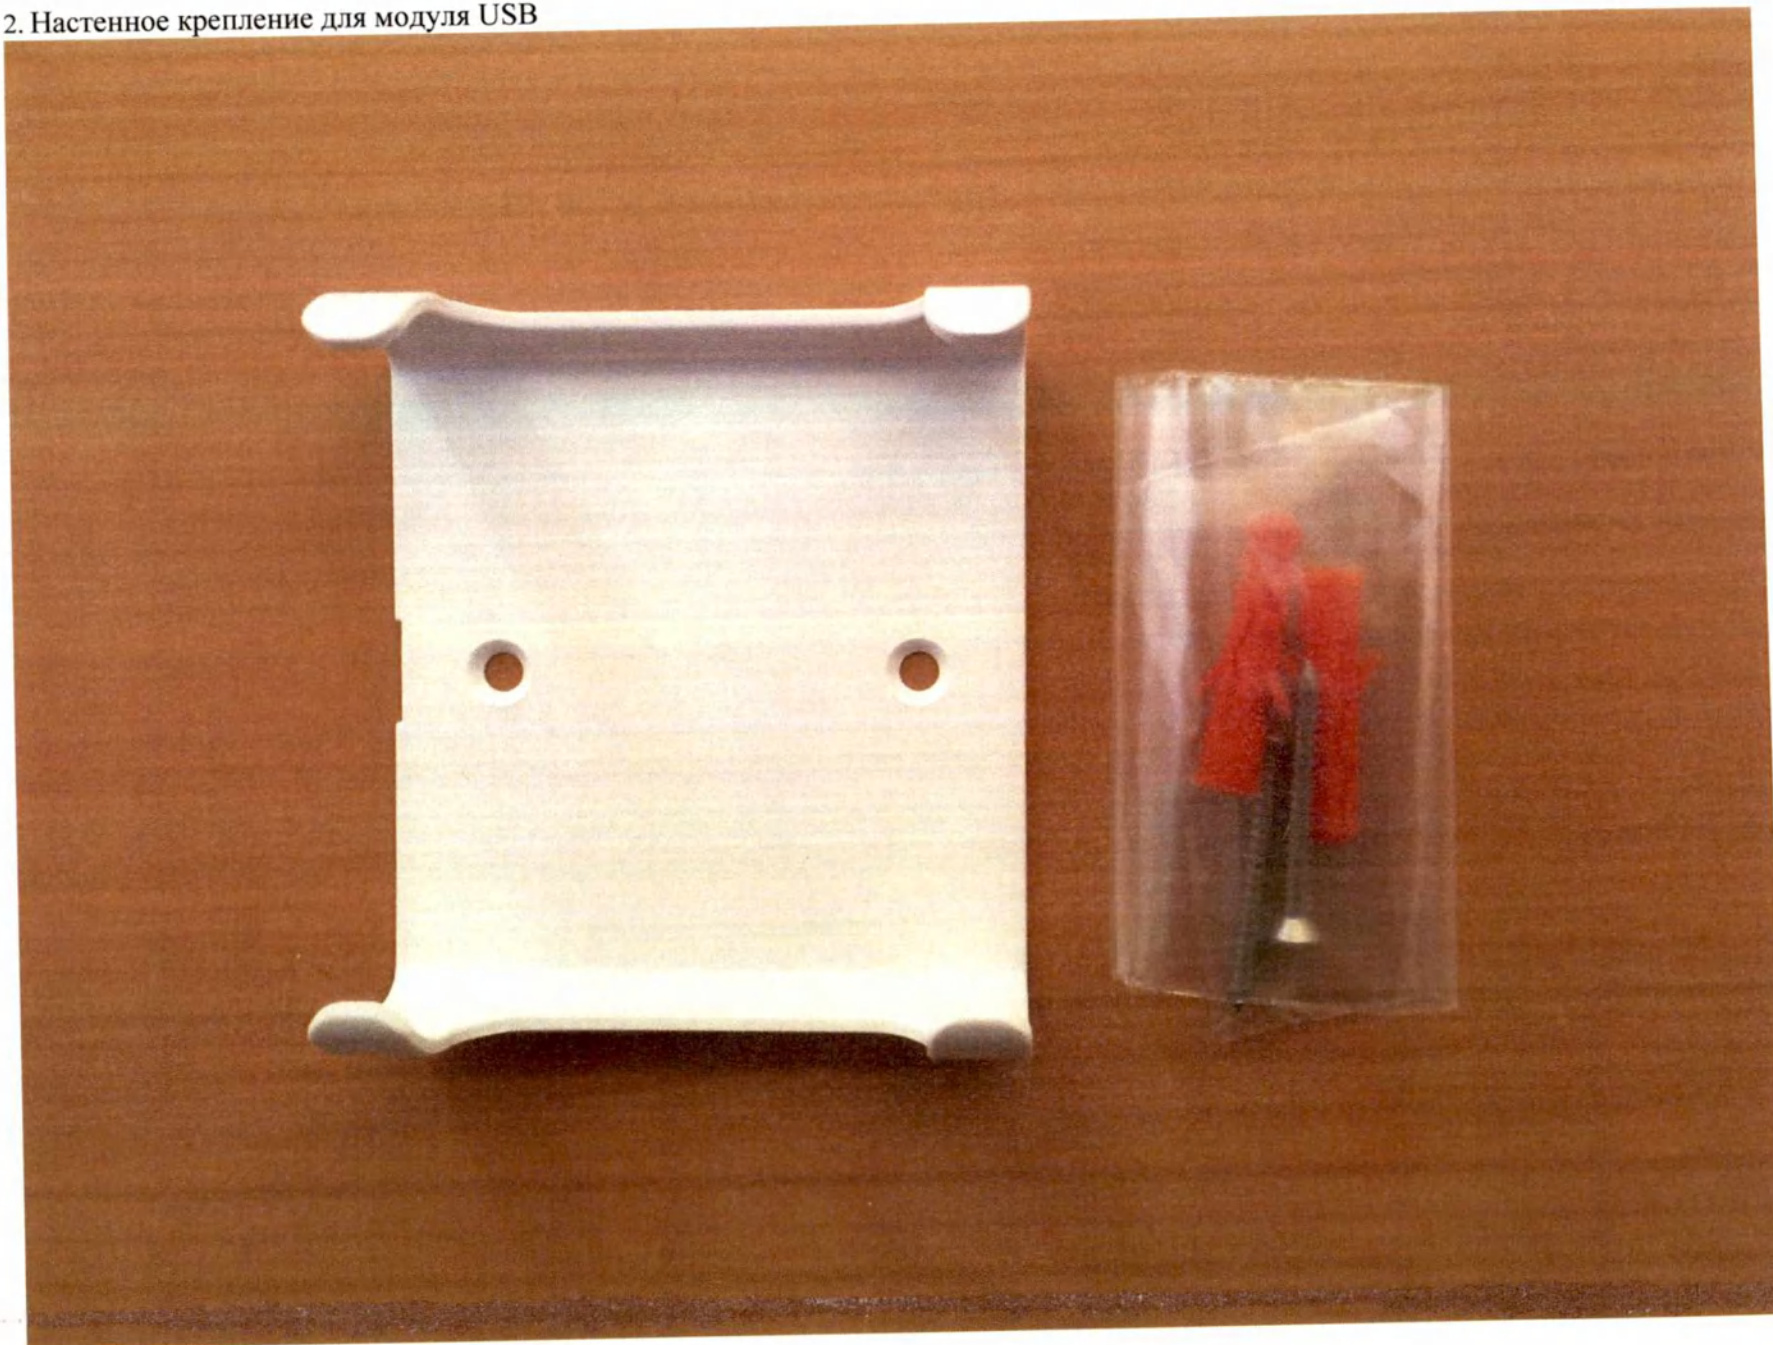

3. Кабель XIOS XG USB A/B.

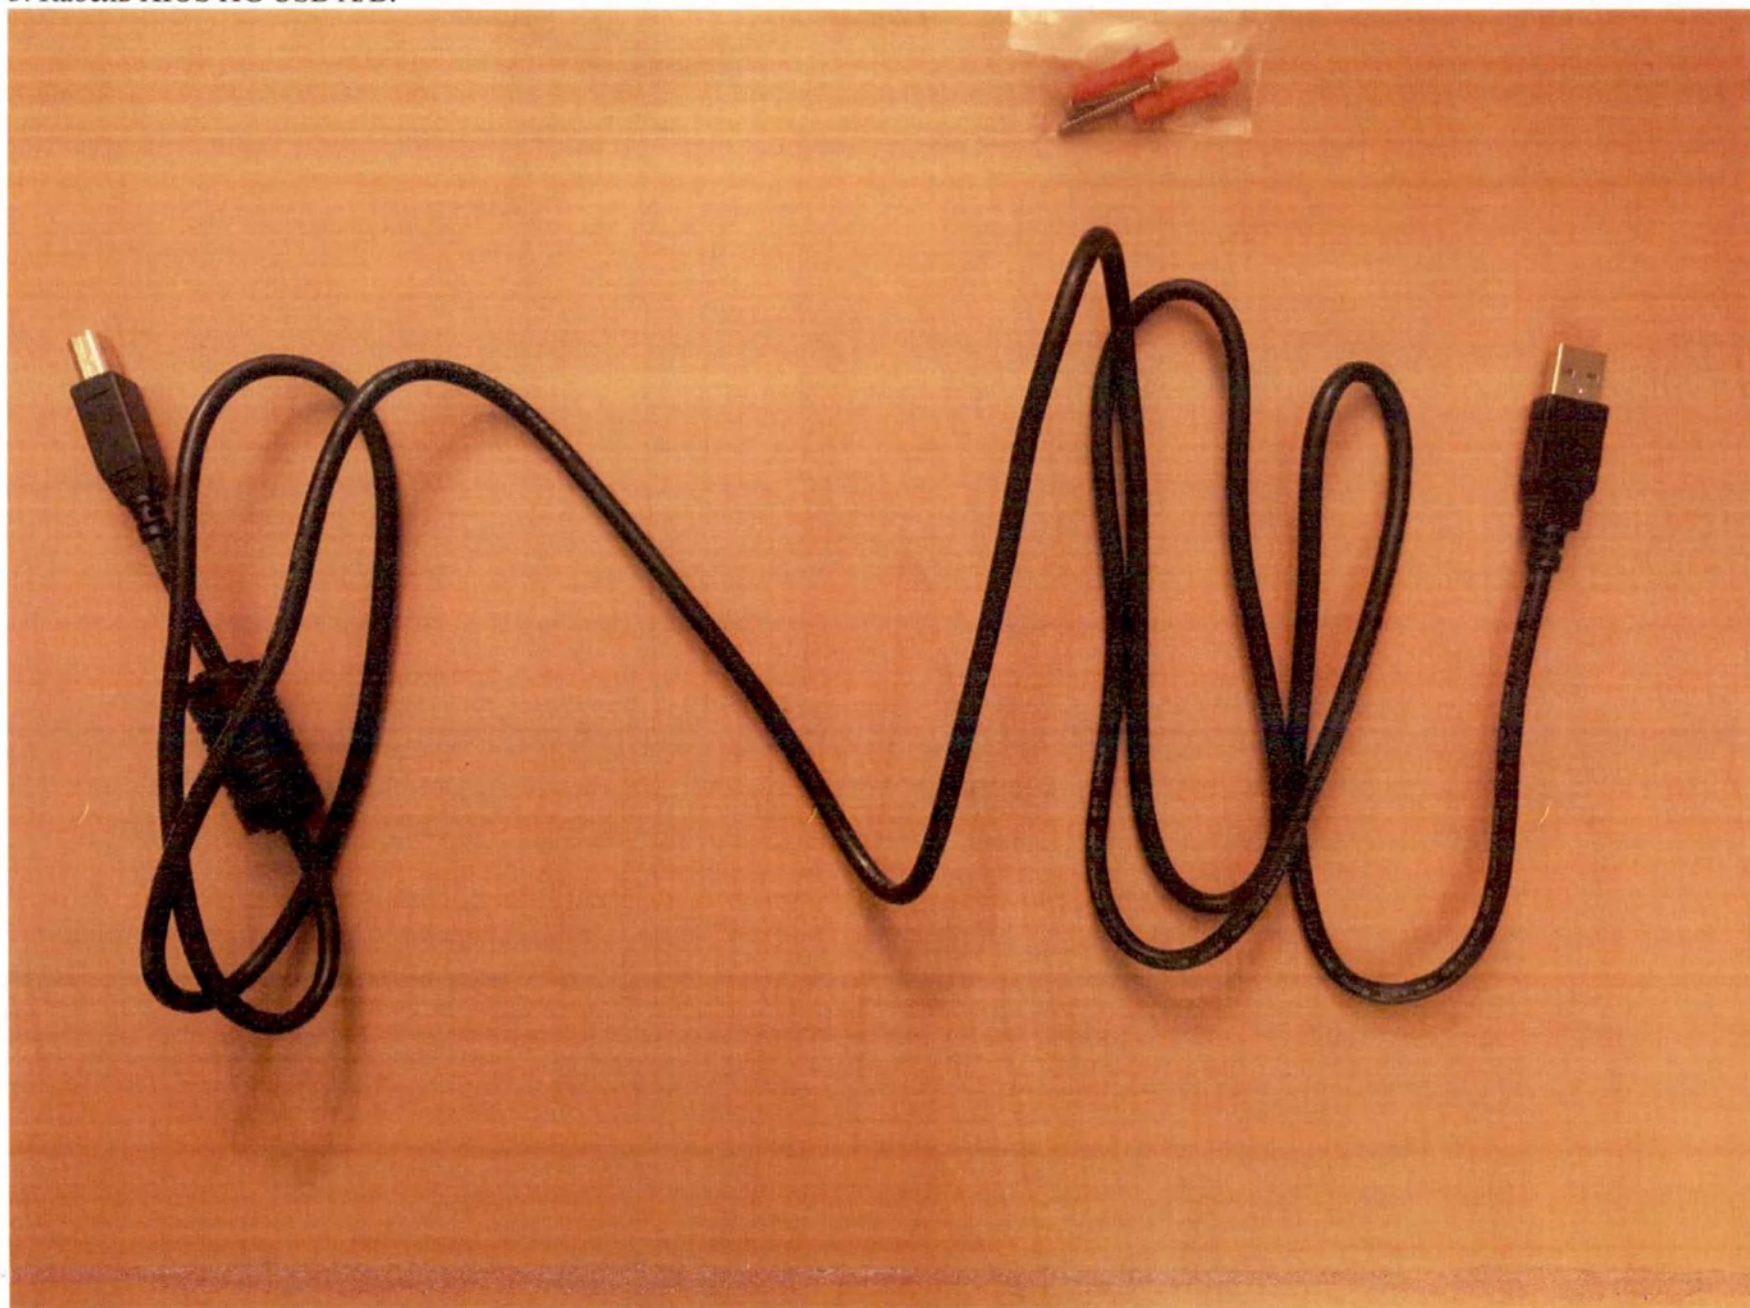

4. Датчик XIOS XG Supreme Sensor USB, размер 0 или размер 1 или размер 2.



Размер 2

XIOS XG Supreme

XIOS XG Supreme

sirona

XIOS XG Supreme

sirona

sirona

Размер 1


Размер 0

5. Настенный держатель датчика XIOS XG.



6. Стартовый комплект позиционеров для датчиков XIOS XG Starter Kit, в составе:



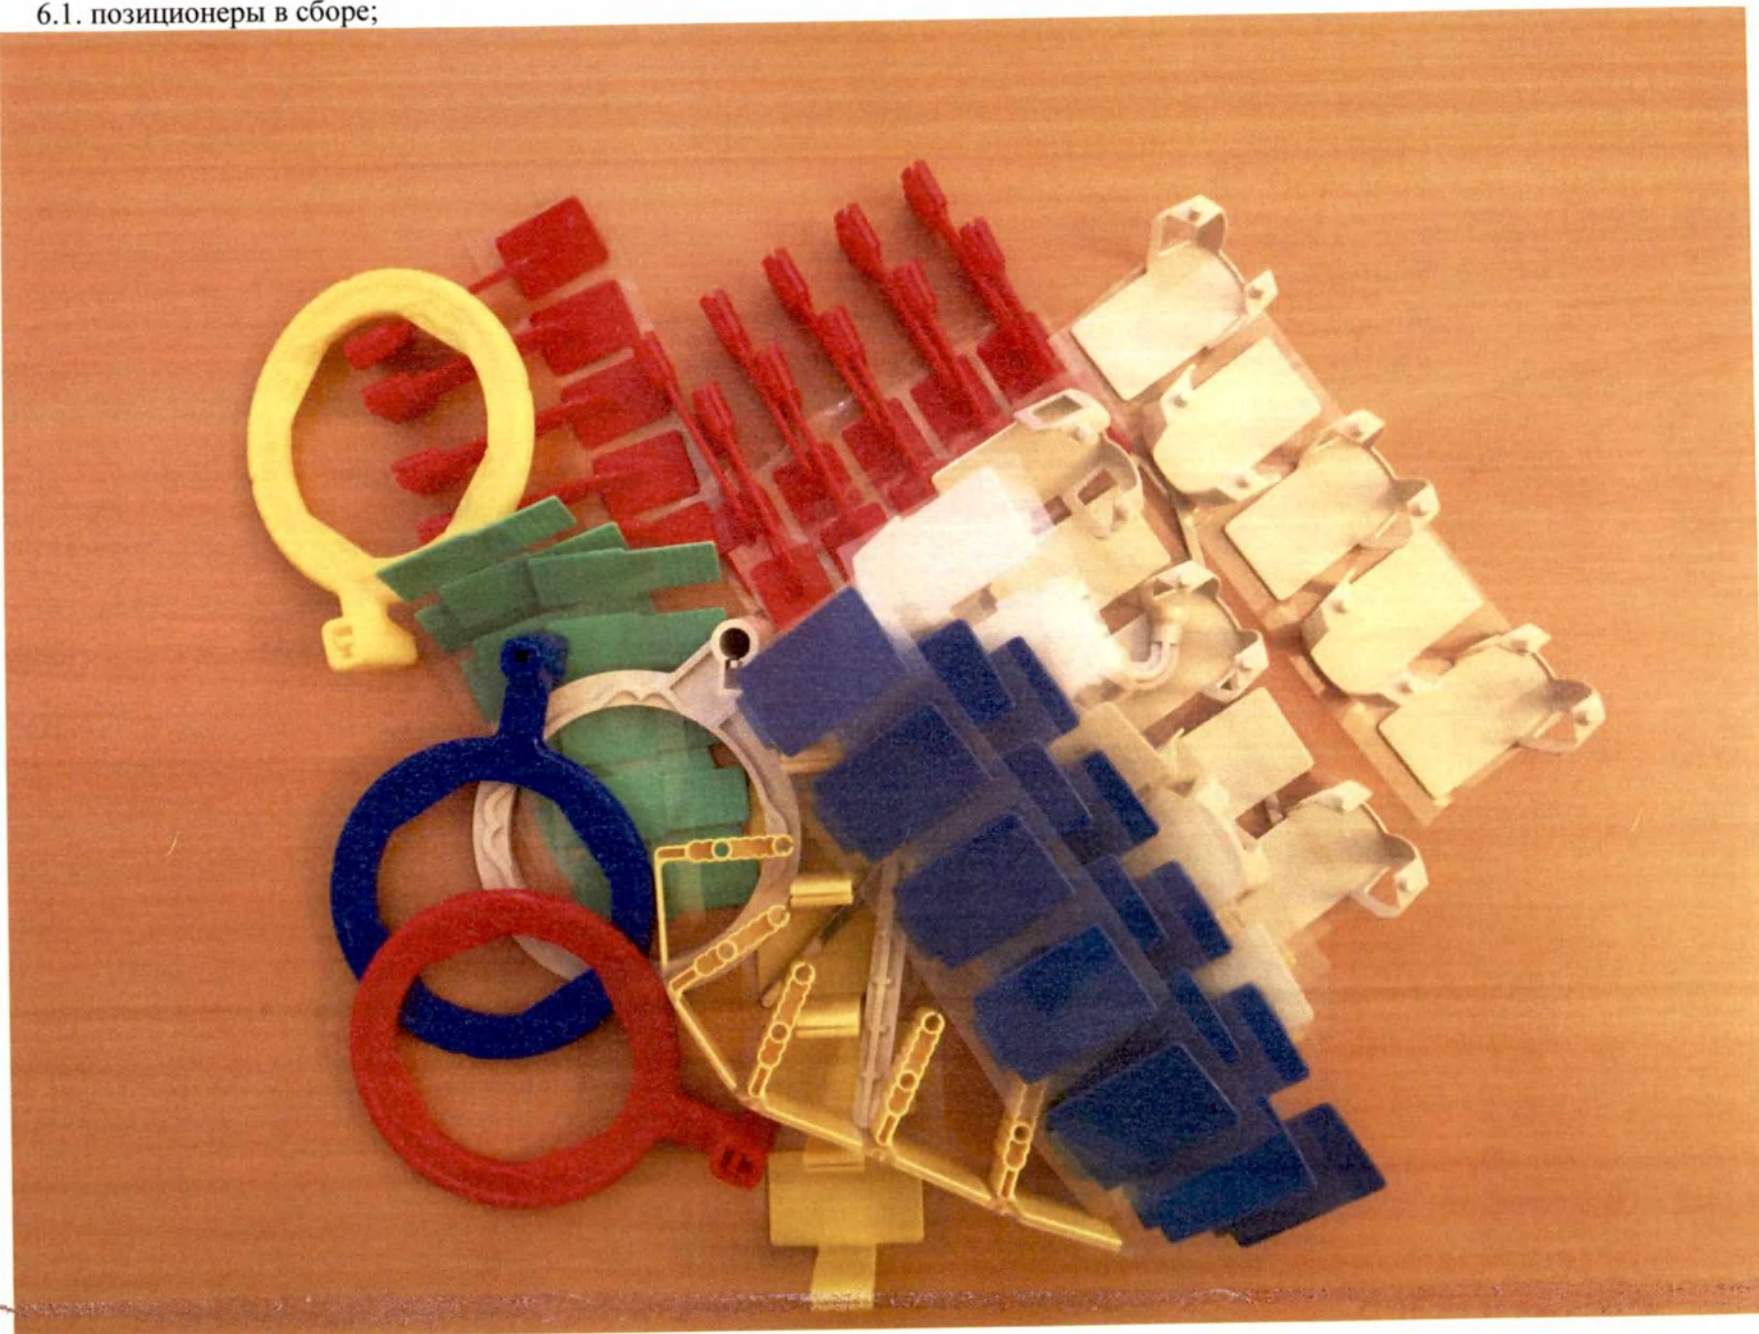

6.2. чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков.





Размер 2

XIOS XG Supreme

sirona

XIOS XG Supreme

sirona

XIOS XG Supreme

sirona


Размер 1

Размер 0


2. Настенный держатель датчика XIOS XG.




3. Настенное крепление для модуля USB.

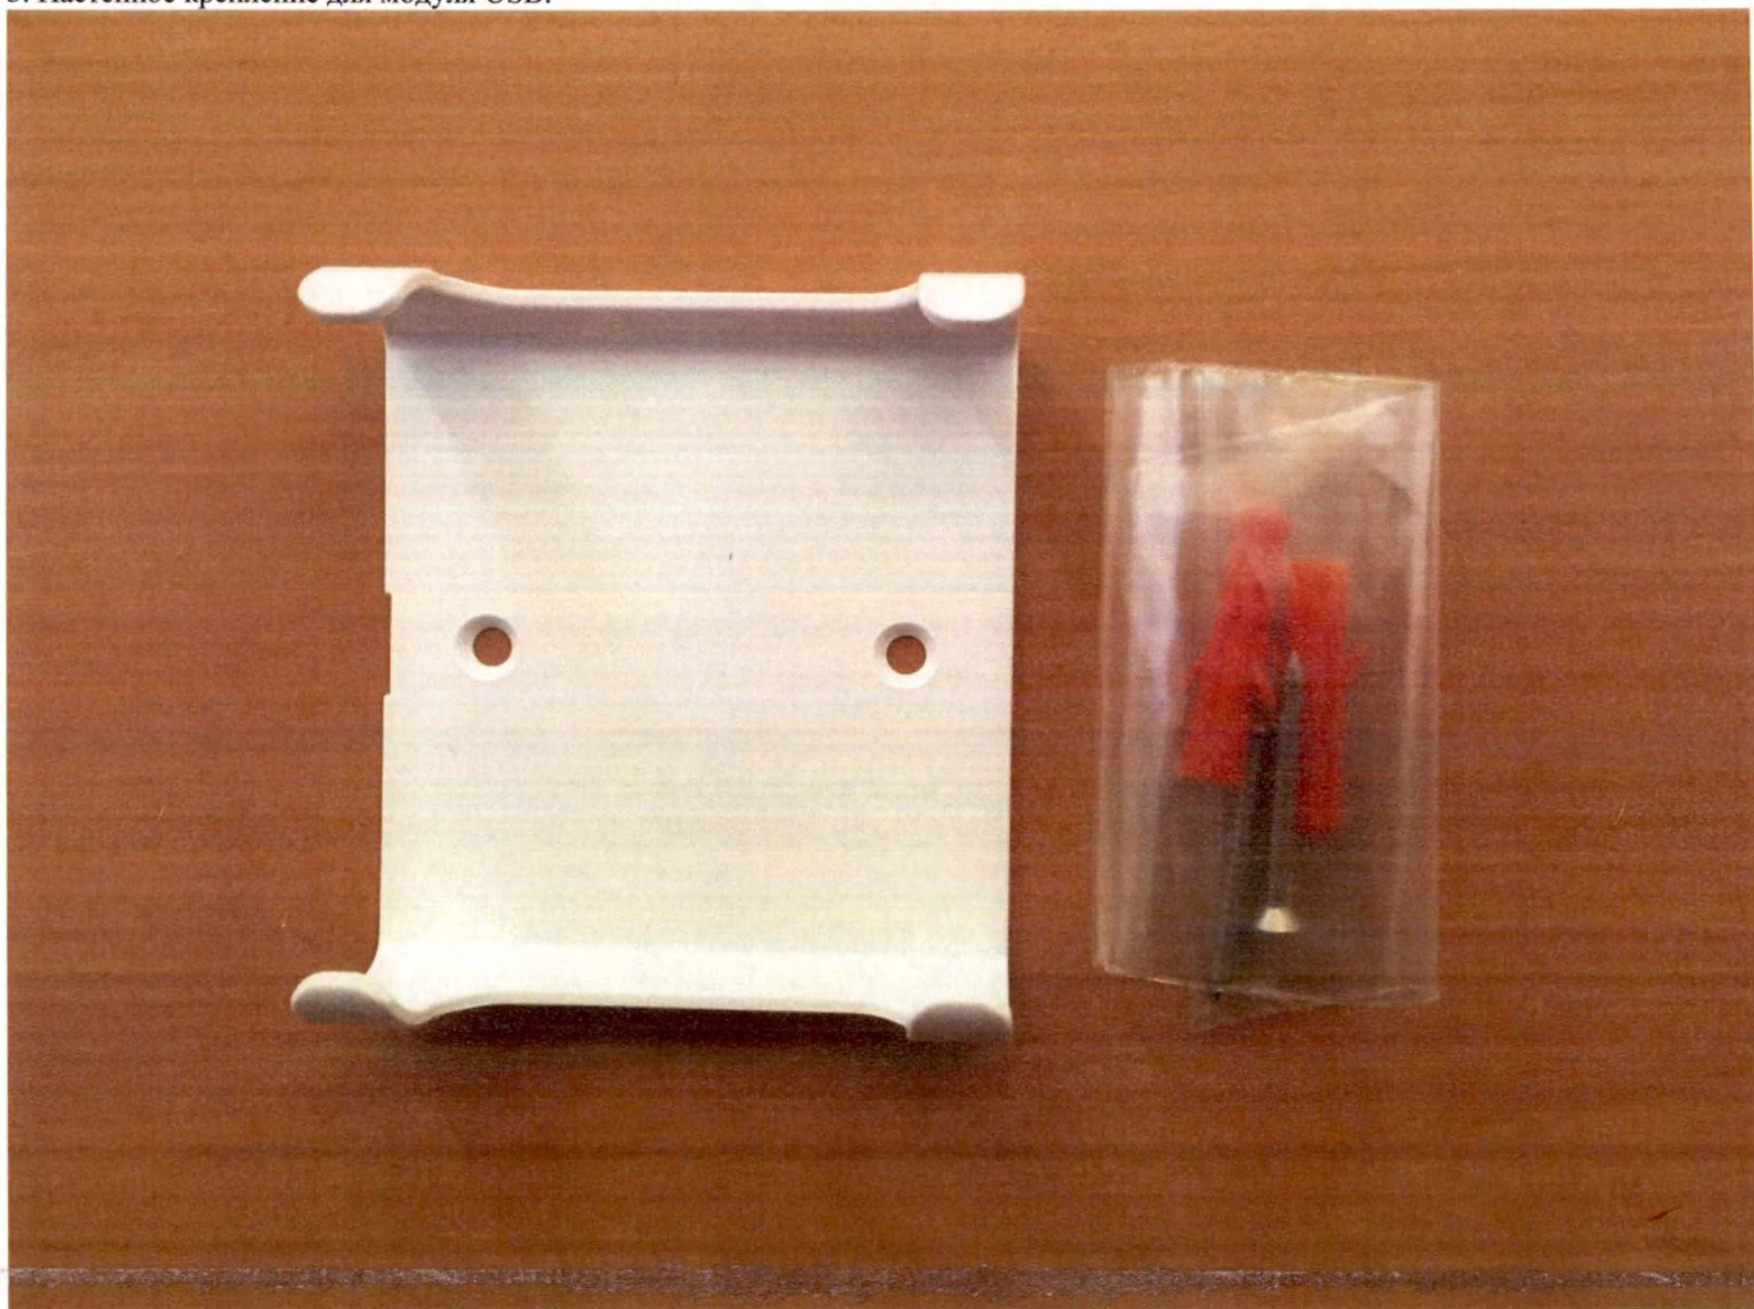

4. Адаптер для настенного модуля.

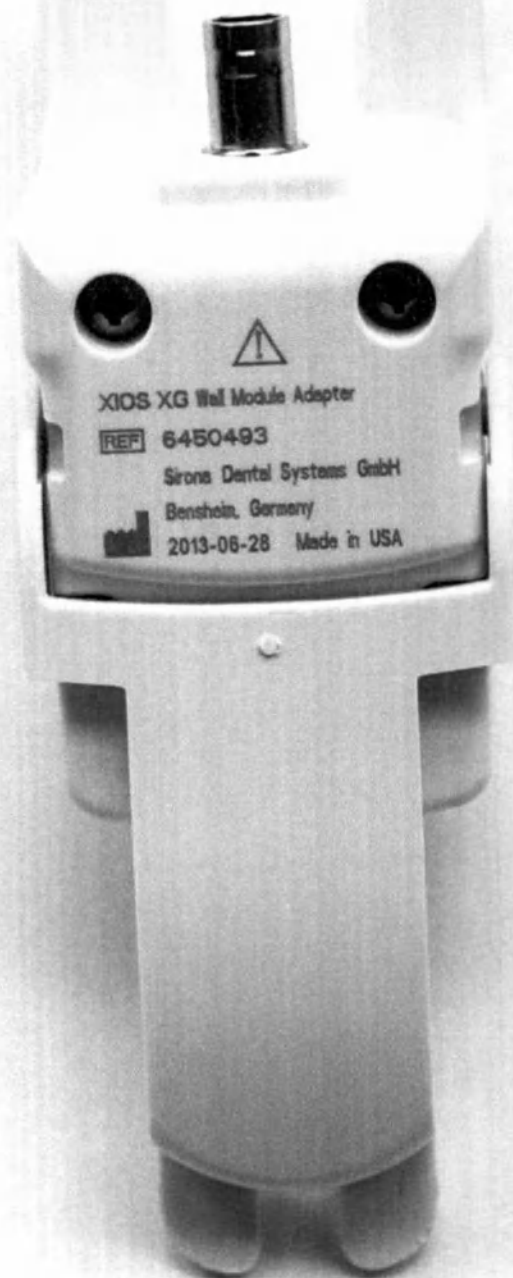


5. Настенный модуль для подключения датчиков.

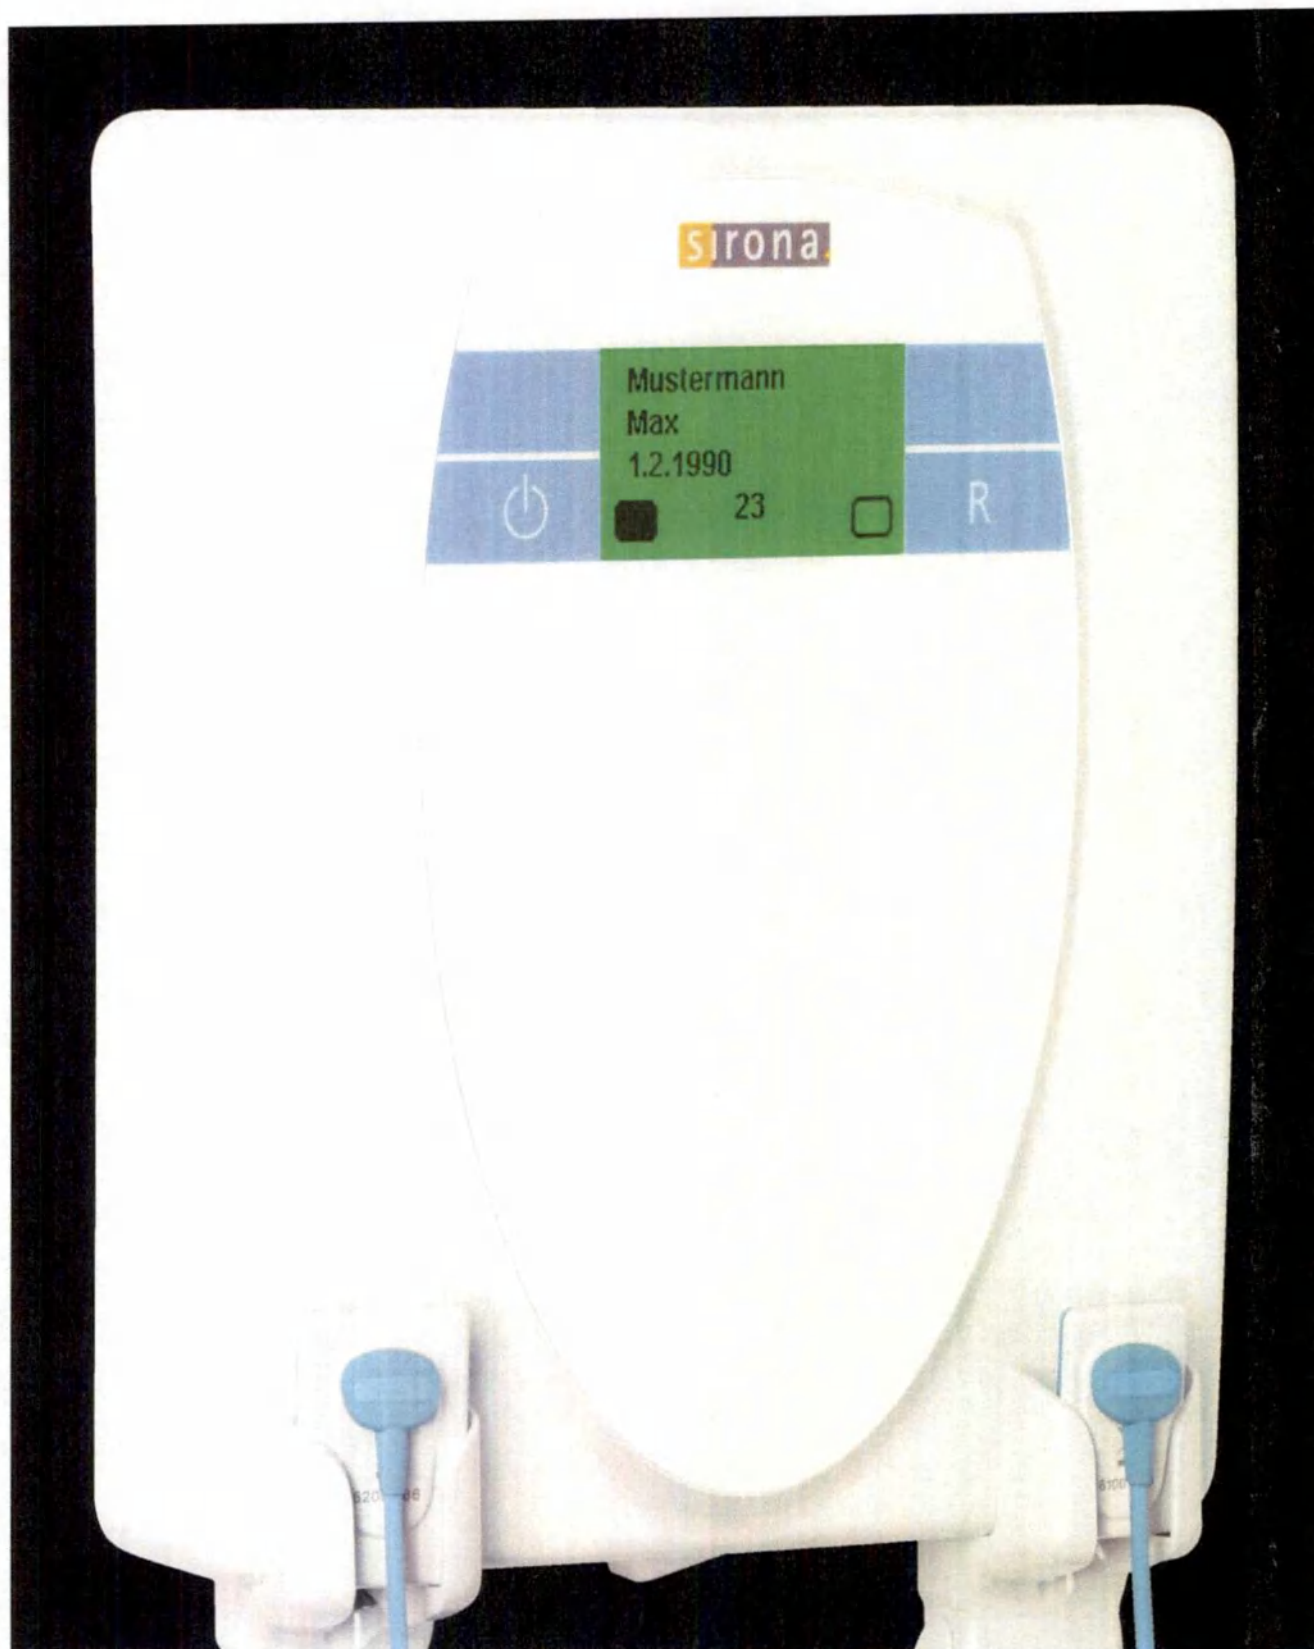


6. Кабель XIOS XG USB A/B.




7. Кабели XIOS XG USB: длиной 90 см.

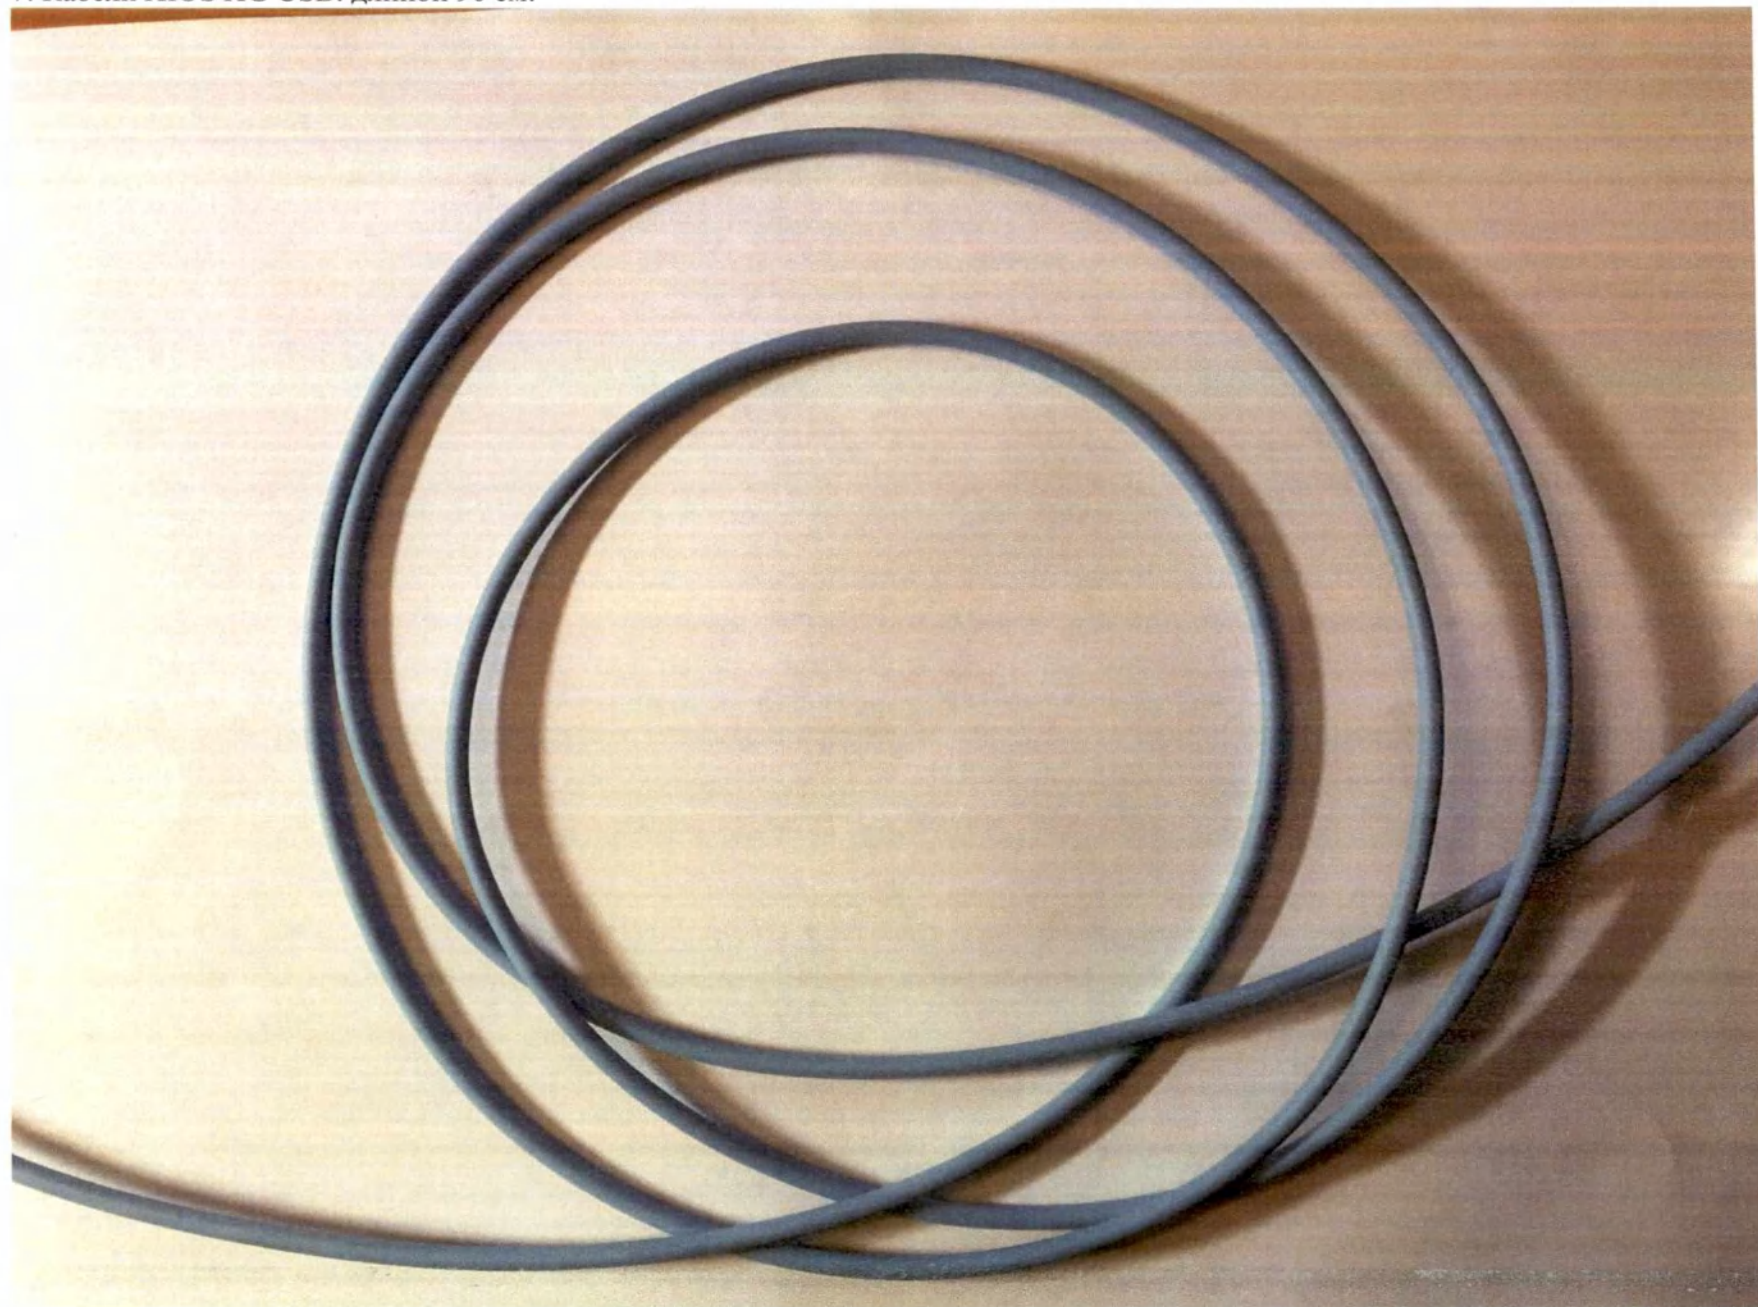

длиной 180 см.

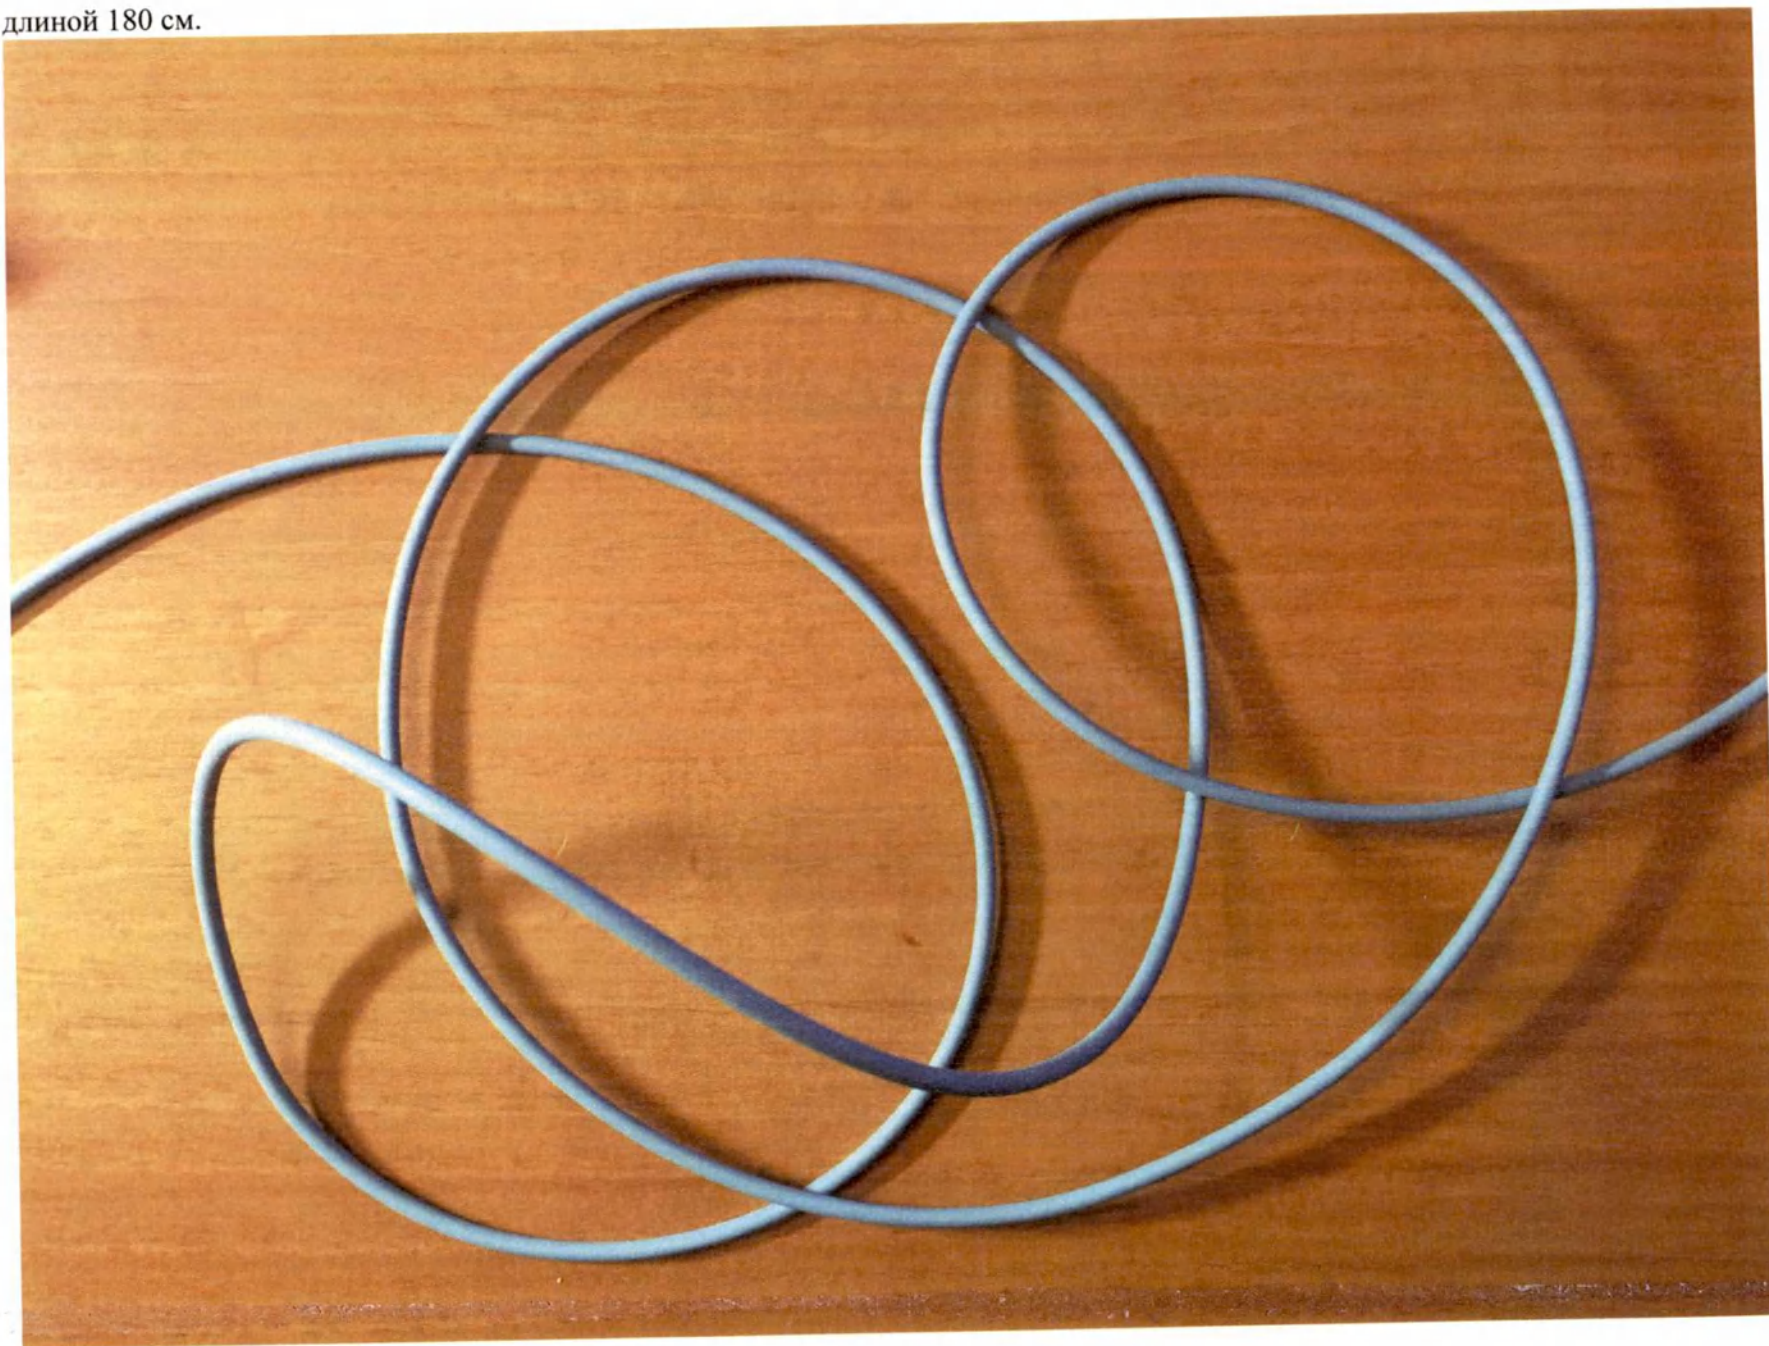


длиной 270 см

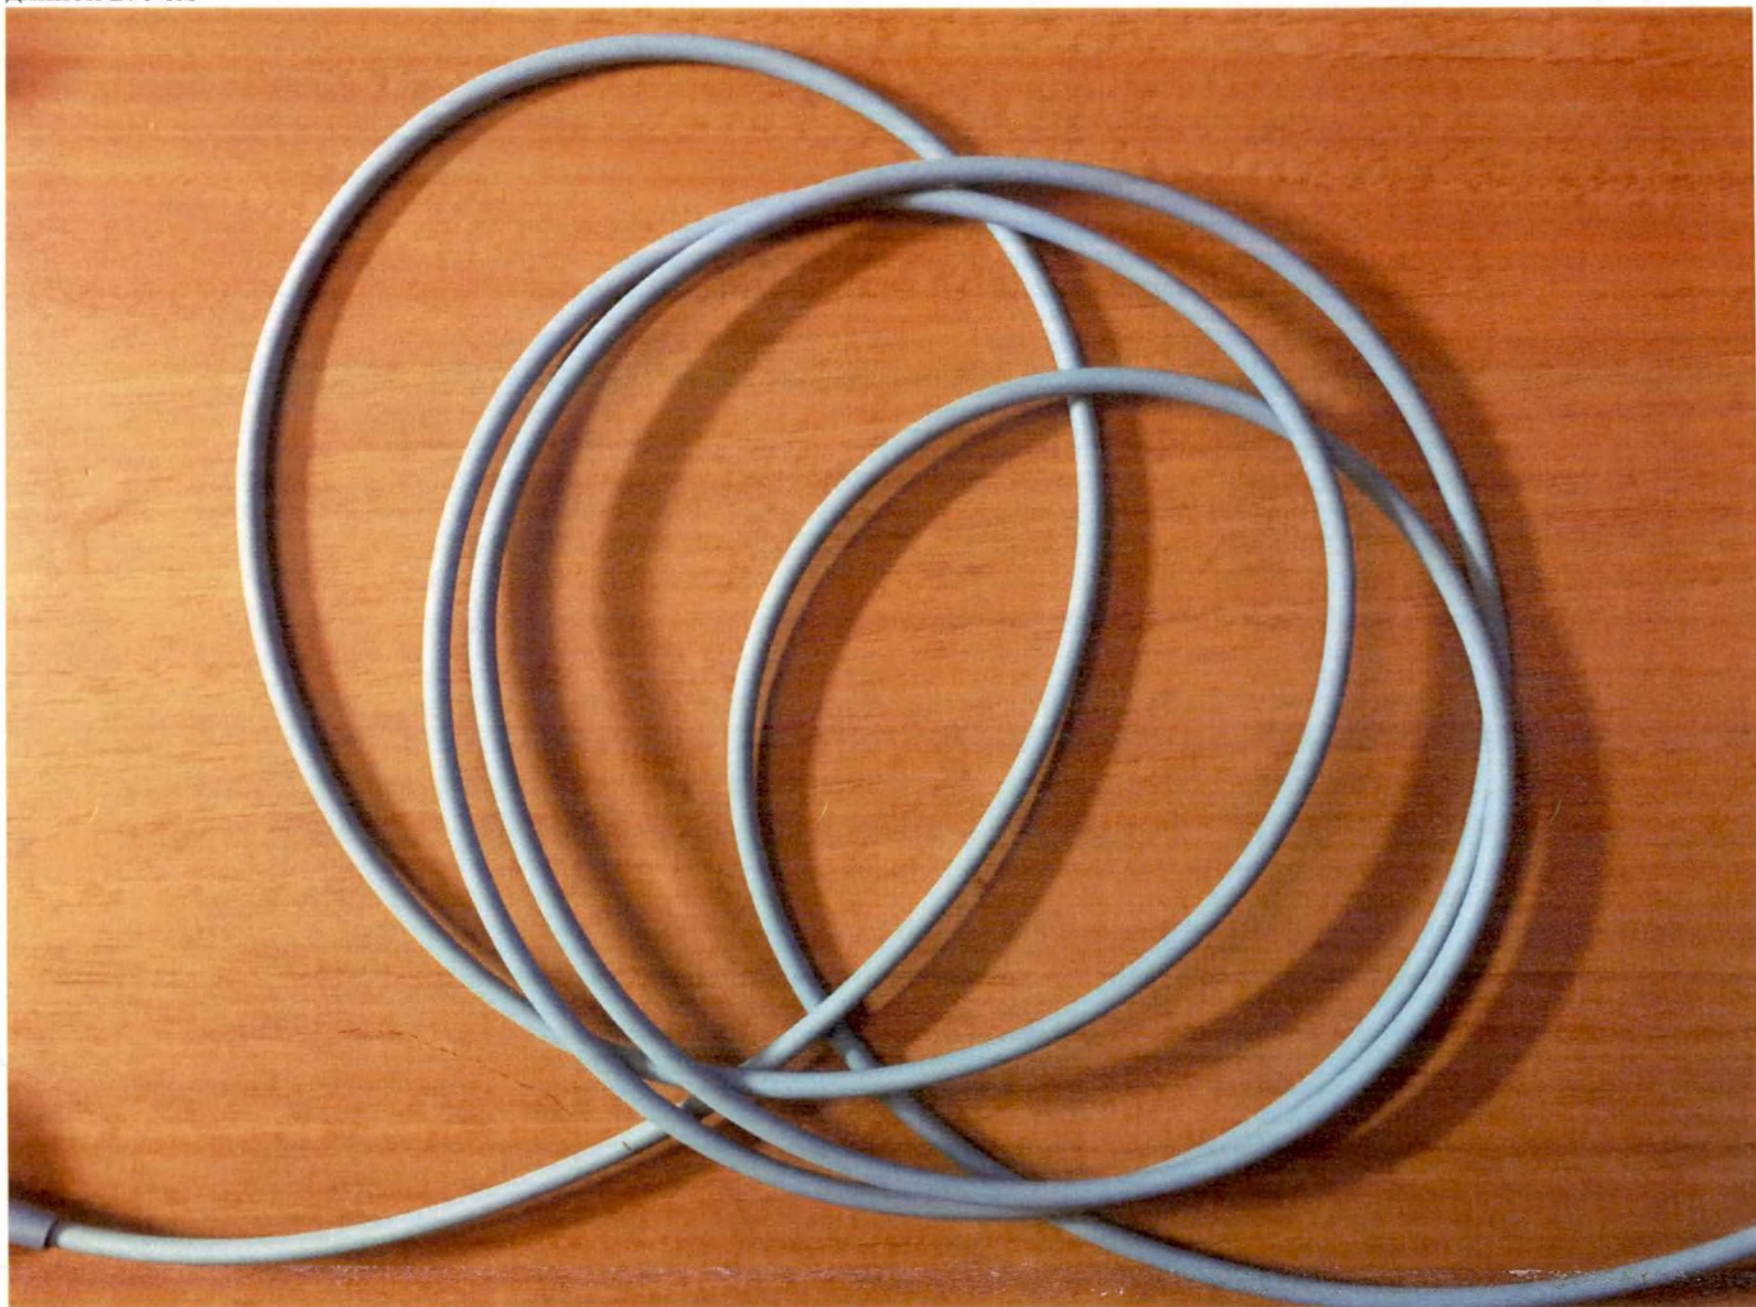

8. Стартовый комплект позиционеров для датчиков XIOS XG Starter Kit, в составе:




8.1. позиционеры в сборе;

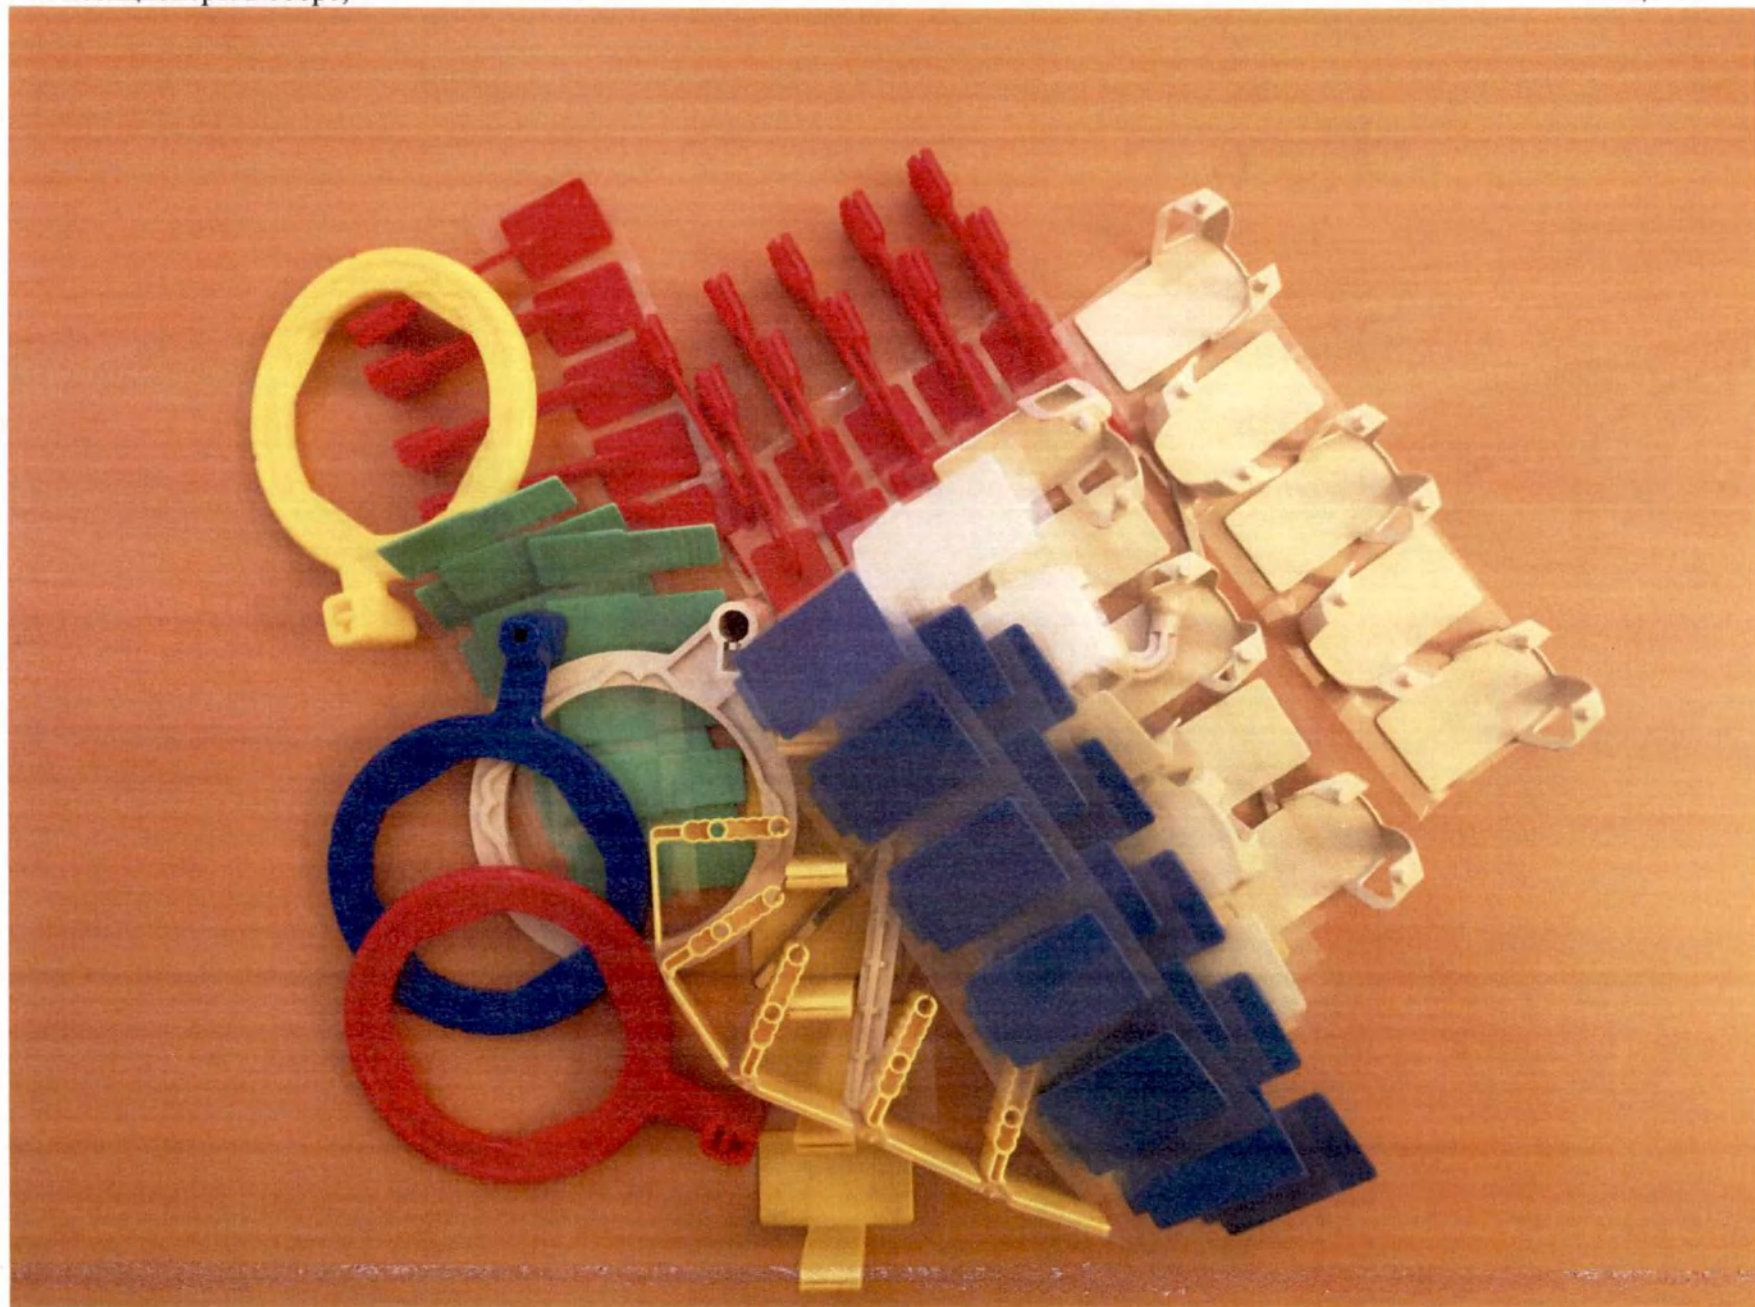


8.2. чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков.




9. Чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков.

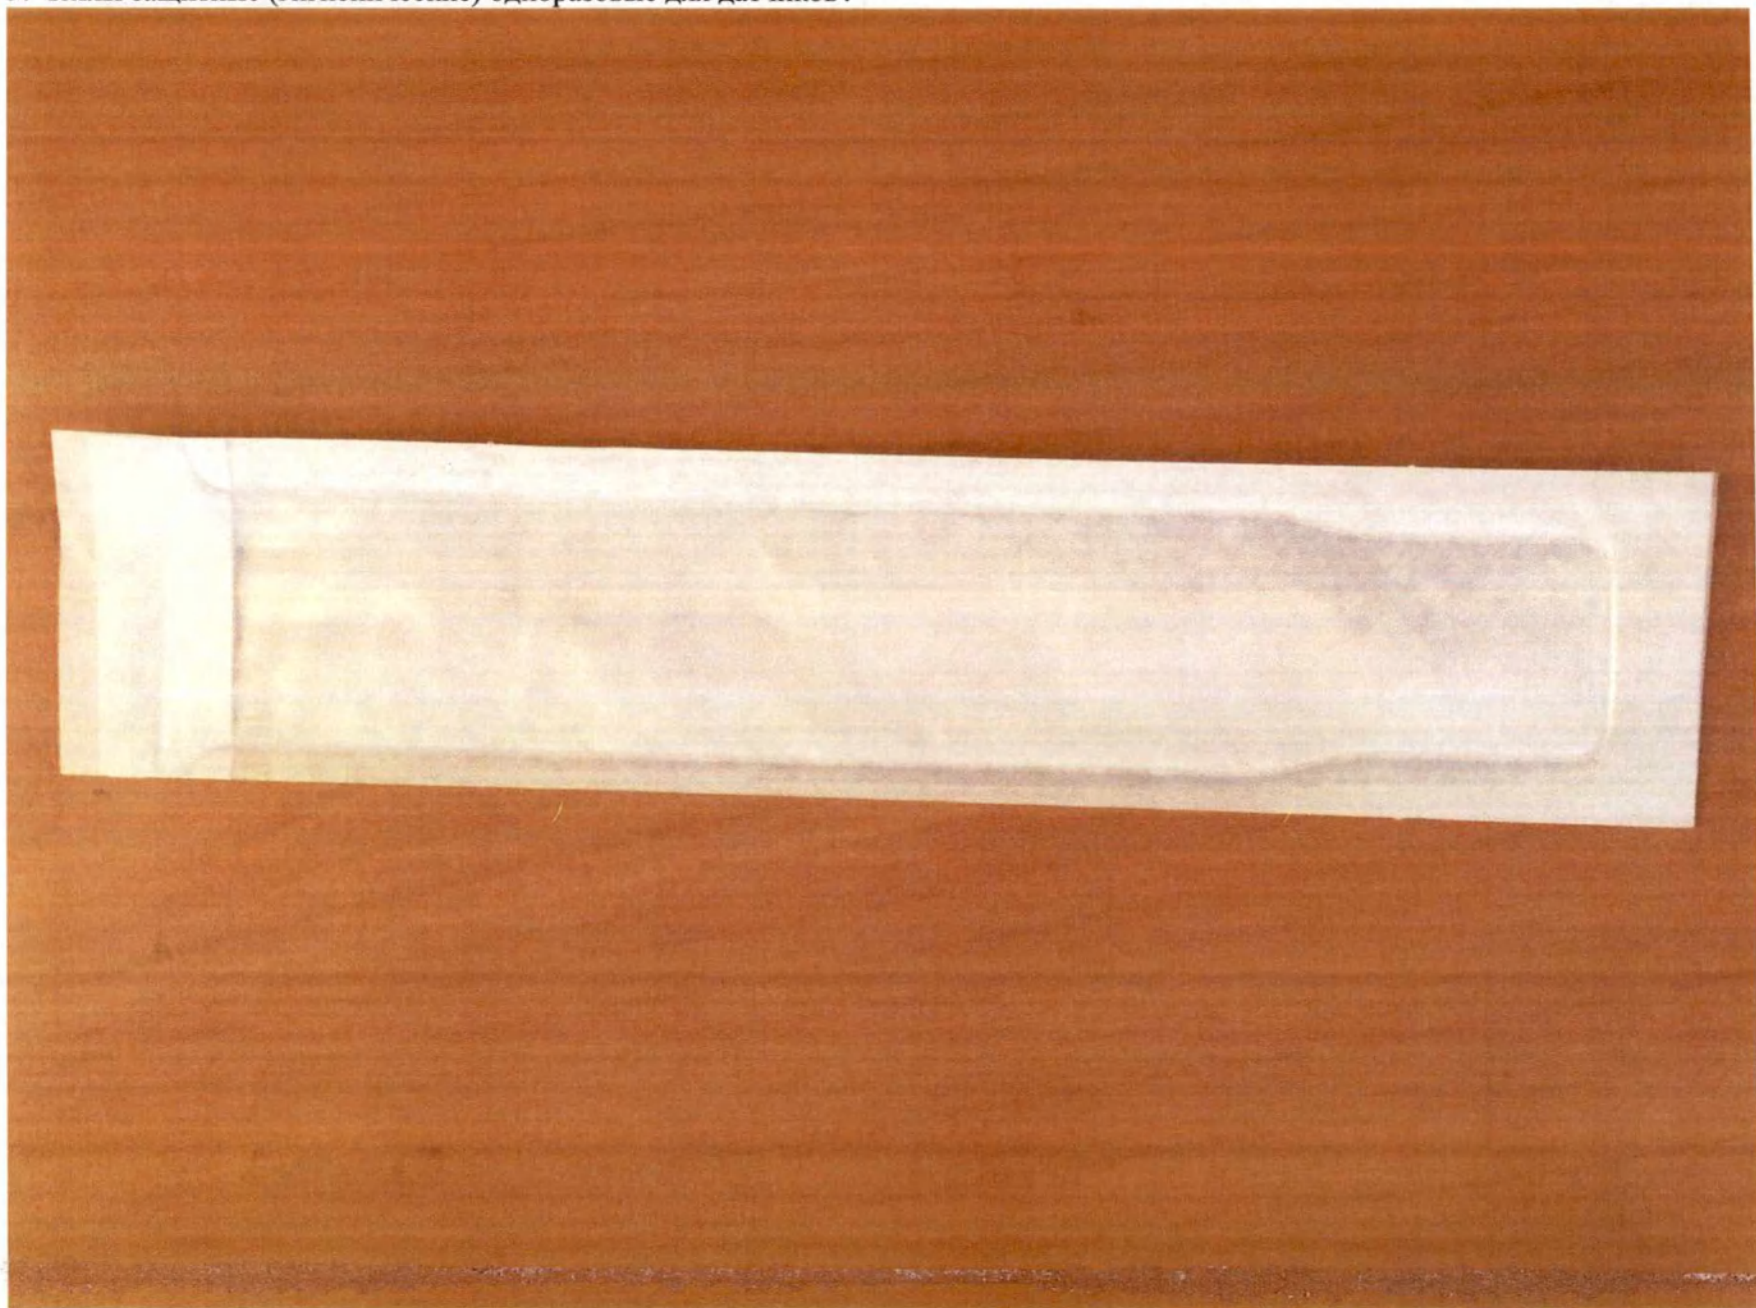


Синие

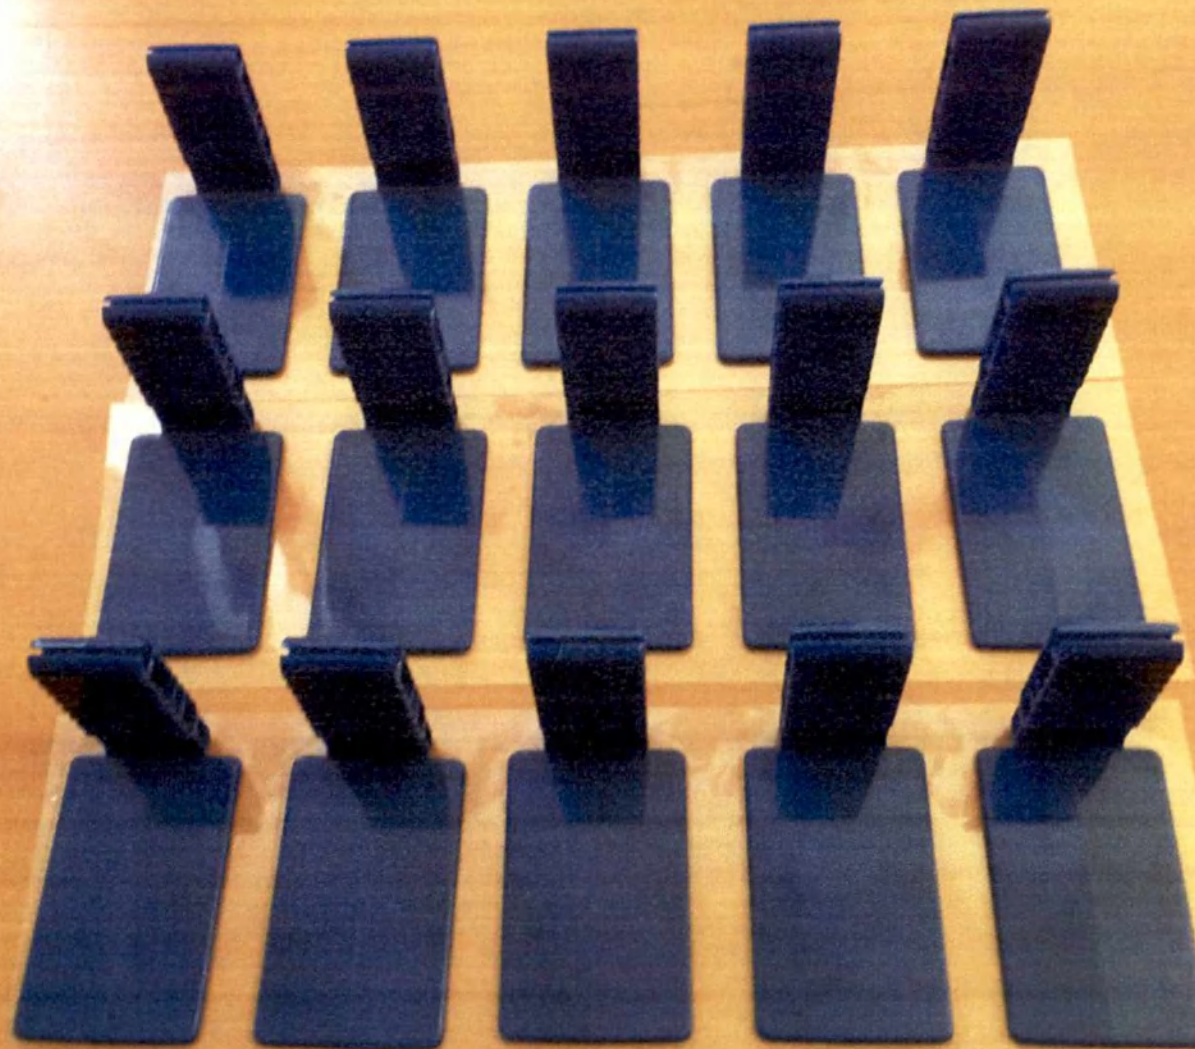


Желтые

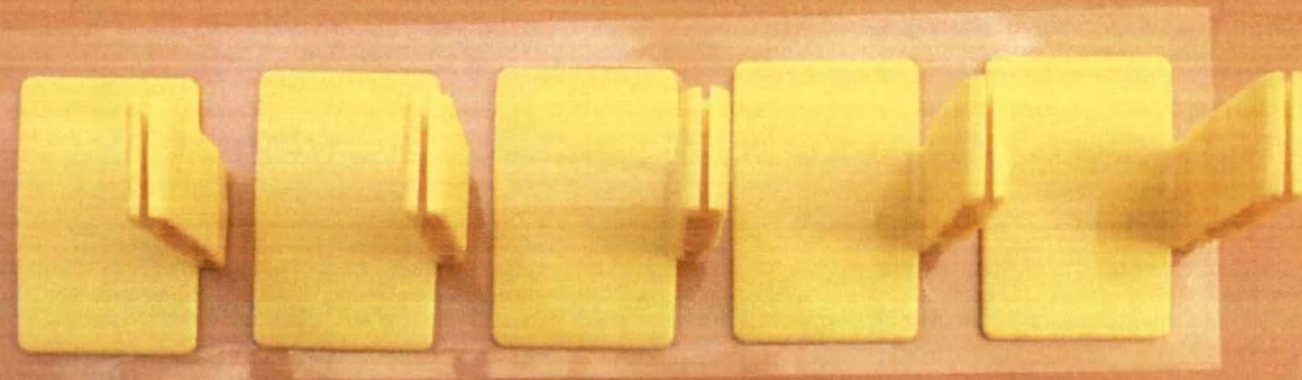


Красные

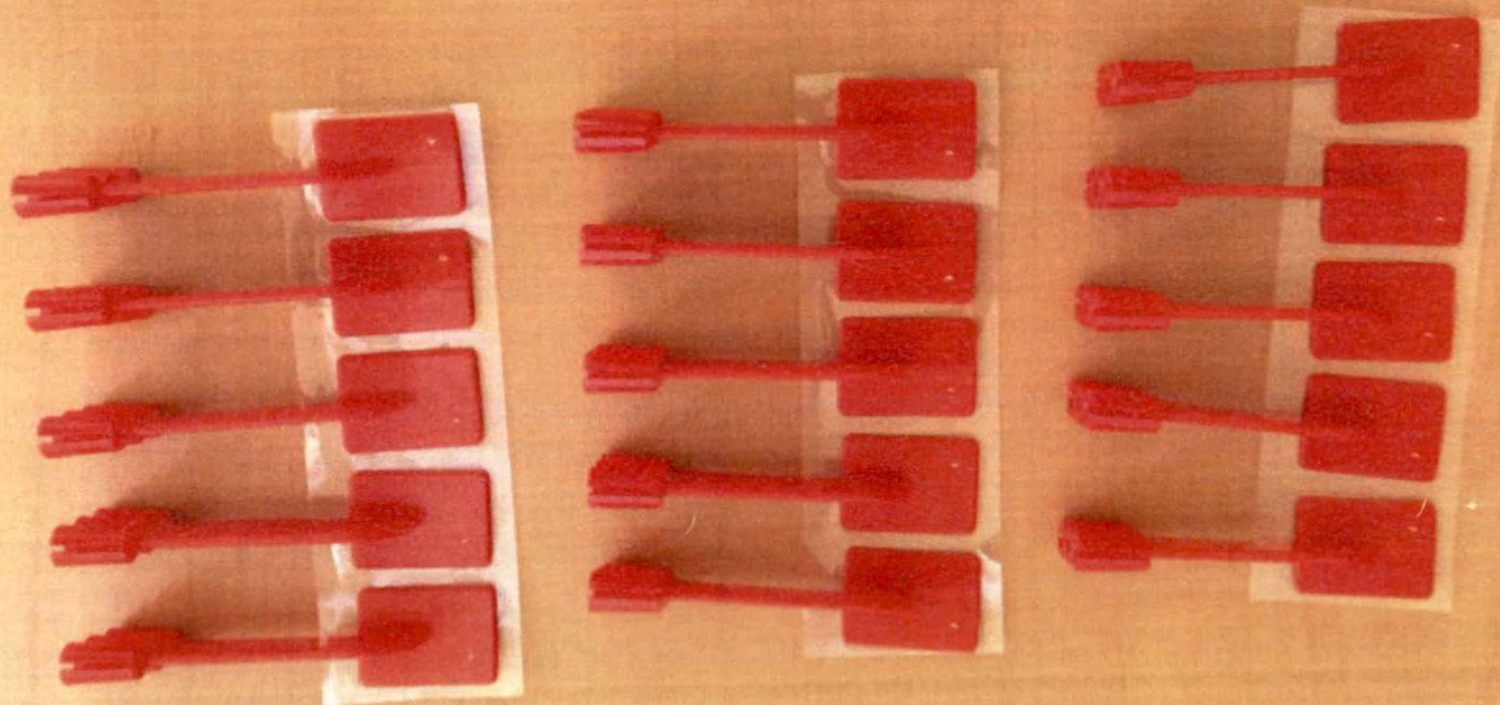


Зеленые

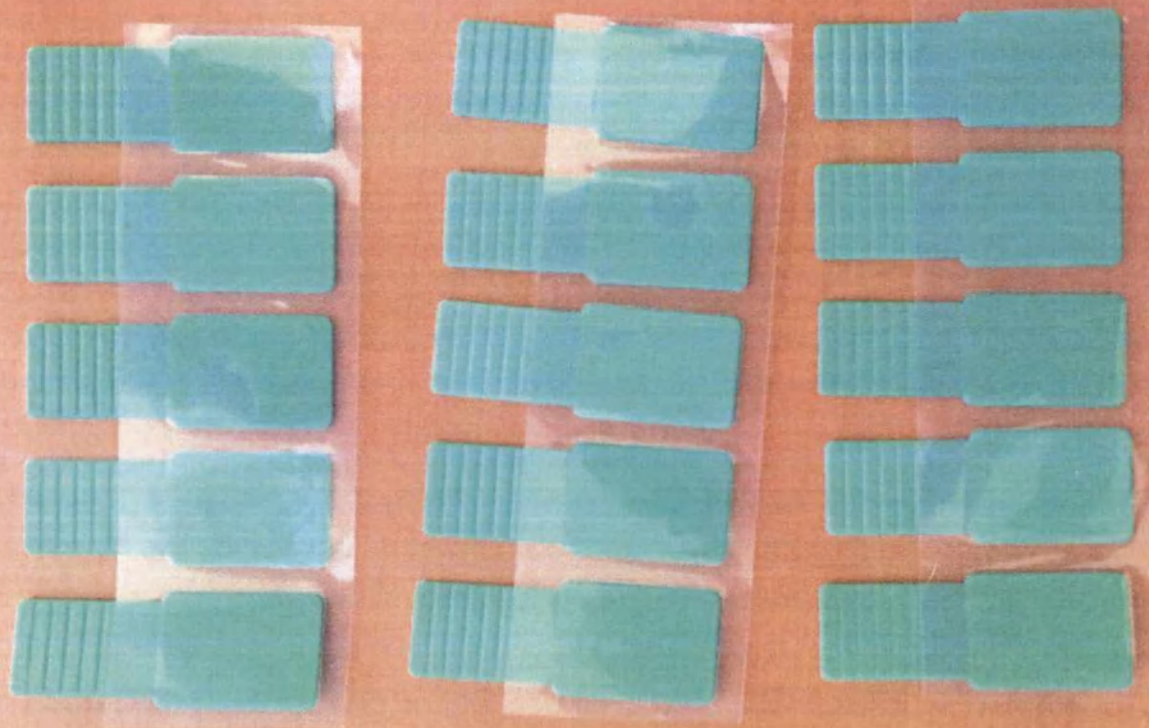


Сепар

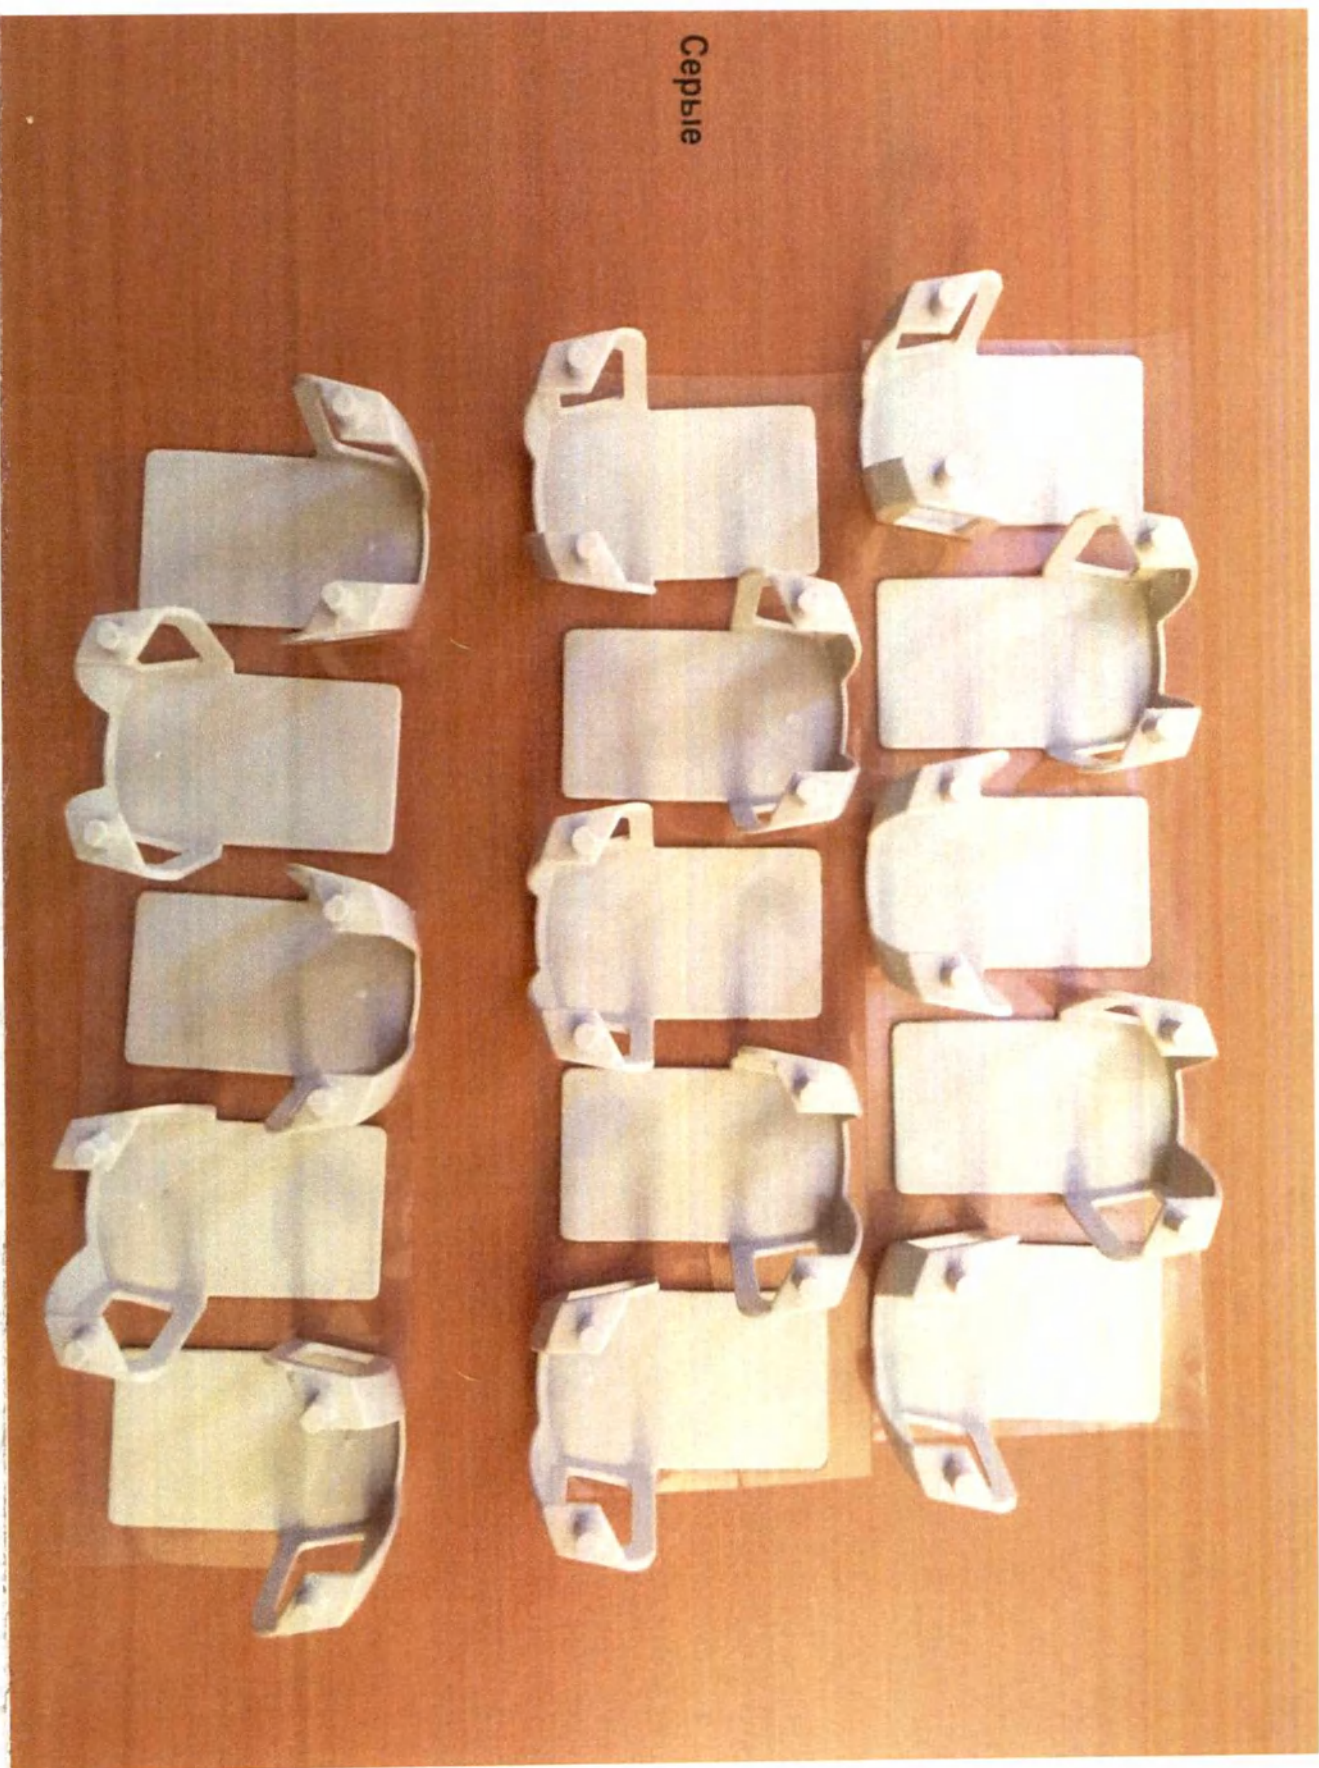


11. Комплекты для замены кабеля XIOS XG USB Cable Kit, в составе:

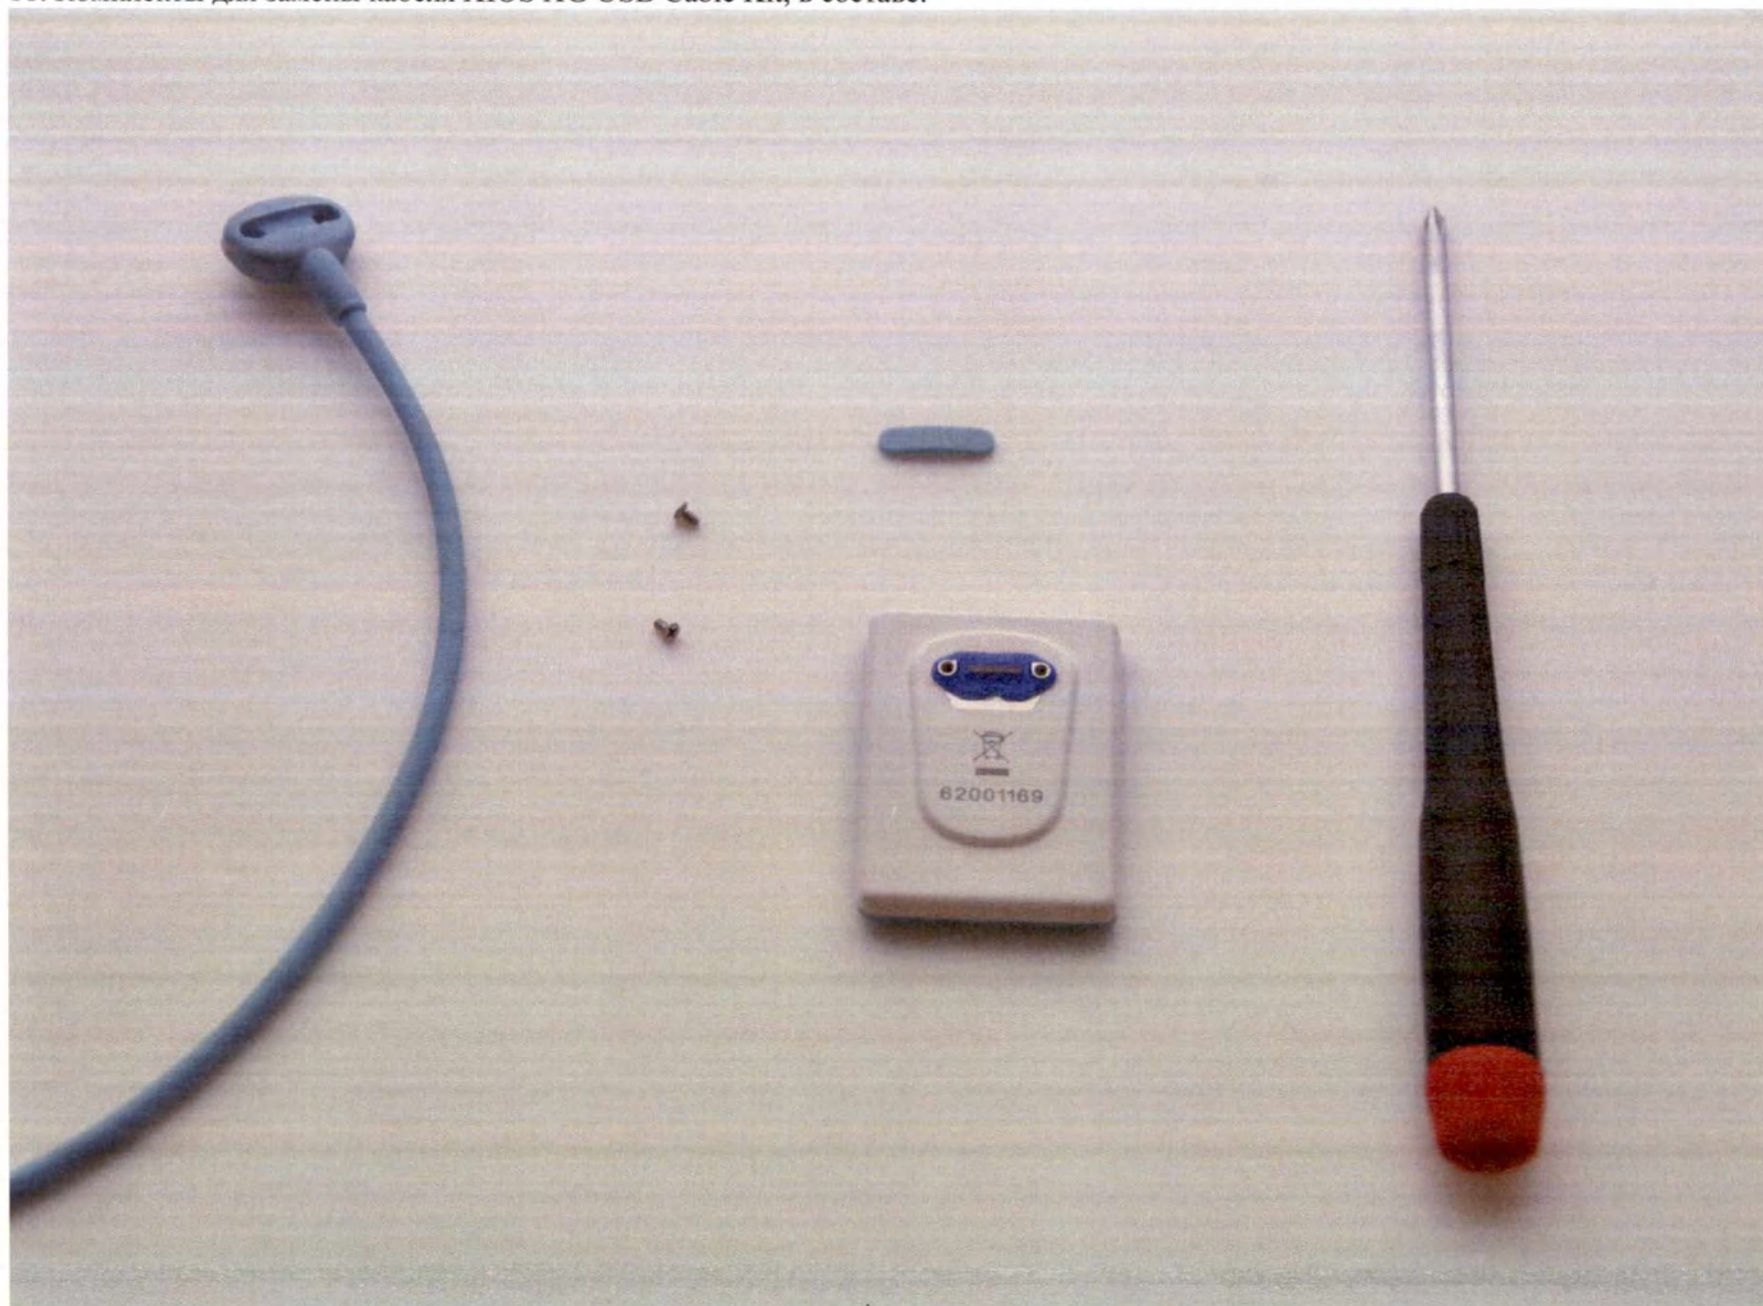


11.1. кабель XIOS XG USB: длиной 90 см; длиной 180 см; длиной 270 см;

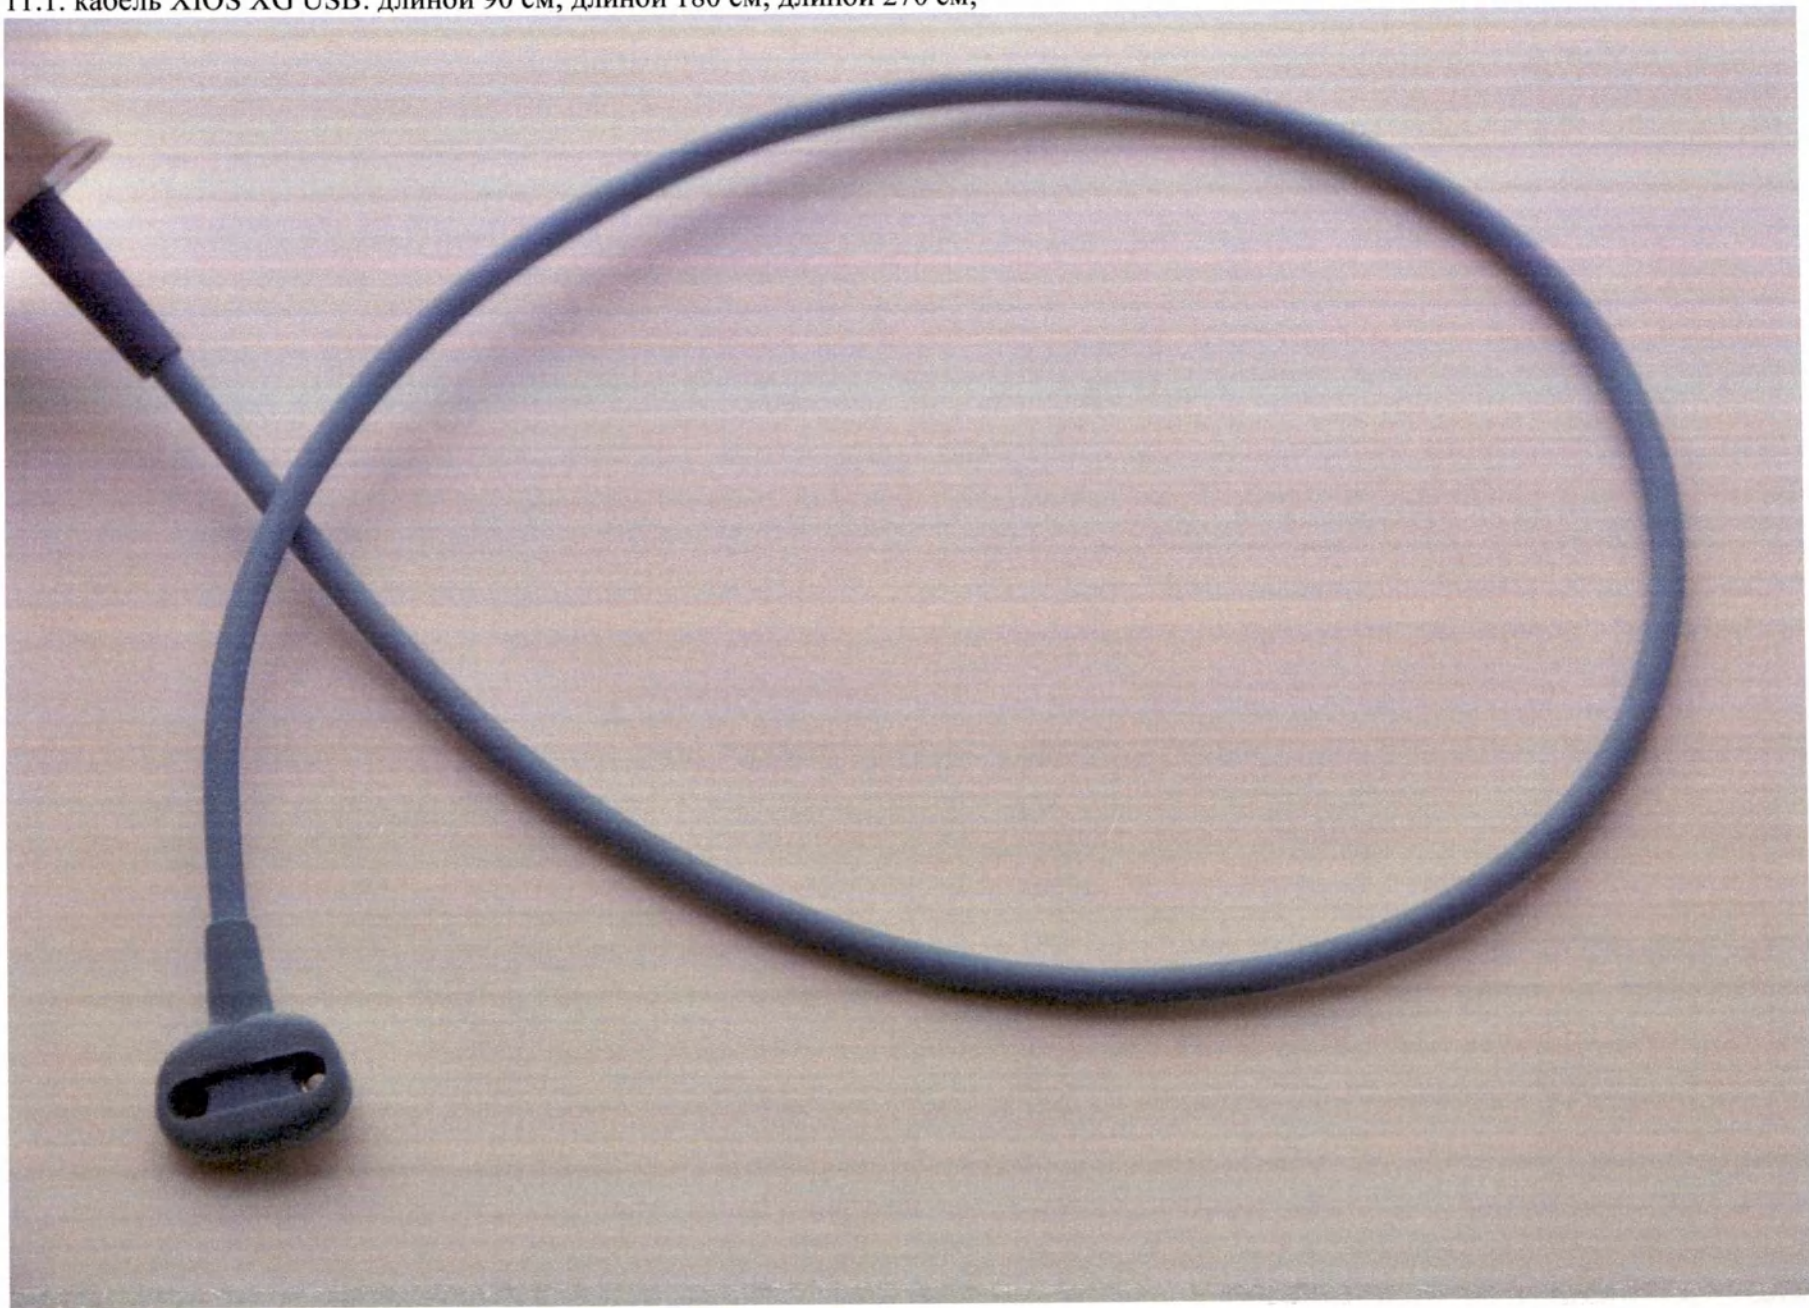


11.2. отвертка специальная;

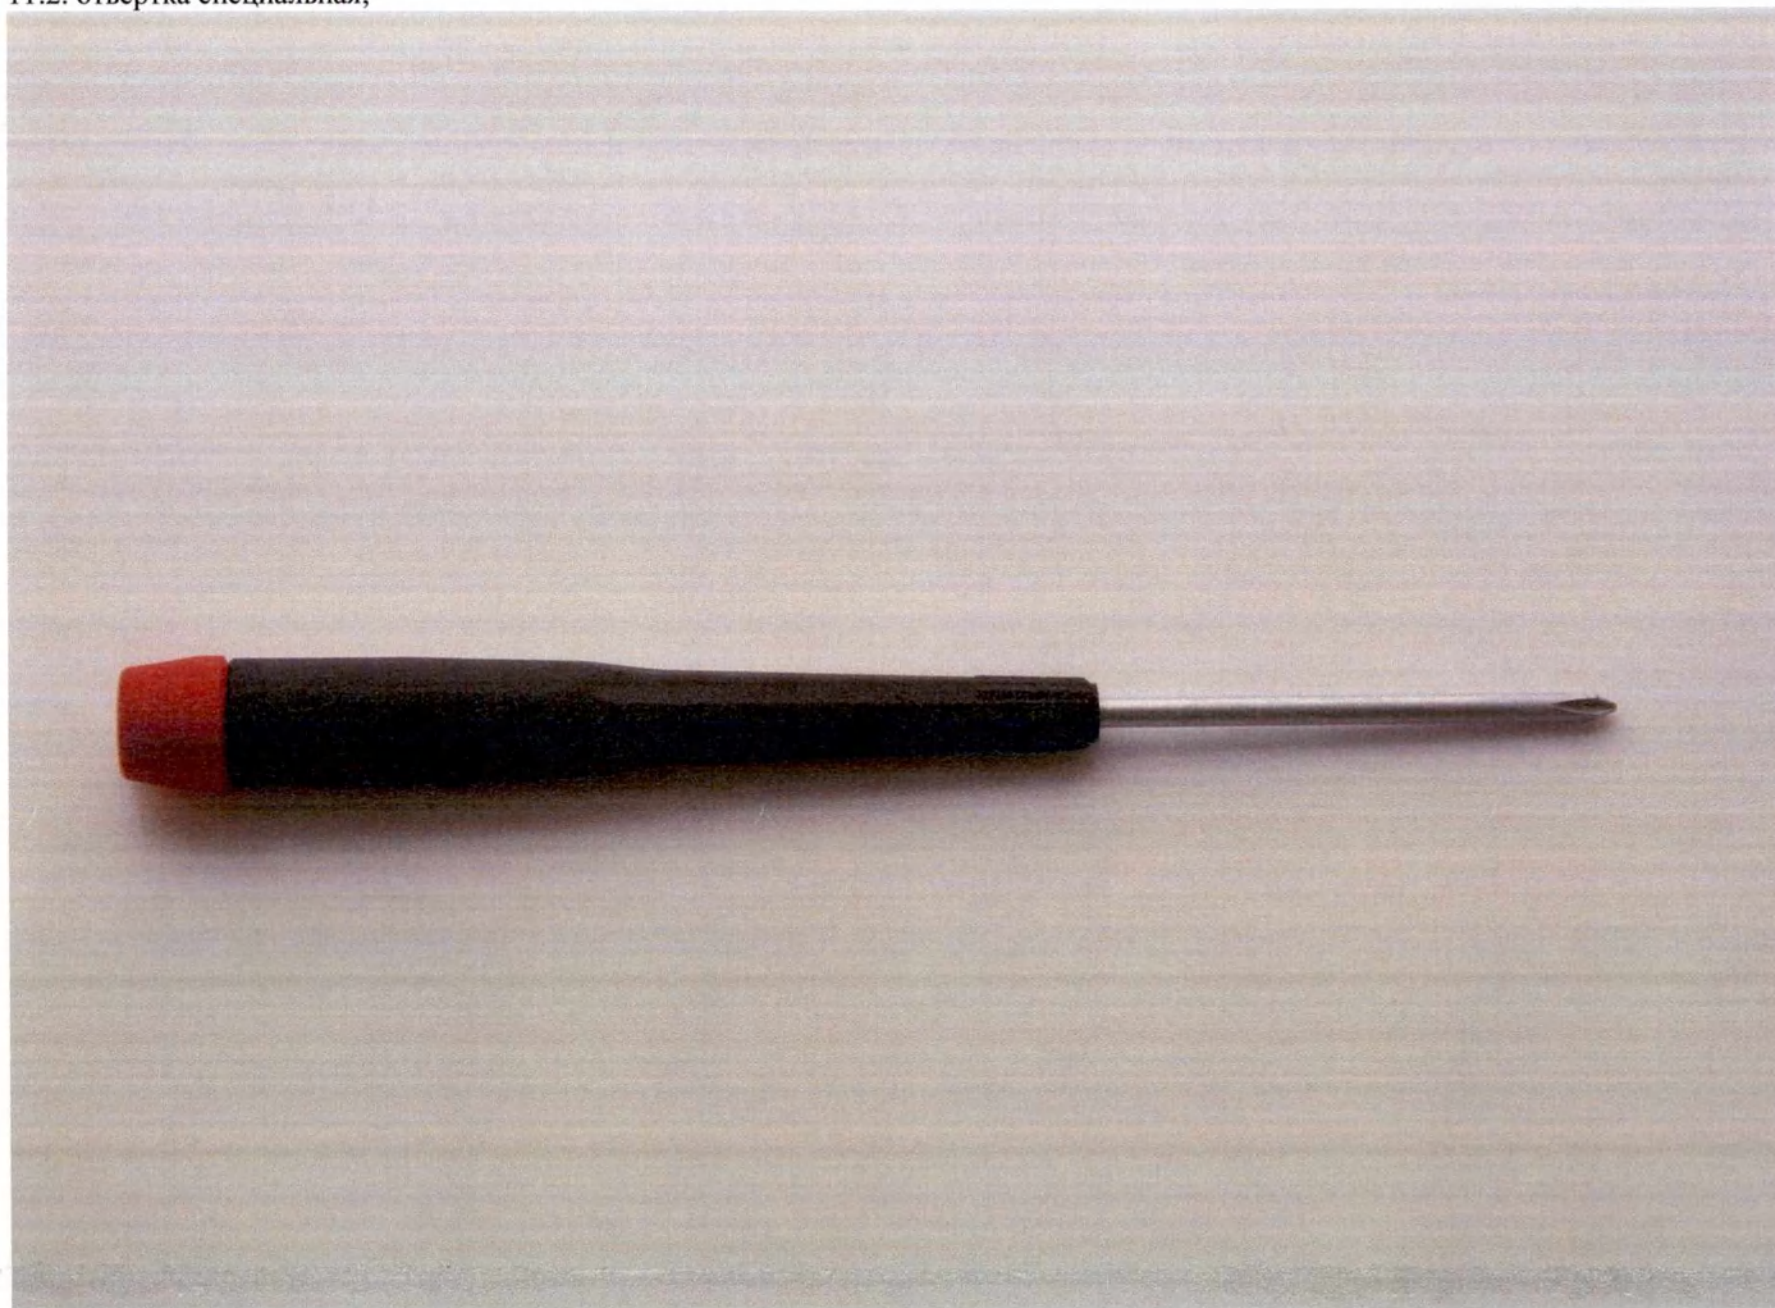


11.3. колпачки защитные резьбовые;



11.4. полосы из эластомера;

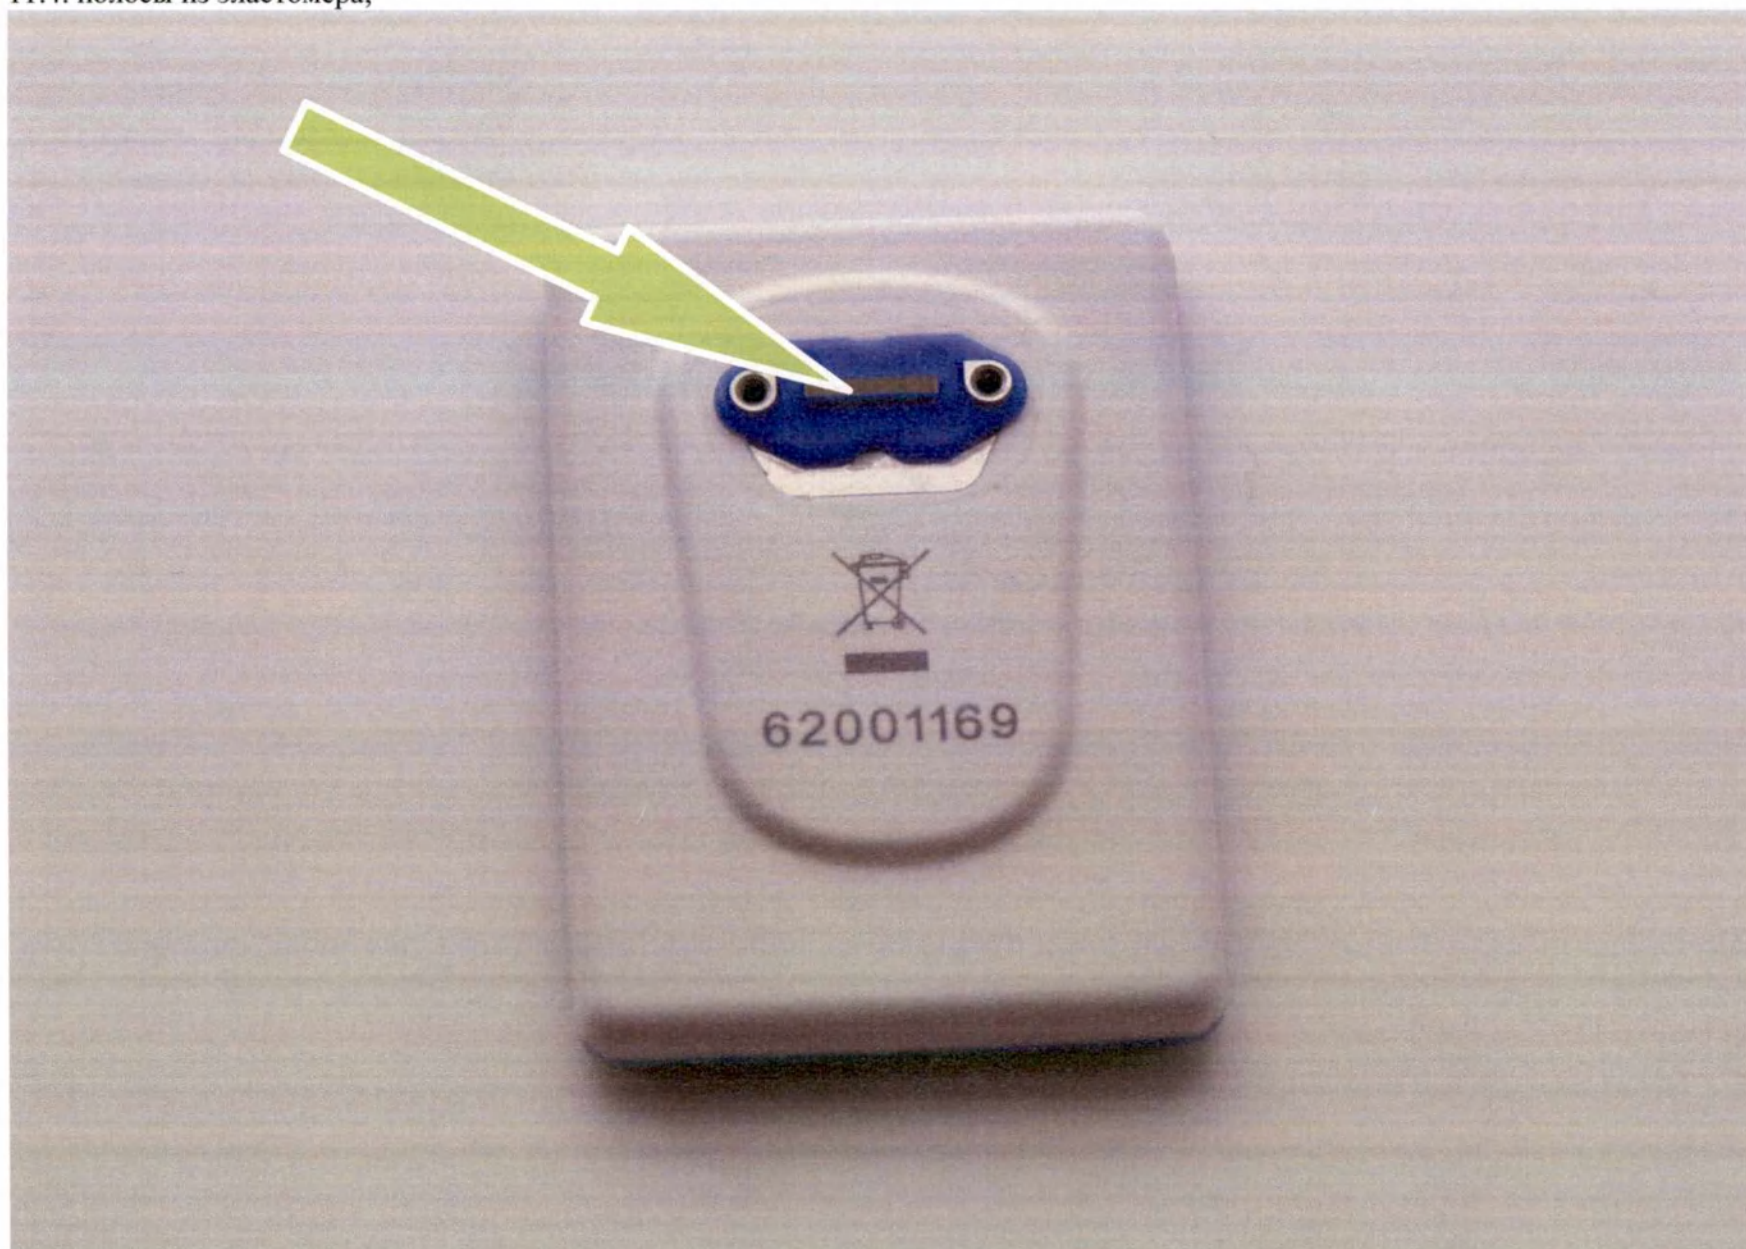

11.5. винты с плоской головкой.

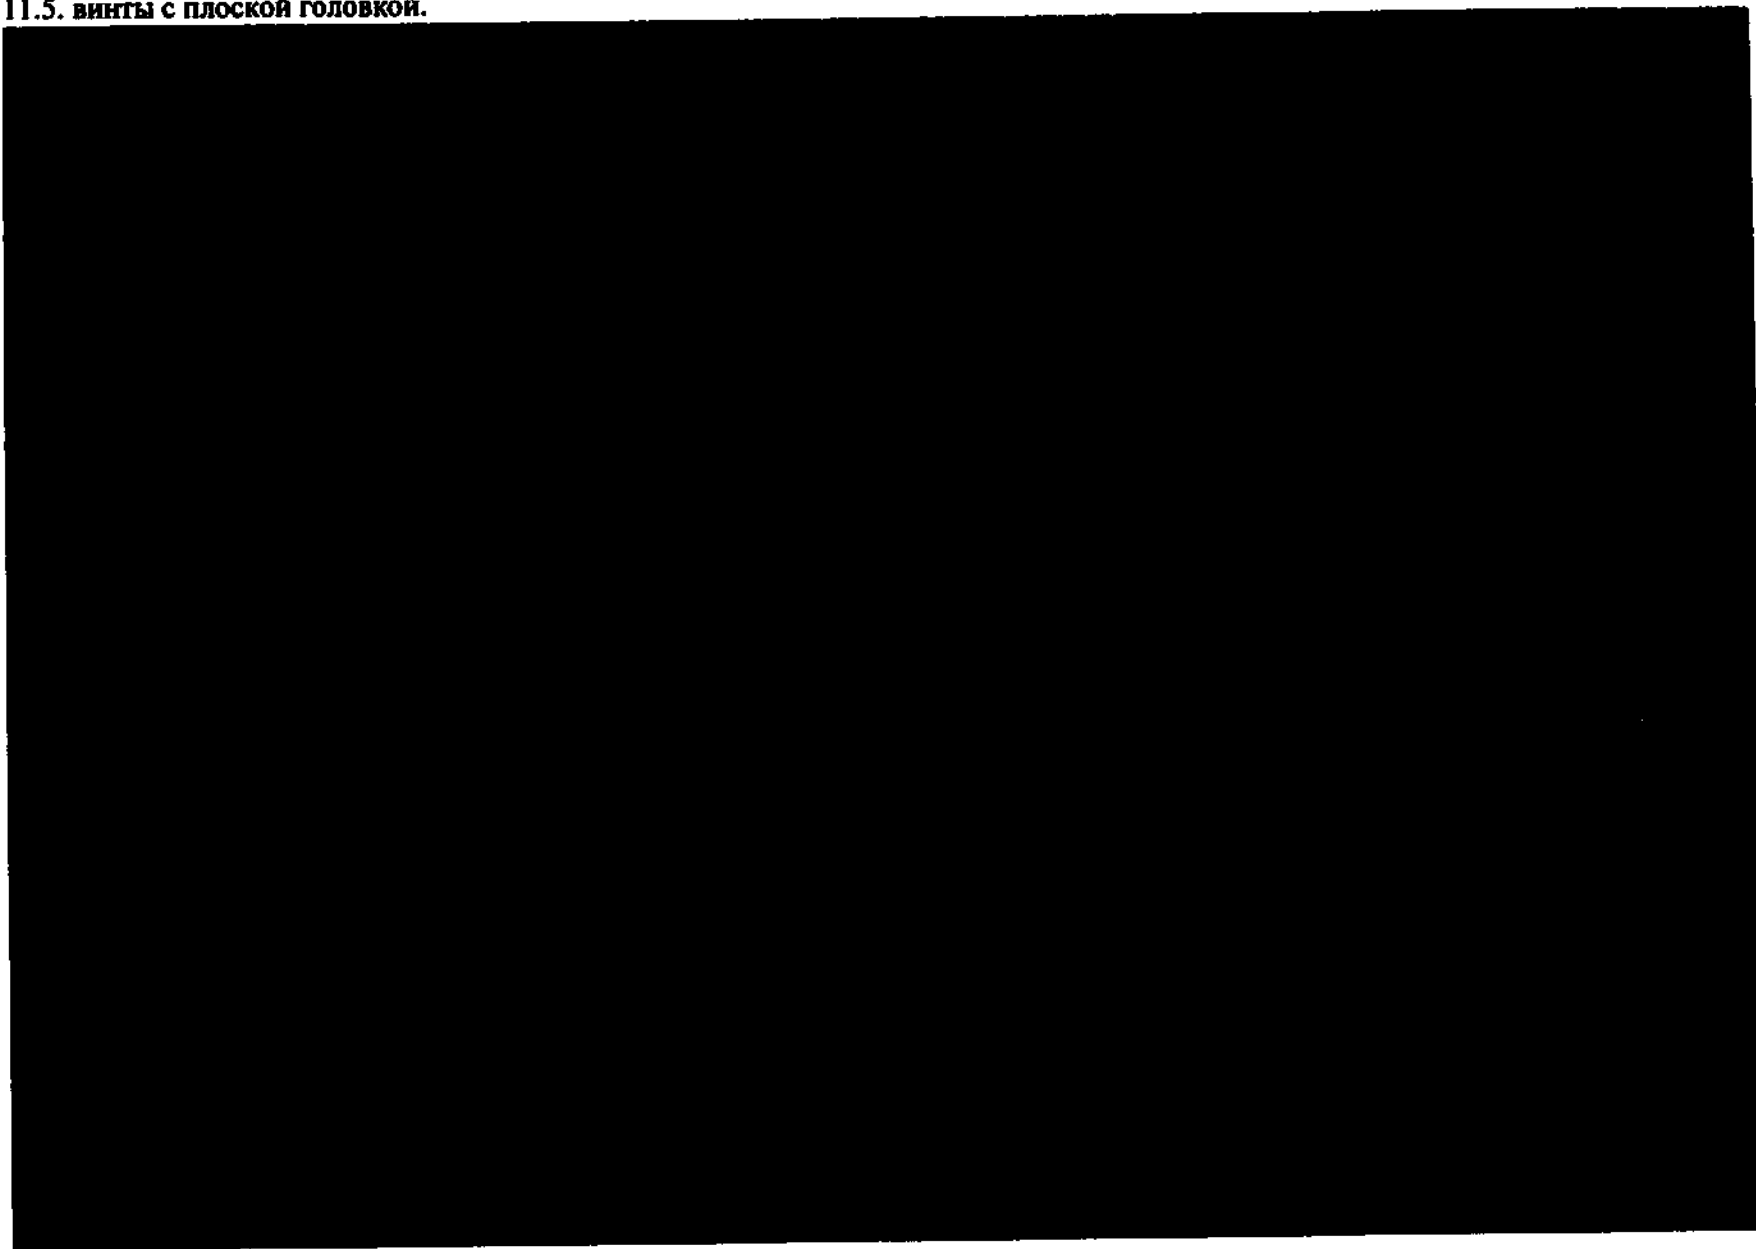

A white, rectangular, single-use medical device, likely a ventilator or respiratory circuit component, with a yellow base and a clear circular window on top. It has a small handle on the side and a label with technical specifications. The device is shown from a three-quarter perspective, highlighting its compact and functional design.

13. Ограничители поля излучения Heliodont Plus для датчика, размер 0 (белый); размер 1 (черный); размер 2 (синий)
размер 0 (белый)



размер 1 (черный)



размер 2 (синий)



14. Программное обеспечения SIDEXIS XG (SIDEXIS XG Standard) / SIDEXIS 4 на электронном носителе.



SIDEXIS 4

001-2013/08/07
(4.0 DE, EN, FR, ES, IT)



Alle Urheber- und Leistungsschutz-
rechte vorbehalten. Kein Verleih.
Keine unerlaubte Vervielfältigung.

All copyrights in the recorded works
and in the recorded performances
reserved. no lending. No unauthorized
duplication. No lease.

CE

0123 Rx only

Diese Produkt trägt das CE-Kennzeichen
mit den Bestimmungen der Richtlinie
93/42/EWG vom 14. Juni 1993 über
Medizinprodukte.

This produkt bears the CE label in
accordance with the provisions of the
Council Directive 93/42/EWG Of June 14,
1993 concerning medical devices.

©Sirona Dental Systems GmbH 2013

The Dental Company

sirona.

6456532 D 3592 000 000

Sirona Dental Systems GmbH

Fabrikstraße 31
D 64625 Bensheim

15. Программное обеспечение для модернизации SIDEXIS XG (SIDEXIS XG Standard) / SIDEXIS 4 - на электронном носителе.



SIDEXIS 4

001-2013/08/07
(4.0 DE, EN, FR, ES, IT)



©Sirona Dental Systems GmbH 2013

The Dental Company

sirona

6456532 D 3592 000 000

Sirona Dental Systems GmbH

Fabrikstraße 31
D 64625 Bensheim

Alle Urheber- und Leistungsschutz-
rechte vorbehalten. Kein Verleih.
Keine unerlaubte Vervielfältigung.

All copyrights in the recorded works
and in the recorded performances
reserved. no lending. No unauthorized
duplication. No lease.

CE
0123

Rx only

Diese Produkt trägt das CE-Kennzeichen
mit den Bestimmungen der Richtlinie
93/42/EWG vom 14. Juni 1993 über
Medizinprodukte.

This produkt bears the CE label in
accordance with the provisions of the
Council Directive 93/42/EWG Of June 14,
1993 concerning medical devices.


REF 64 11 578 D3610

002-15/04/13

(1.1 DE, EN, FR, ES, IT)

© Sirona Dental Systems GmbH 2013 • Fabrikstraße 31 • D-64625 Bensheim

XIOS XG Select/Supreme SIDEXIS XG Plugin

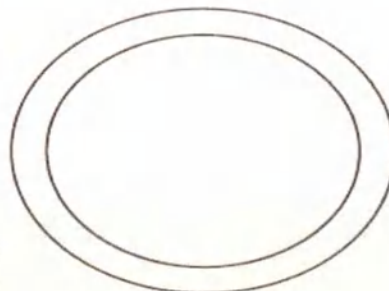

Alle Urheber- und Leistungs-
schutzrechte vorbehalten. Kein
Verleih. Keine unerlaubte Nutzung.
Keine unerlaubte Vervielfältigung.

All copyrights in the recorded works
and in the recorded performances
reserved. No lending. No
unauthorized duplication. No lease.

sirona.
The Dental Company

SIDEXIS XG Terminal Server Edition



The Dental Company **sirona.**

SIDICOM[®] WLS



The Dental Company

sirona.

SIDEXIS DICOM Query & Retrieve



The Dental Company **sirona.**

SIDICOM PS



The Dental Company

sirona